

ФОТОГРАФИЧЕСКЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов

**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech Zone,
611731 Chengdu, People's Republic of China**



 Specification: 2 × 100 Tests

Storage: 2°C–8°C Protect from direct sunlight

REF Cat No.: IM4404052  Production date: 20230825

LOT Lot No.: 0823031  Expiry date: 20240825



[01] 06950617423393
[10] 0823031
[11] 230825
[17] 241125
[21] 5W2307030160001058

FT3 (CLIA)

FT3



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (ТЗ свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов»



maccura



IVD

生产许可证编号: 川食药监械生产许20150064号

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号:

川械注准20182400128

注意事项: 其他内容详见说明书

EC REP Shanghai International Holding Corp.GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80,20537
Hamburg, Germany

FT3



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司

住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号

电话: + 86 28 8782 6777

传真: + 86 28 8782 5783

邮编: 611731

邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.

Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731

Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel: +86 28 8782 6777


Fax: +86 28 8782 5783

E-mail: maccura@maccura.com

www.maccura.com




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов»

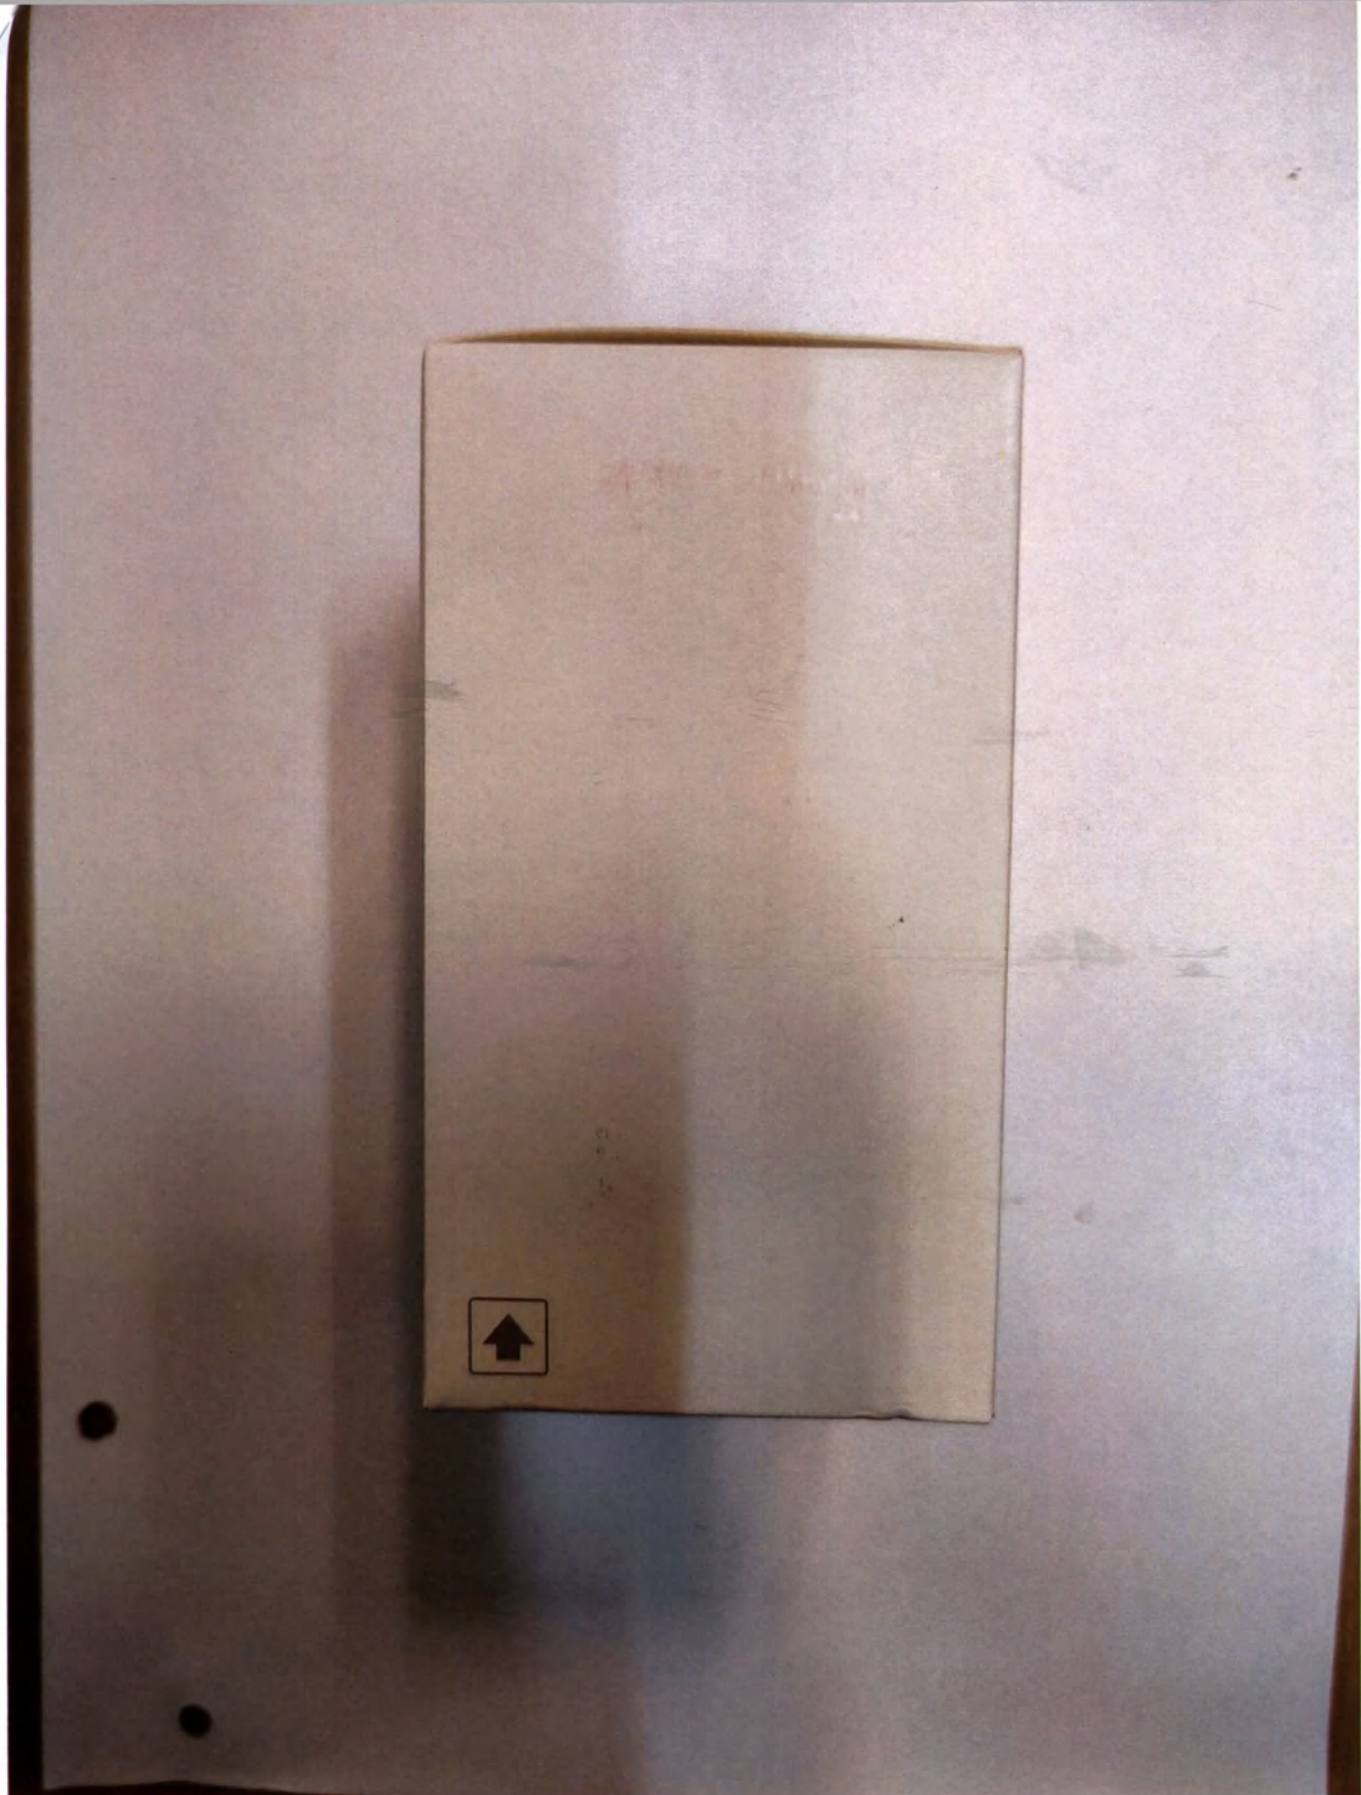


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура і (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов»




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура і (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов»

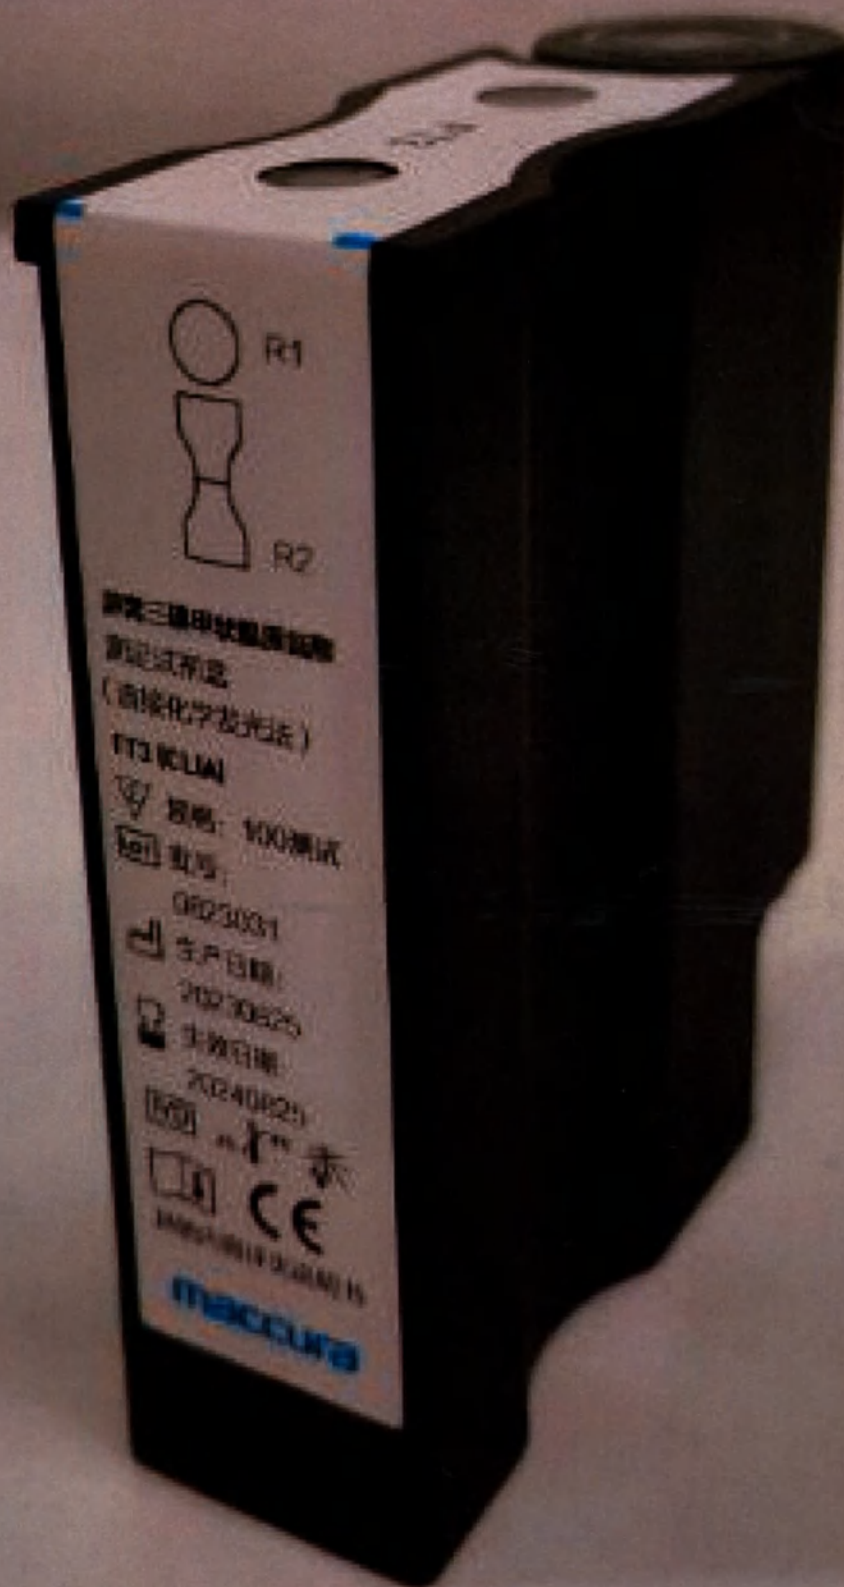


Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов»

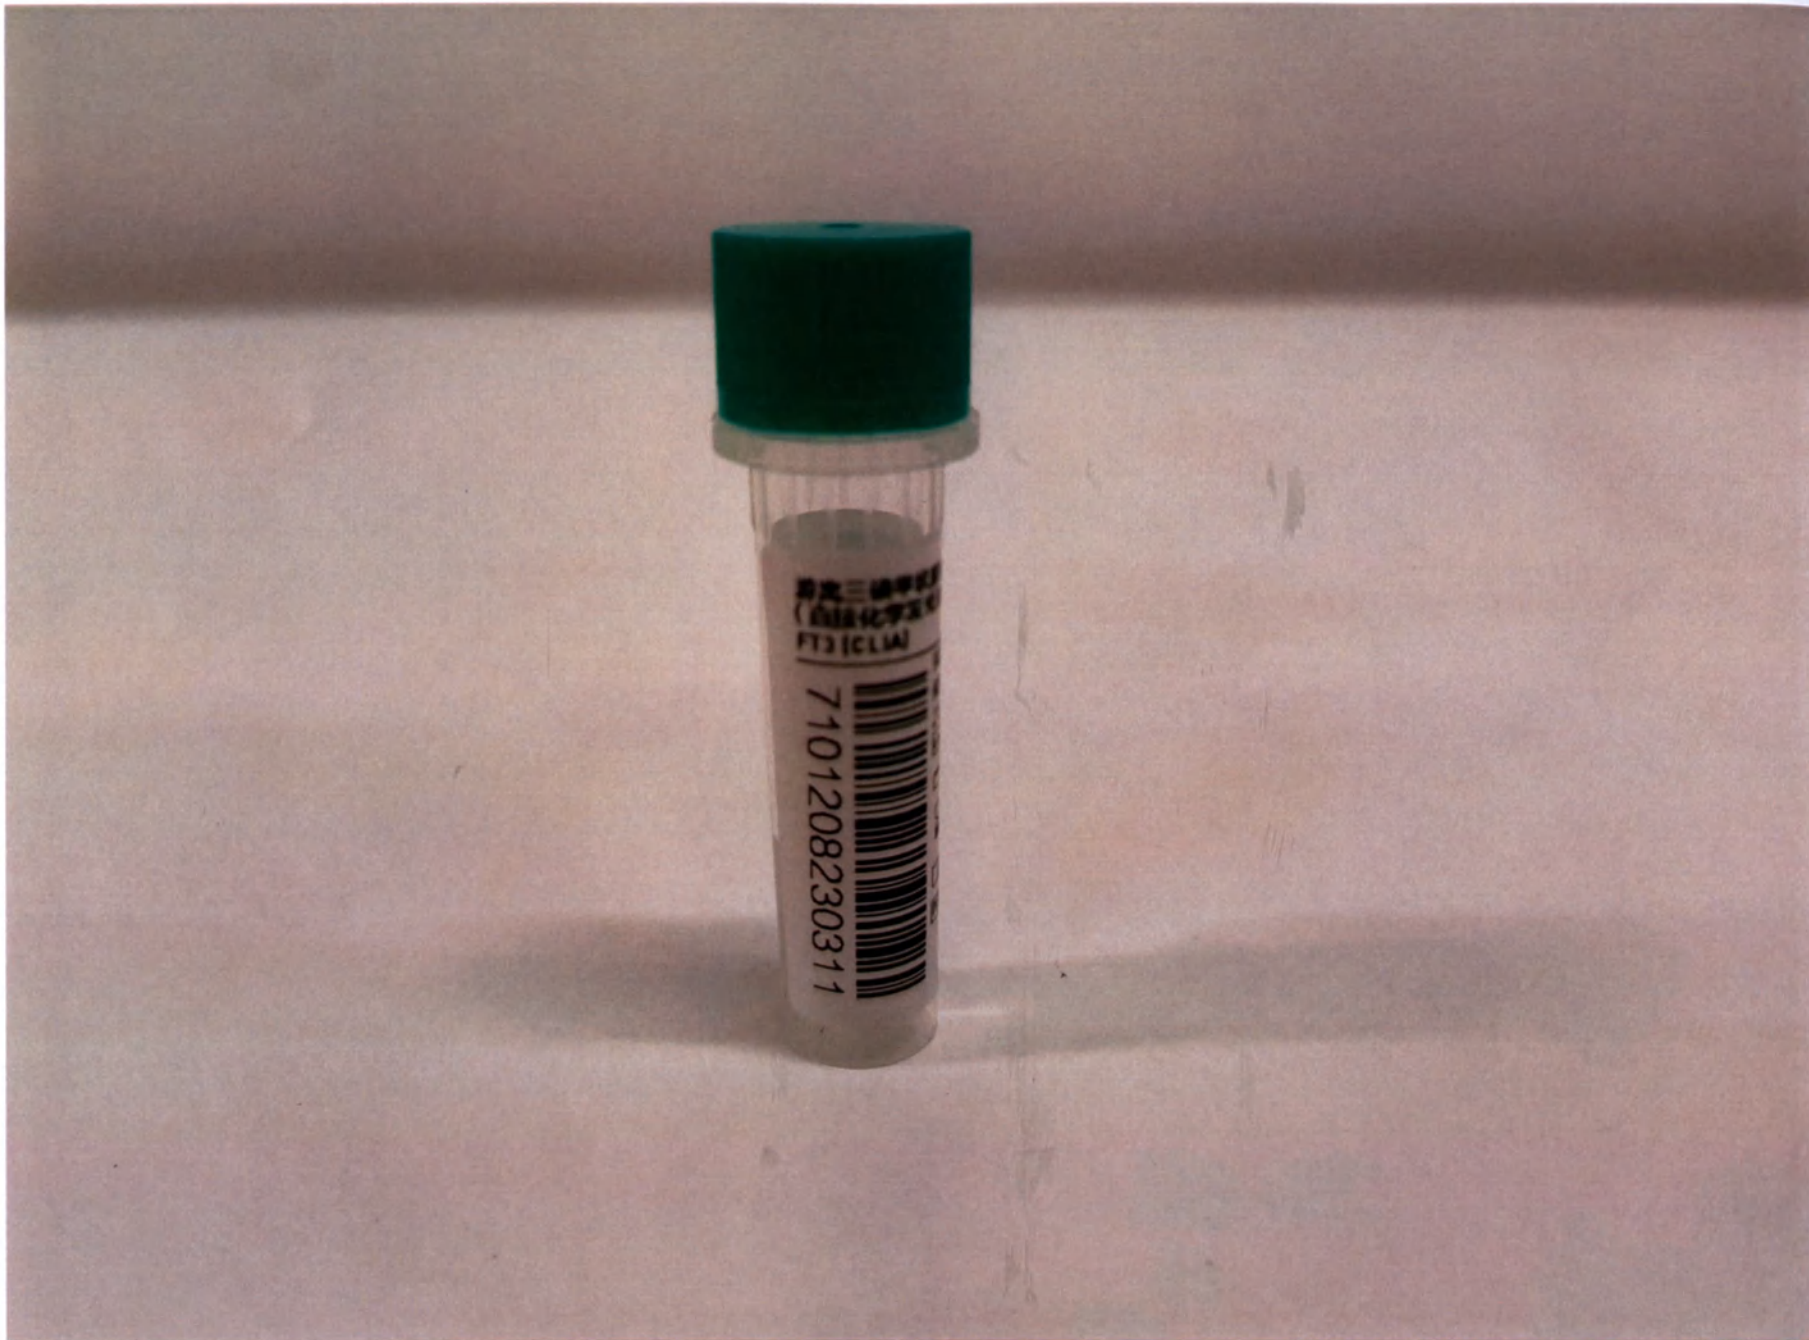


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

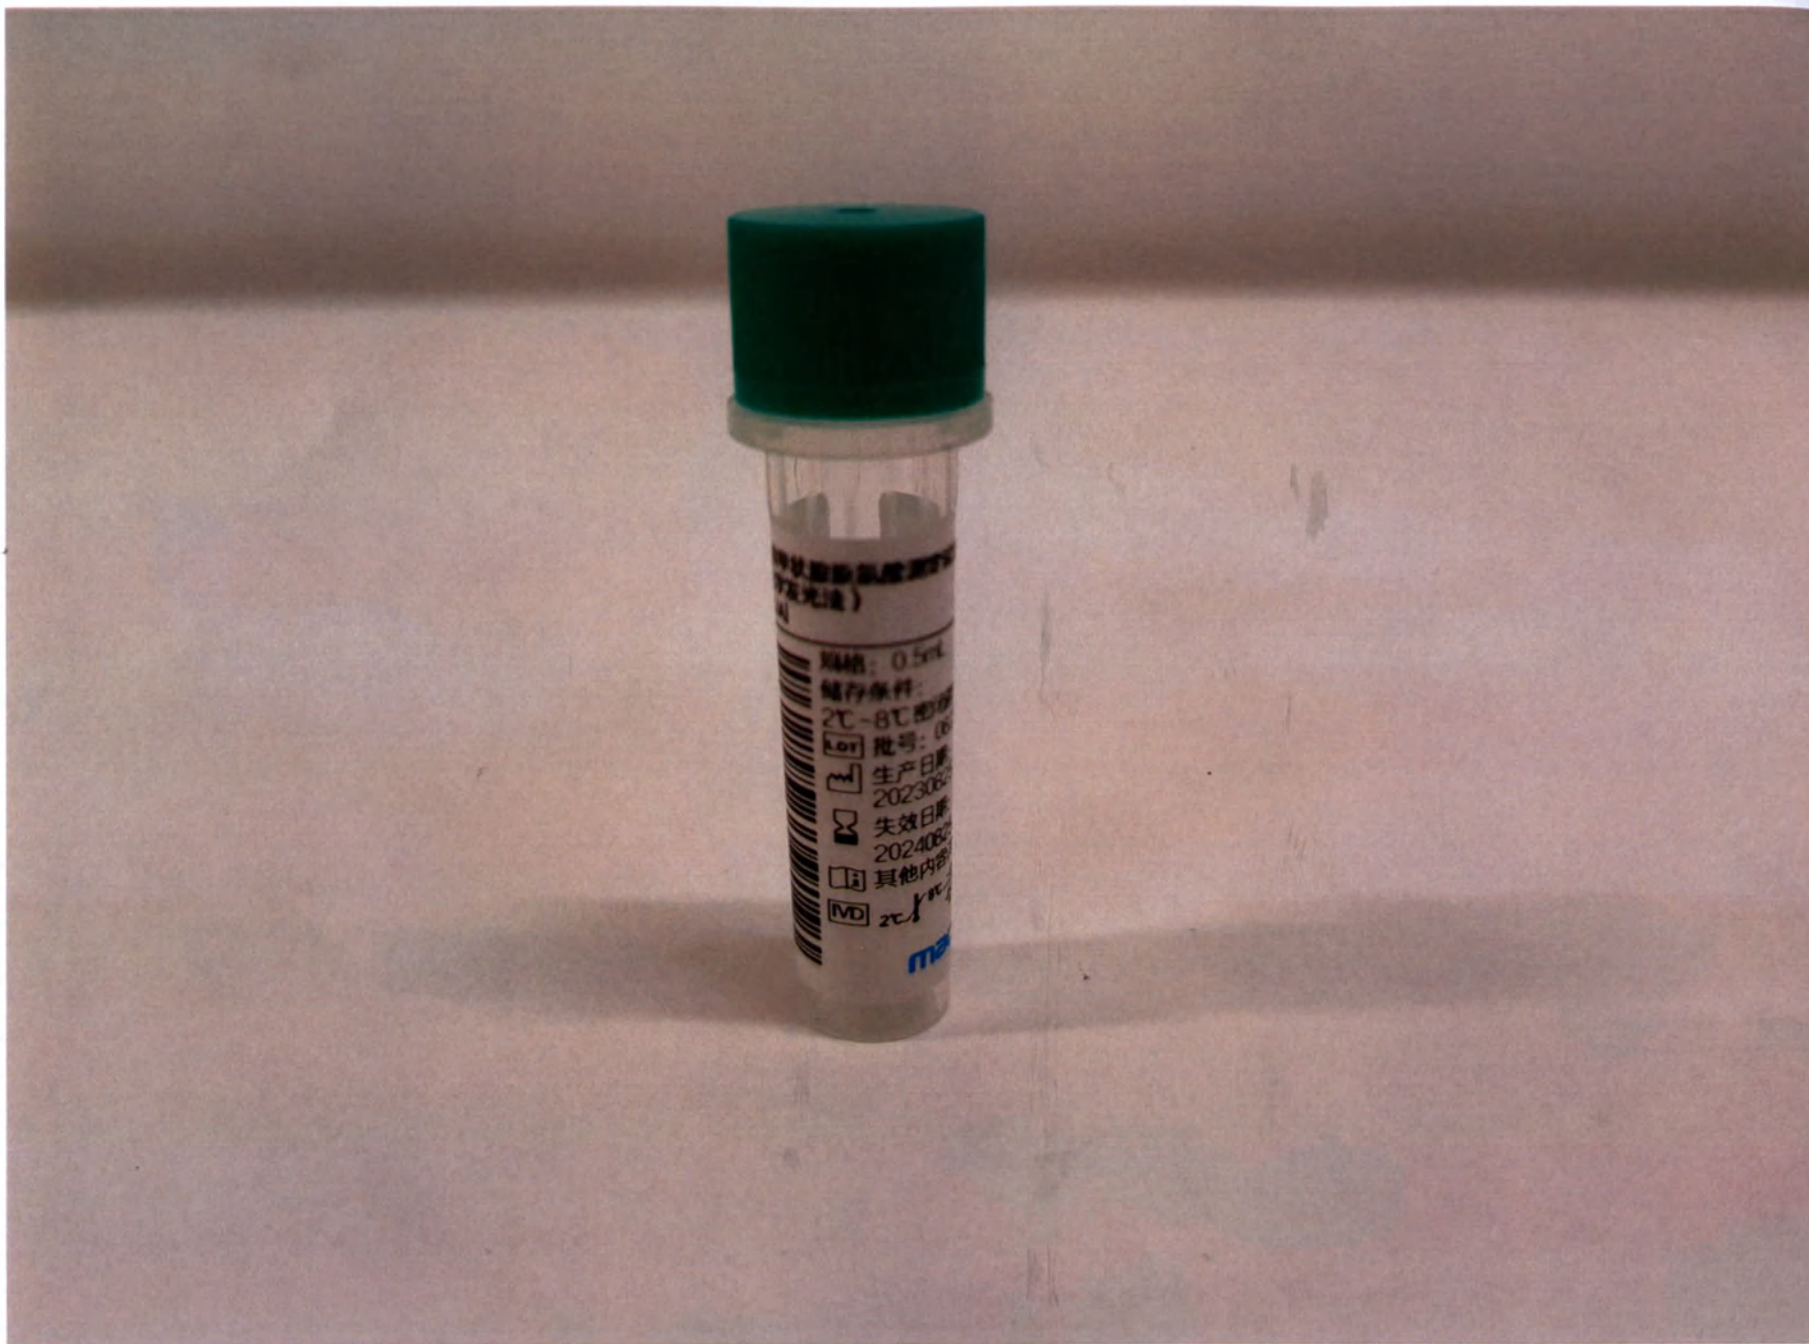


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массуга i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

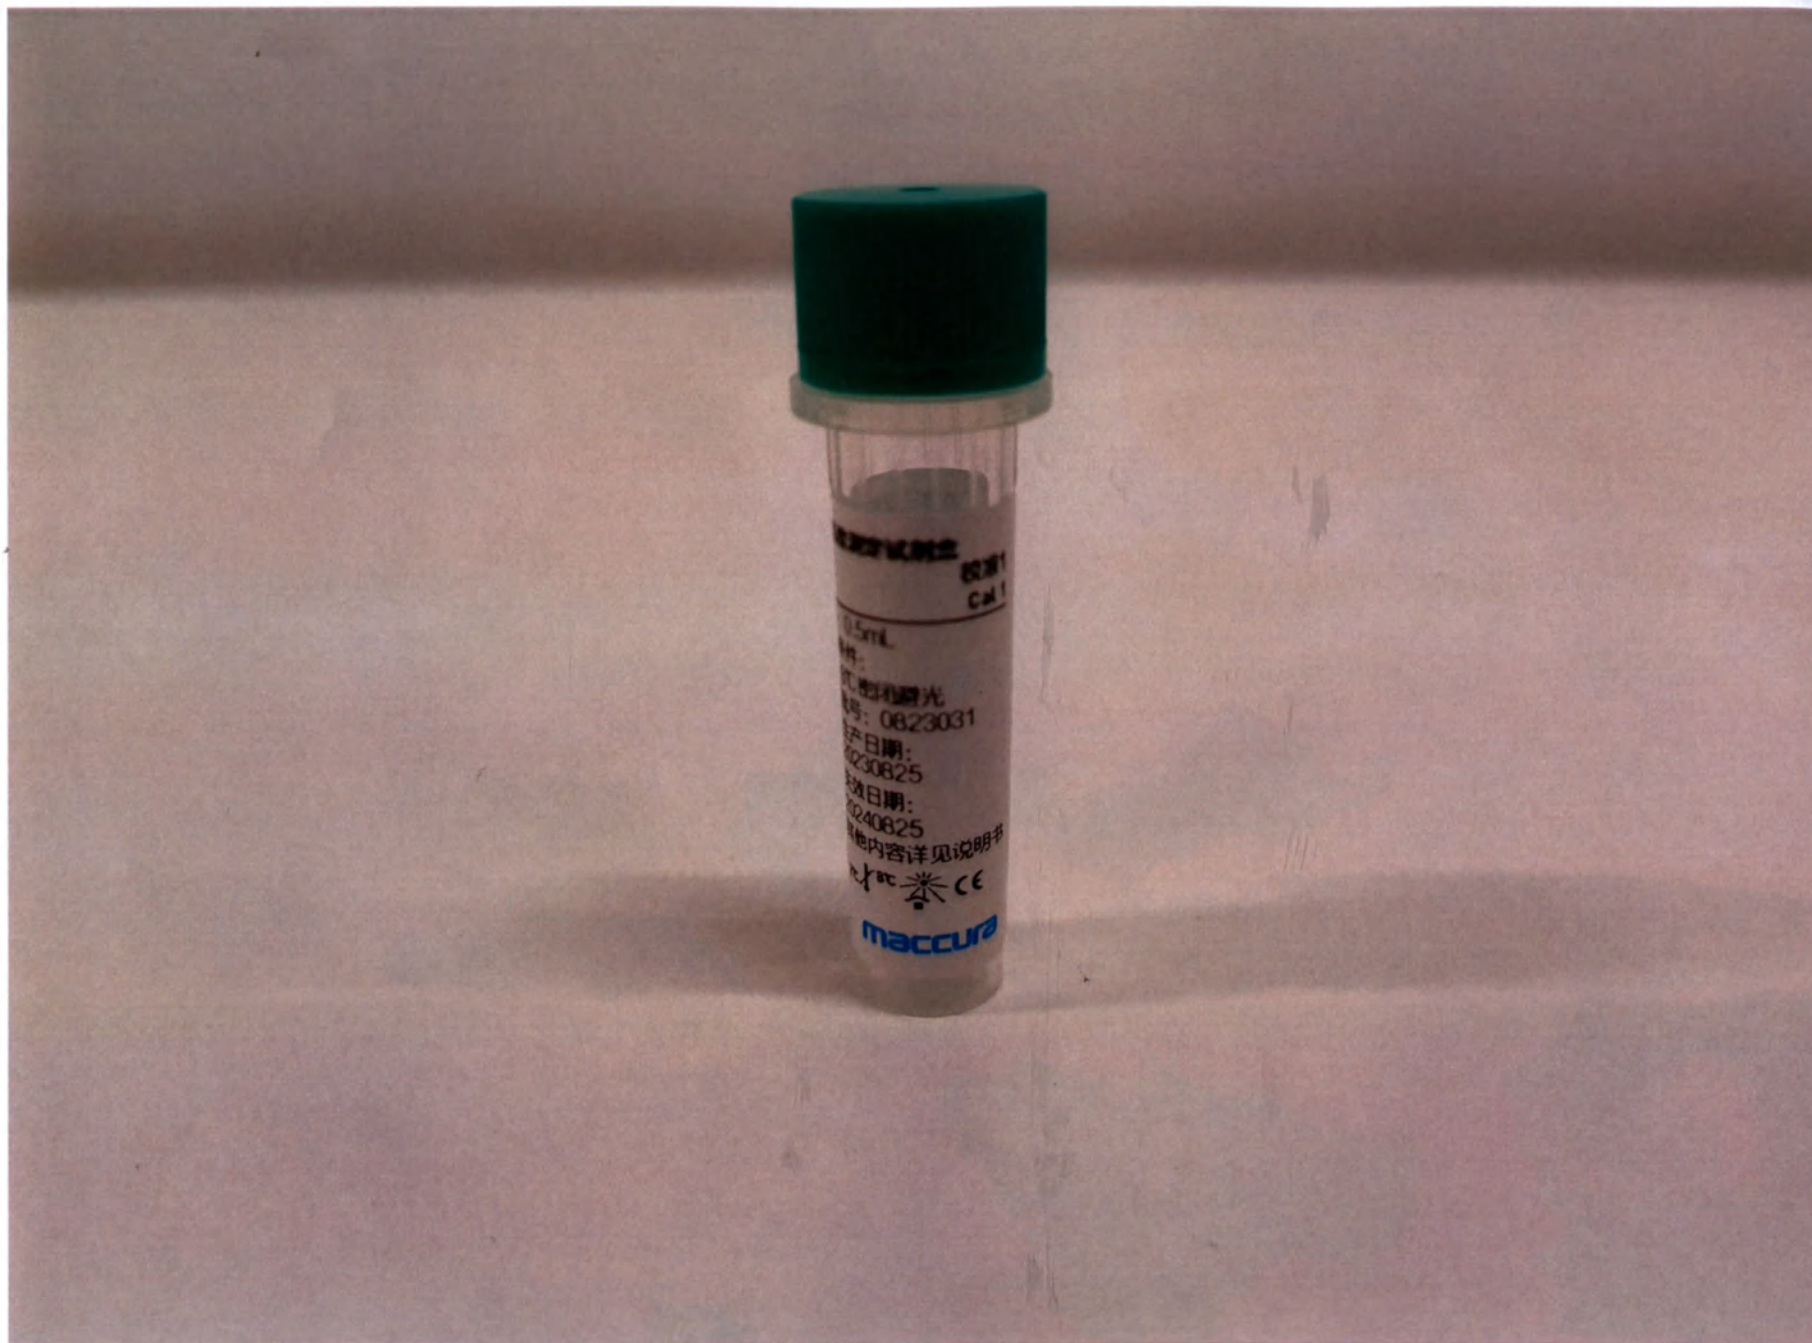


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

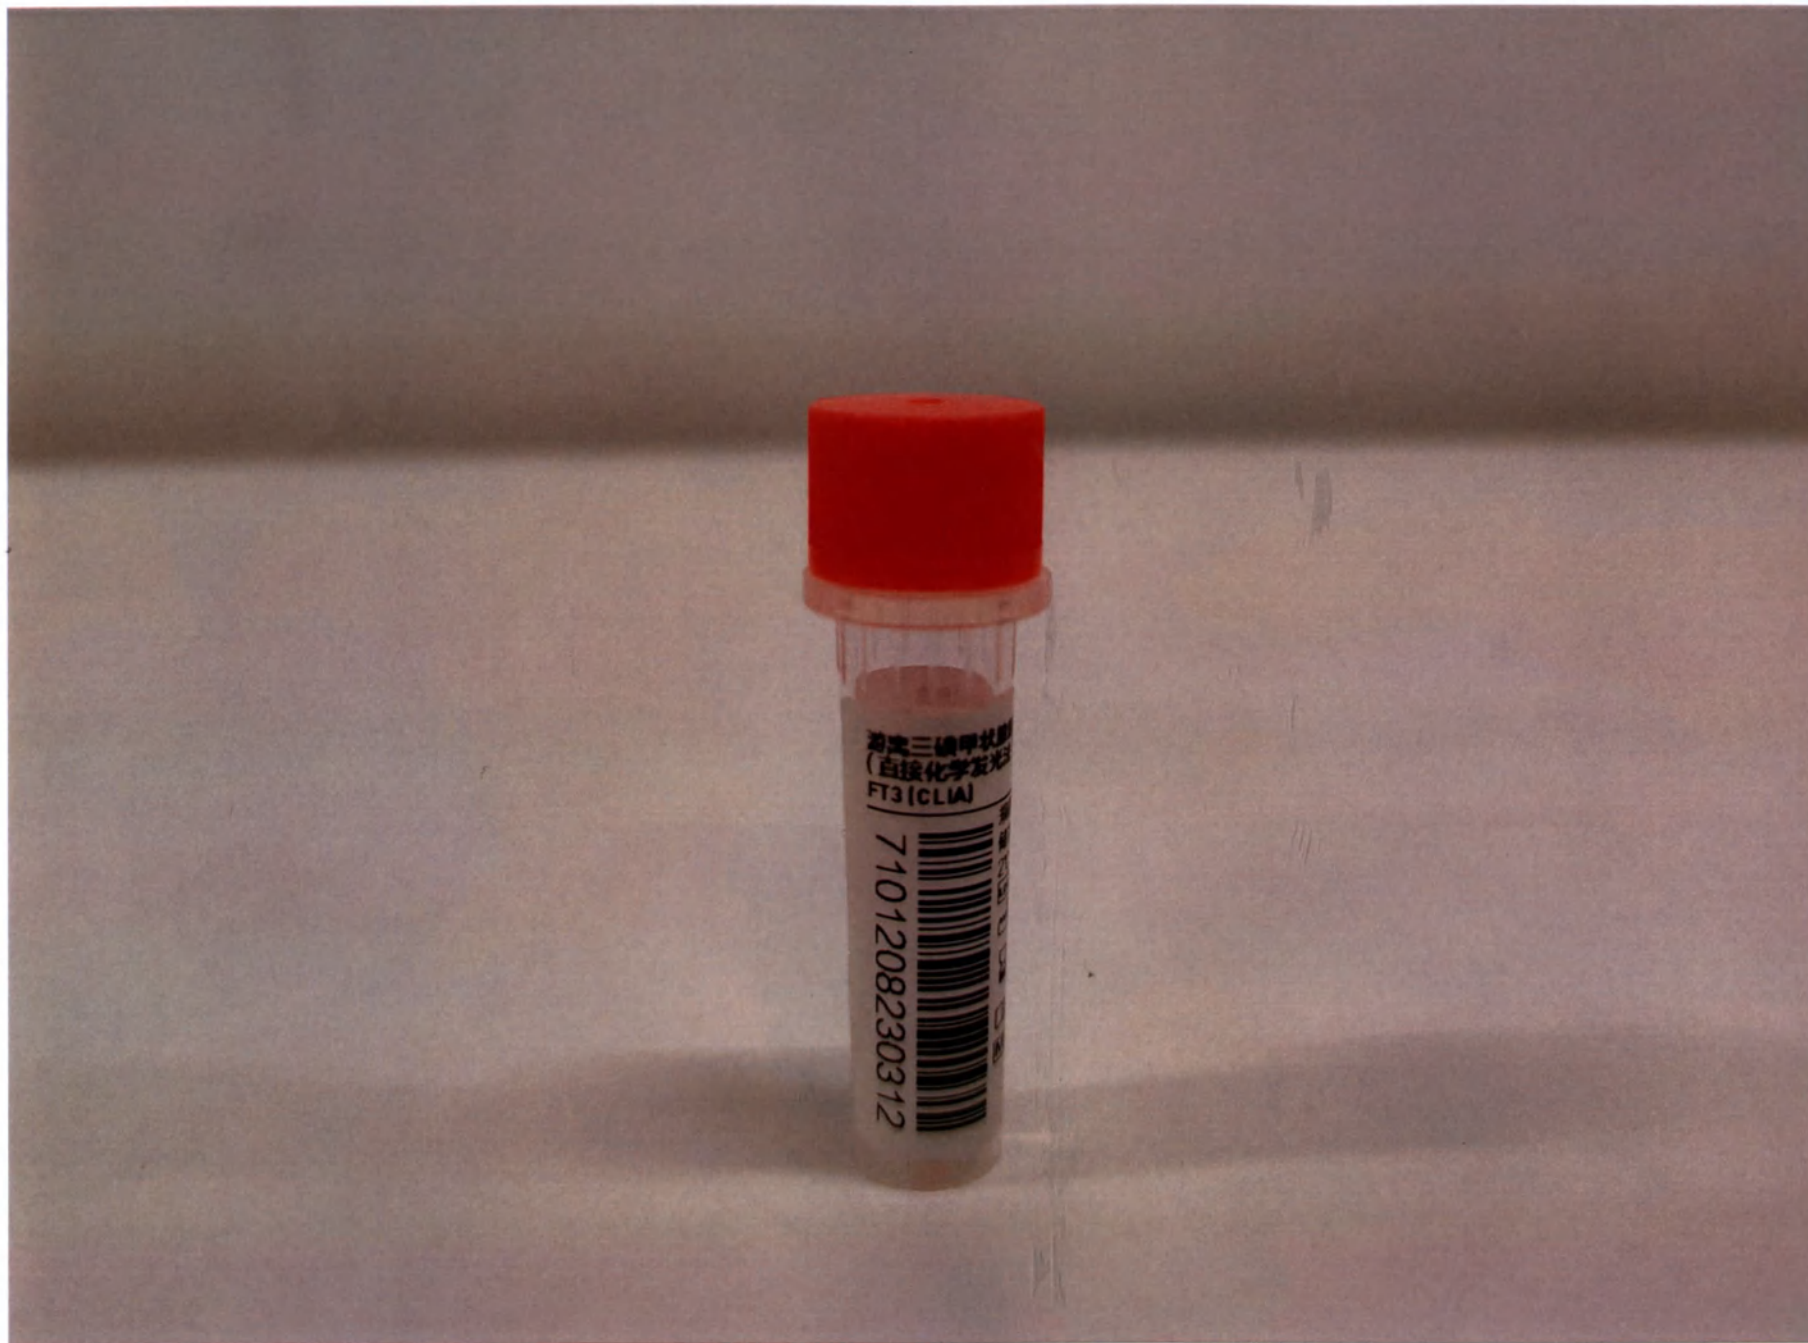


Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

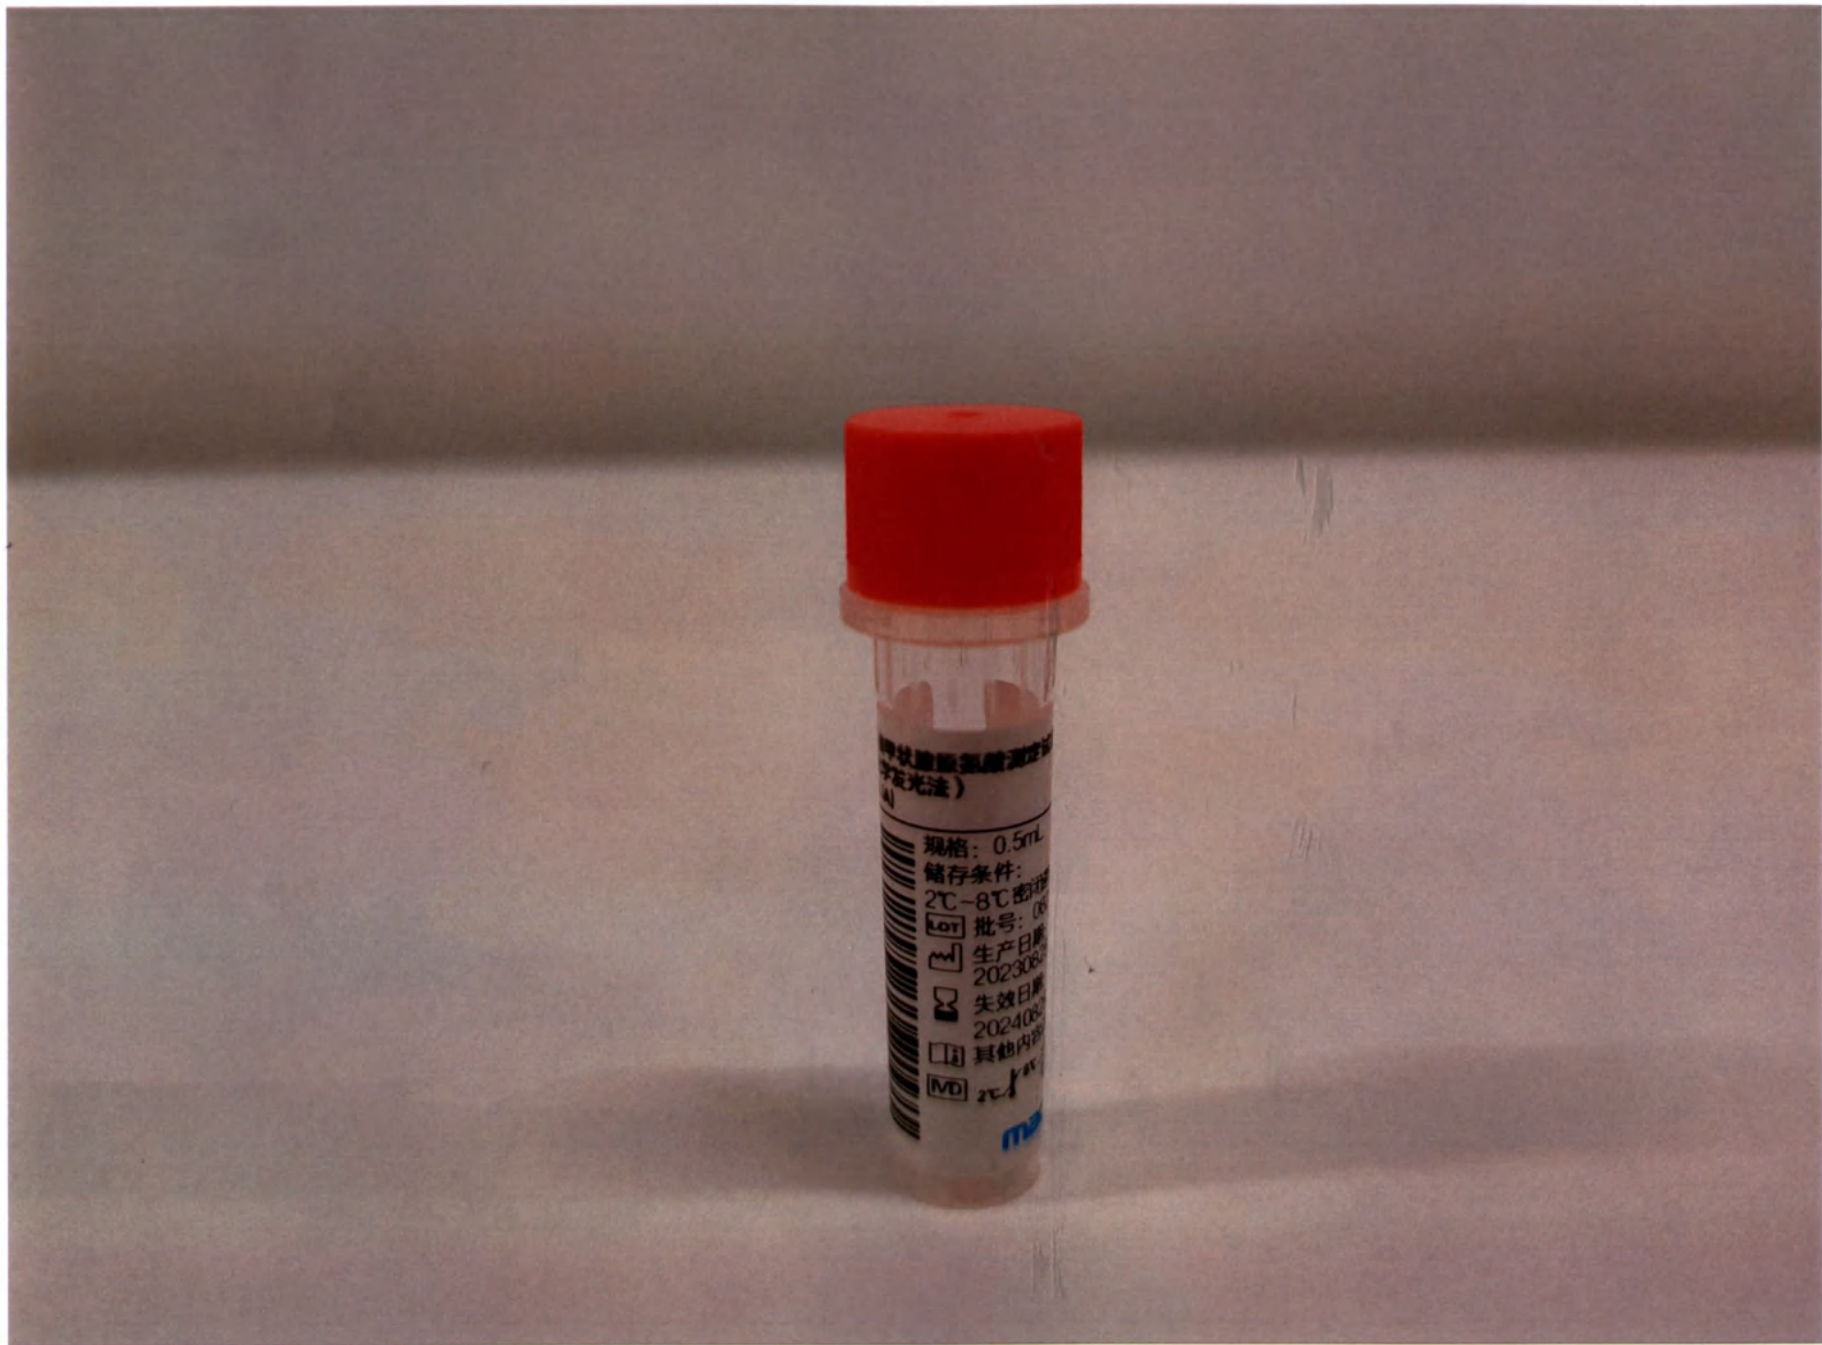

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

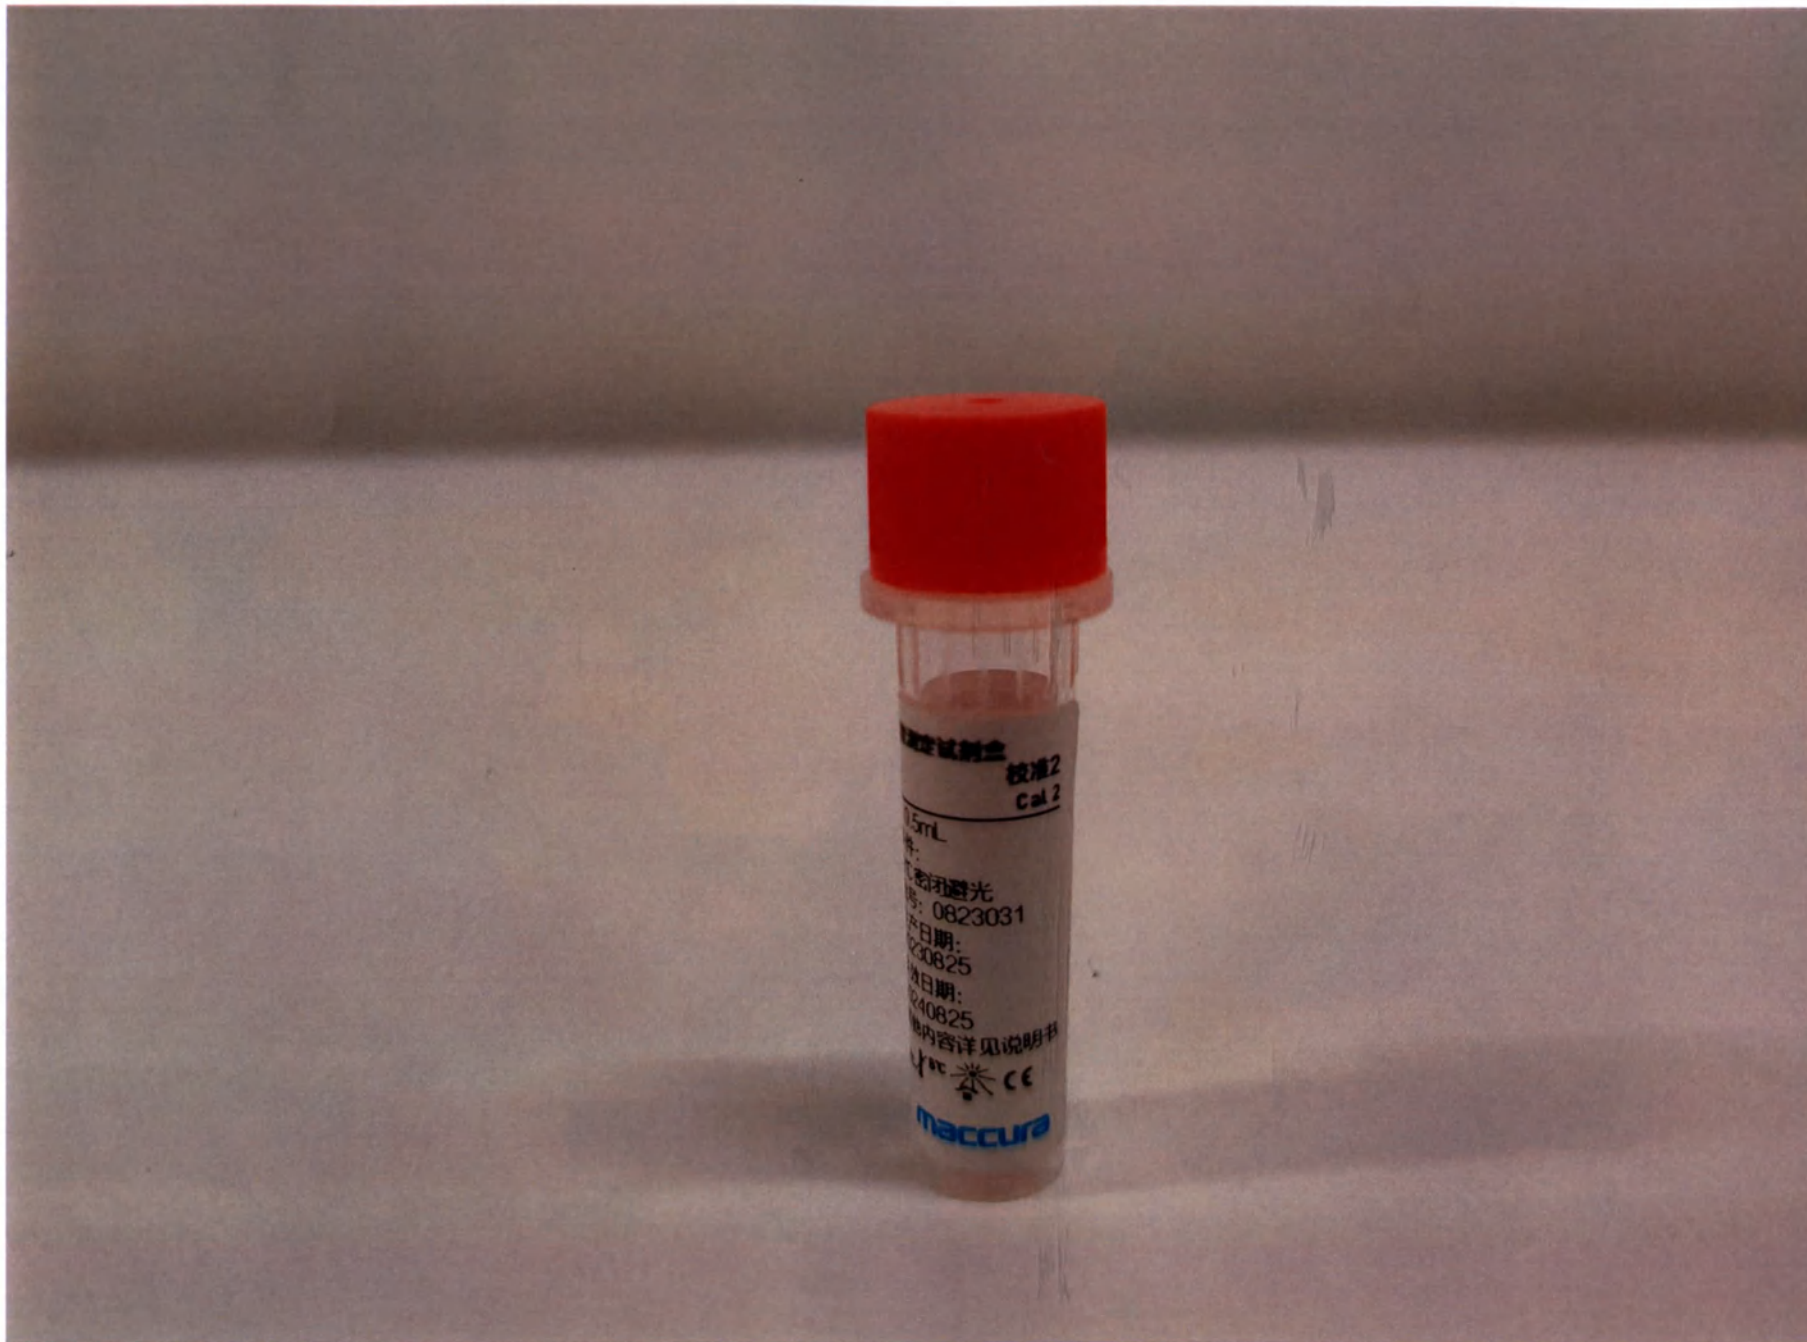

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3 свободный) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (FT3 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

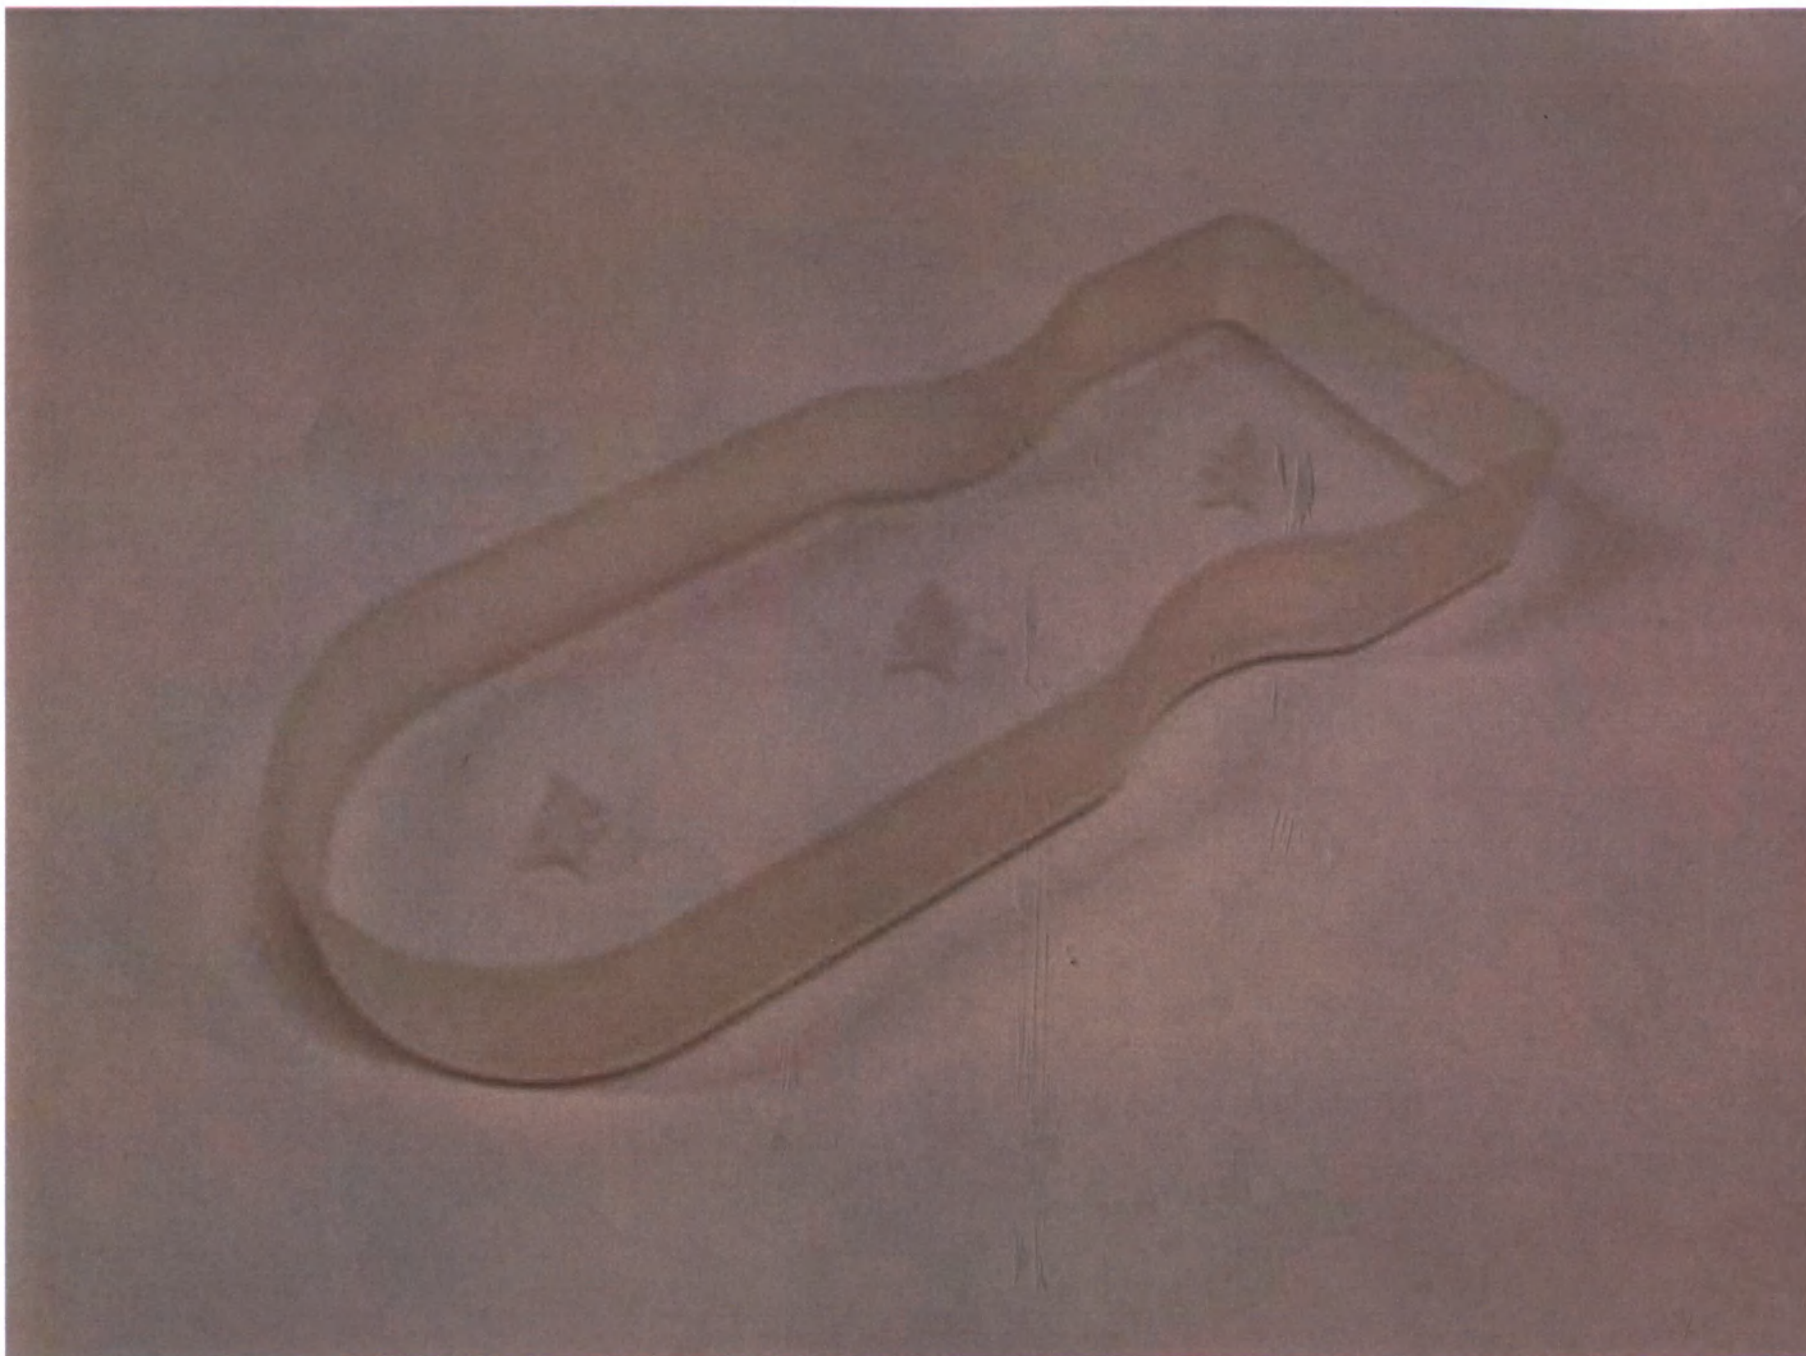

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения свободного трийодтиронина (Т3



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 листов

Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»