

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«01» февраля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения
ракового эмбрионального антигена (РЭА, СЕА) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на
анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур»
для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-217-65614693-2022»**

Картридж (в составе: реагент парамагнитных частиц (R1), 3,5 мл/уп; реагент меченных антител (R2), 4,0 мл/уп.)

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
РЭА

3,5мл	4,0мл
R 1	R 2

LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX

IVD   ProClin 300  

2°C 8°C $\Sigma 1 \times 50$

9031 1017

Калибратор 1 (CAL1)

лидкор
Лидлаб Амур РЭА

2°C 8°C IVD   ProClin 300  

1,0 мл	LOT	XXXXXXXXX
		XX.XX.XXXX
CAL 1	REF	C86004

Калибратор 2 (CAL2)

лидкор
Лидлаб Амур РЭА

1,0 мл	LOT	XXXXXXXXXX
CAL 2		XX.XX.XXXX
	REF	C86004

Калибратор 3 (CAL3)

лидкор
Лидлаб Амур РЭА

1,0 мл	LOT	XXXXXXXXXX
CAL 3		XX.XX.XXXX
	REF	C86004

Пароизоляционные крышки

лидкор
Лидлаб Амур
РЭА

Пароизоляционные крышки – 4 шт.		
LOT	XXXXXXXXXX	
	XX.XX.XXXX	
REF	C86004	

QR-code



Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения ракового эмбрионального антигена (РЭА, СЕА) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-217-65614893-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур РЭА

Набор реагентов на 100 тестов

LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C86004

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения ракового эмбрионального антигена (РЭА, СЕА) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-217-65614893-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур РЭА

Набор реагентов на 200 тестов

LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C86004

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения ракового эмбрионального антигена (РЭА, CEA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-217-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, За

Лидлаб Амур РЭА

Набор реагентов на 500 тестов

Рис. 300

LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C86004

Состав изделия

- Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.
- Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.
- Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.
- Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.
- Пароизоляционные крышки – 40 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения ракового эмбрионального антигена (РЭА, CEA) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилуминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилуминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-217-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, За

Лидлаб Амур РЭА

Набор реагентов на 1000 тестов


Рис. 300

LOT XXXXXXXX XX.XX.XXXX REF C86004


Состав изделия

- Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.
- Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
- Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
- Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.
- Пароизоляционные крышки – 80 шт.
- Инструкция по применению – 1 шт.
- Аналитический паспорт – 1 шт.

Потребительская коробка

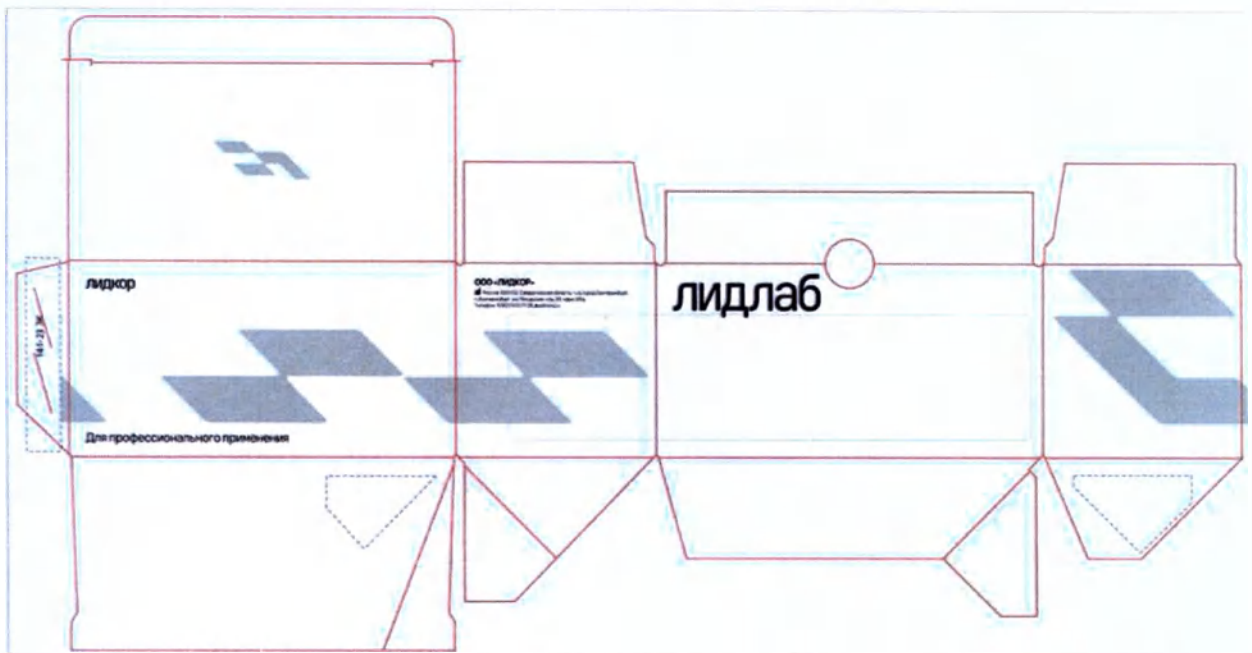

Транспортная упаковка



Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения ракового эмбрионального антигена (РЭА, СЕА) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-217-65614693-2022




Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX	
LOT	XXXXXXXX	REF	C86004



Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения ракового эмбрионального антигена (РЭА, СЕА) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-217-65614693-2022

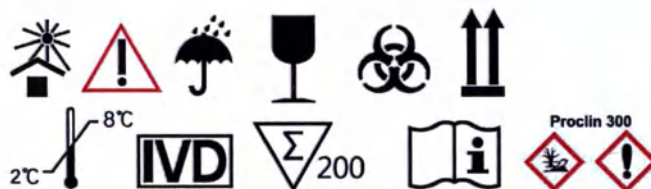


Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX	
LOT	XXXXXXXX	REF	C86004



Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения ракового эмбрионального антигена (РЭА, СЕА) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro
по ТУ 21.20.23-217-65614693-2022

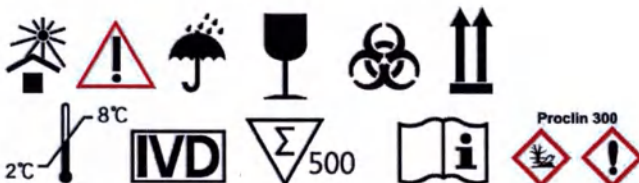


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86004



Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения ракового эмбрионального антигена (РЭА, СЕА) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro
по ТУ 21.20.23-217-65614693-2022

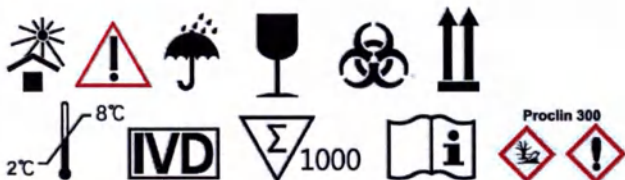

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86004

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь)) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»



/Е. Ю. Гохгут/


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ЛИДКОР»
Е.Ю. Тохгут
2023 г.
М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур РЭА» для количественного определения
ракового эмбрионального антигена (РЭА, СЕА) в сыворотке и плазме крови
человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на
анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур»
для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-217-65614693-2022»


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

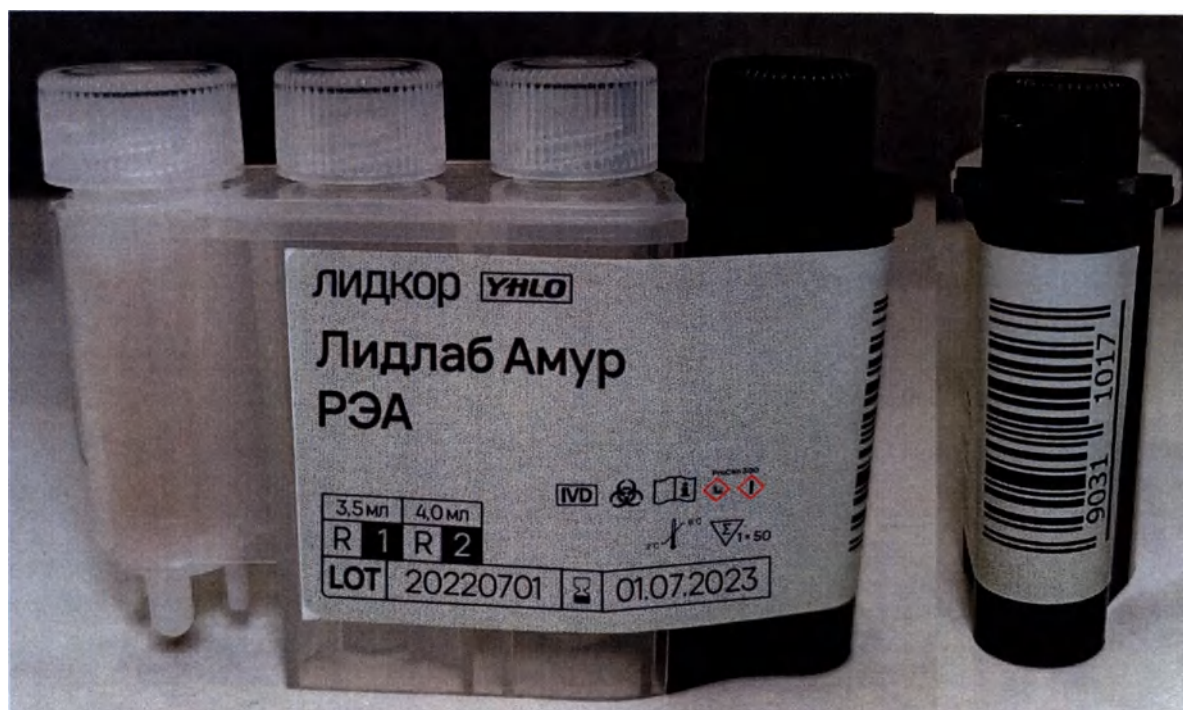


Пароизоляционные крышки



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

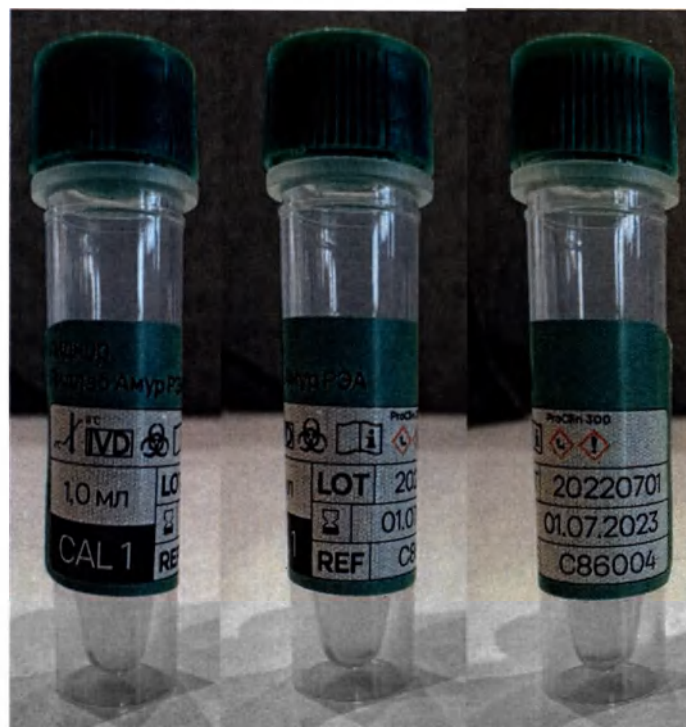


Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

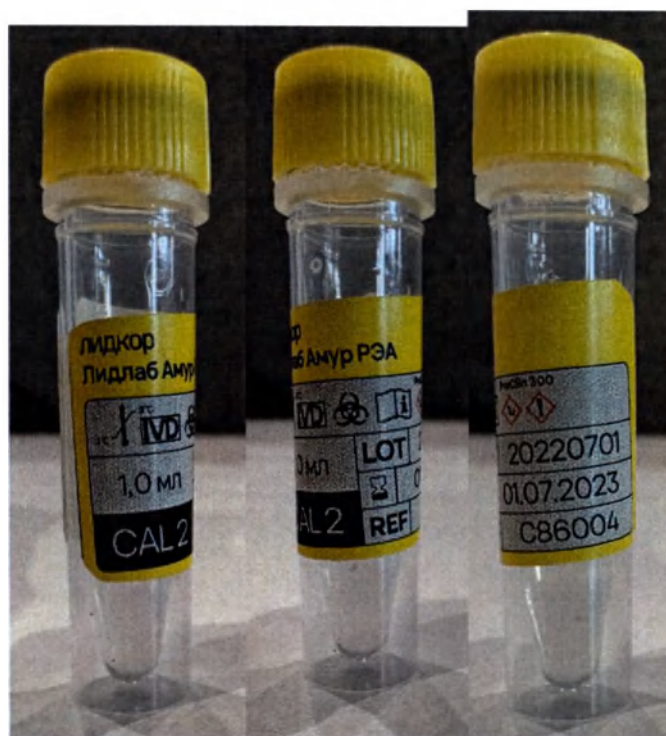

Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон



Потребительская упаковка

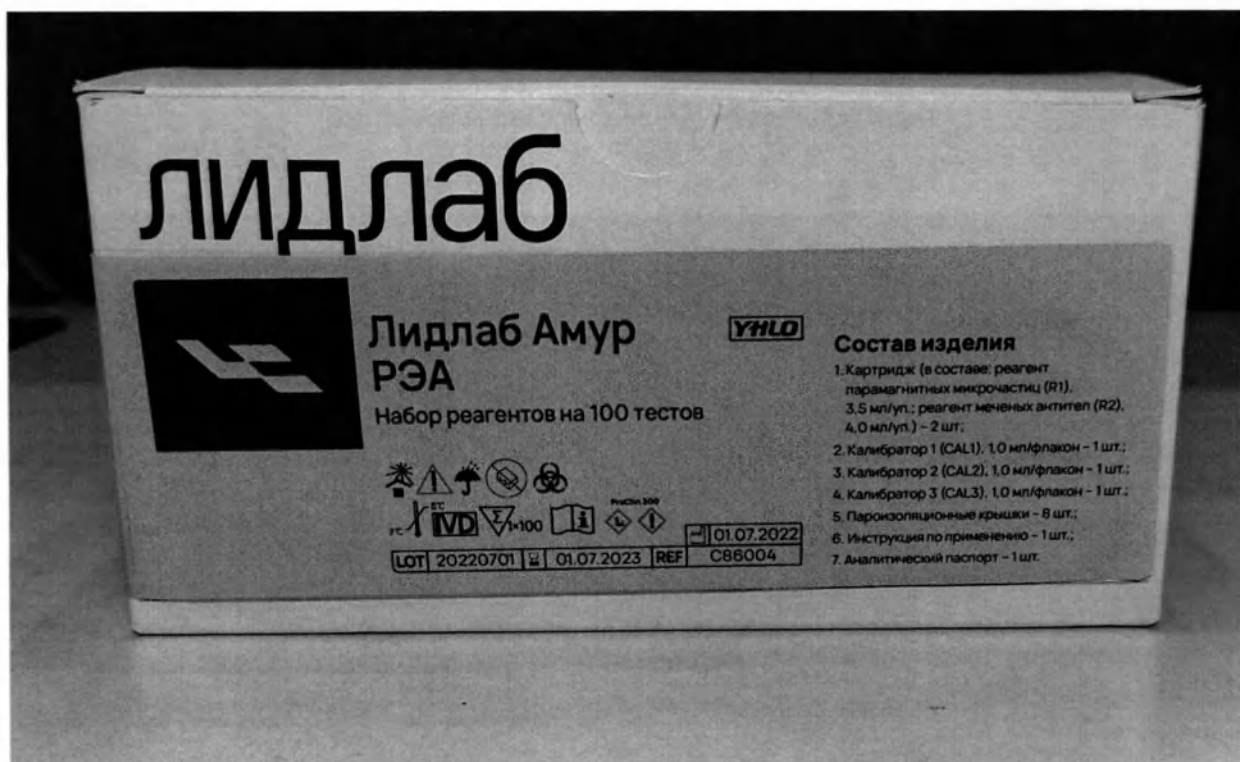


Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

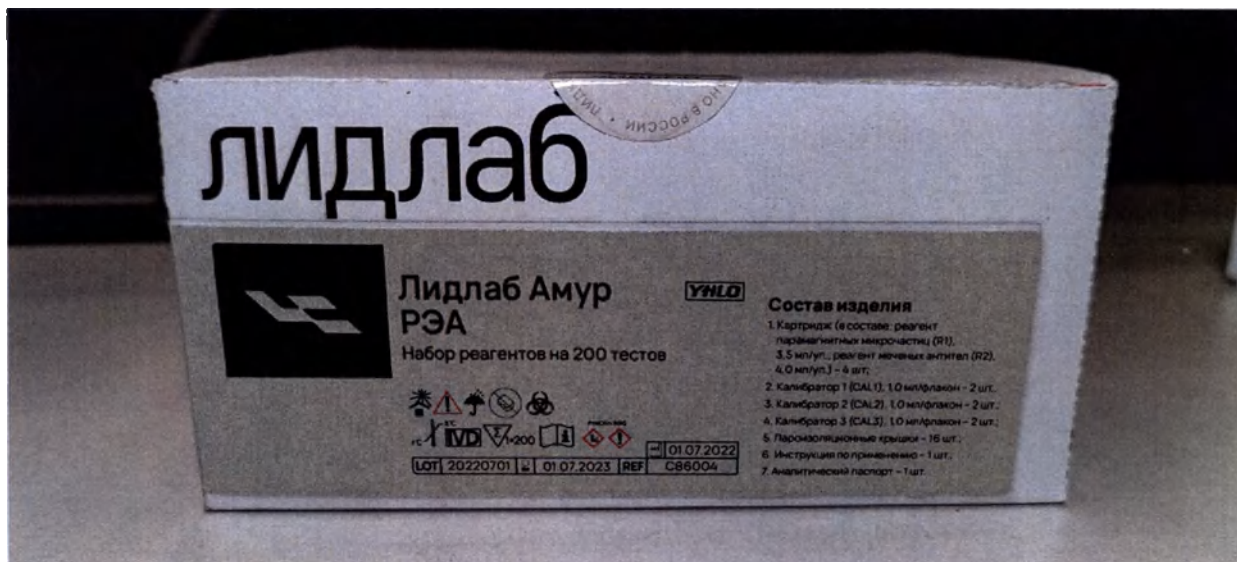

Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

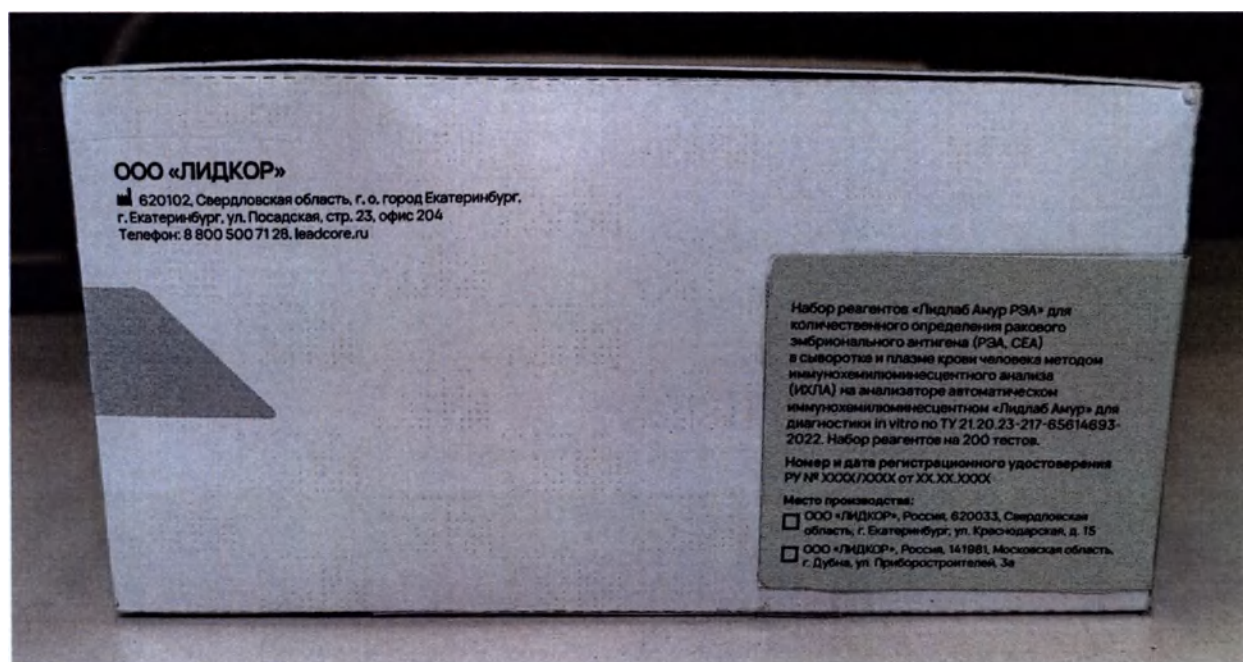


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

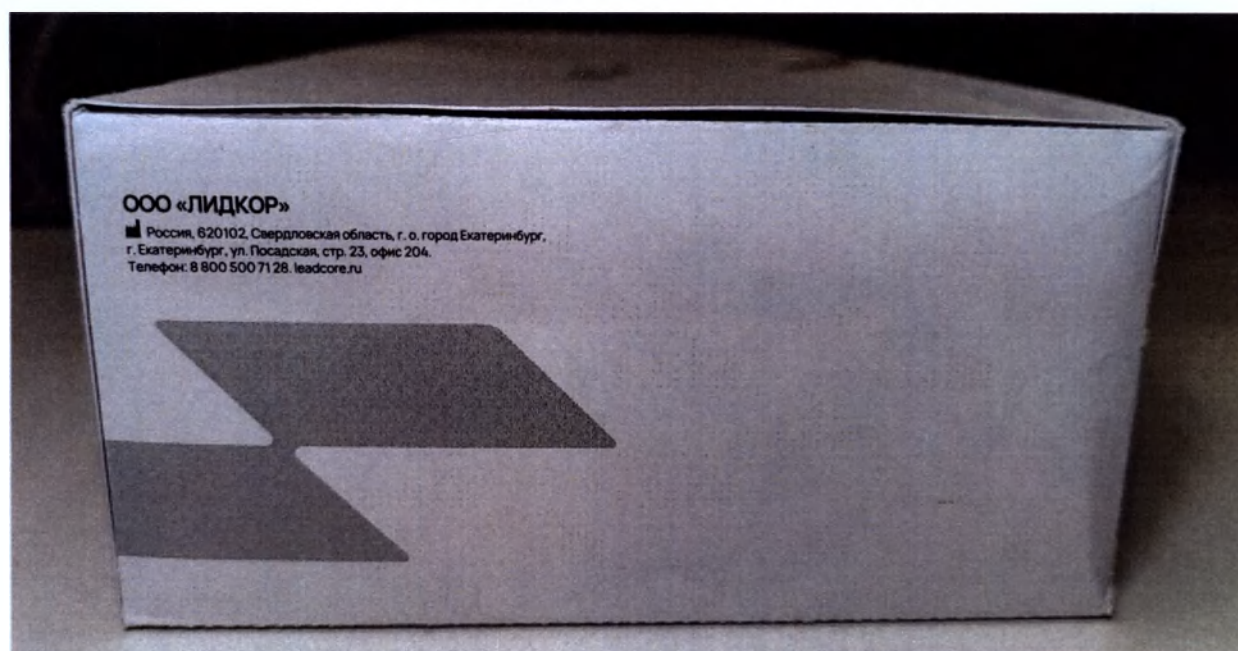

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

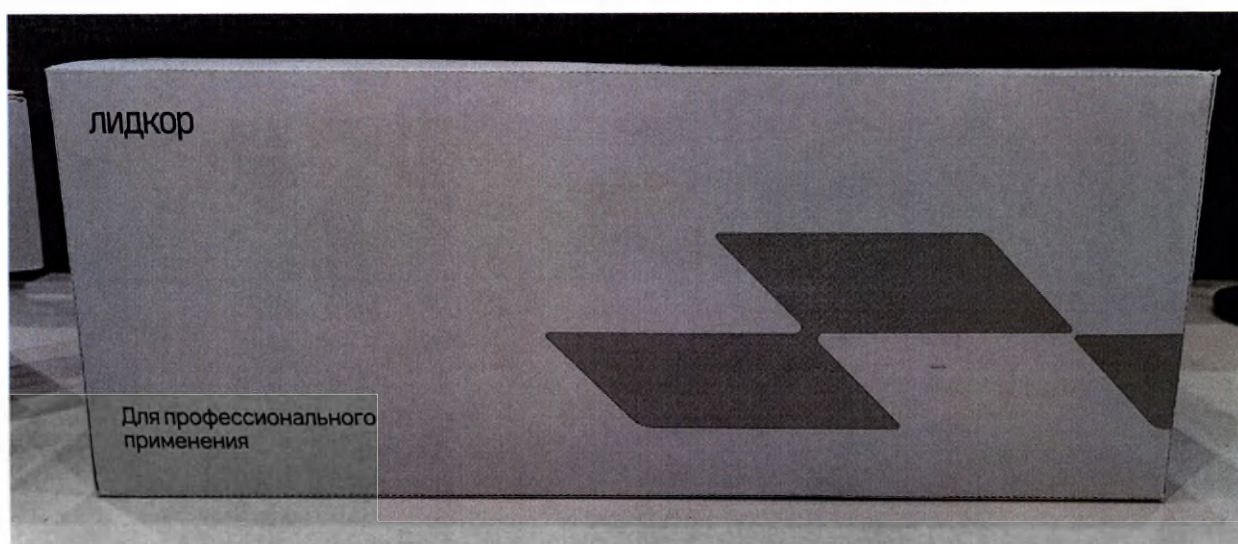

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

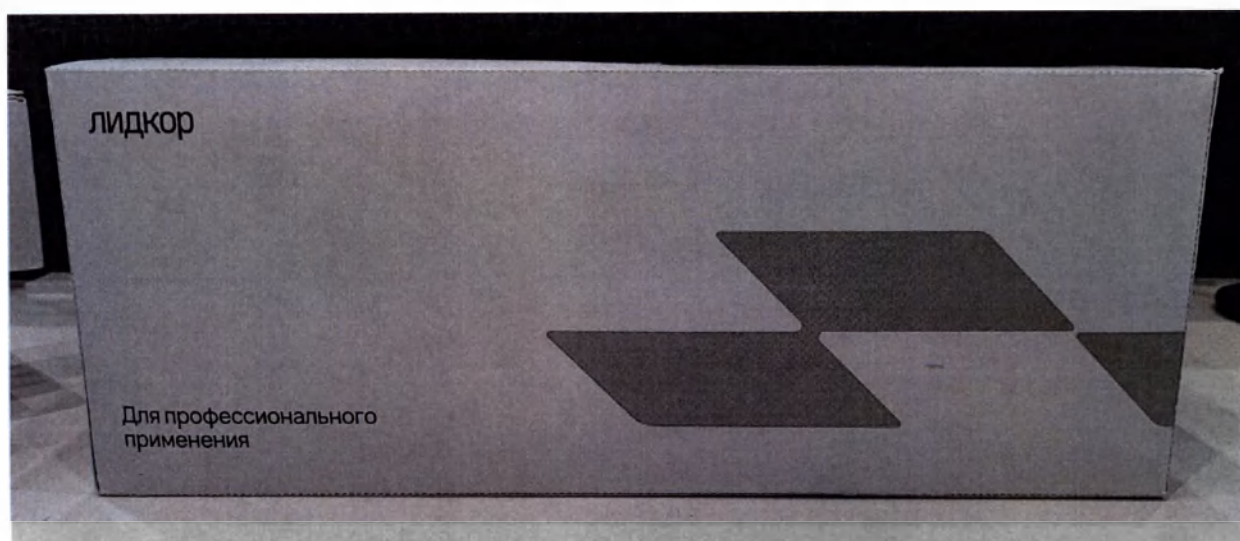

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)





Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото.



Транспортная упаковка



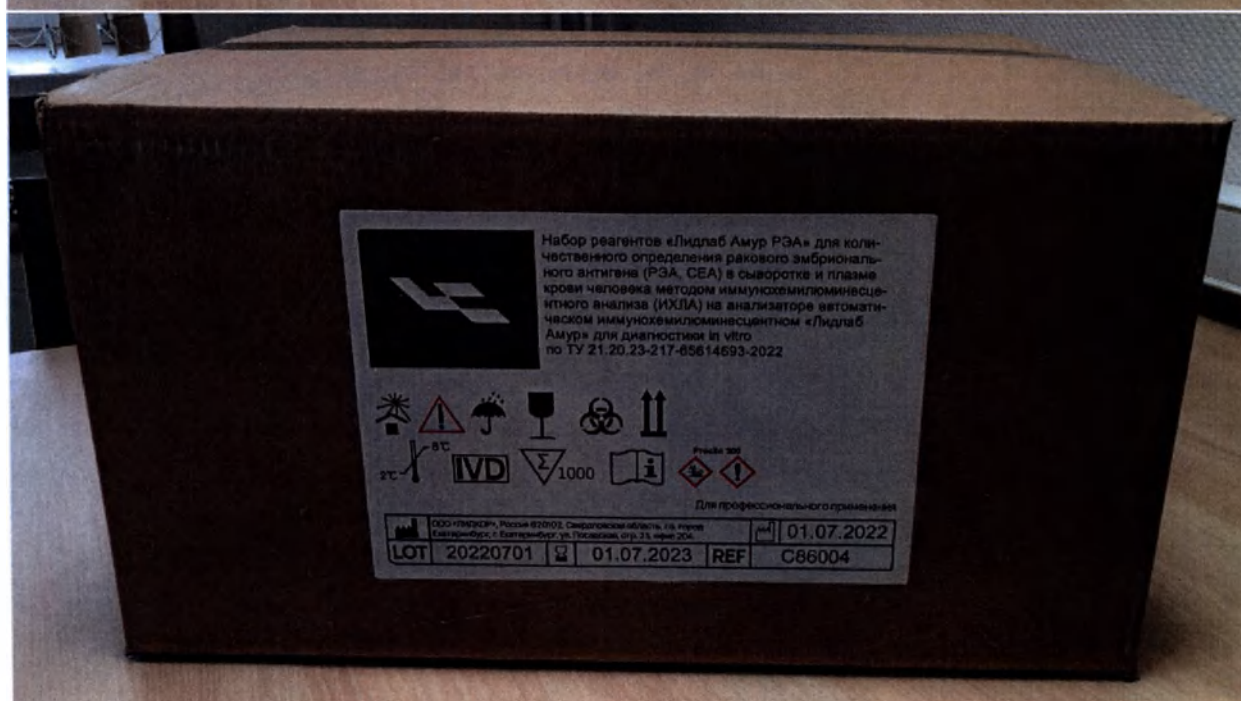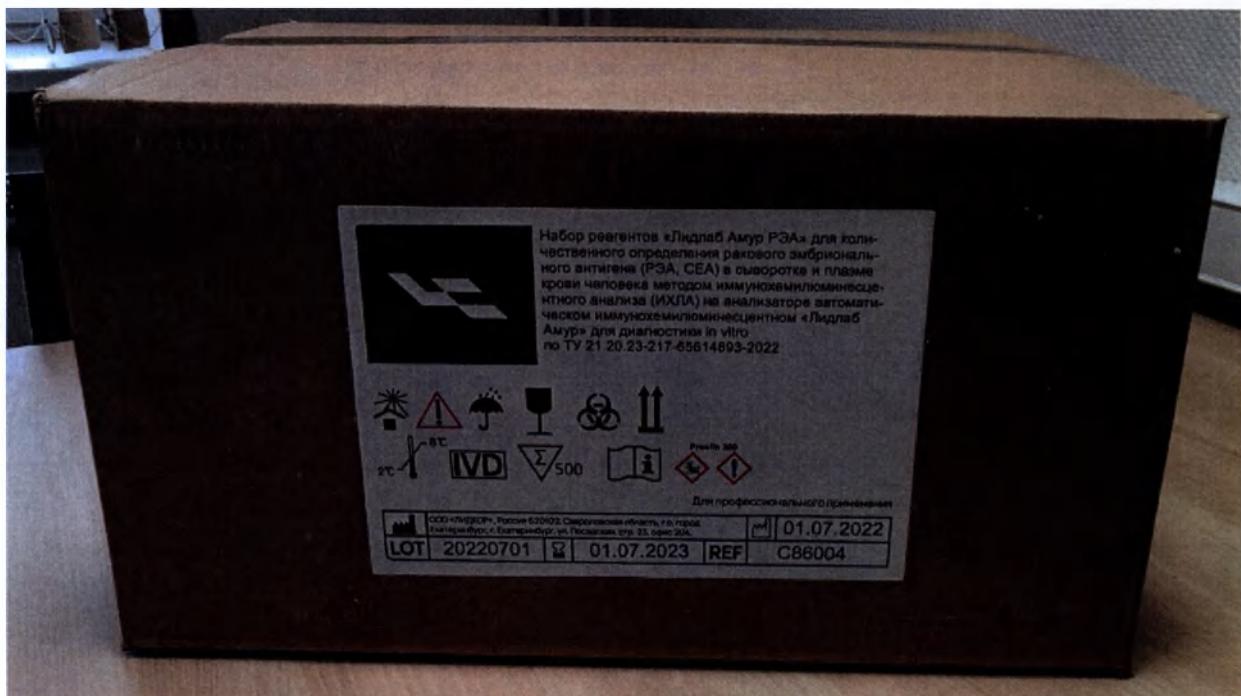

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/