

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для количественного определения натрийуретического пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для количественного определения натрийуретического пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для количественного определения натрийуретического пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур BNP

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO

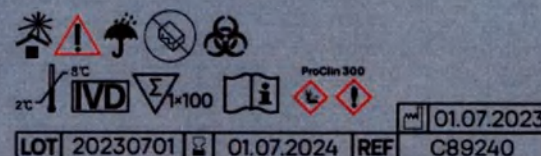

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченного конъюгата к BNP (R2) 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 1 флакон;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 1 флакон;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 1 флакон;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.



Лидлаб Амур BNP

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO

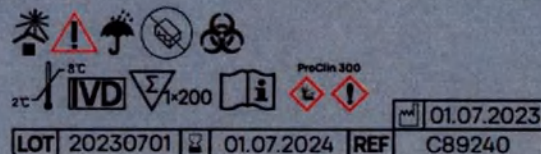

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченного конъюгата к BNP (R2) 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 2 флакона;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 2 флакона;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 2 флакона;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для количественного определения натрийуретического пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур BNP

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO

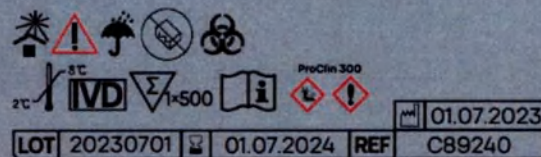

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченного конъюгата к BNP (R2) 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 5 флаконов;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 5 флаконов;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 5 флаконов;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для количественного определения натрийуретического пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур BNP

Набор реагентов на 1000 тестов


YHLO

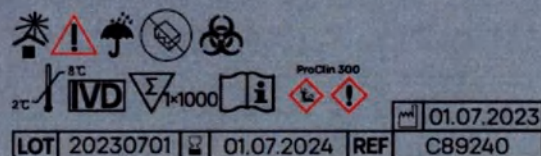

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченного конъюгата к BNP (R2) 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат – 10 флаконов;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат – 10 флаконов;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат – 10 флаконов;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

**Лидлаб Амур
BNP**



3,5мл	4,0мл
R 1	R 2

LOT	20230701		01.07.2024
-----	----------	---	------------

1,0 мл	    			REF	C89240
CAL 1	LOT	20230701		01.07.2024	



лидкор
Лидлаб Амур BNP

1,0 мл	     	REF	C89240	
CAL 2	LOT	20230701	01.07.2024	

лидкор
Лидлаб Амур BNP

1,0 мл	     	REF	C89240	
CAL 3	LOT	20230701	01.07.2024	



лидкор
Лидлаб Амур
BNP

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

IVD



 01.07.2024


REF C89240




Лидлаб Амур BNP



LOT 20230701 EXP 01.07.2024

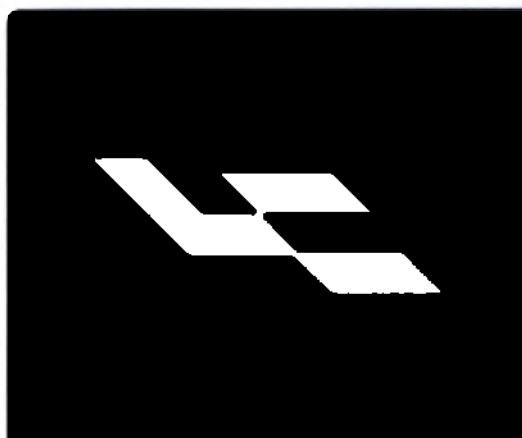


Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для
количественного определения натрийуретического
пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на
анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022

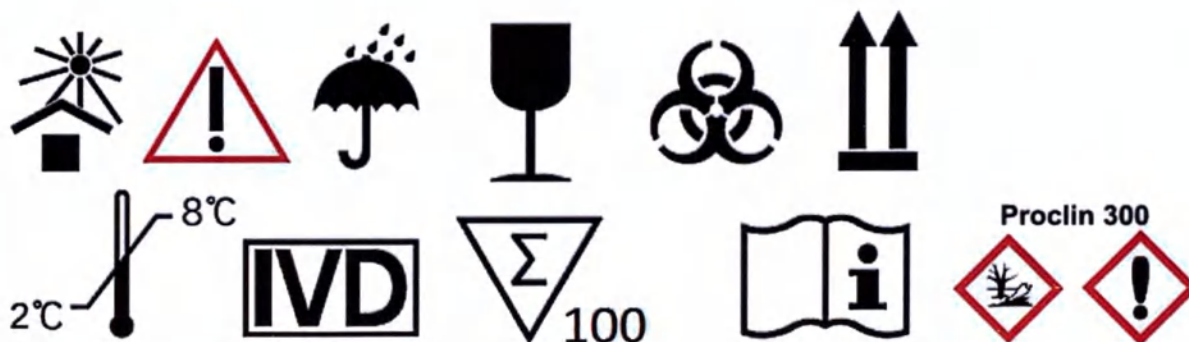


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89240

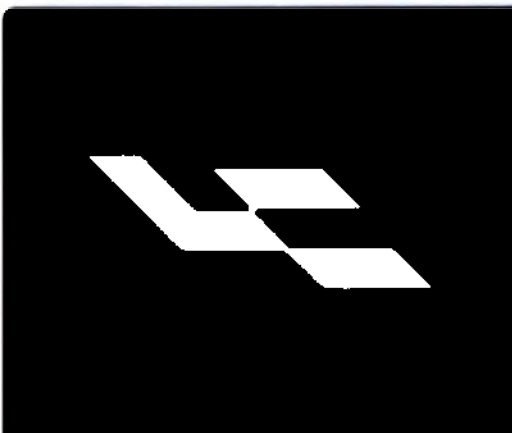


Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для
количественного определения натрийуретического
пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на
анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022

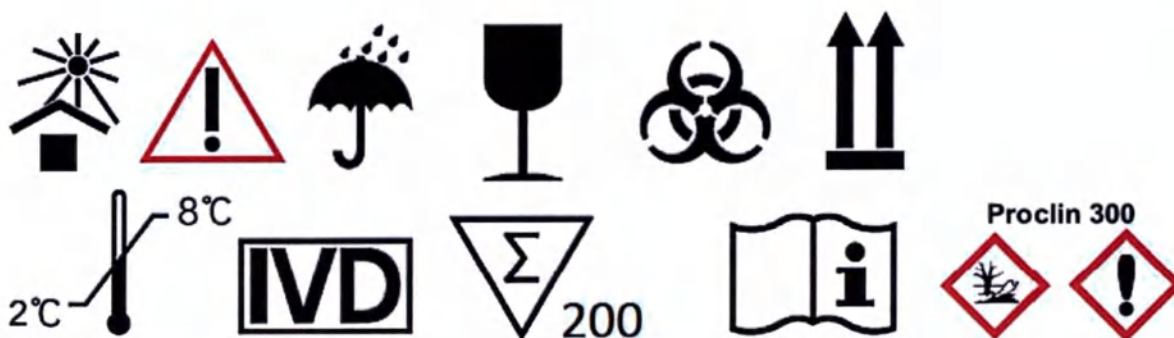


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89240

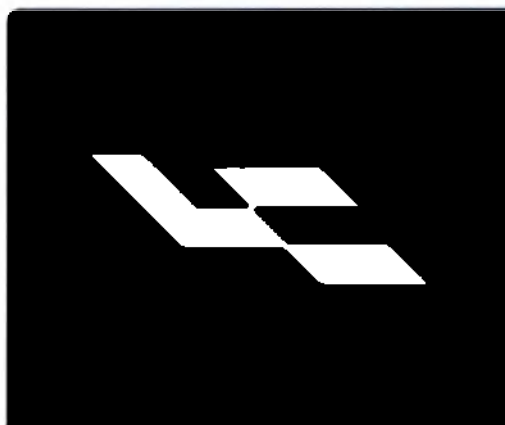


Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для
количественного определения натрийуретического
пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на
анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022

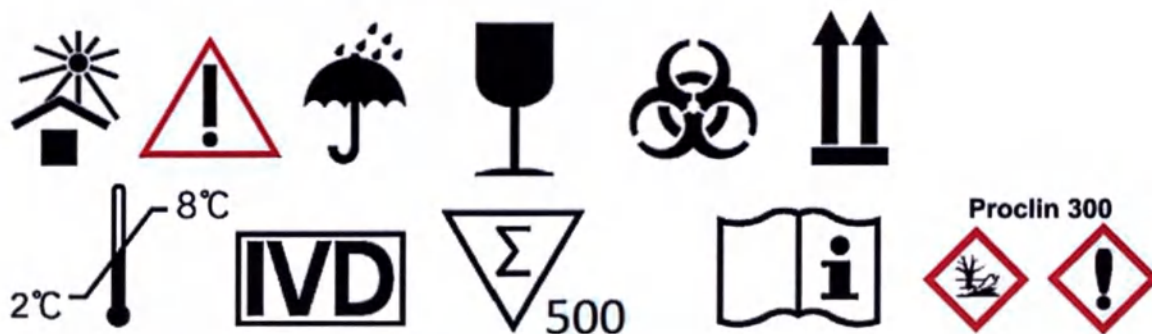


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89240

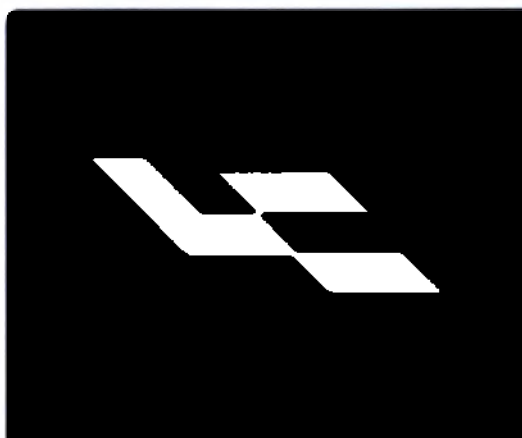


Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для
количественного определения натрийуретического
пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на
анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022

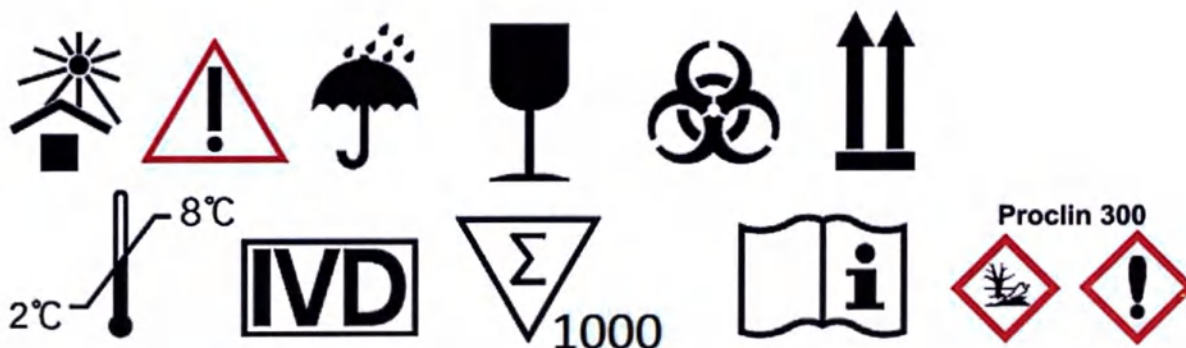

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89240

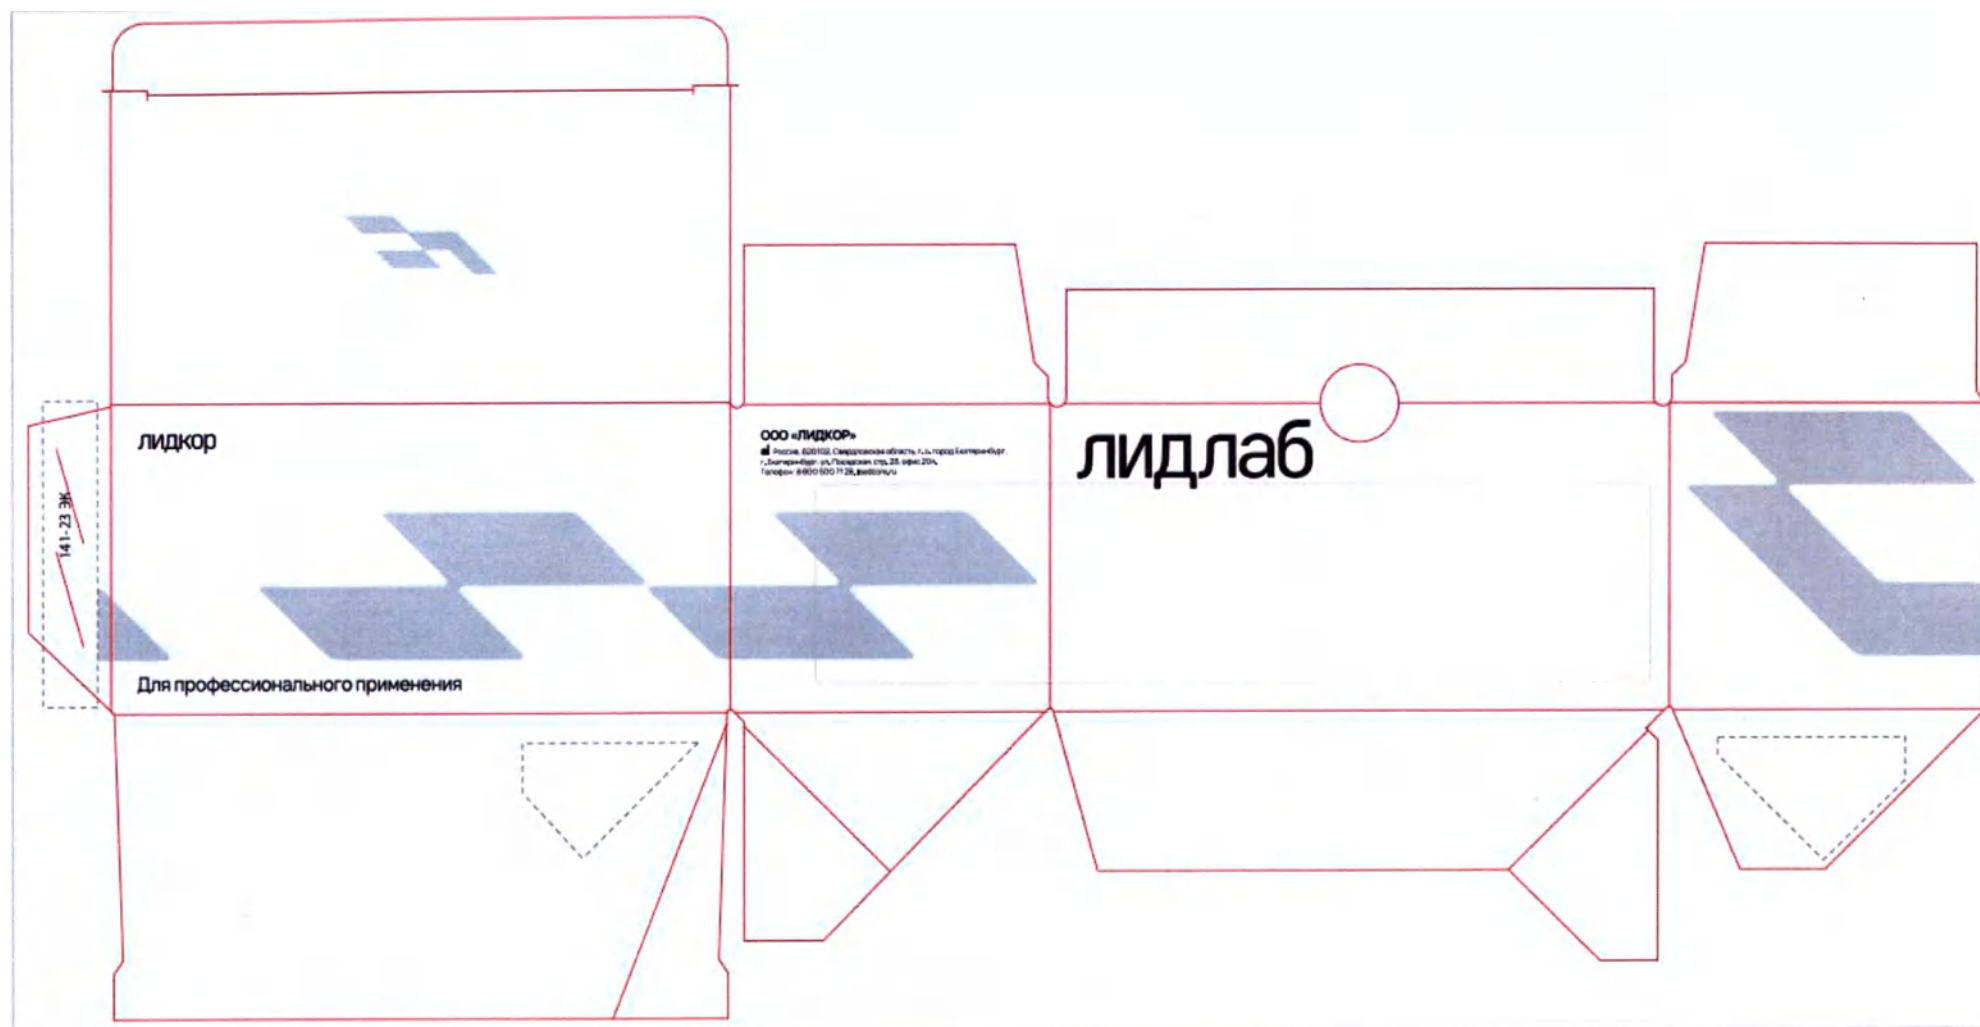

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

12 (звена) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»



/Е. Ю. Гохгут/

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

 Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.

М.П.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для количественного определения натрийуретического пептида типа В (BNP) в плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-2022

2023

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1) 3,5 мл/уп., Реагент меченного конъюгата к BNP (R2) 4,0 мл/уп)

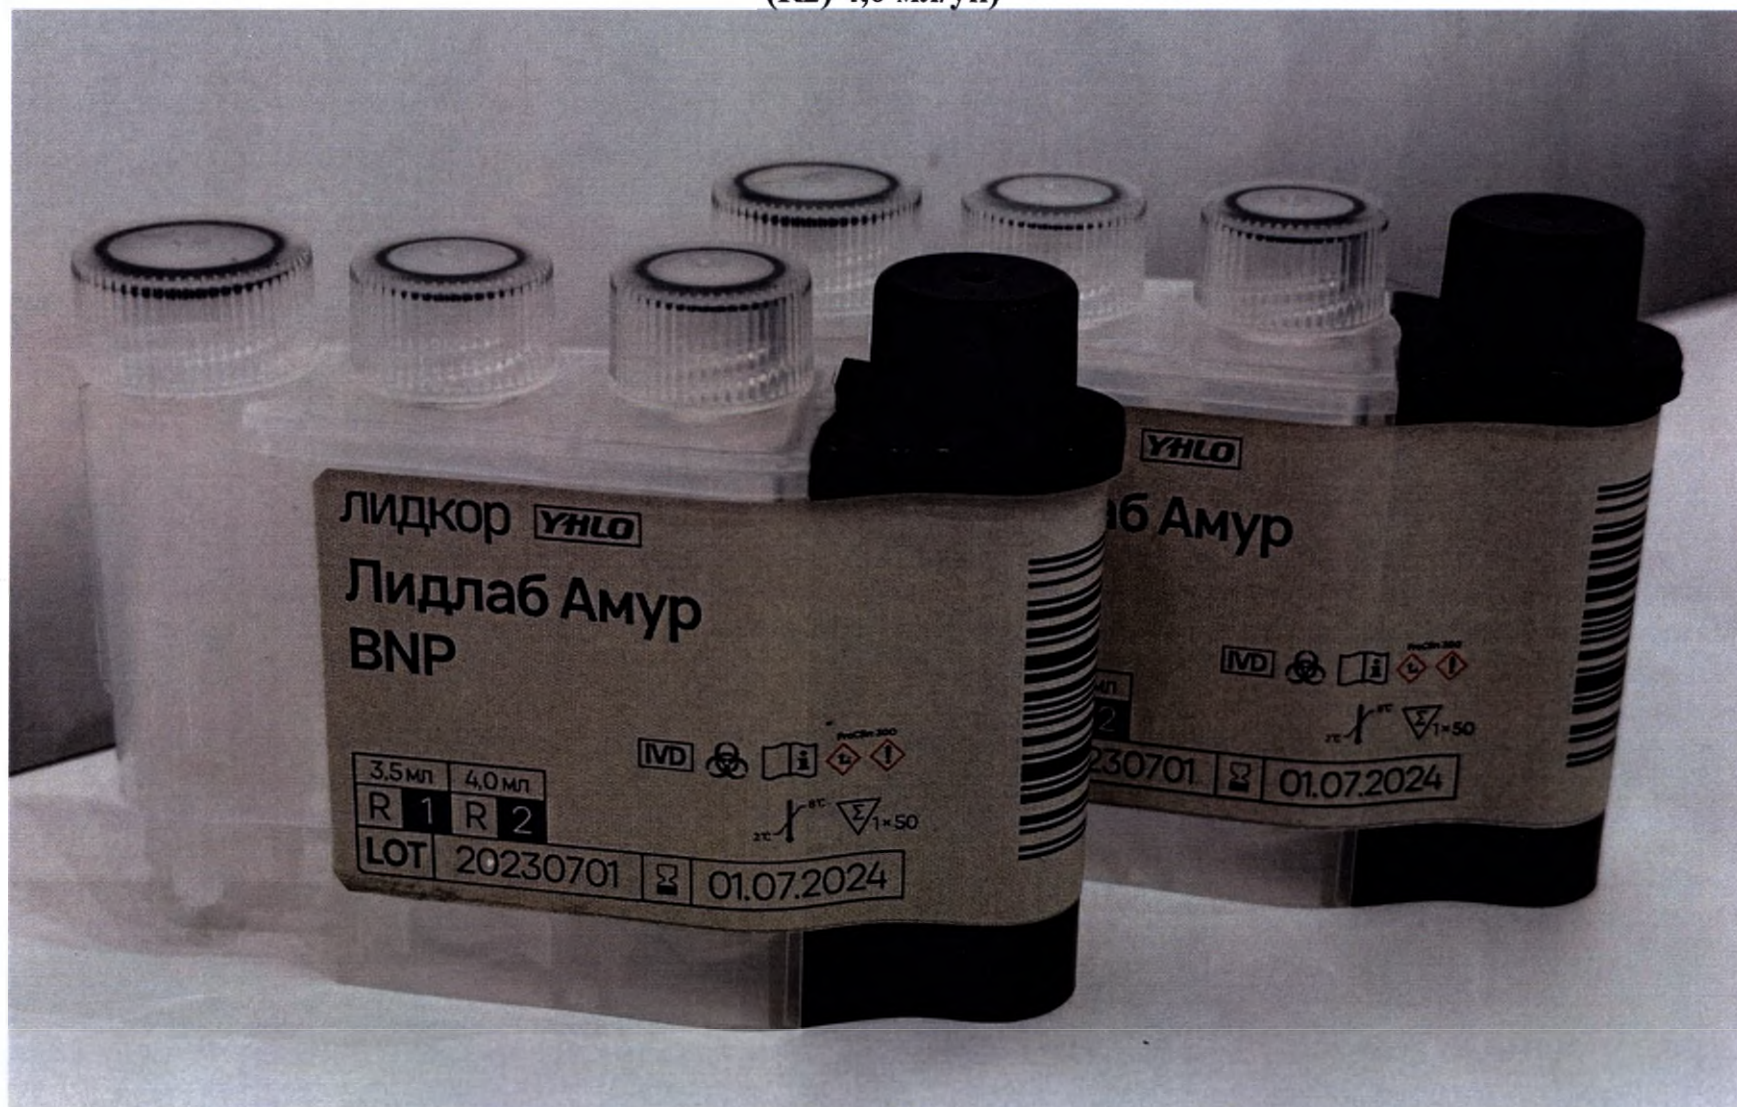

Калибратор 1 (CAL1), лиофилизат




Калибратор 2 (CAL2), лиофилизат



Калибратор 3 (CAL3), лиофилизат



Пароизоляционные крышки

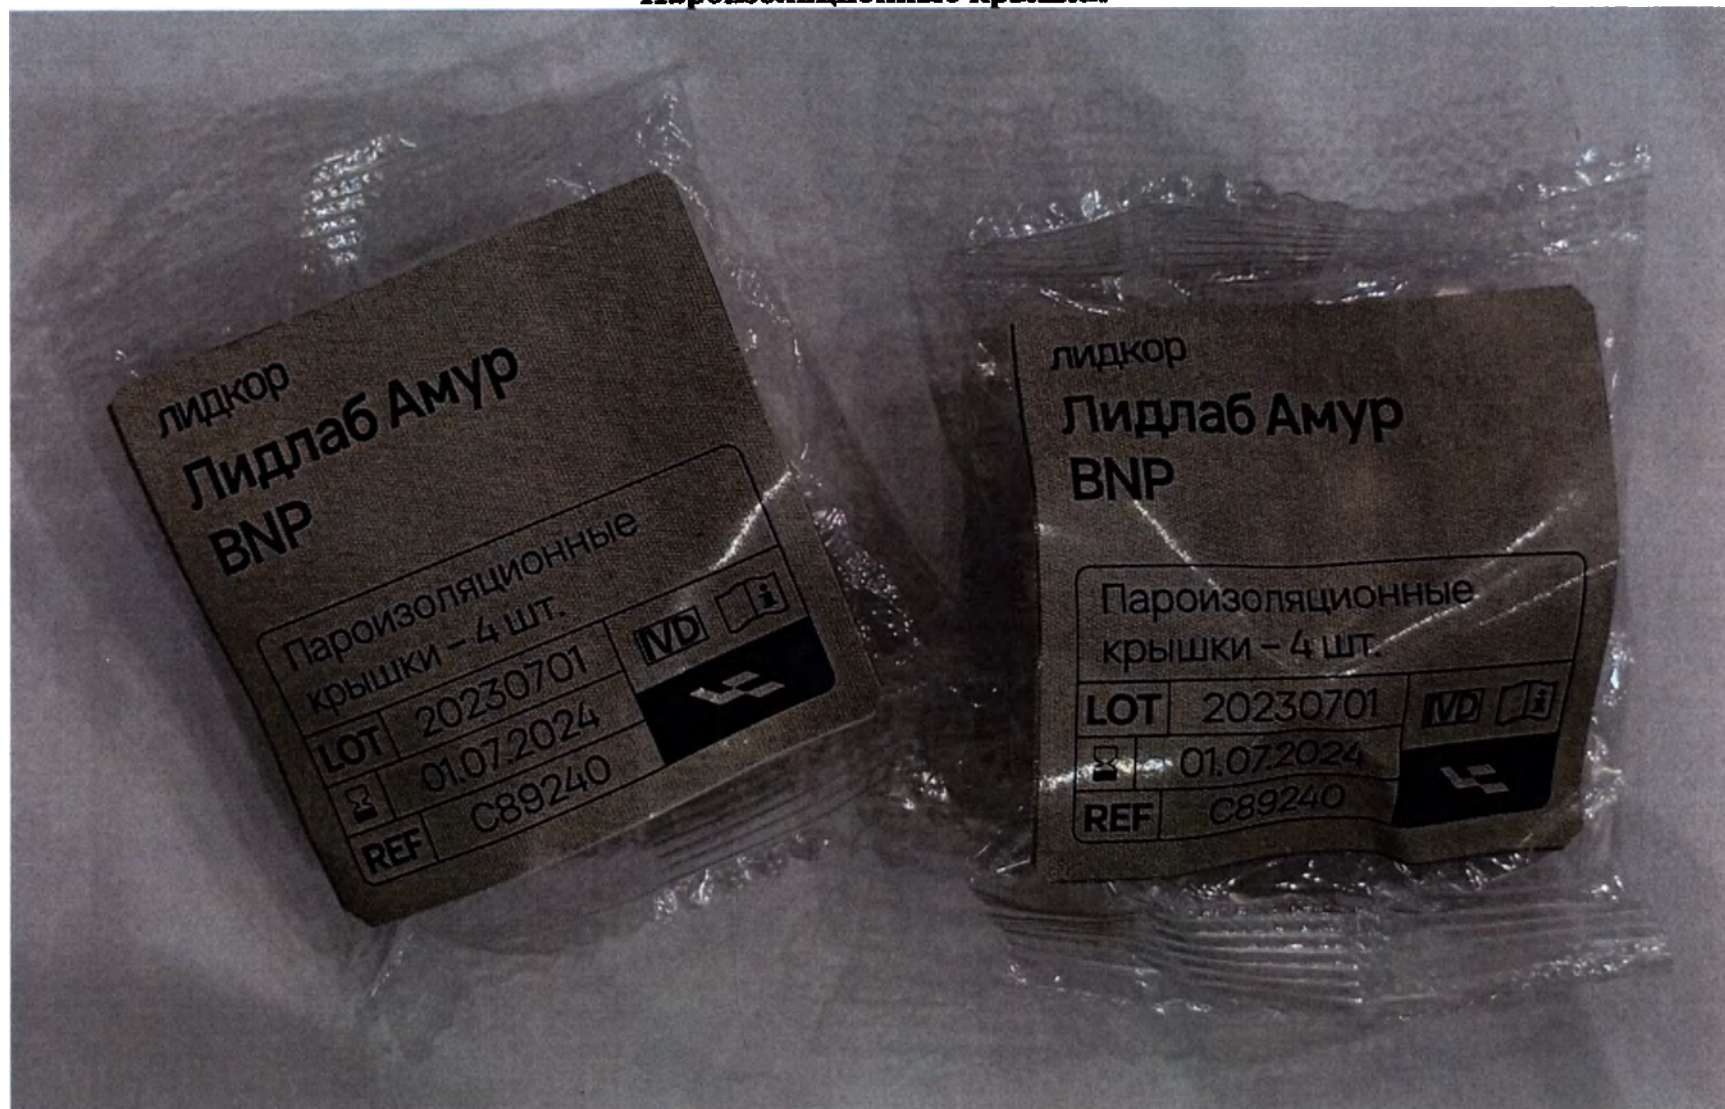

лидлаб


Лидлаб Амур BNP

Набор реагентов на 100 тестов


Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент параметрический микронизированный (PM) 3,5 мл/уп, Реагент ионный калия/галакт (KAL) 4,0 мл/уп) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), глюкофизет – 1 флакон.
3. Калибратор 2 (CAL2), глюкофизет – 1 флакон.
4. Калибратор 3 (CAL3), глюкофизет – 1 флакон.
5. Паранормализационные крышки – 8 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.


Набор реагентов на 100 тестов. Вид сбоку

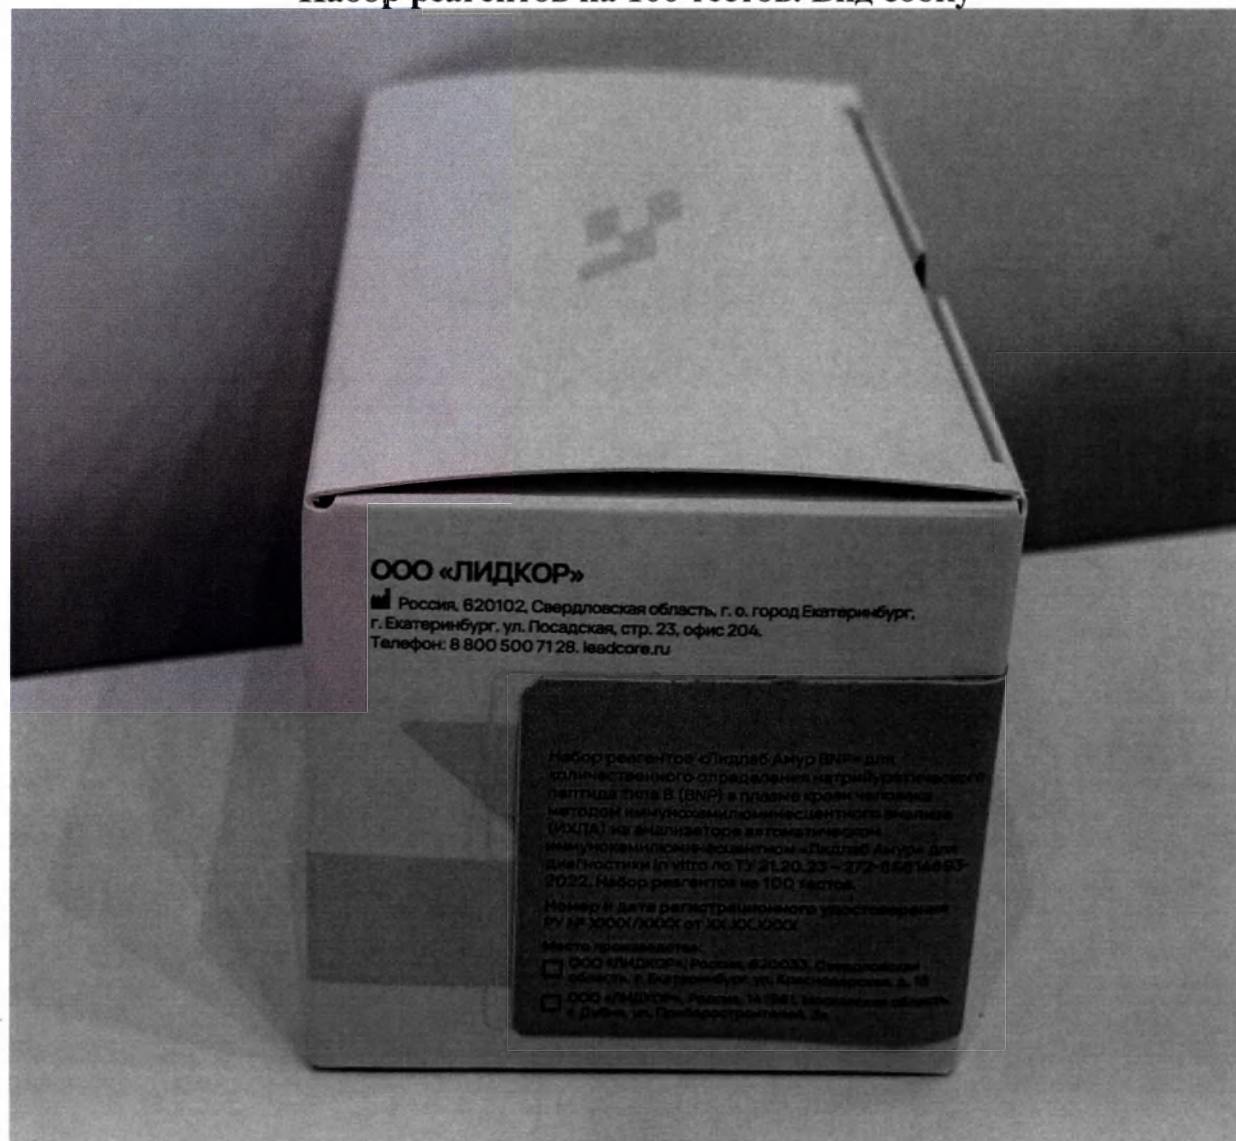

Набор реагентов на 100 тестов. Вид сзади

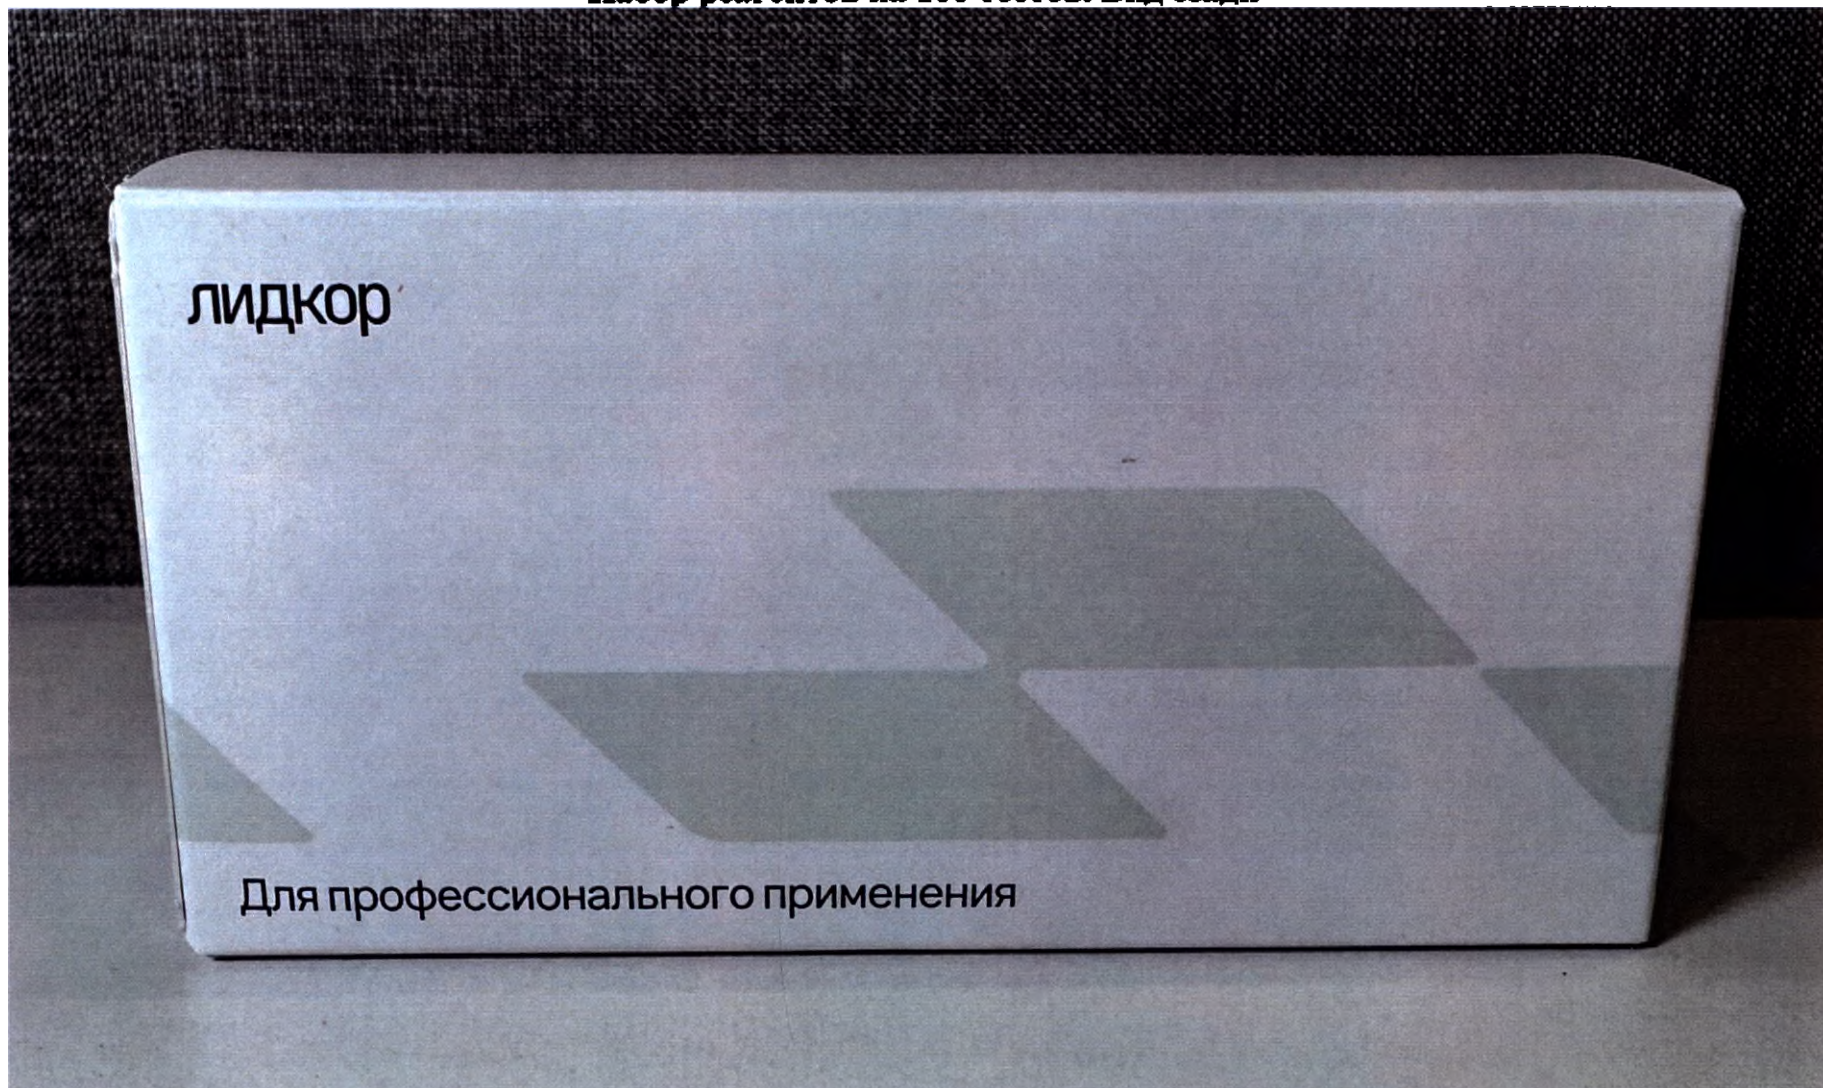

Набор реагентов на 200 тестов

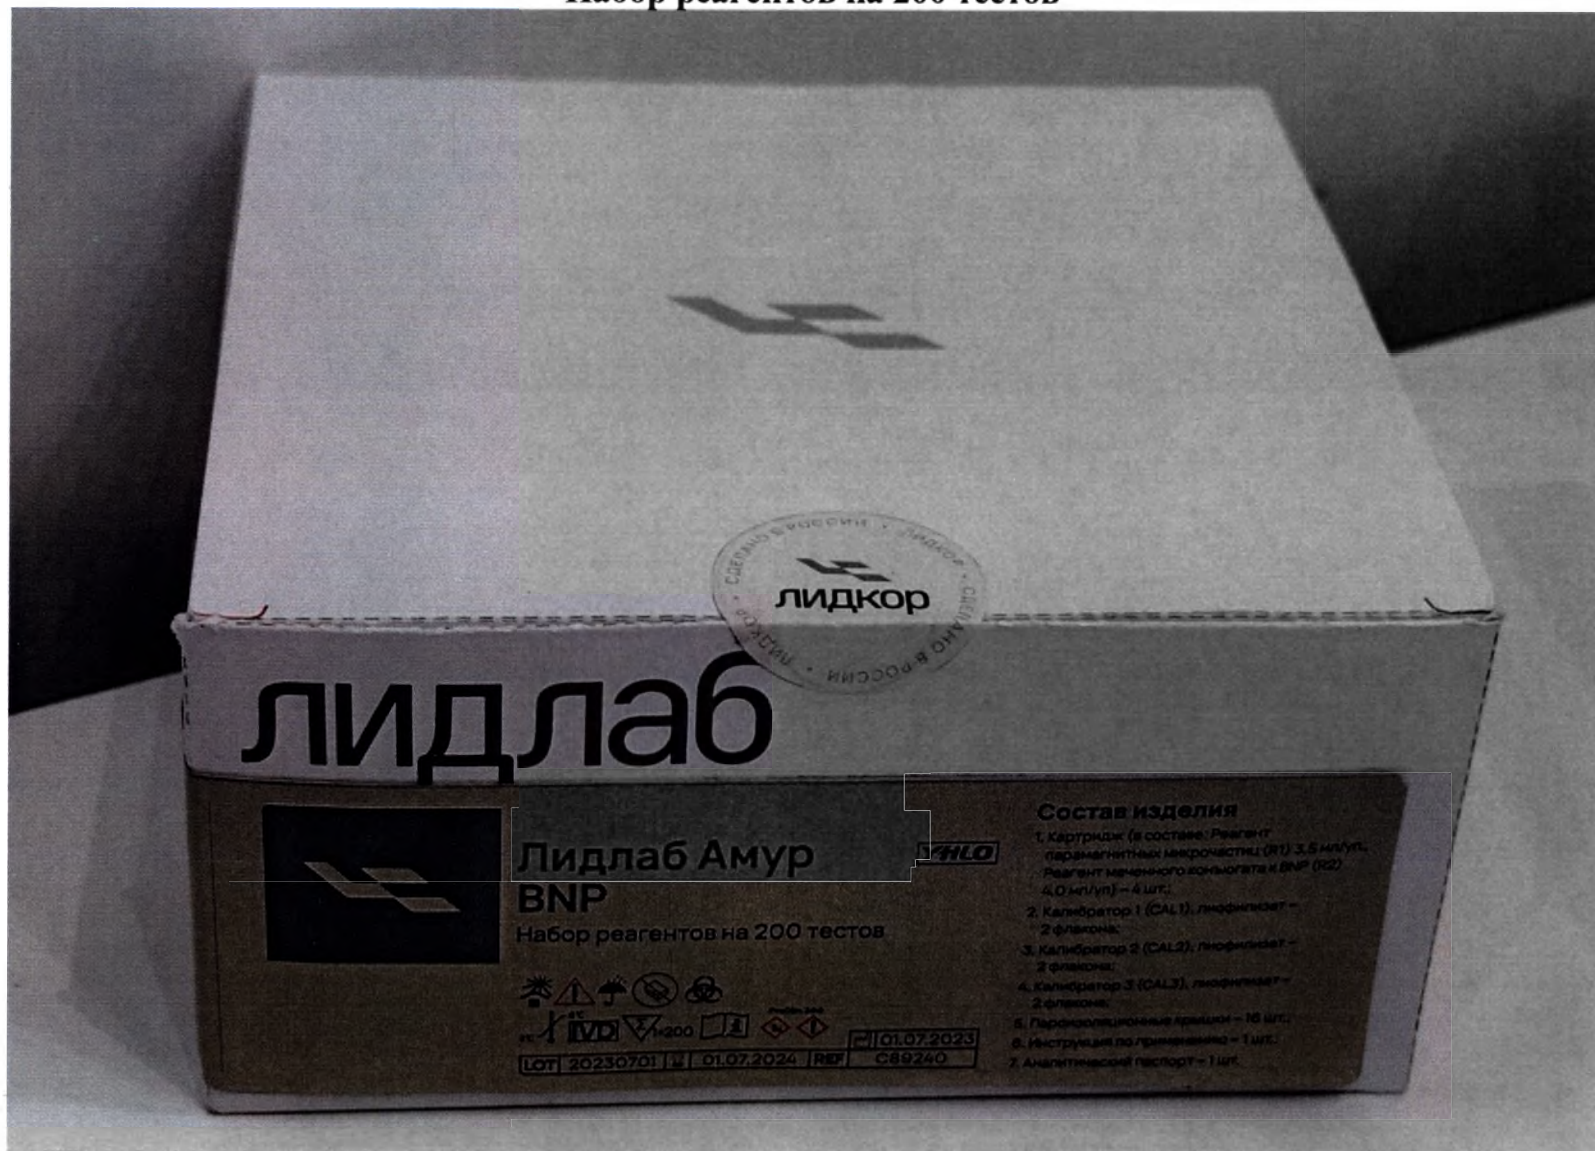

Набор реагентов на 200 тестов. Вид сбоку

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 7128. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур BNP» для
количественного определения натрийуретического
пептида типа В (BNP) в плазме крови человека
методом иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23 – 272-65614693-
2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, За




Набор реагентов на 200 тестов. Вид сзади





Набор реагентов на 500 тестов

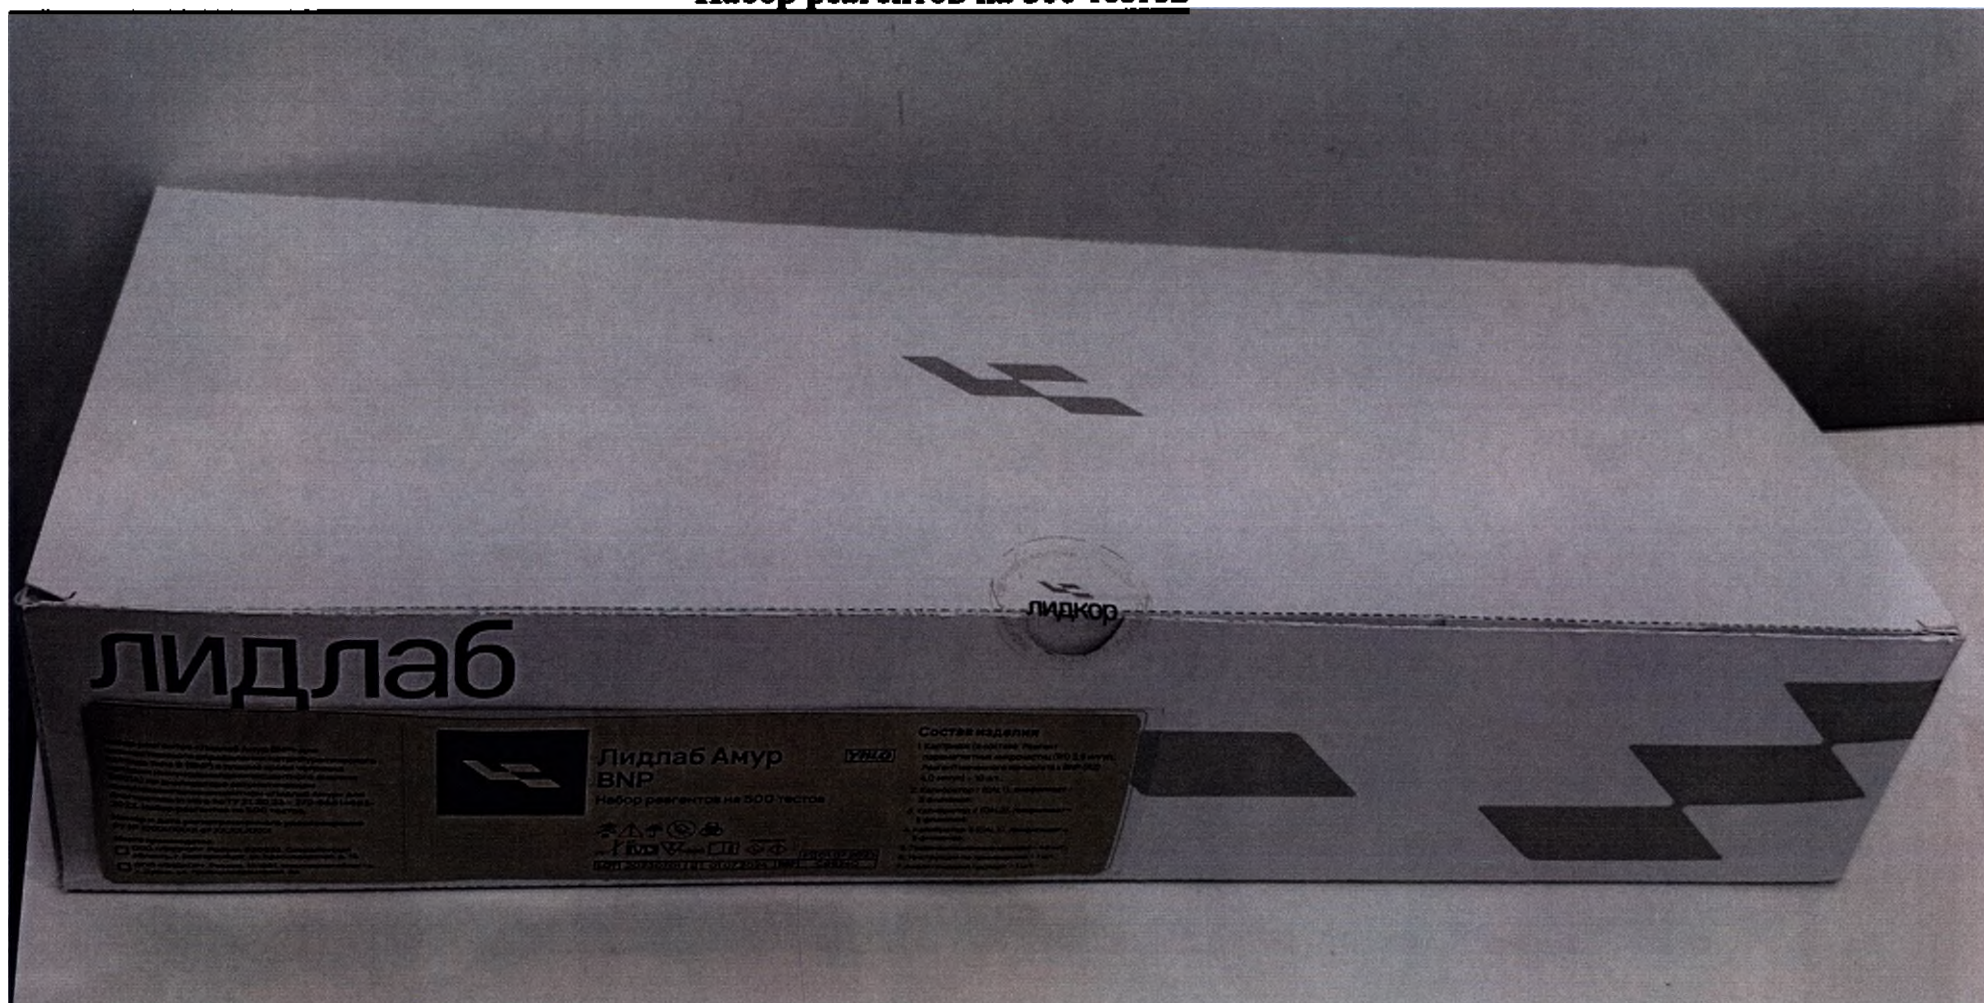

лидлаб

лидкор

Лидлаб Амур
BNP


Набор реагентов на 500 тестов

Состав изделия


- 1. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 2. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 3. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 4. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 5. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 6. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 7. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 8. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 9. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)
- 10. Карtridge (картридж) с реактивом для определения концентрации BNP в моче, 4,0 мл (10 шт.)



Набор реагентов на 500 тестов. Вид сбоку

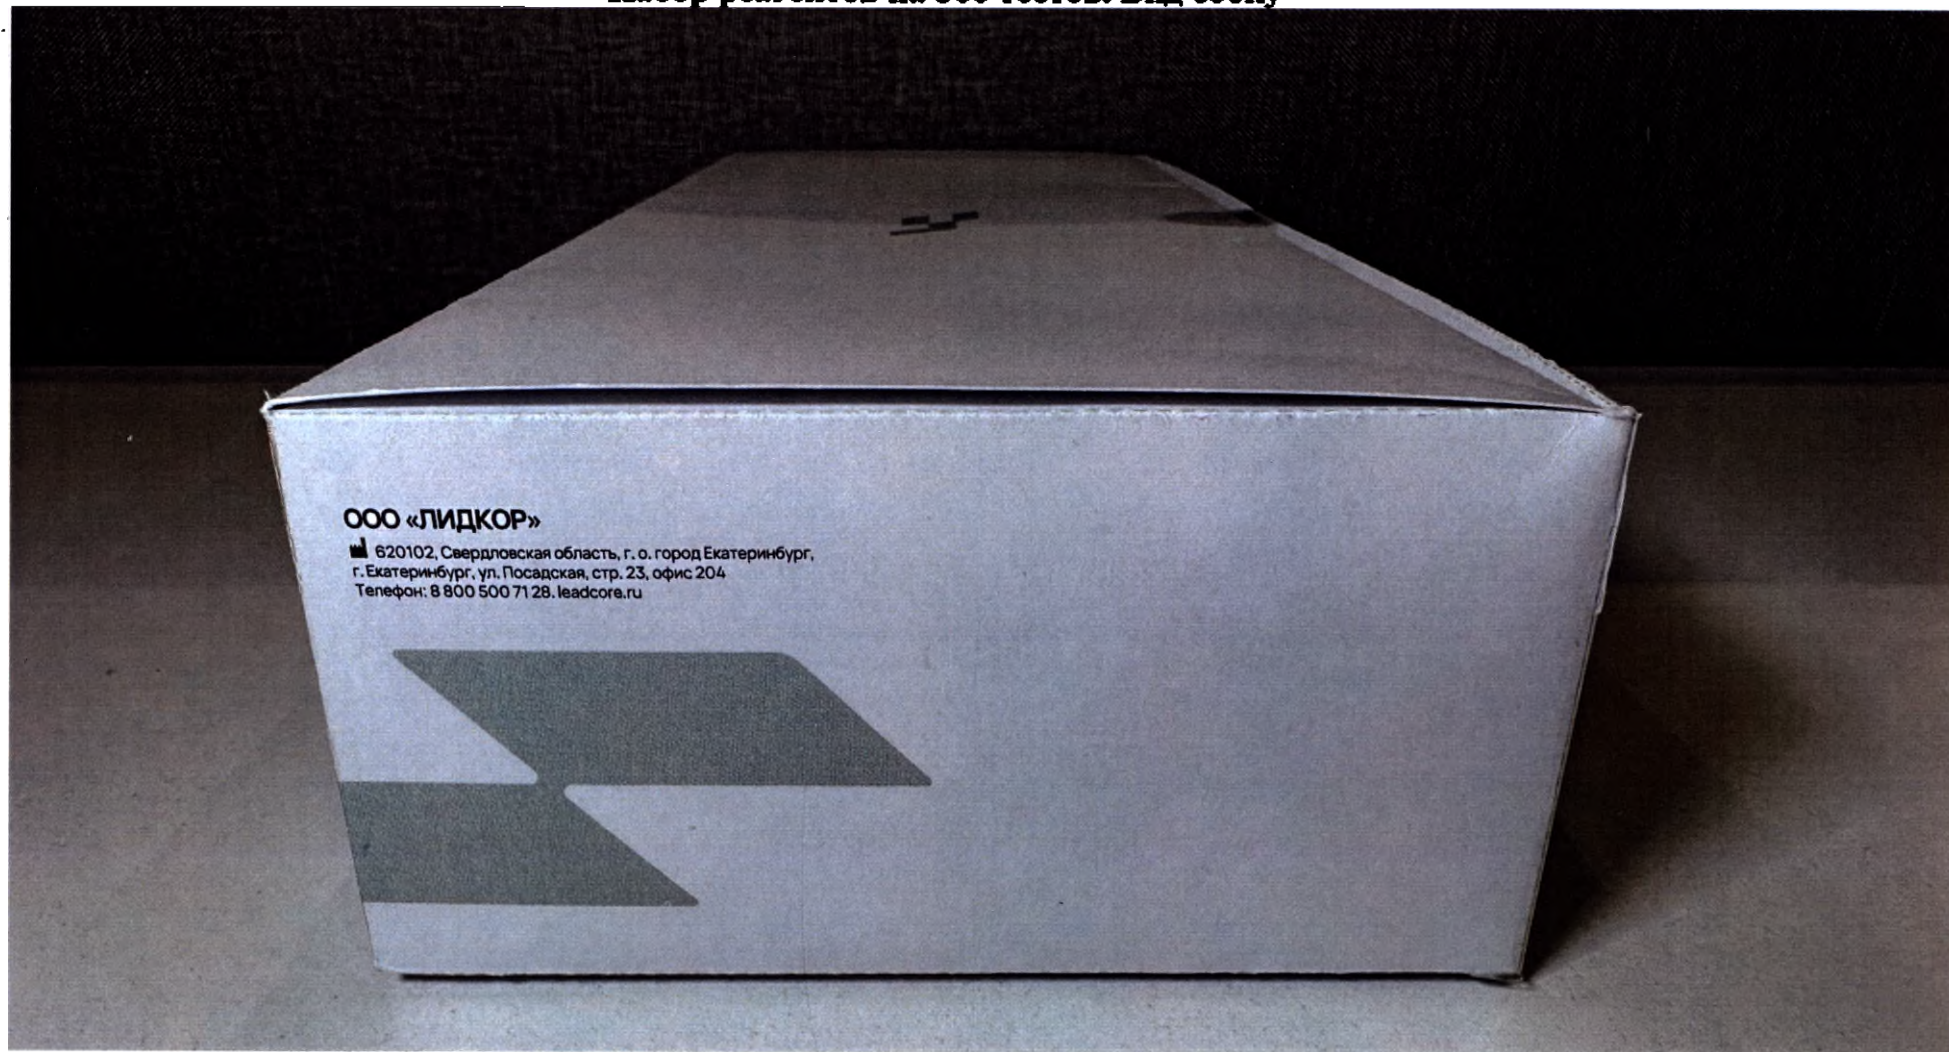

Набор реагентов на 500 тестов. Вид сзади

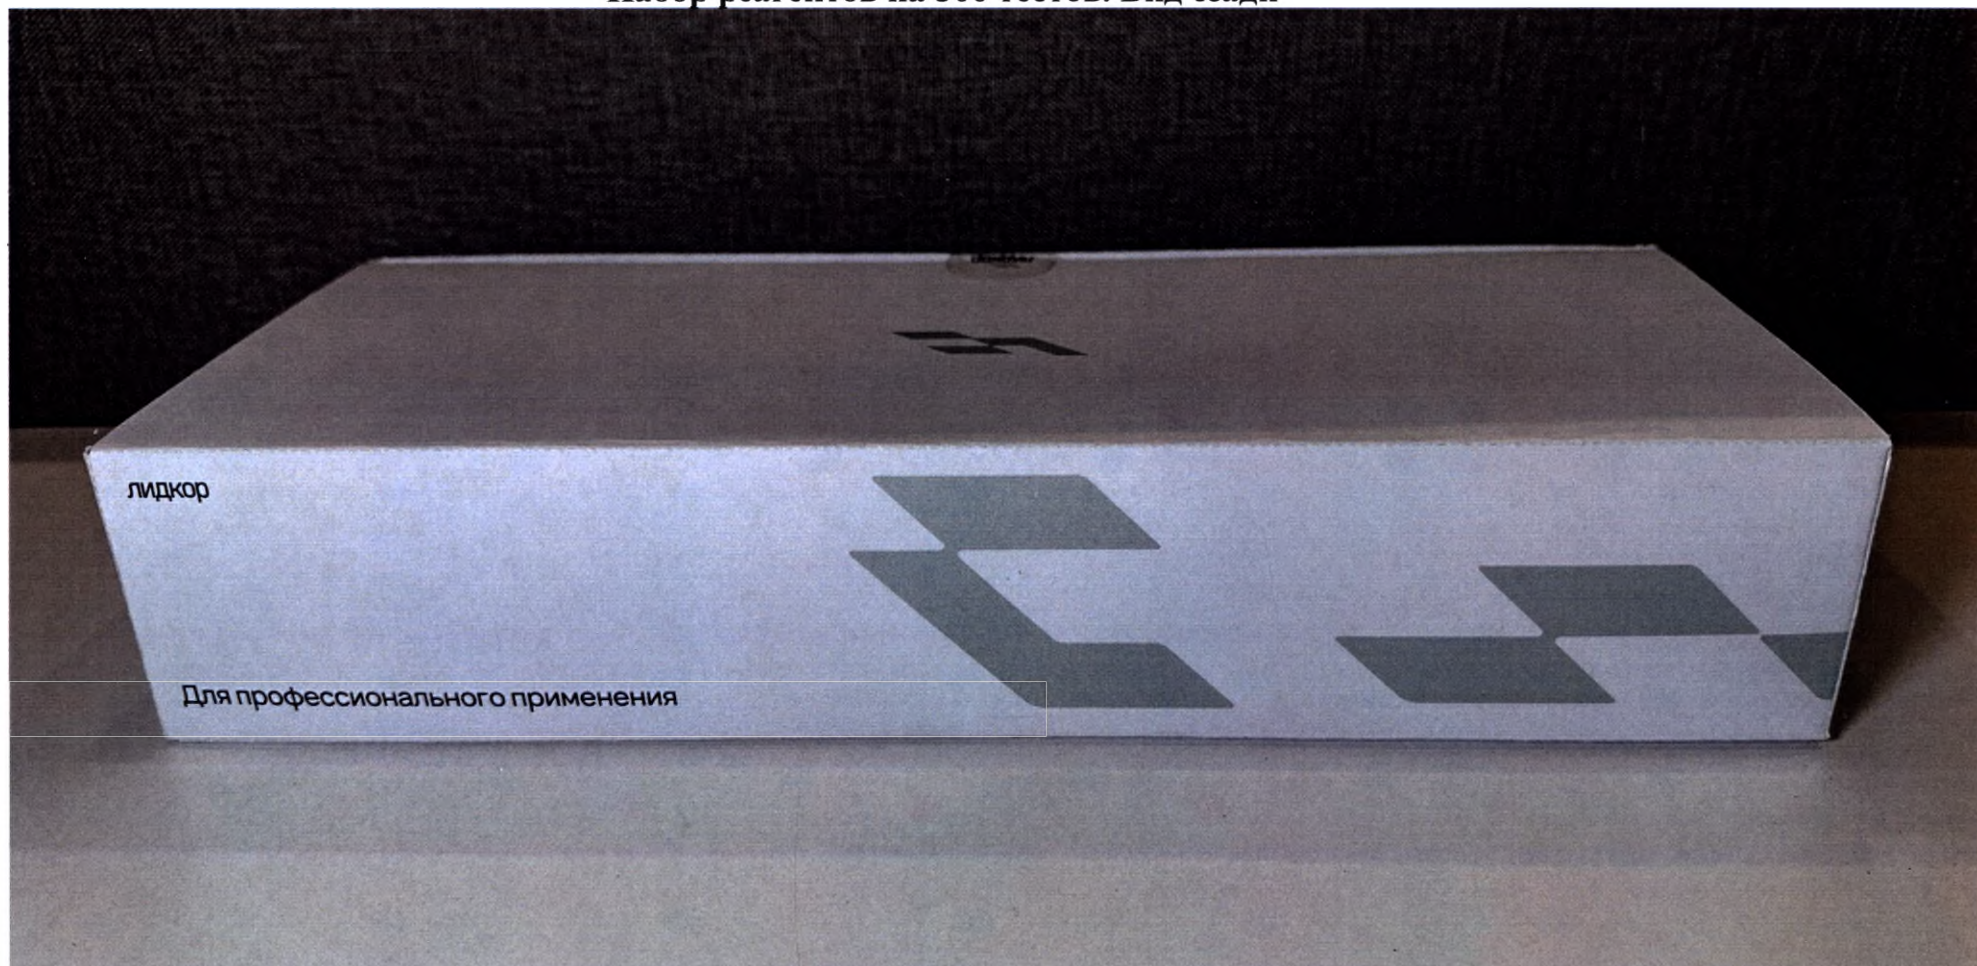



Набор реагентов на 1000 тестов






Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сбоку




Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сзади

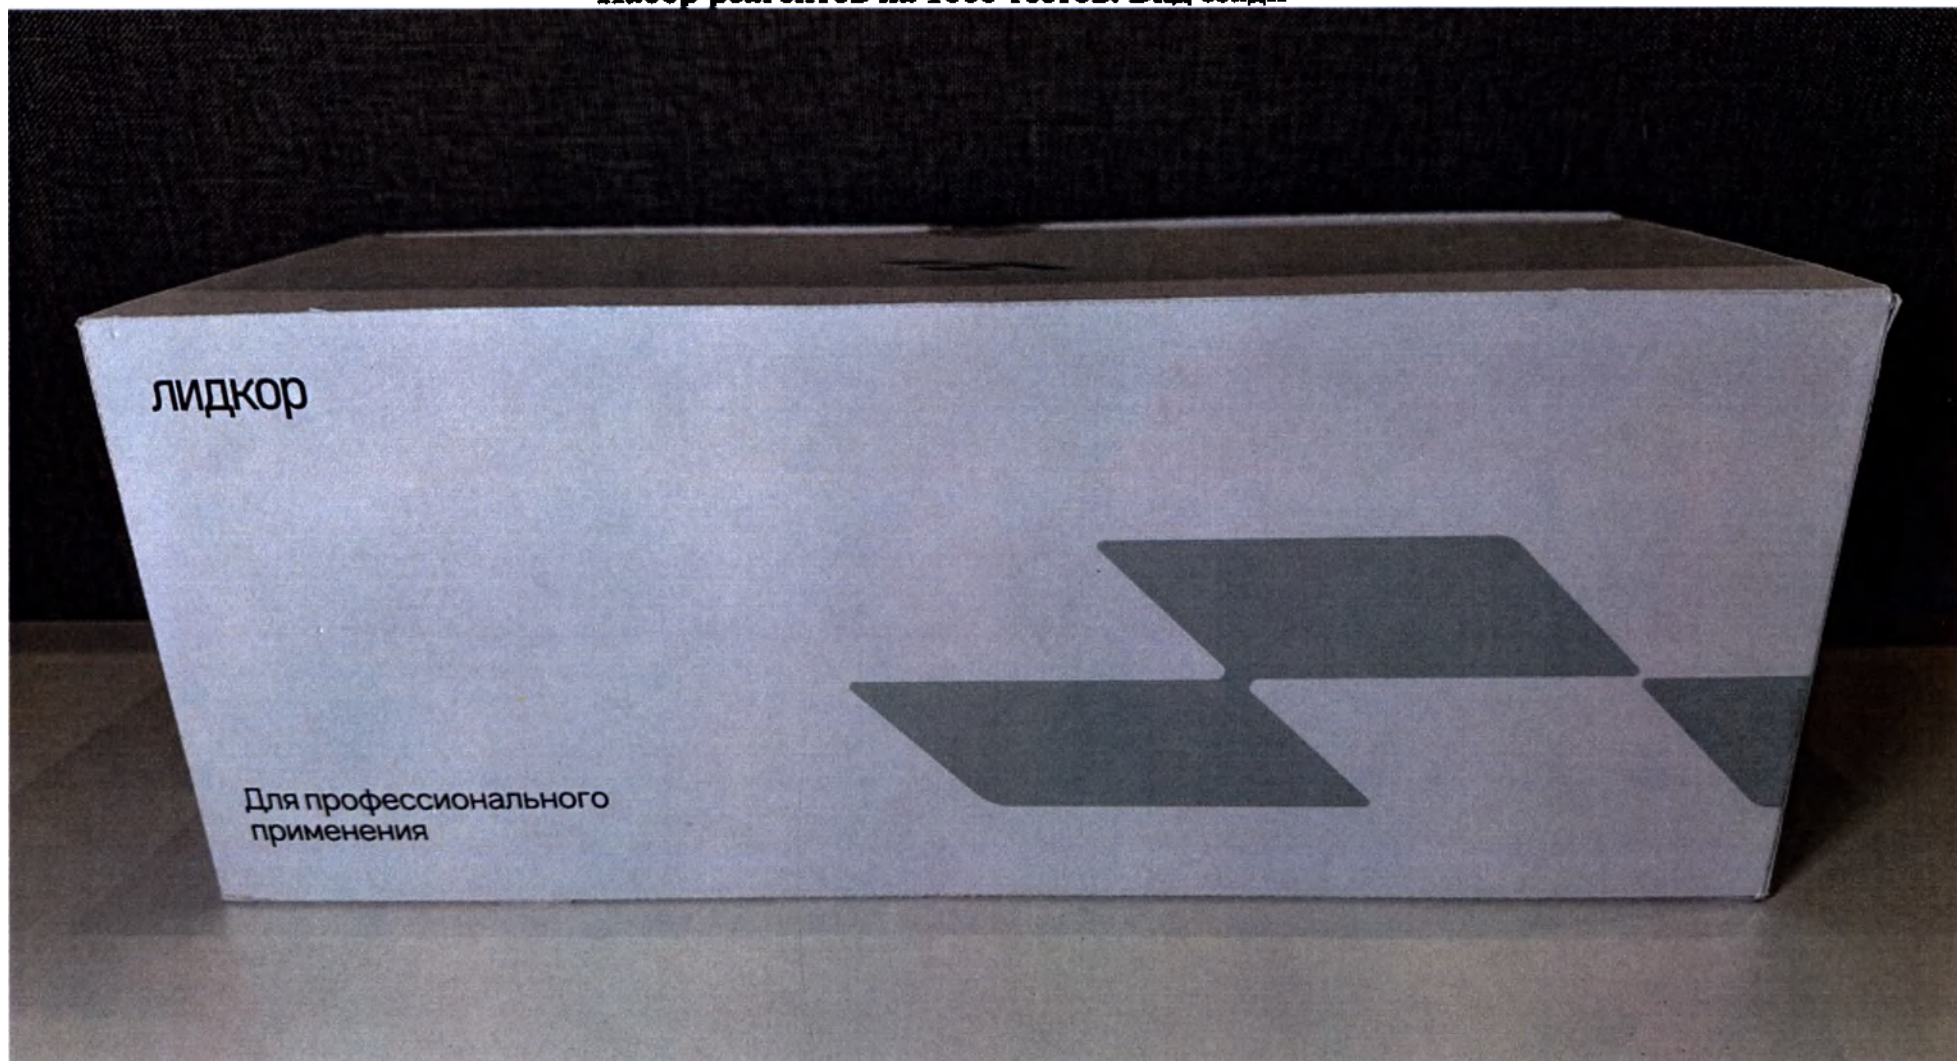


Общий вид медицинского изделия



Транспортная упаковка Набора реагентов на 100 тестов

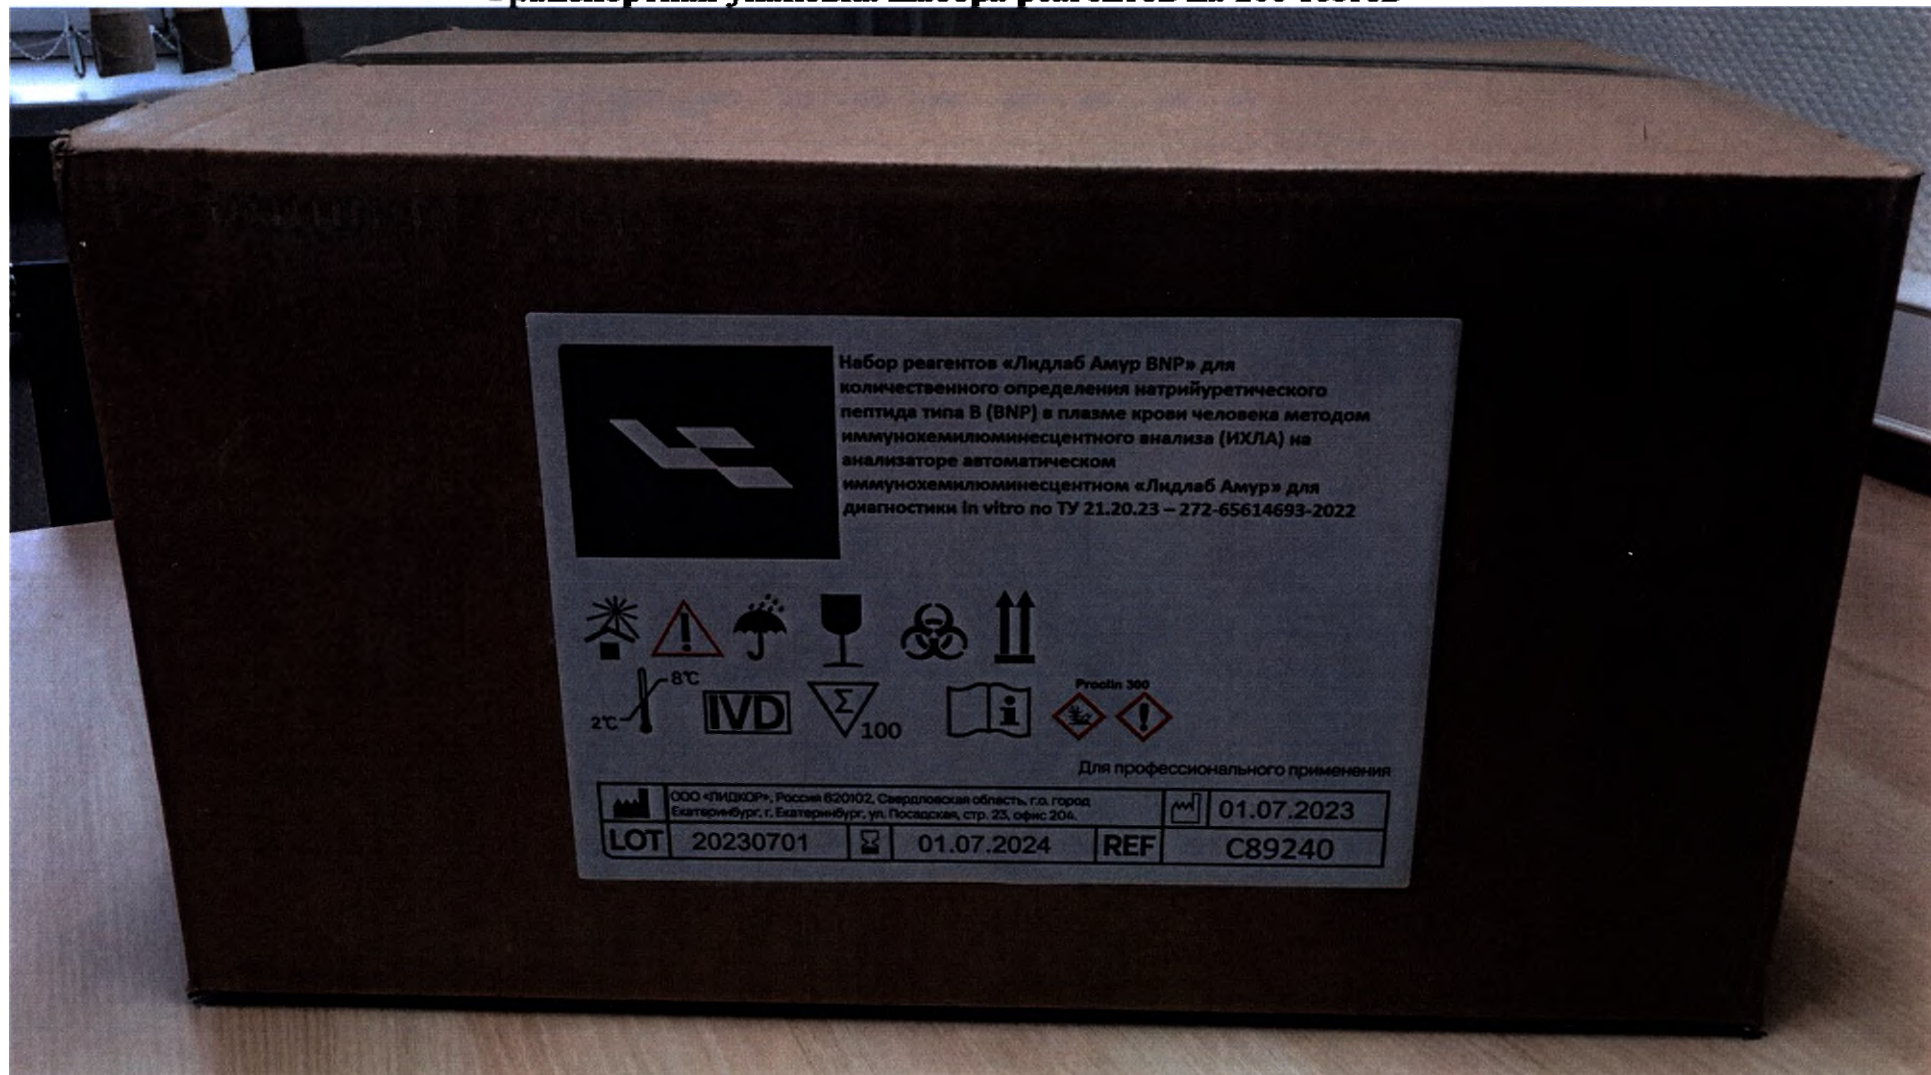


Транспортная упаковка Набора реагентов на 200 тестов

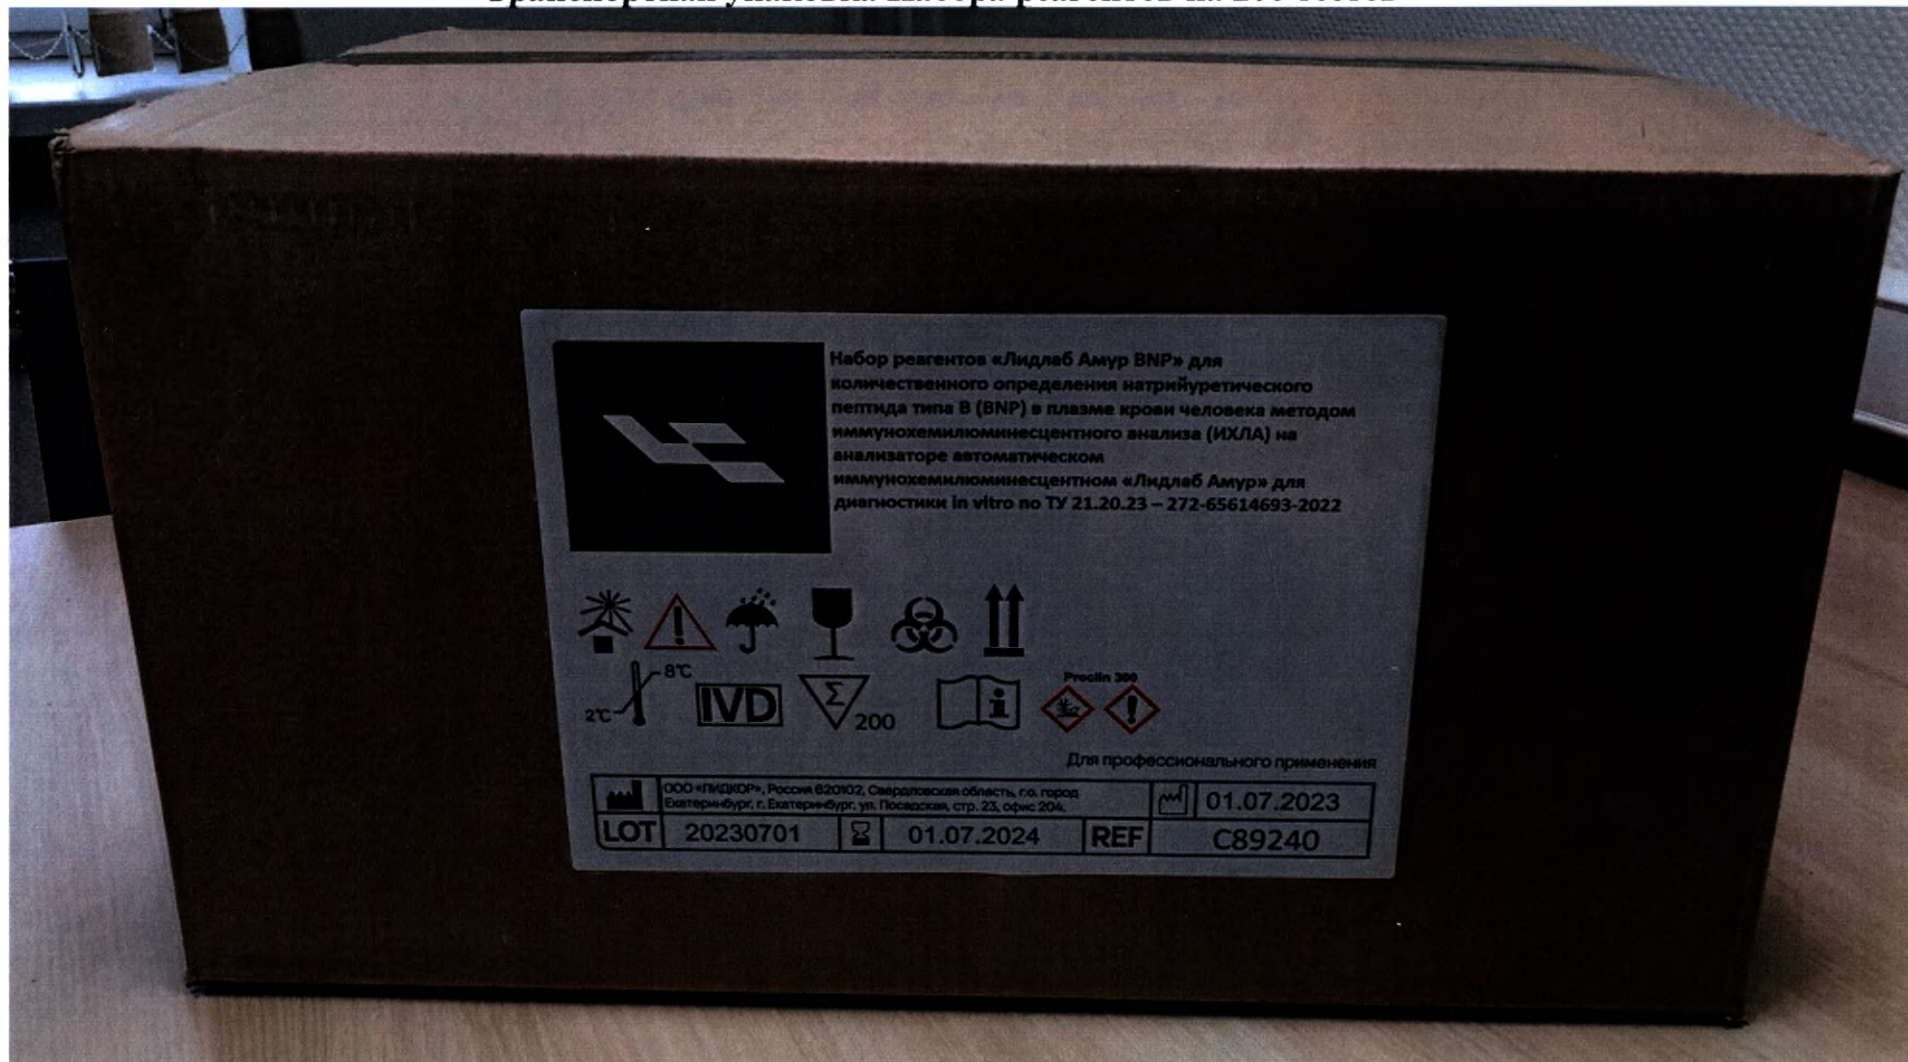

Транспортная упаковка Набора реагентов на 500 тестов



Транспортная упаковка Набора реагентов на 1000 тестов

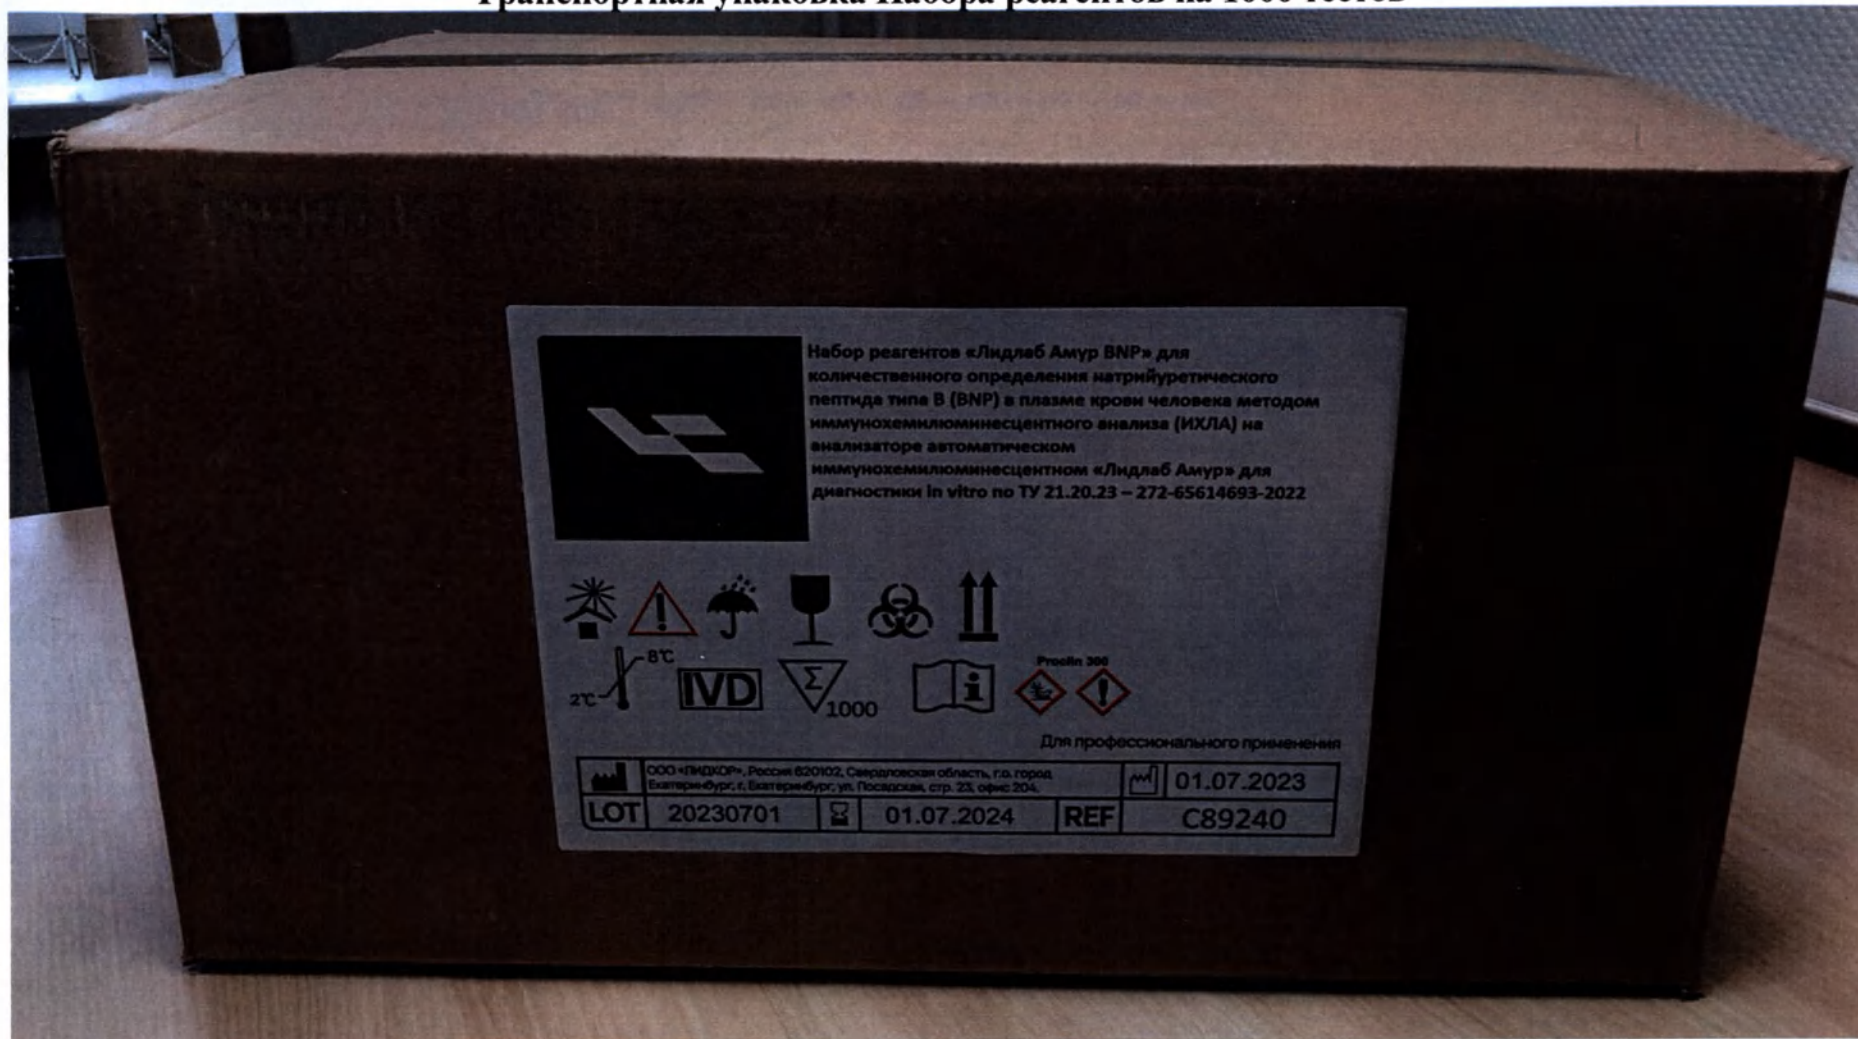

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

23 (подпись) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгу

