




«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер по регистрации
медицинских изделий Бизнес-
юнита «Радиология»

АО «БАЙЕР»

Тихонова М.А.

«11» июня 2020 г.



АО «БАЙЕР»

107113, Россия, Москва
ул. 3-я Рыбинская д.18, стр.2


Тел.: (495) 234 20 00


www.bayer.ru

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Наборы вспомогательные полимерные стерильные одноразовые, к емкостям полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к устройствам для внутривенного введения
MEDRAD Avanta



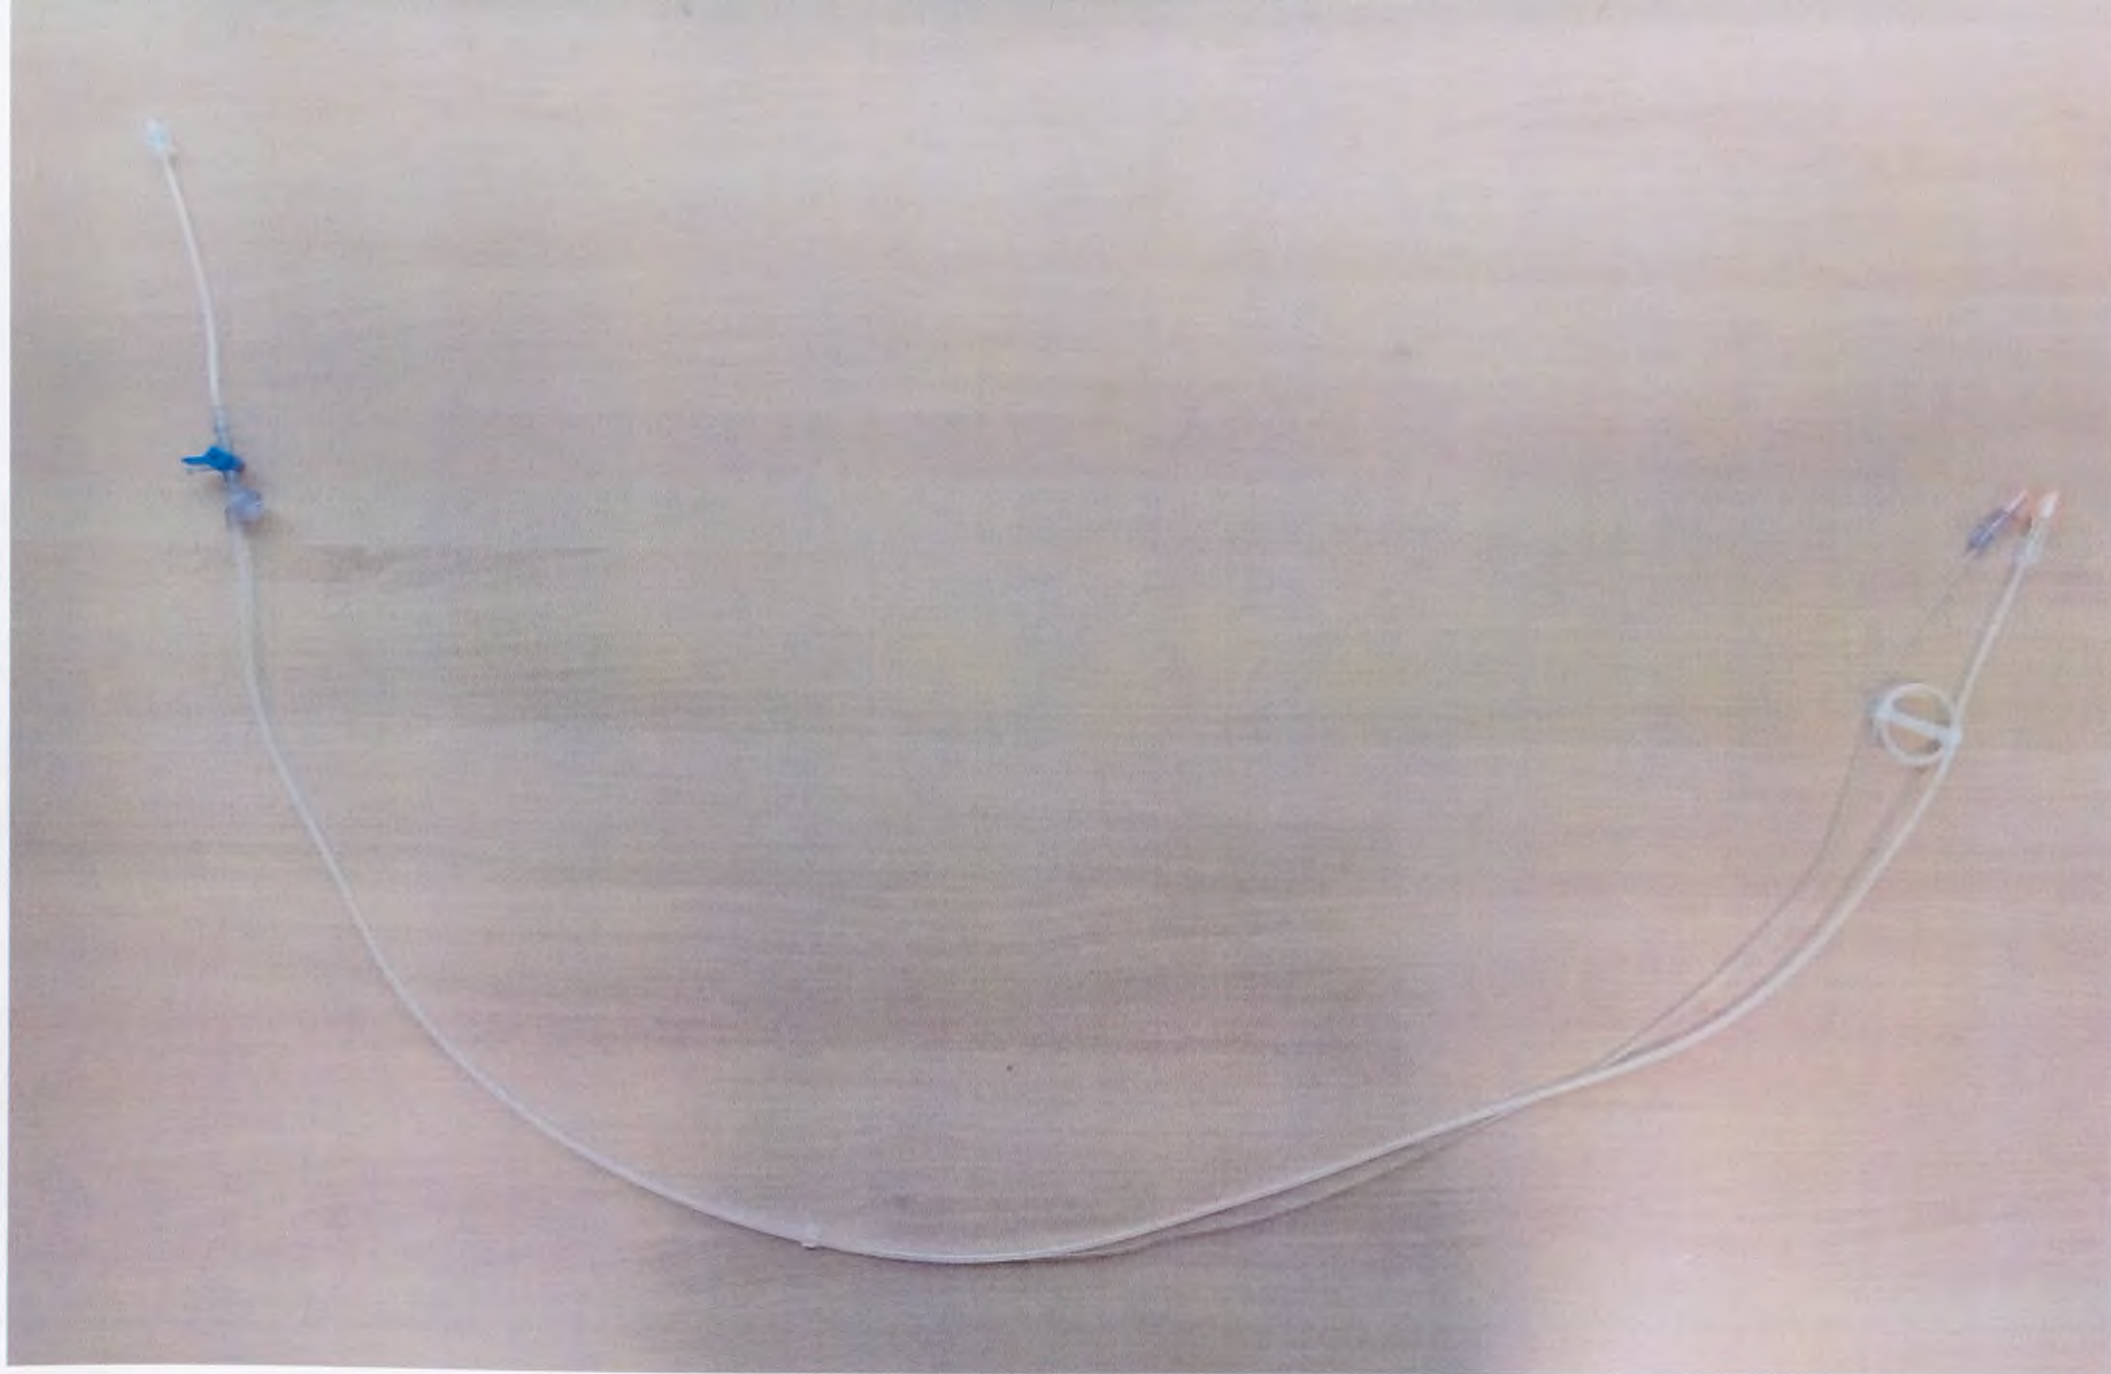

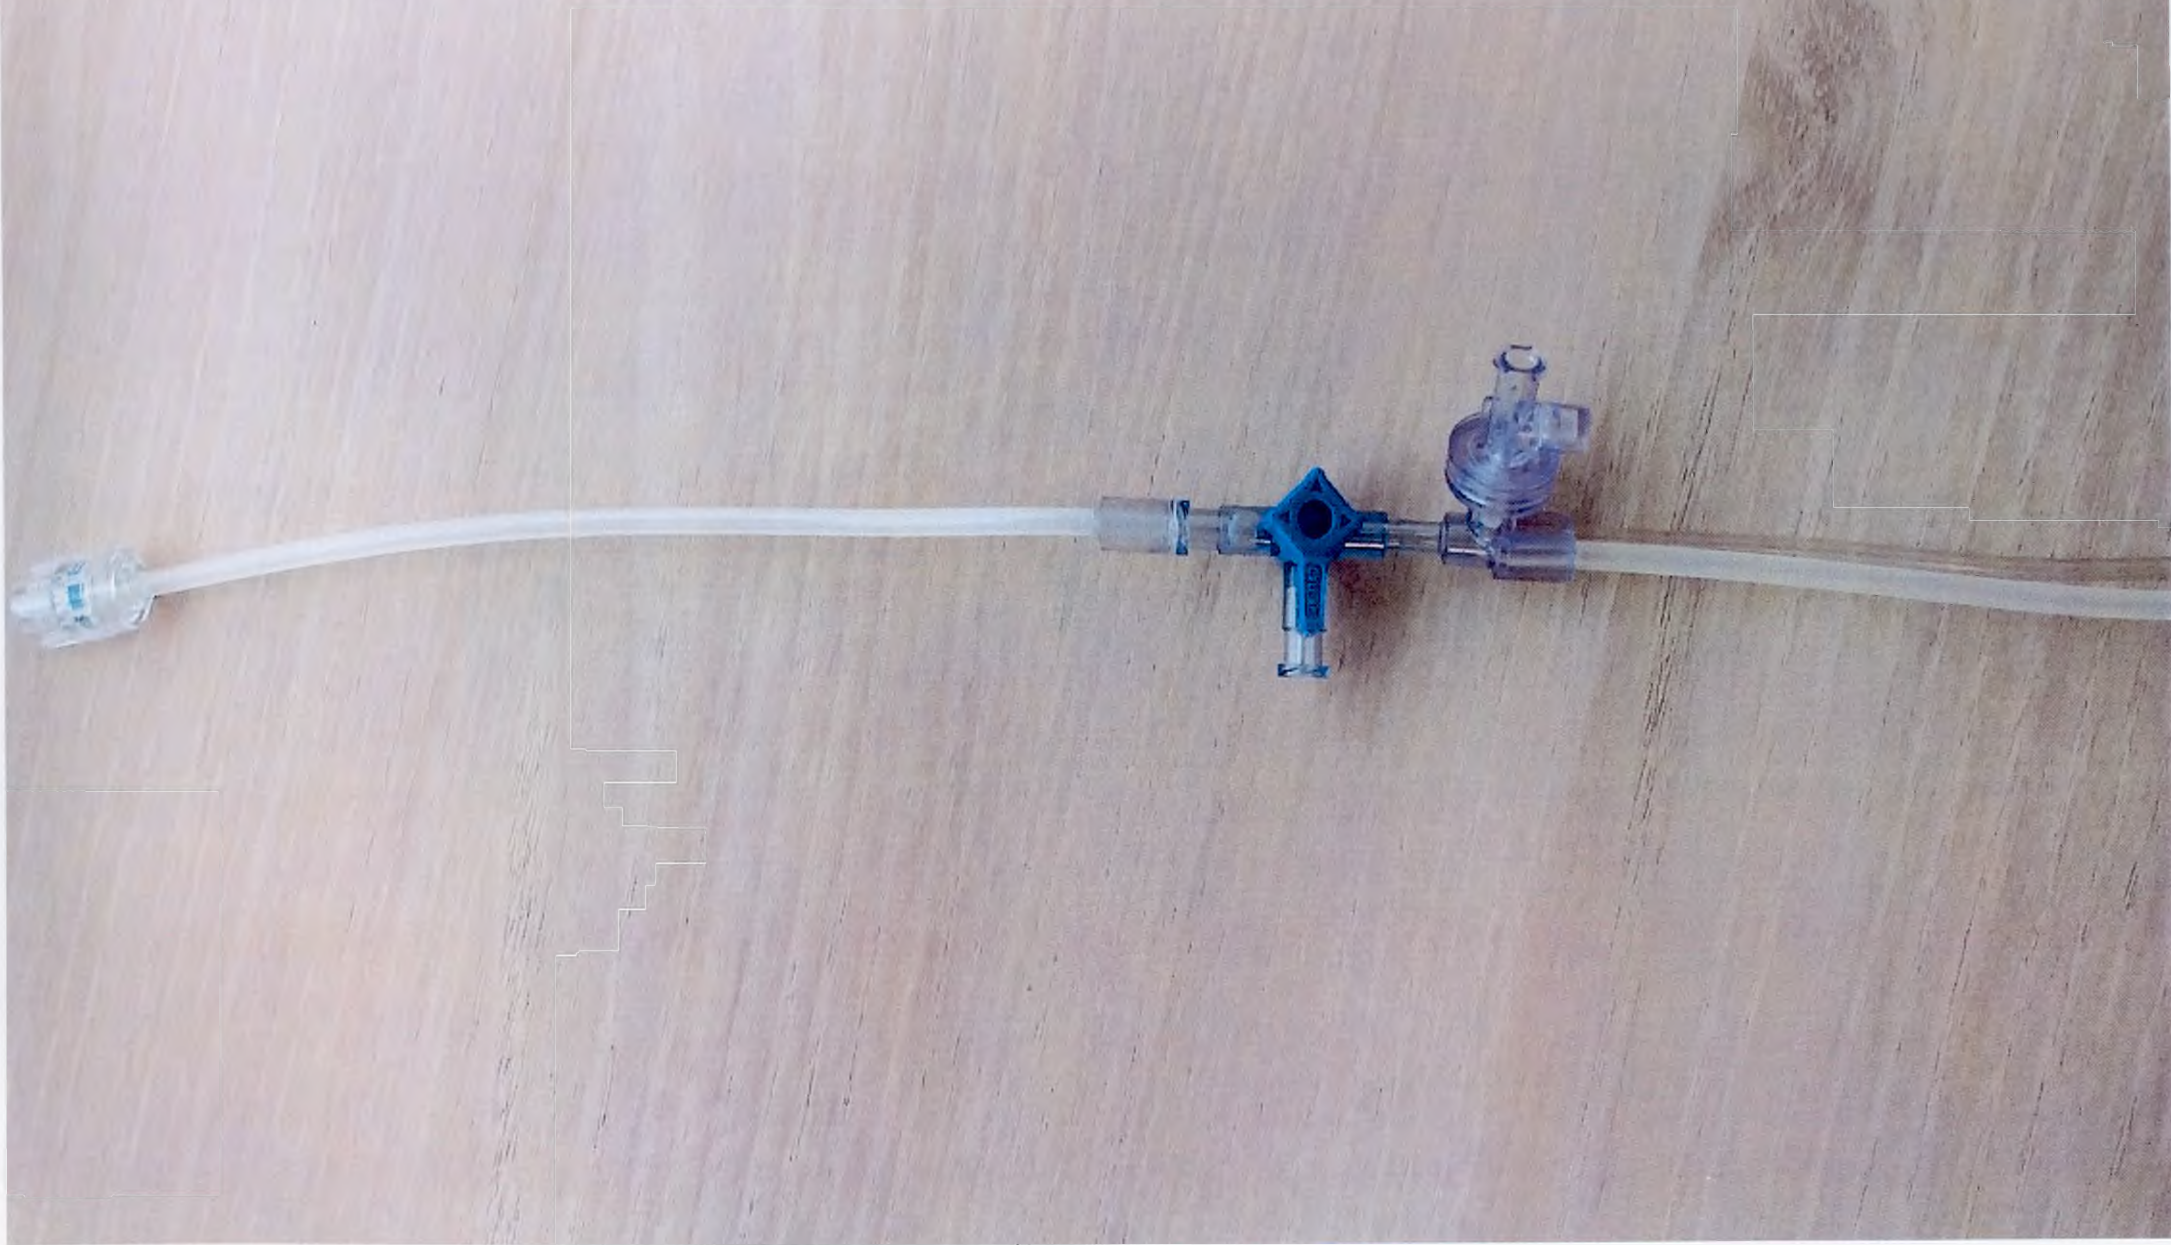


Трубка 7" Ø 0,145" (фото 1)



Трубка 59" Ø 0,110" и Трубка 59" Ø 0,145" (фото 2)



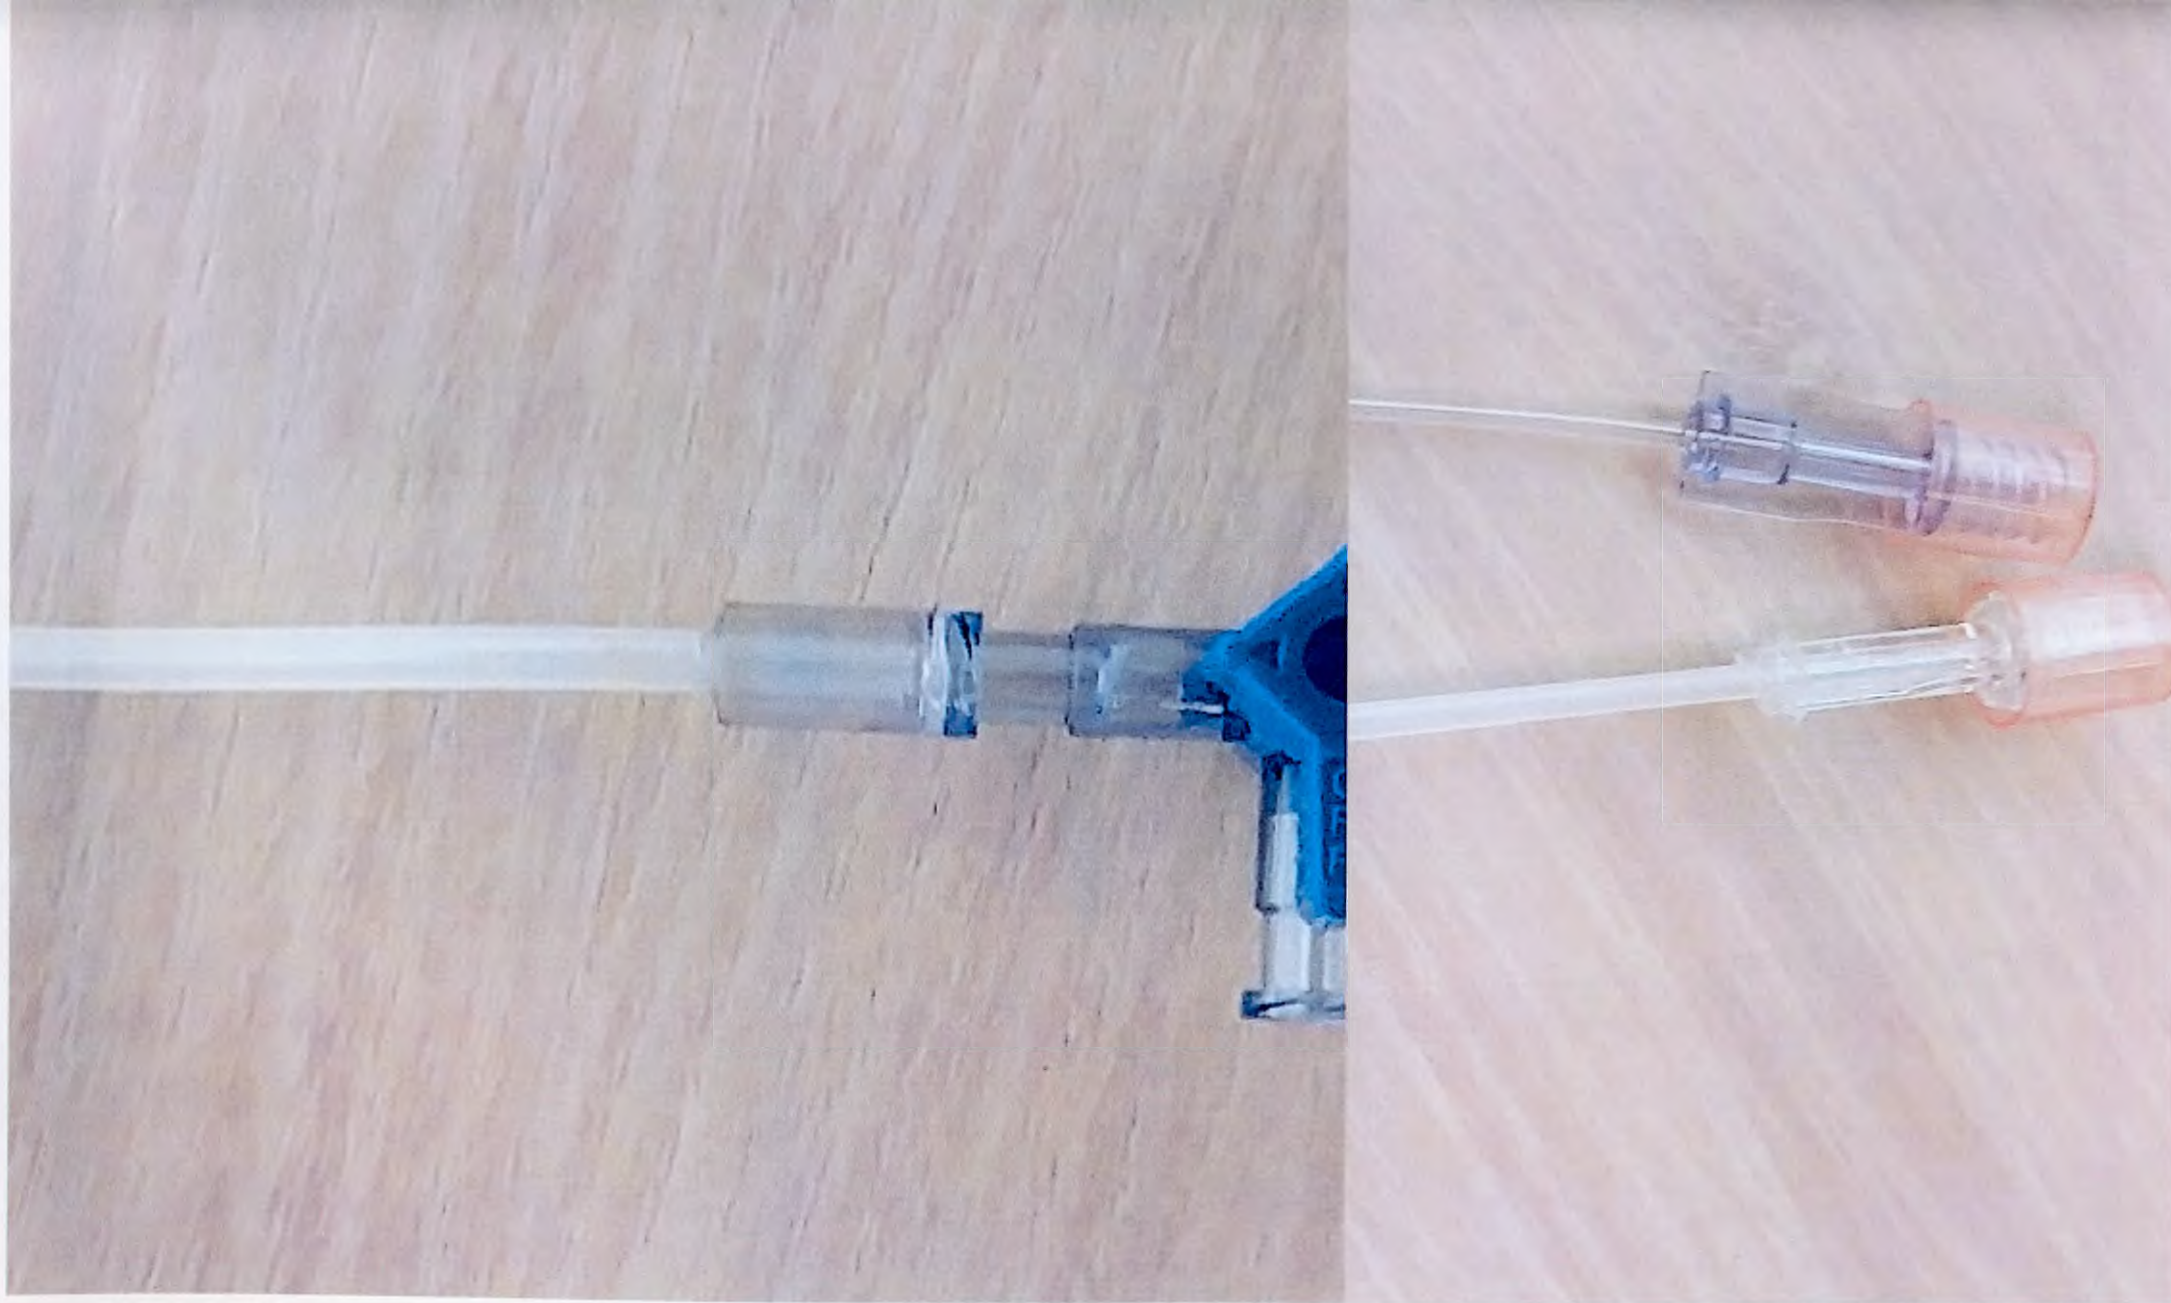

Адаптер Луэра - 3 шт










Адаптер вращающийся.




Набор AVA 500 SPAT Angio в составе в общем виде (в стерильной упаковке)

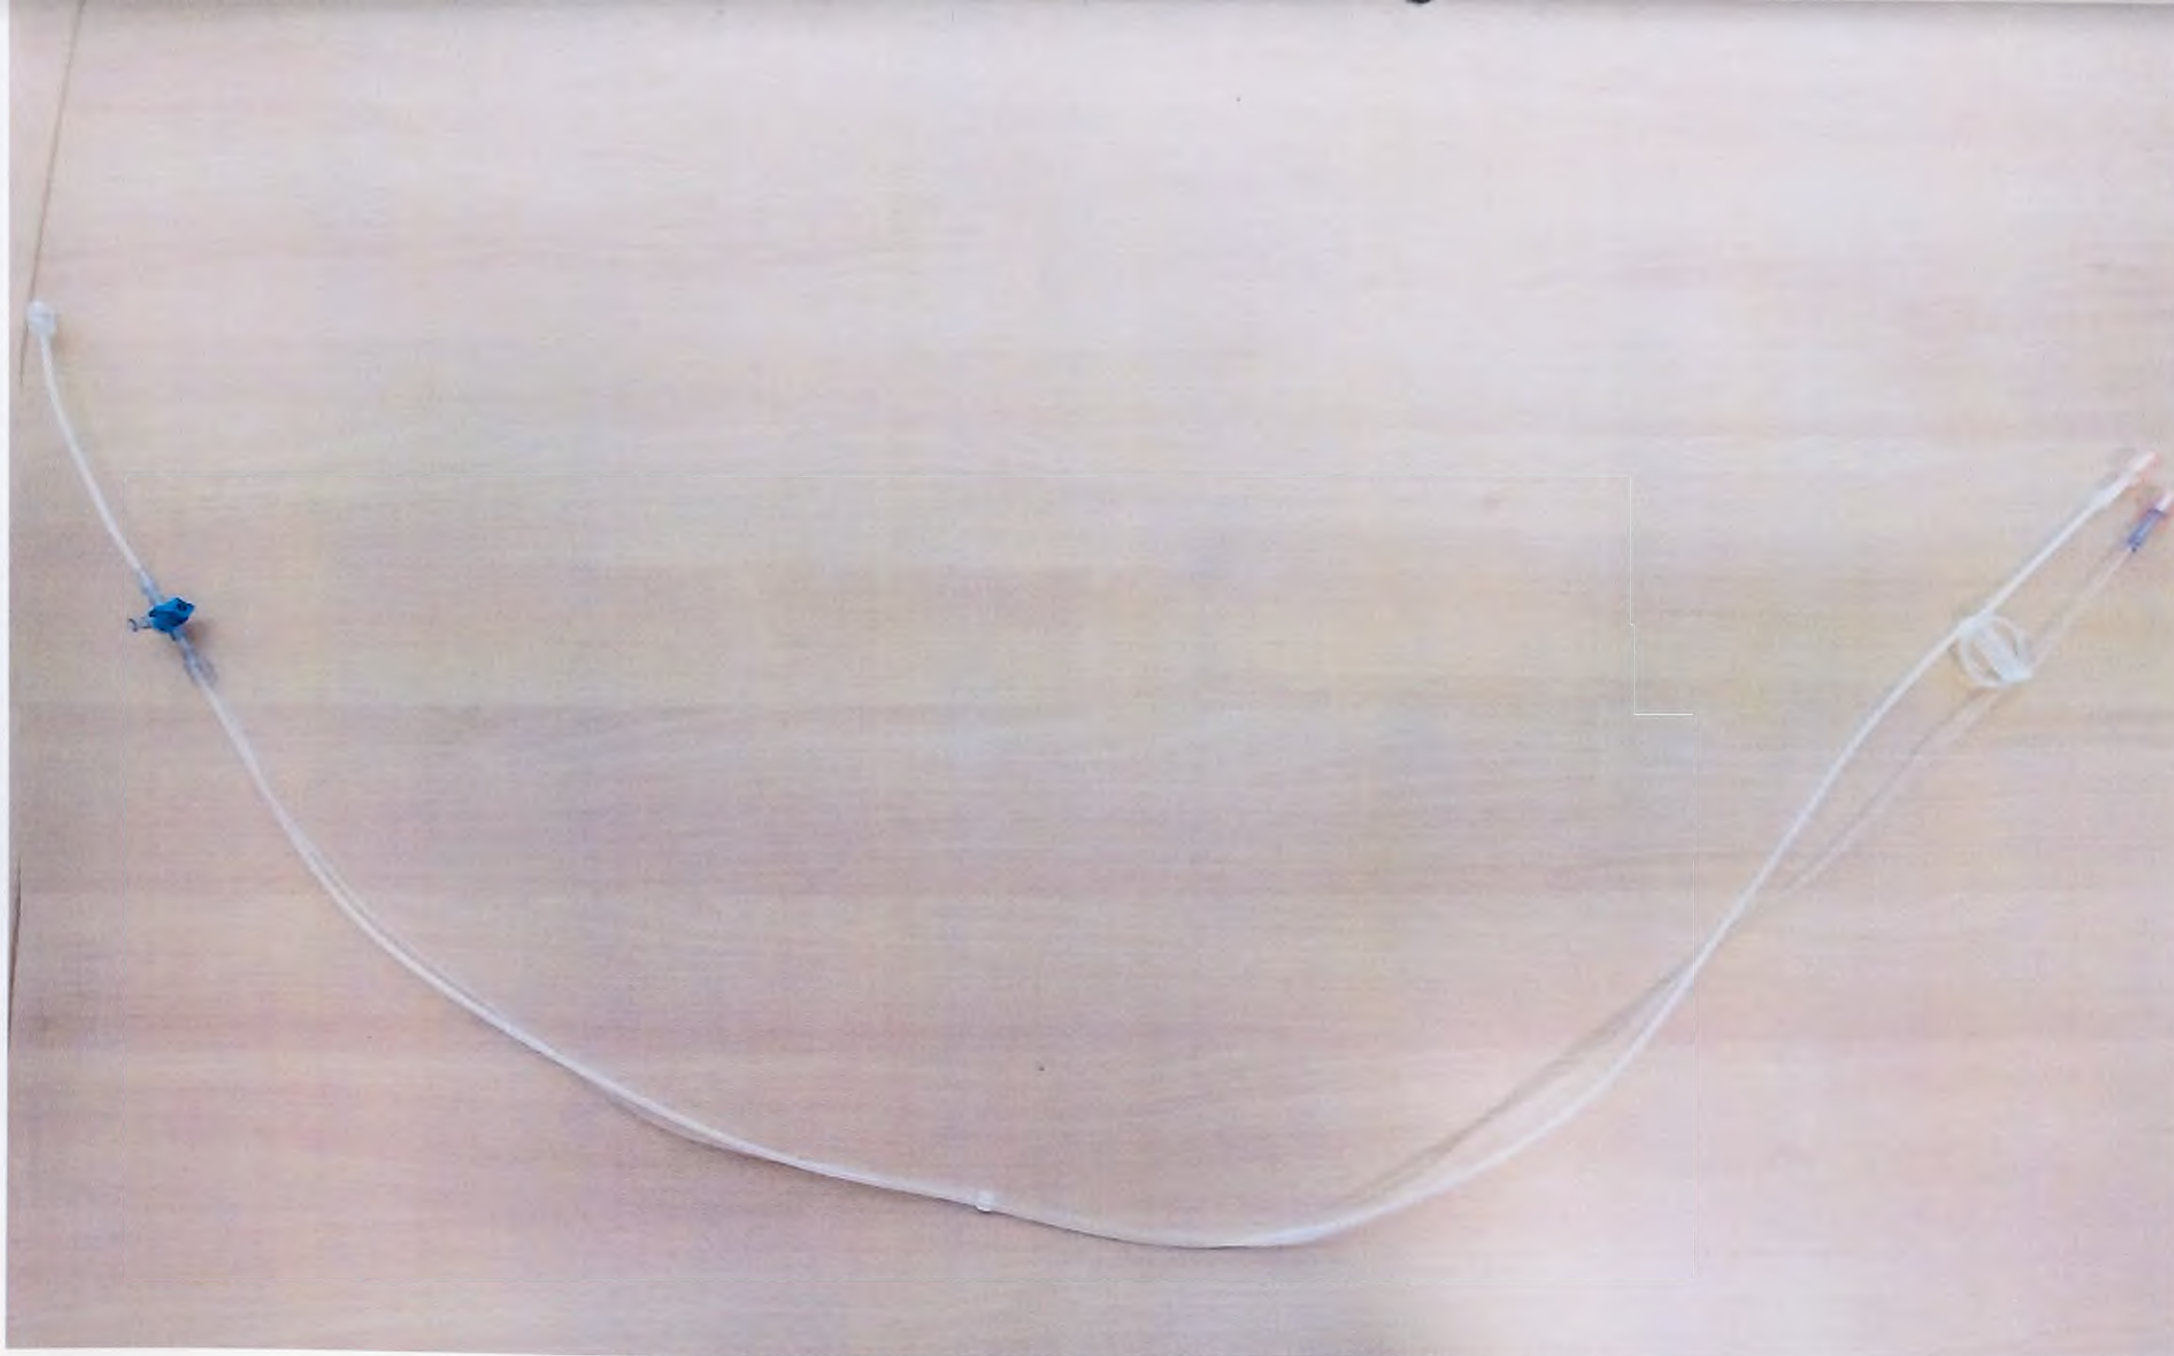



Набор AVA 500 SPAT Angio в составе в общем виде (без упаковки)



Трубка 59" Ø 0,110" и Трубка 59" Ø 0,145" (фото 1)

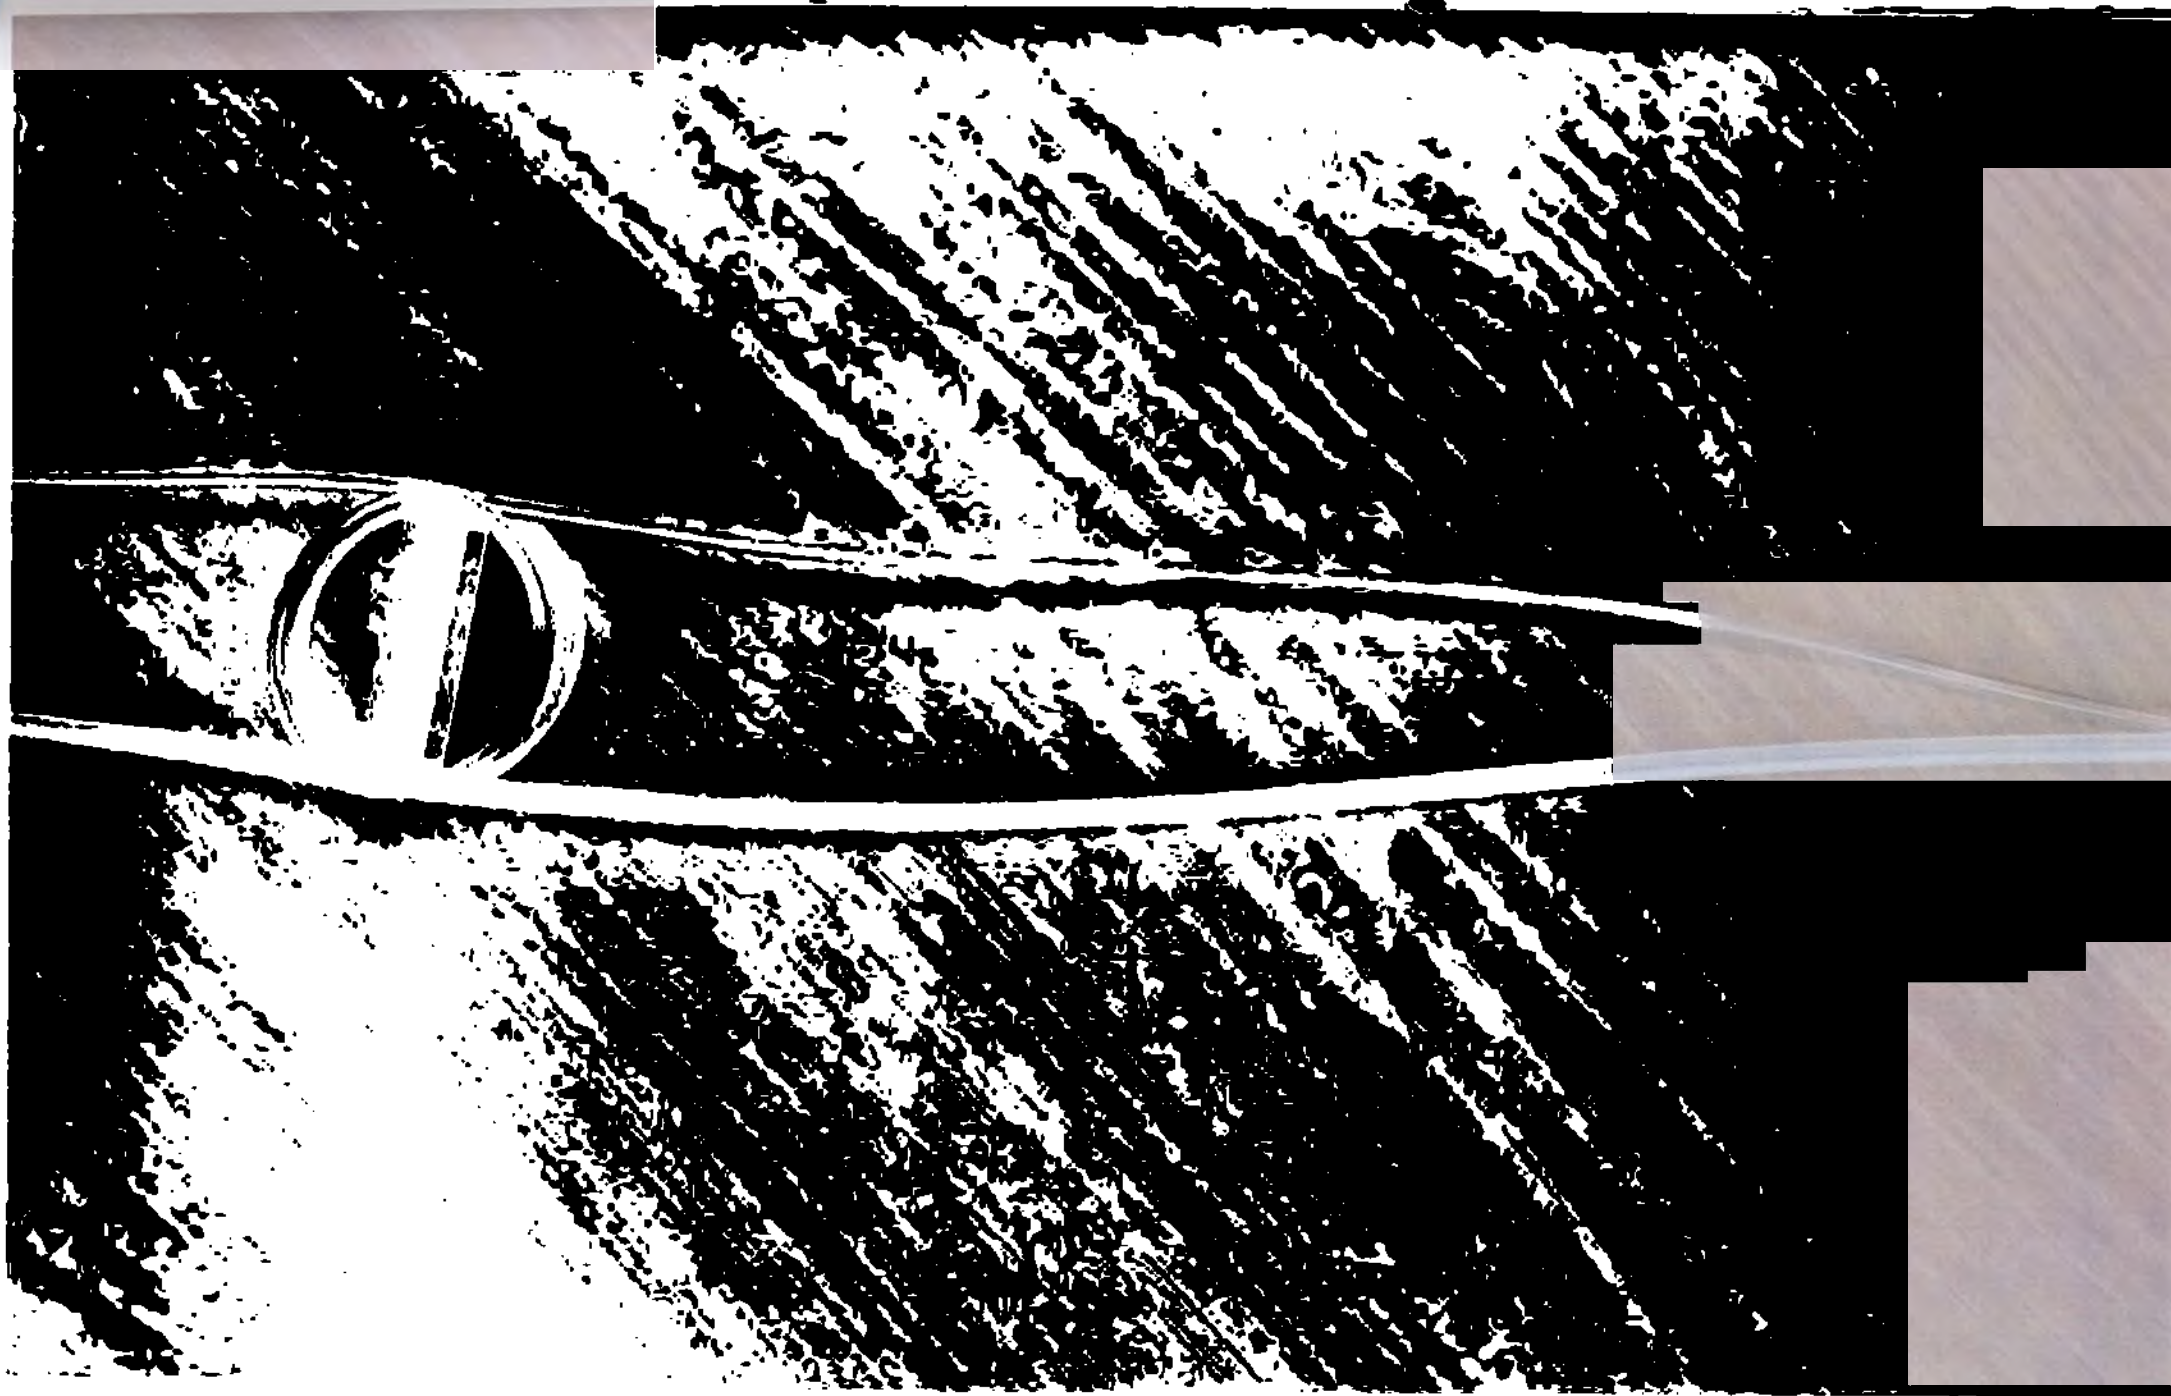

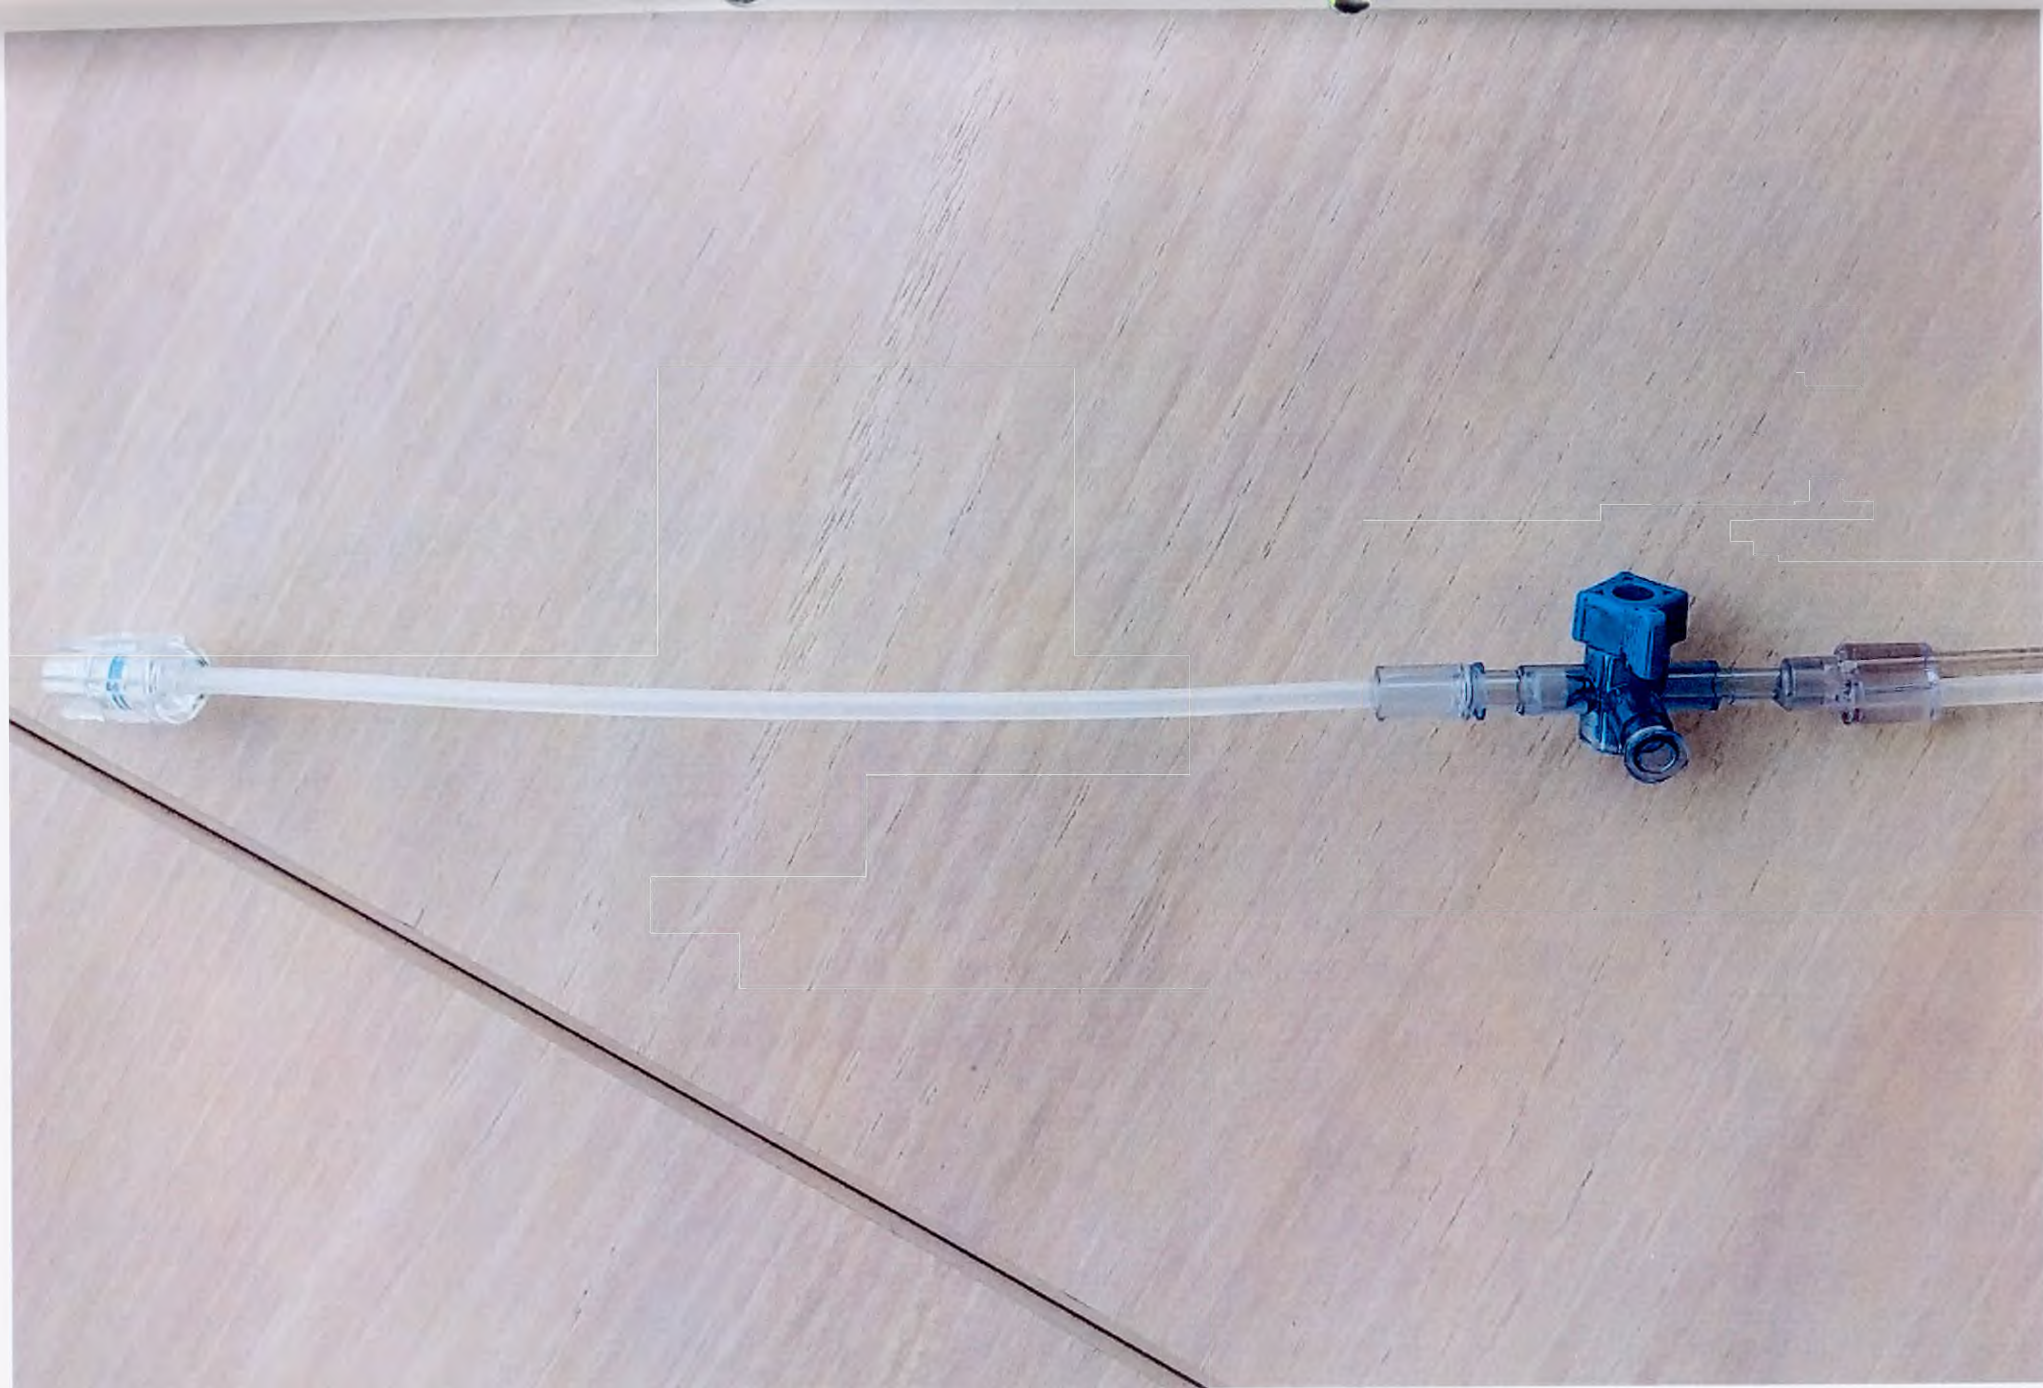

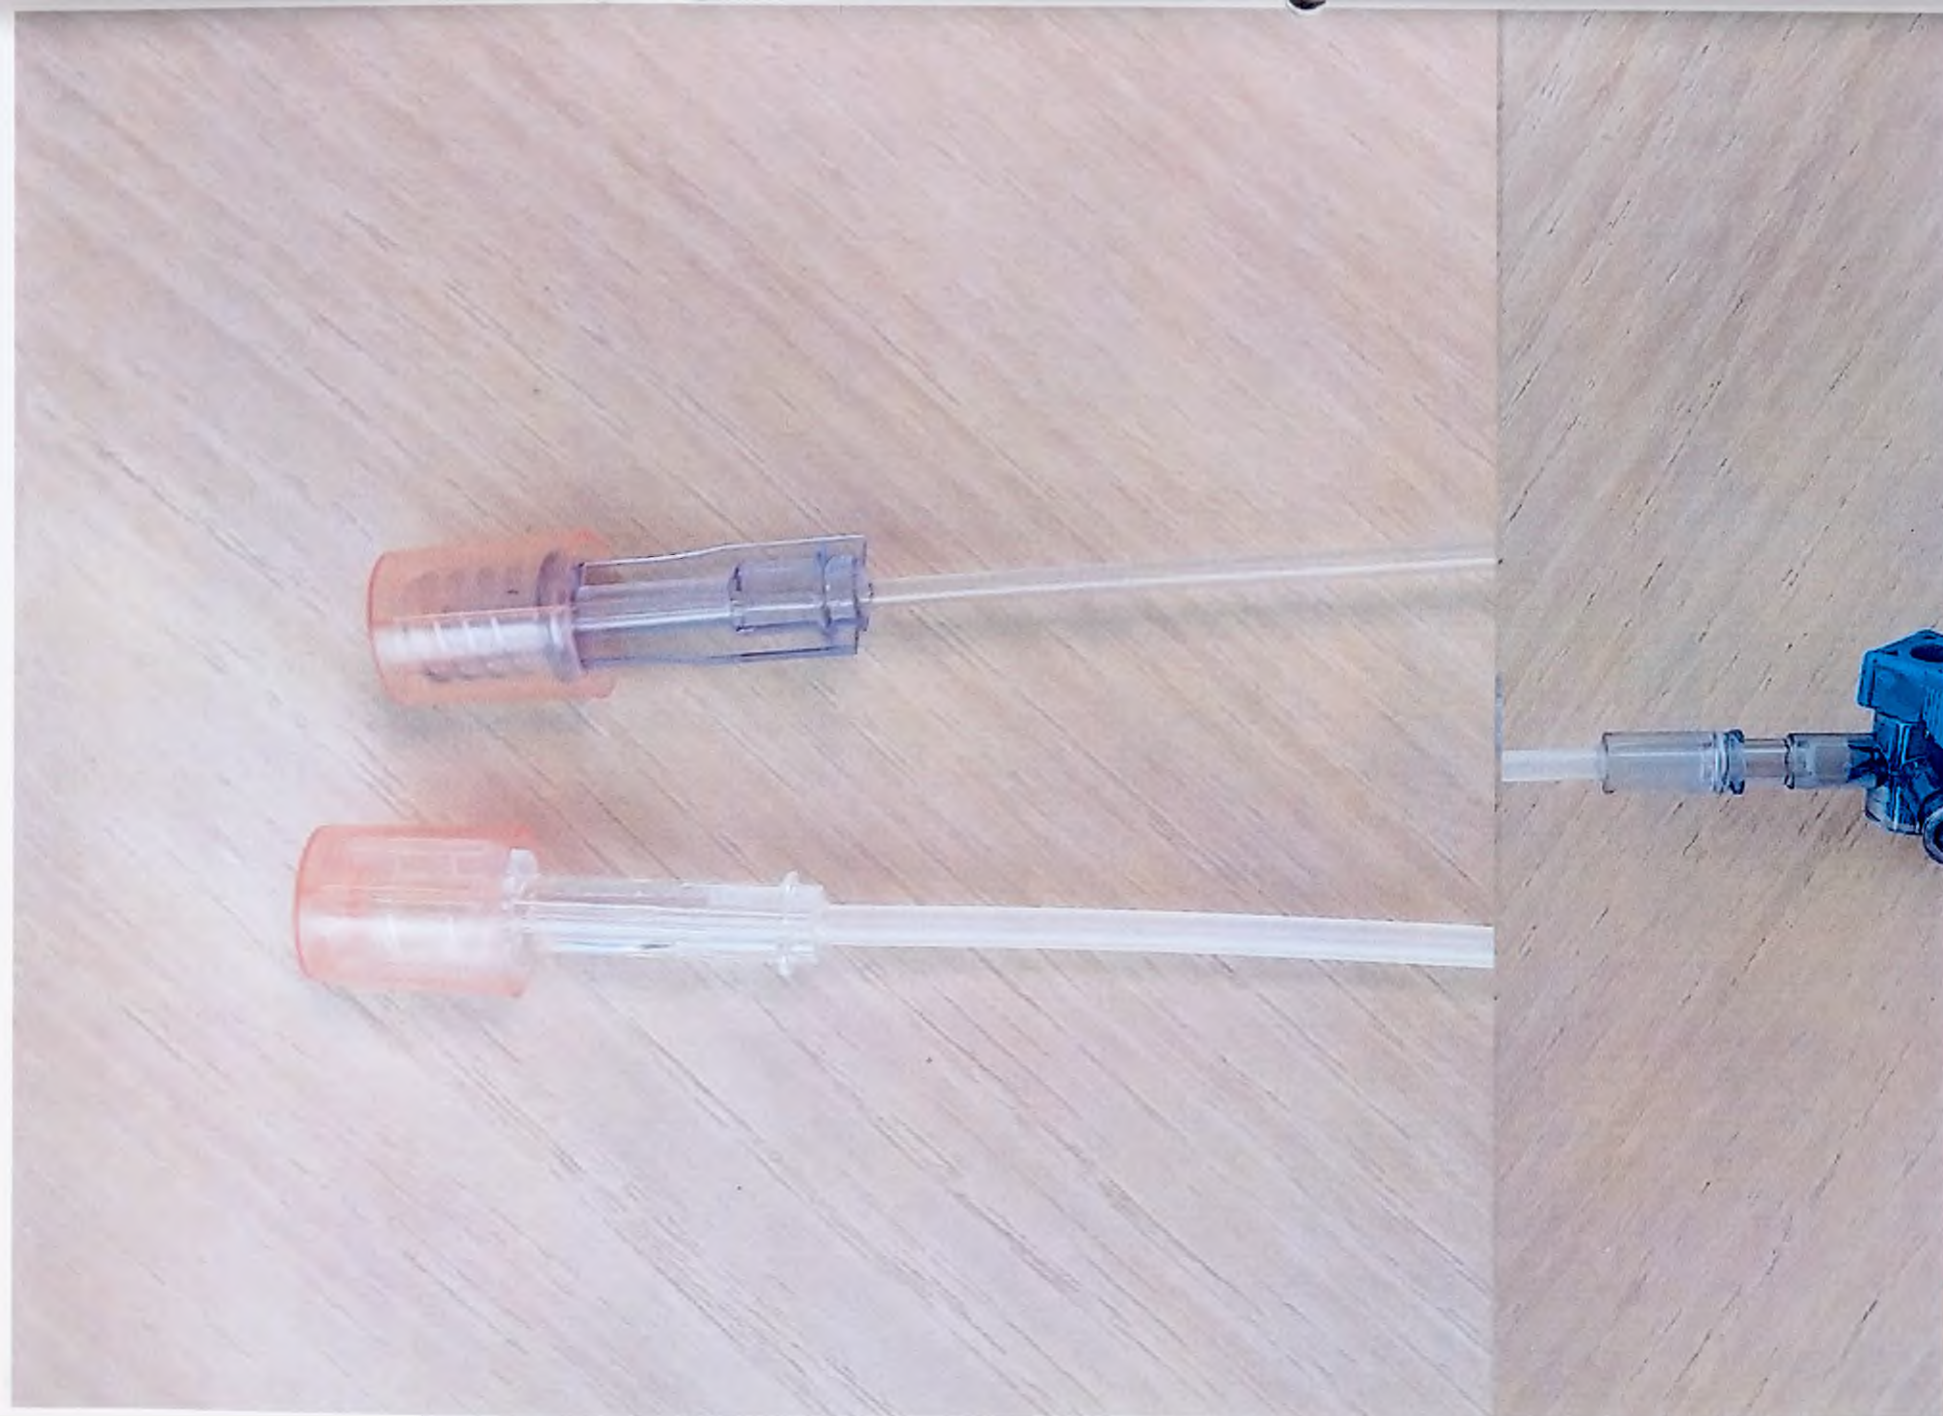





Клипсы - 2 шт (в упаковке).



Клипсы - 2 шт (без упаковки).

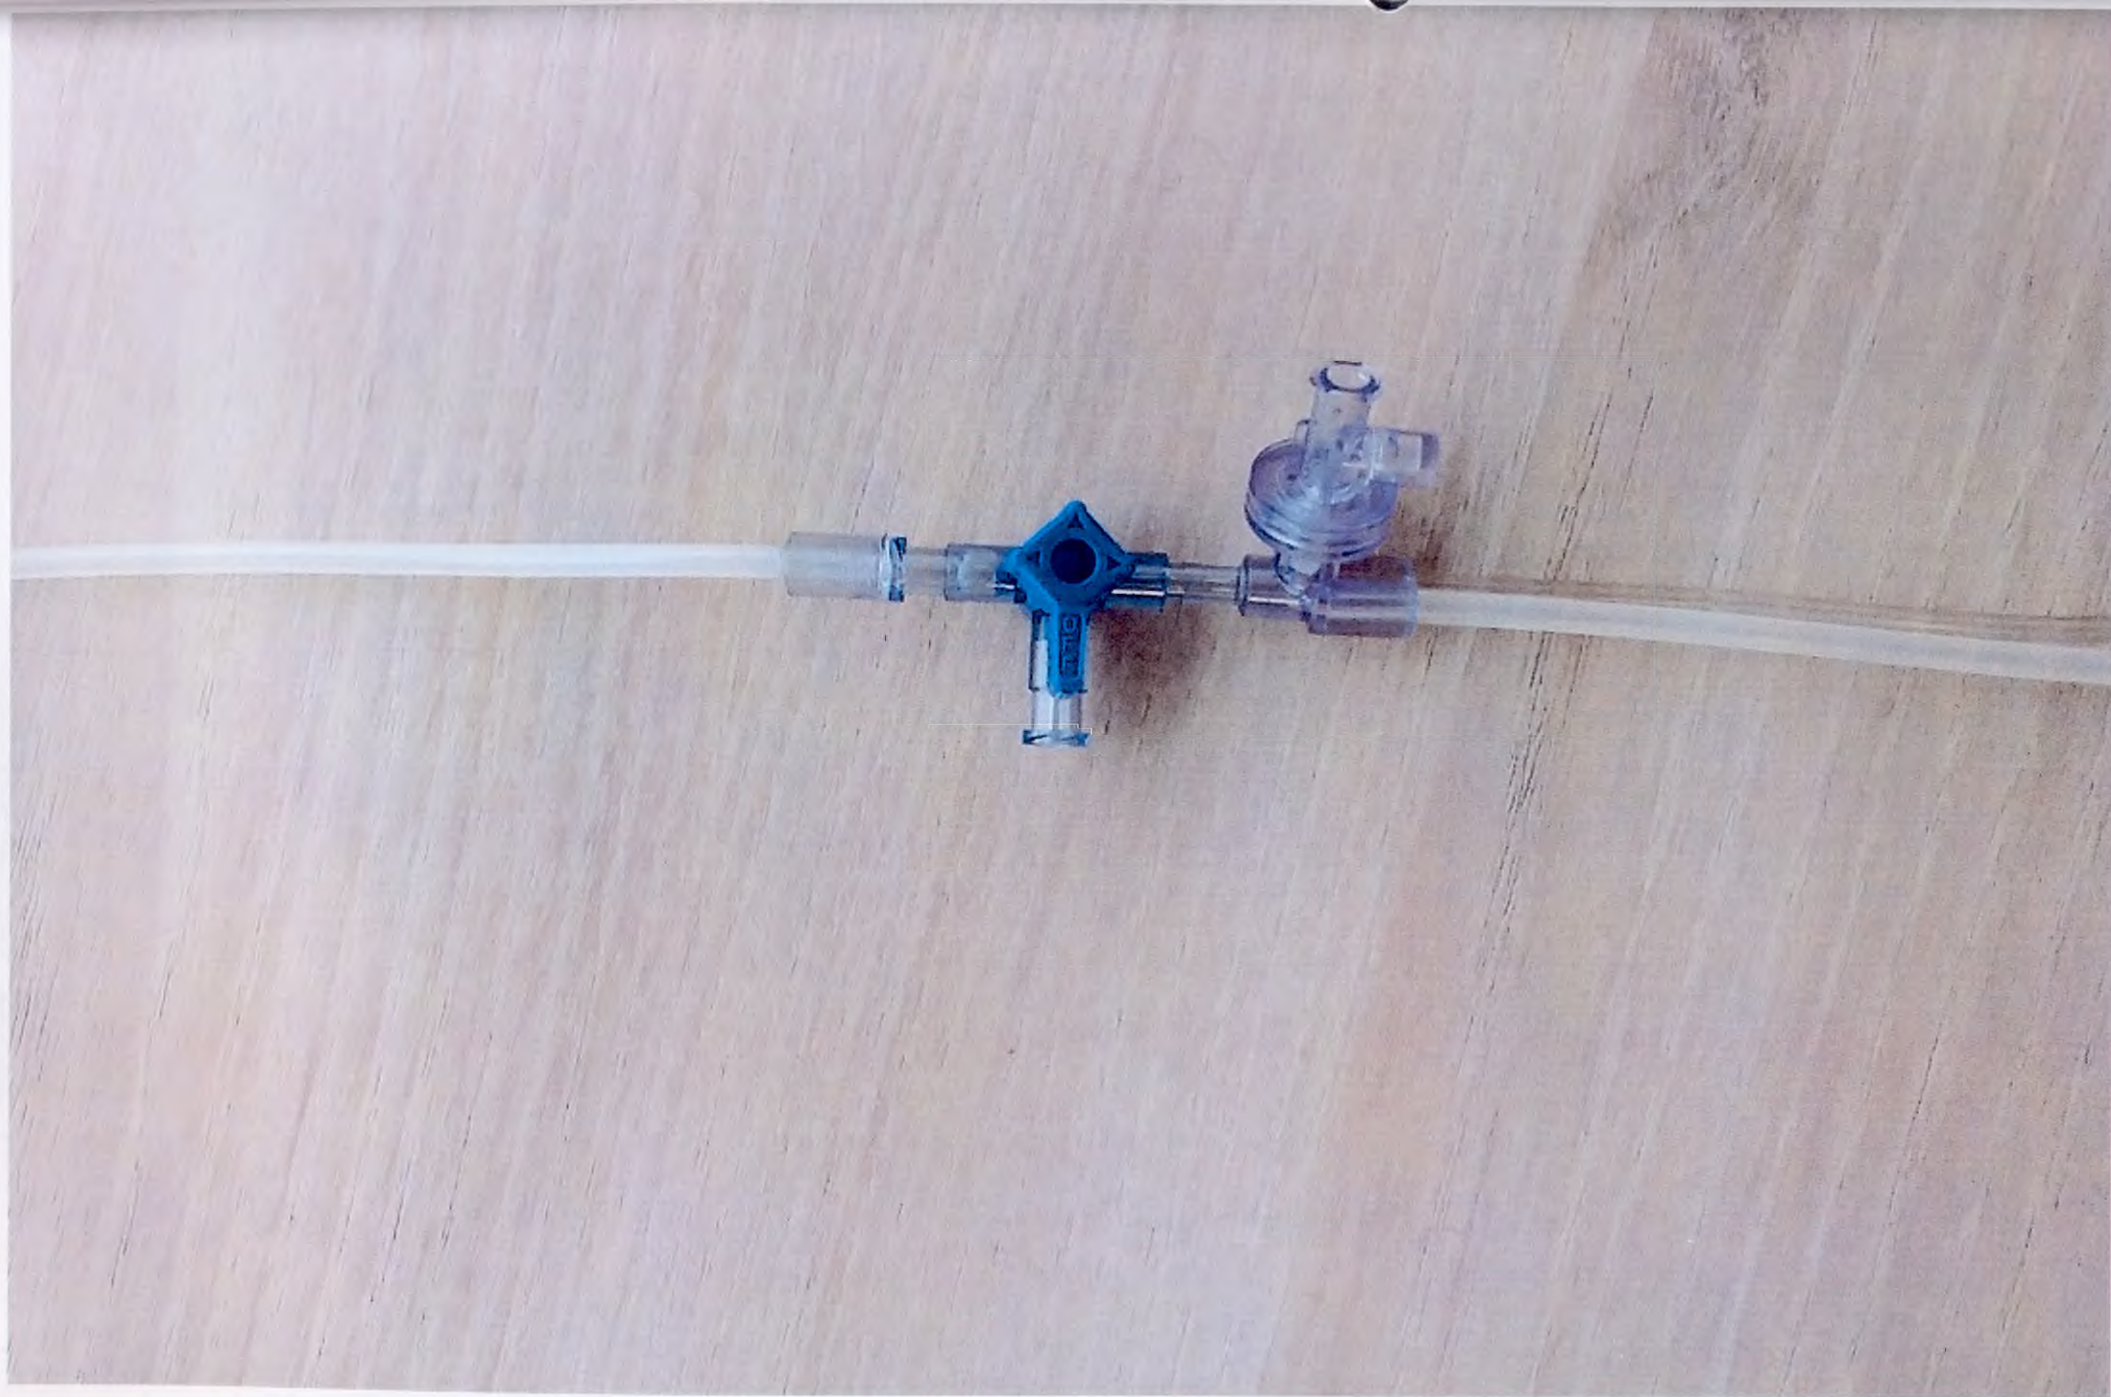

Соединитель Т-У-образный и Кран запорный.

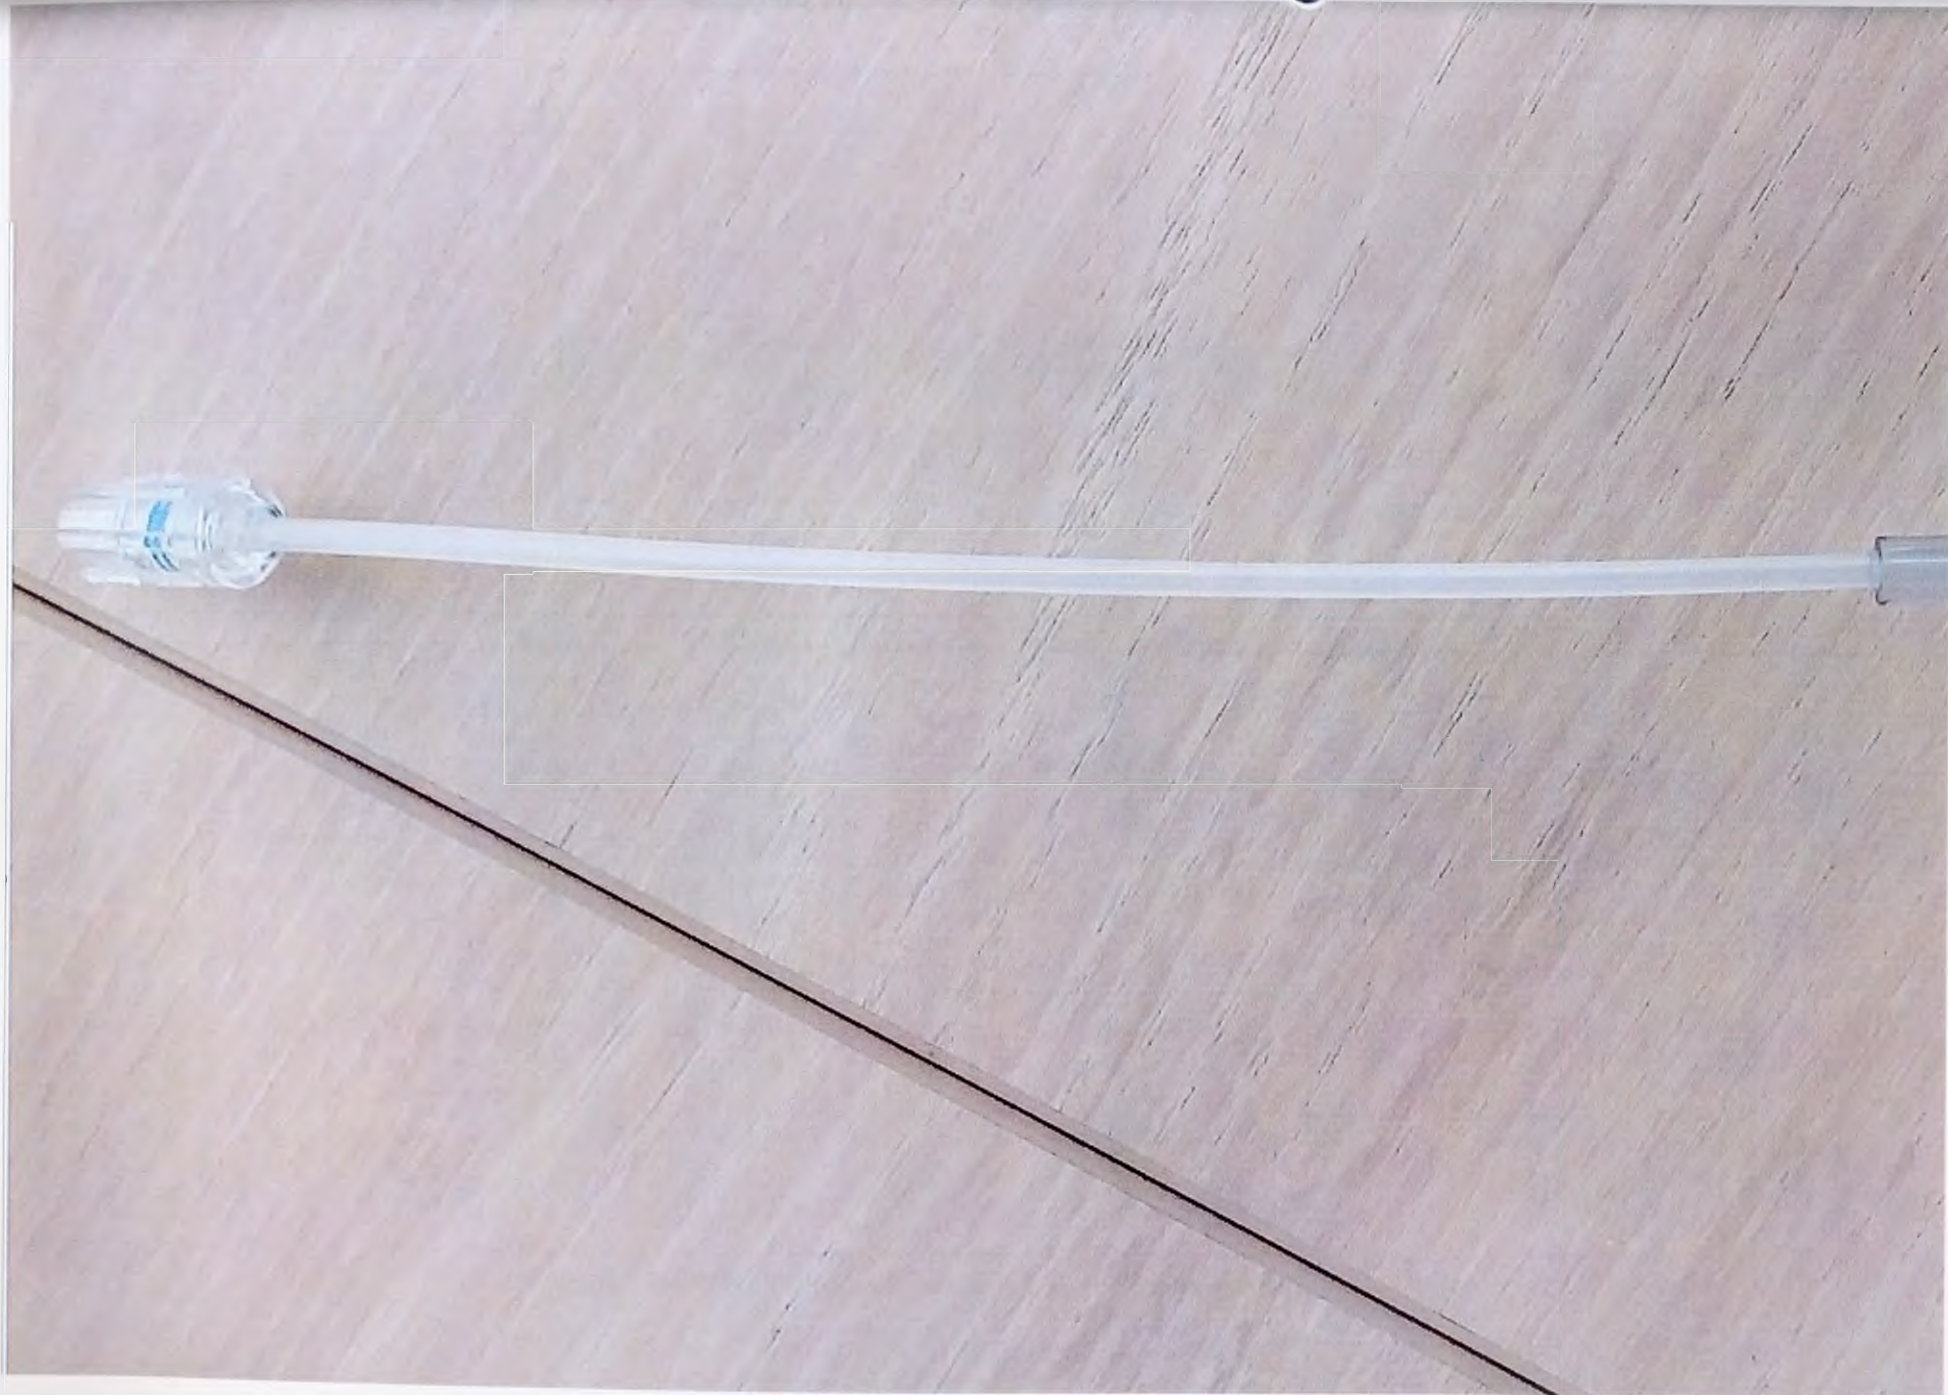

medrad® Avanta
Single Patient Disposable Set - Angio
Набор вспомогательный полимерный
стерильный одноразовый, к емкостям
полимерным стерильным одноразовым,
для рентгеноконтрастных веществ
и физиологического раствора
к устройствам для внутривенного
введения MEDRAD Avanta:
AVA 500 SPAT Angio в составе: Трубка 59"
Ø 0,110"; Трубка 7" Ø 0,145"; Трубка 59"
Ø 0,145"; Адаптер Луара - 3 шт; Клипсы -
2 шт.; Соединитель Т-У-образный;
Адаптер вращающийся; Кран запорный.

REF Catalog Number:
Номер по каталогу: **AVA 500 SPAT ANGIO**

Non-pyrogenic fluid path
Непирогенный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged. Не использовать вскрытые или поврежденные упаковки.

Attention: Refer to warnings and cautions on instructions for use packaged in each carton. ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных сведений о мерах предосторожности изучите инструкцию по применению, вложенную в упаковку.

Single use only
Использовать только один раз

STERILE EO Sterilized with Ethylene Oxide
Стерилизован при помощи этиленоксида

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
Сделано без применения натурального латекса

Rs Only Нетоксично

Use By
Использовать до

Date of Manufacture
Дата производства

LOT Lot Number
Номер партии

Space for UDI Barcode

Производитель
Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэа Инк.,
США
1 Bayer Drive
Indianola, IA 15051-0780
U.S.A.

Производитель
Bayer Medical Care B.V.
Hertweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands

Импортер на территории России АО «БАЙЕР»
Бизнес-центр «Рубинская»,
107113, 3-я Рубинская ул.,
А 18, стр. 2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

Патентная информация:
www.patents.bayer.com

Made in China
Сделано в Китае

Bayer

CE 2797 RU № ФСЗ 2011J16808 от XX XXXX XXXX года DN-246025 Rev. A



(07) 0 063625801113 4

Набор AVA 500 SPAT Angio в составе (макет маркировки упаковки).

medrad® Avanta
Single Patient Disposable Set -
Transducer Compatible
Набор вспомогательный полимерный
стерильный одноразовый, к емкостям
полимерным стерильным одноразовым,
для рентгеноконтрастных веществ
и физиологического раствора к устройствам
для внутривенного введения MEDRAD Avanta:
AVA 500 SPAT L в составе: Трубка 59" Ø 0,110";
Трубка 7" Ø 0,145"; Трубка 59" Ø 0,145"; Адаптер
Луара - 3 шт; Клипсы - 2 шт; Клапан
испаряющий давление с гемодинамическим
портом; Адаптер вращающийся; Кран запорный.

REF Catalog Number:
Номер по каталогу: **AVA 500 SPAT L**

Non-pyrogenic fluid path
Непирогенный тракт подачи жидкости

Do not use if package is opened or damaged. Не использовать вскрытые или поврежденные упаковки.

Attention: Refer to warnings and cautions on instructions for use packaged in each carton. ВНИМАНИЕ! Для получения дополнительных сведений о мерах предосторожности изучите инструкцию по применению, вложенную в упаковку.

Single use only
Использовать только один раз

STERILE EO Sterilized with Ethylene Oxide
Стерилизован при помощи этиленоксида

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX
Сделано без применения натурального латекса

Rs Only Нетоксично

Use By
Использовать до

Date of Manufacture
Дата производства

LOT Lot Number
Номер партии

Space for UDI Barcode

Производитель
Bayer Medical Care Inc.
Байер Медикал Кэа Инк., США
1 Bayer Drive
Indianola, IA 15051-0780
U.S.A.

Производитель
Bayer Medical Care B.V.
Hertweg 24
6199 AC Maastricht Airport
The Netherlands


Импортер на территории России АО «БАЙЕР»
Бизнес-центр «Рубинская»,
107113, 3-я Рубинская ул.,
А 18, стр. 2, Москва, Россия
тел.: +7 495 231 1200
www.bayer.ru

Патентная информация:
www.patents.bayer.com

Made in China
Сделано в Китае

Bayer

CE 2797 RU № ФСЗ 2011J16808 от XX XXXX XXXX года DN-246025 Rev. A

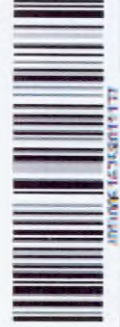

000000 163625801113 7

Набор AVA 500 SPAT L в составе (макет маркировки упаковки).



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
22 листа (ос)