

PHILIPS

Руководитель отдела нормативного
регулирования ООО «ФИЛИПС»




Град А.А.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система магнитно-резонансной томографии MR 5300 с принадлежностями»


Базовый состав:

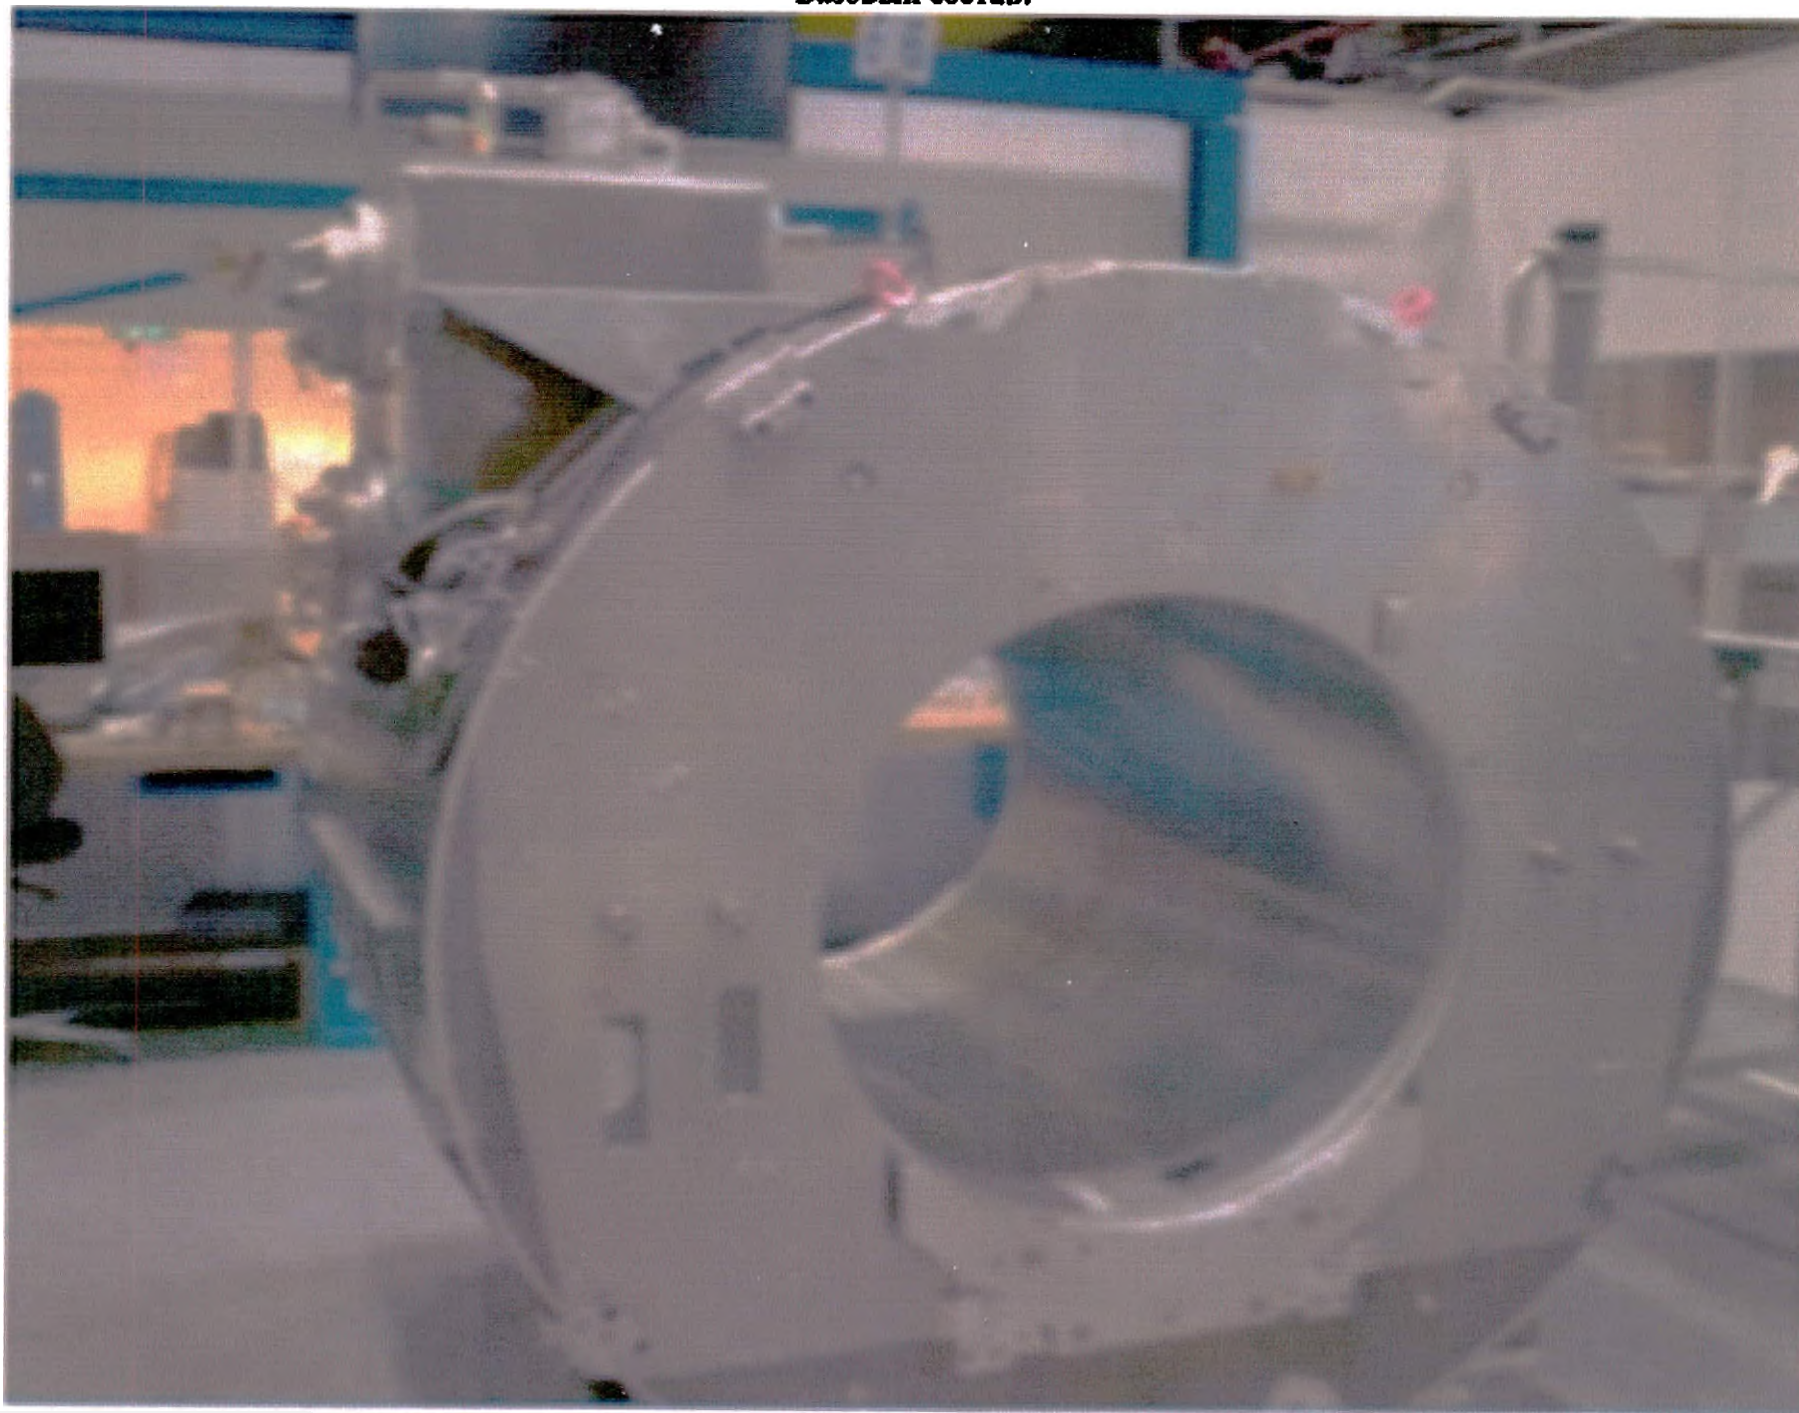






2. Градиентная система. Градиентный усилитель.

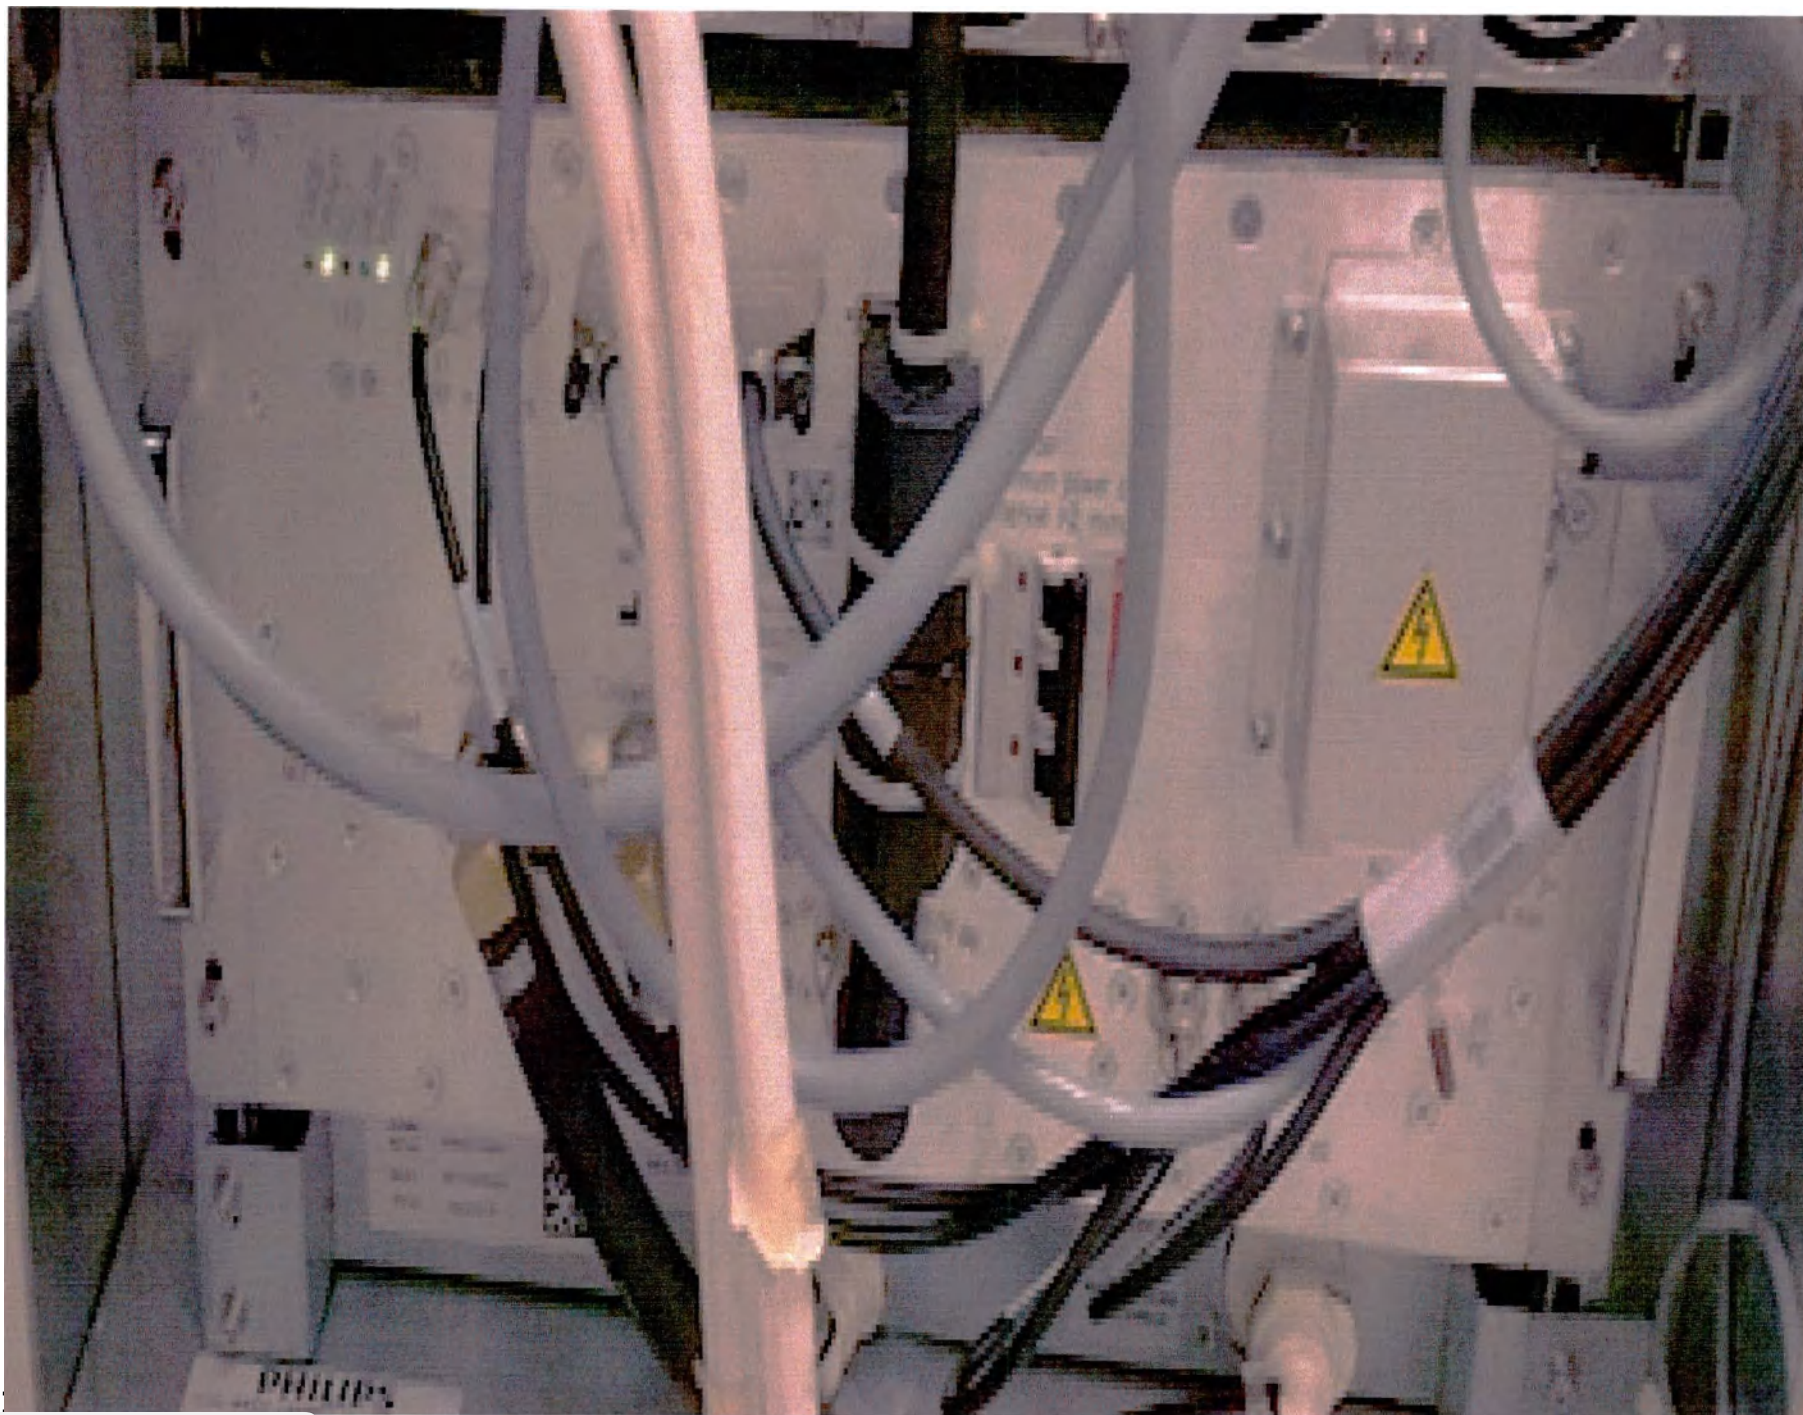



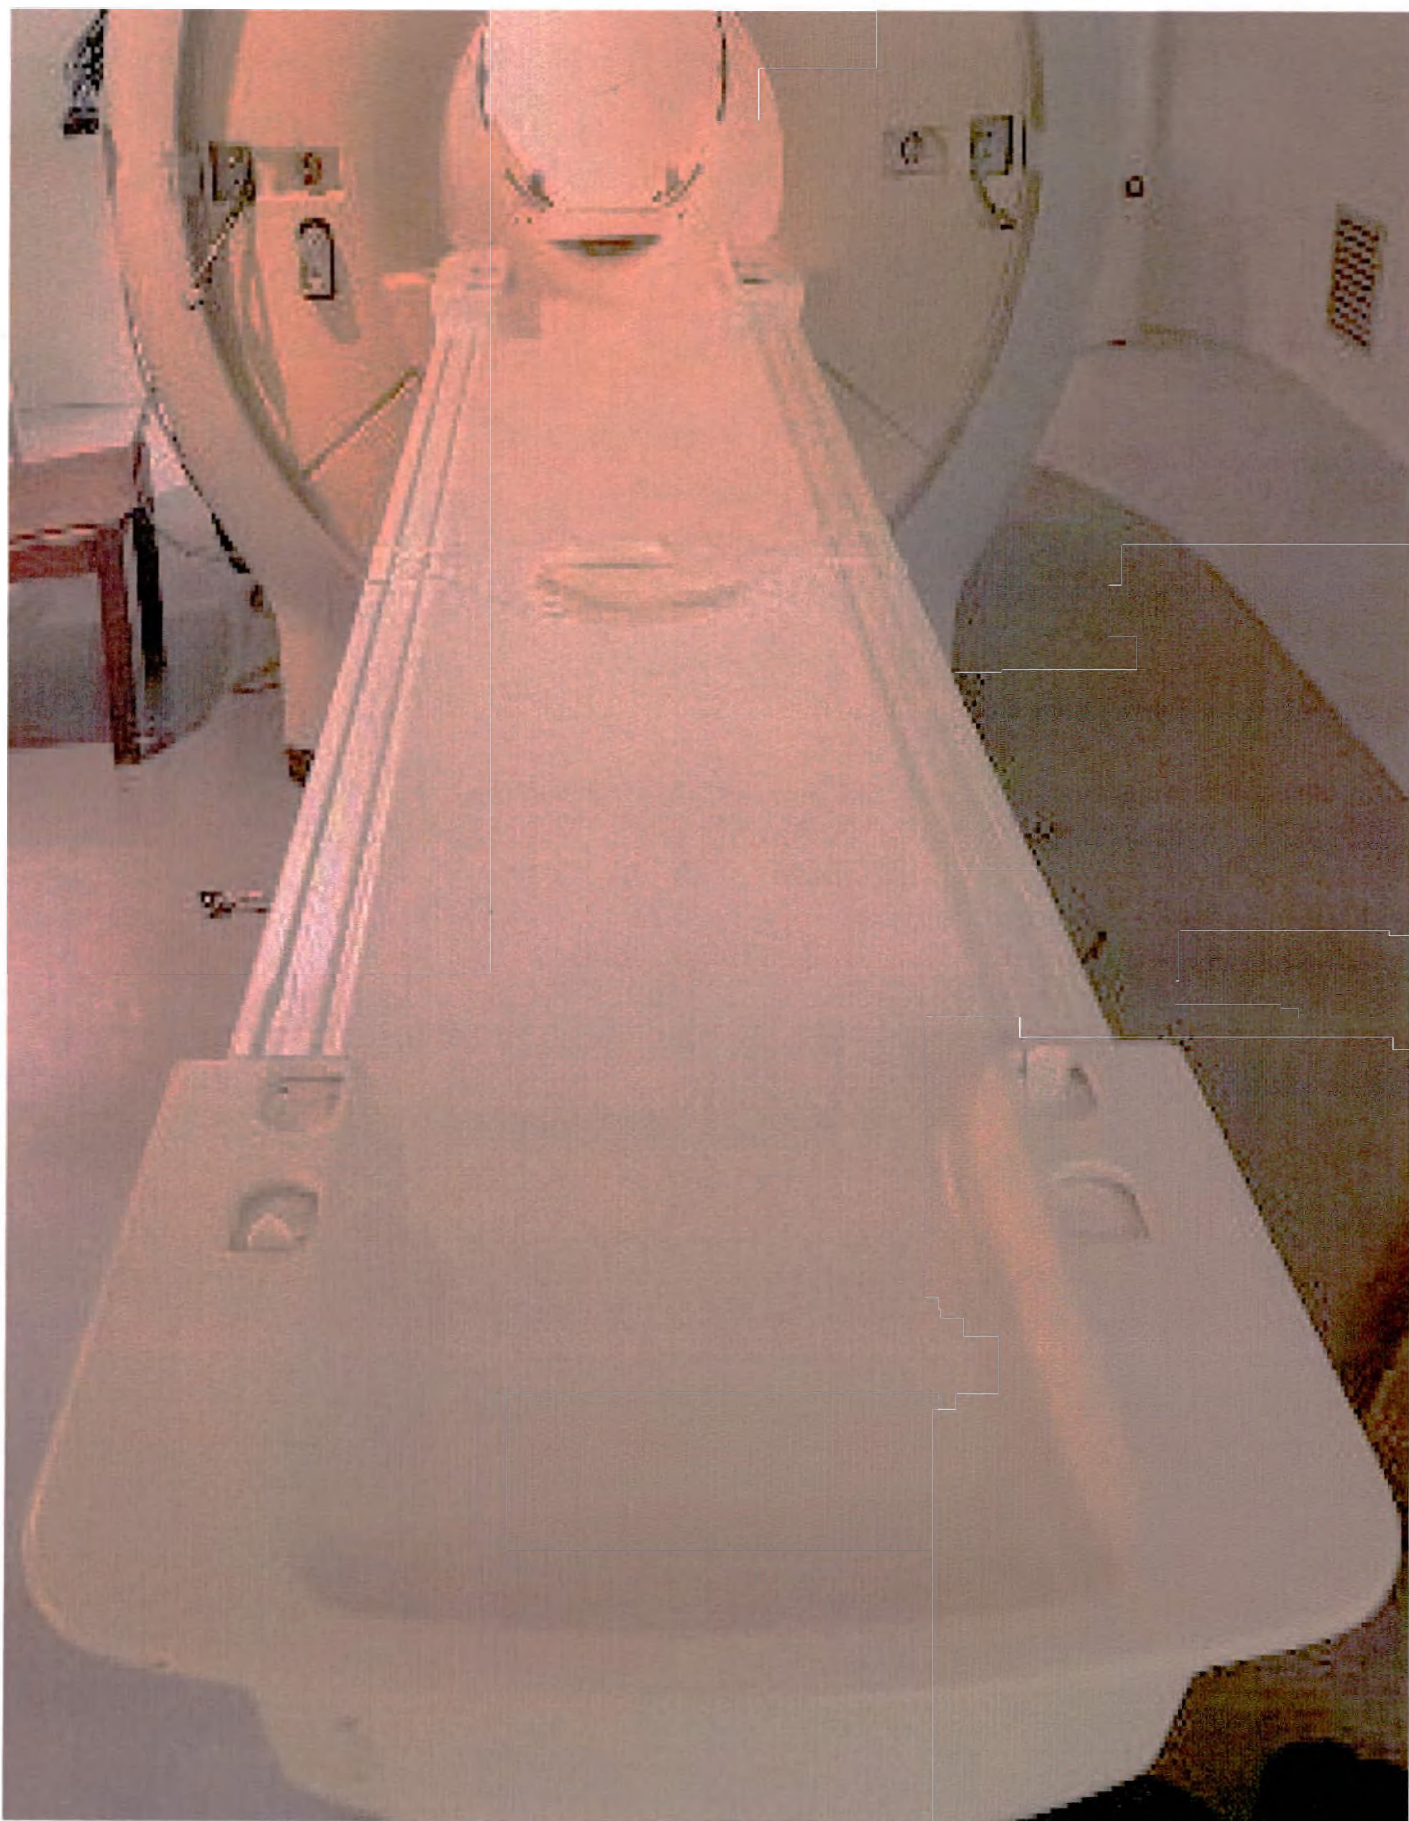


5. Дека стола.

6. РЧ-катушки:




6.1. Катушка dS Base.



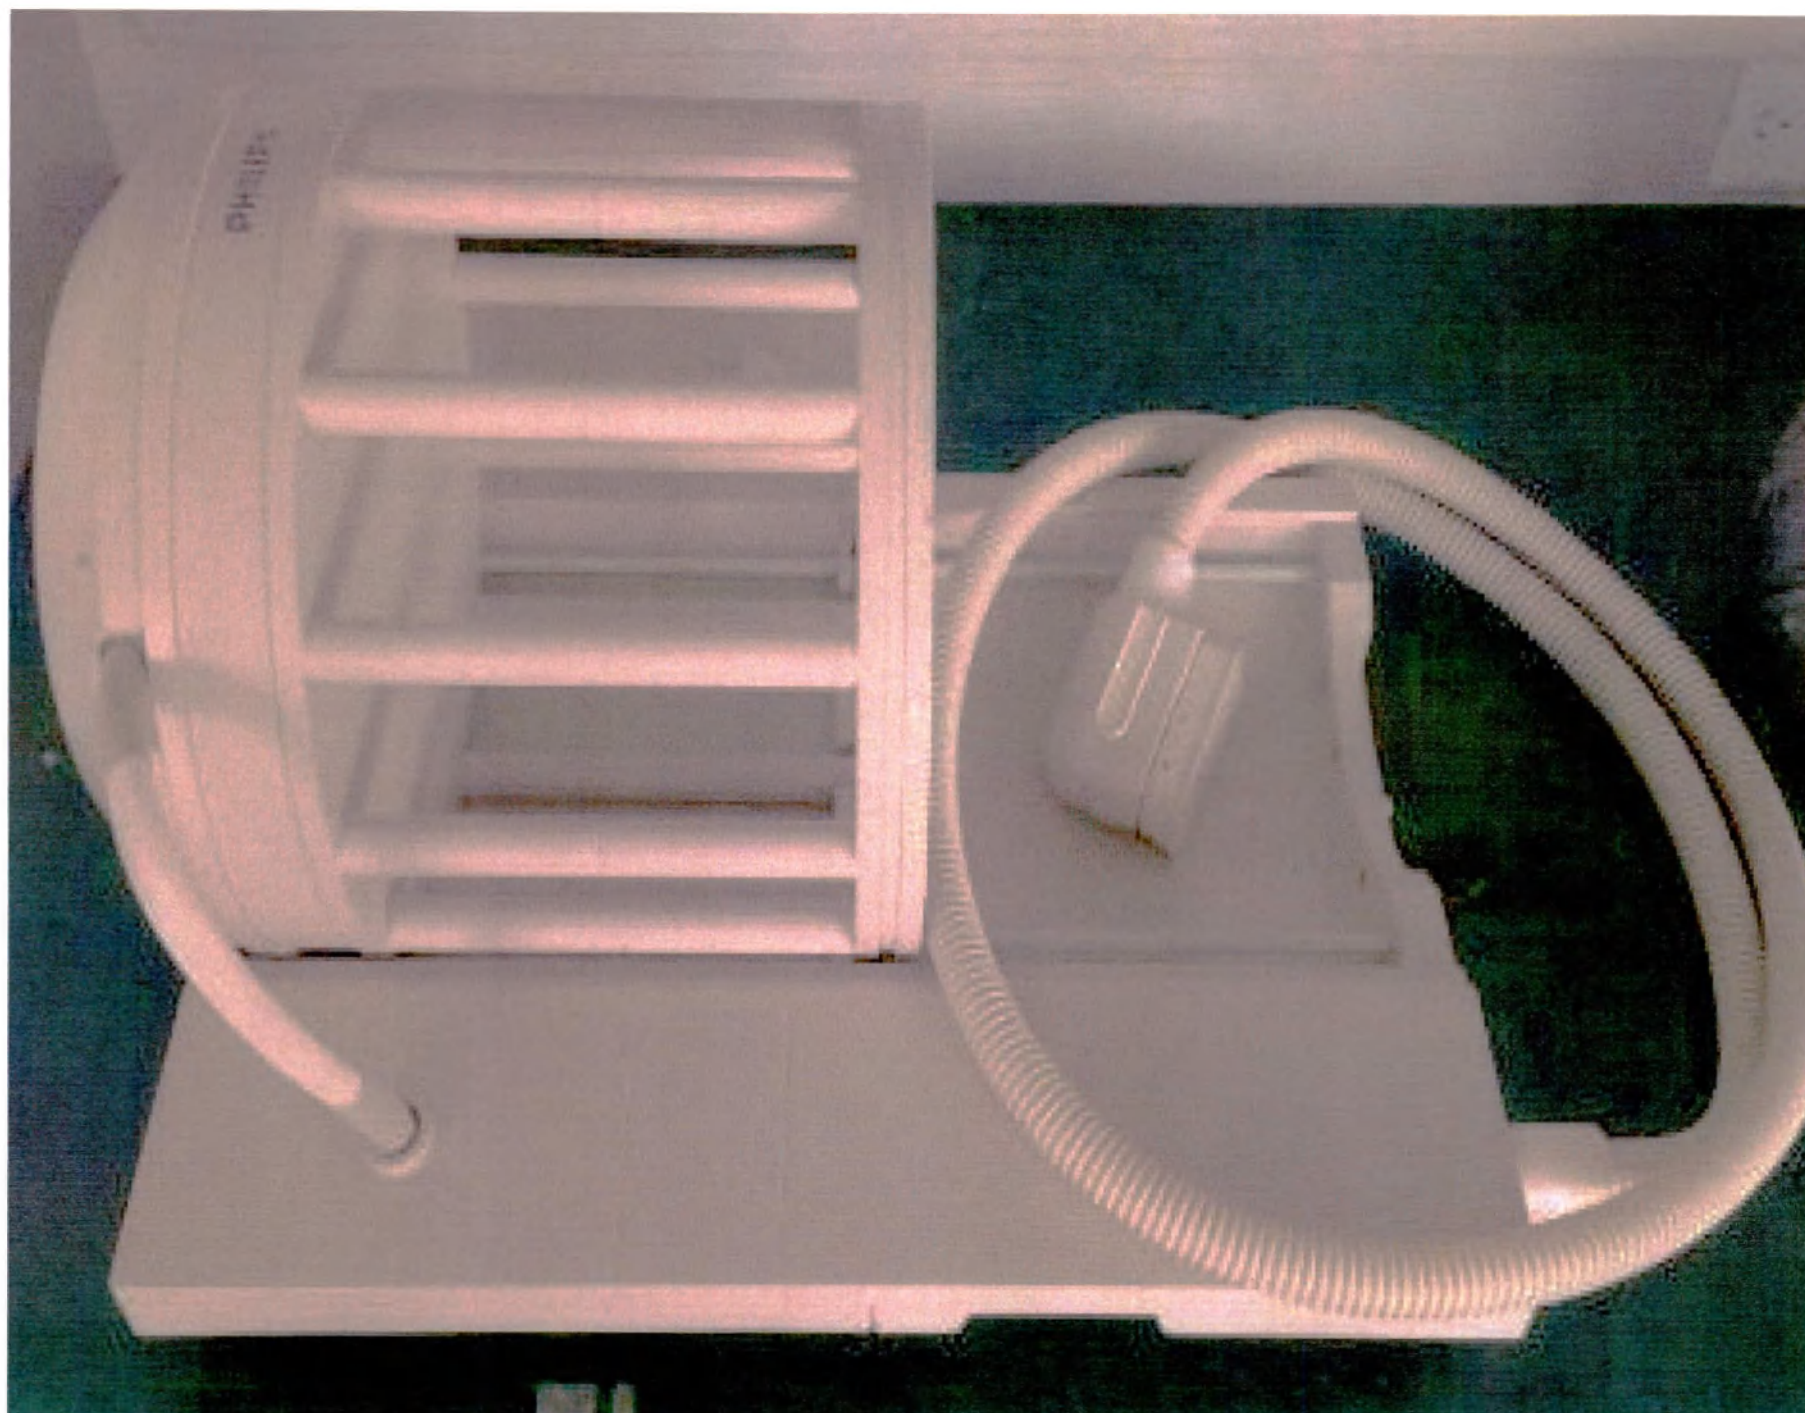

6.3. Катушка T/R Head.

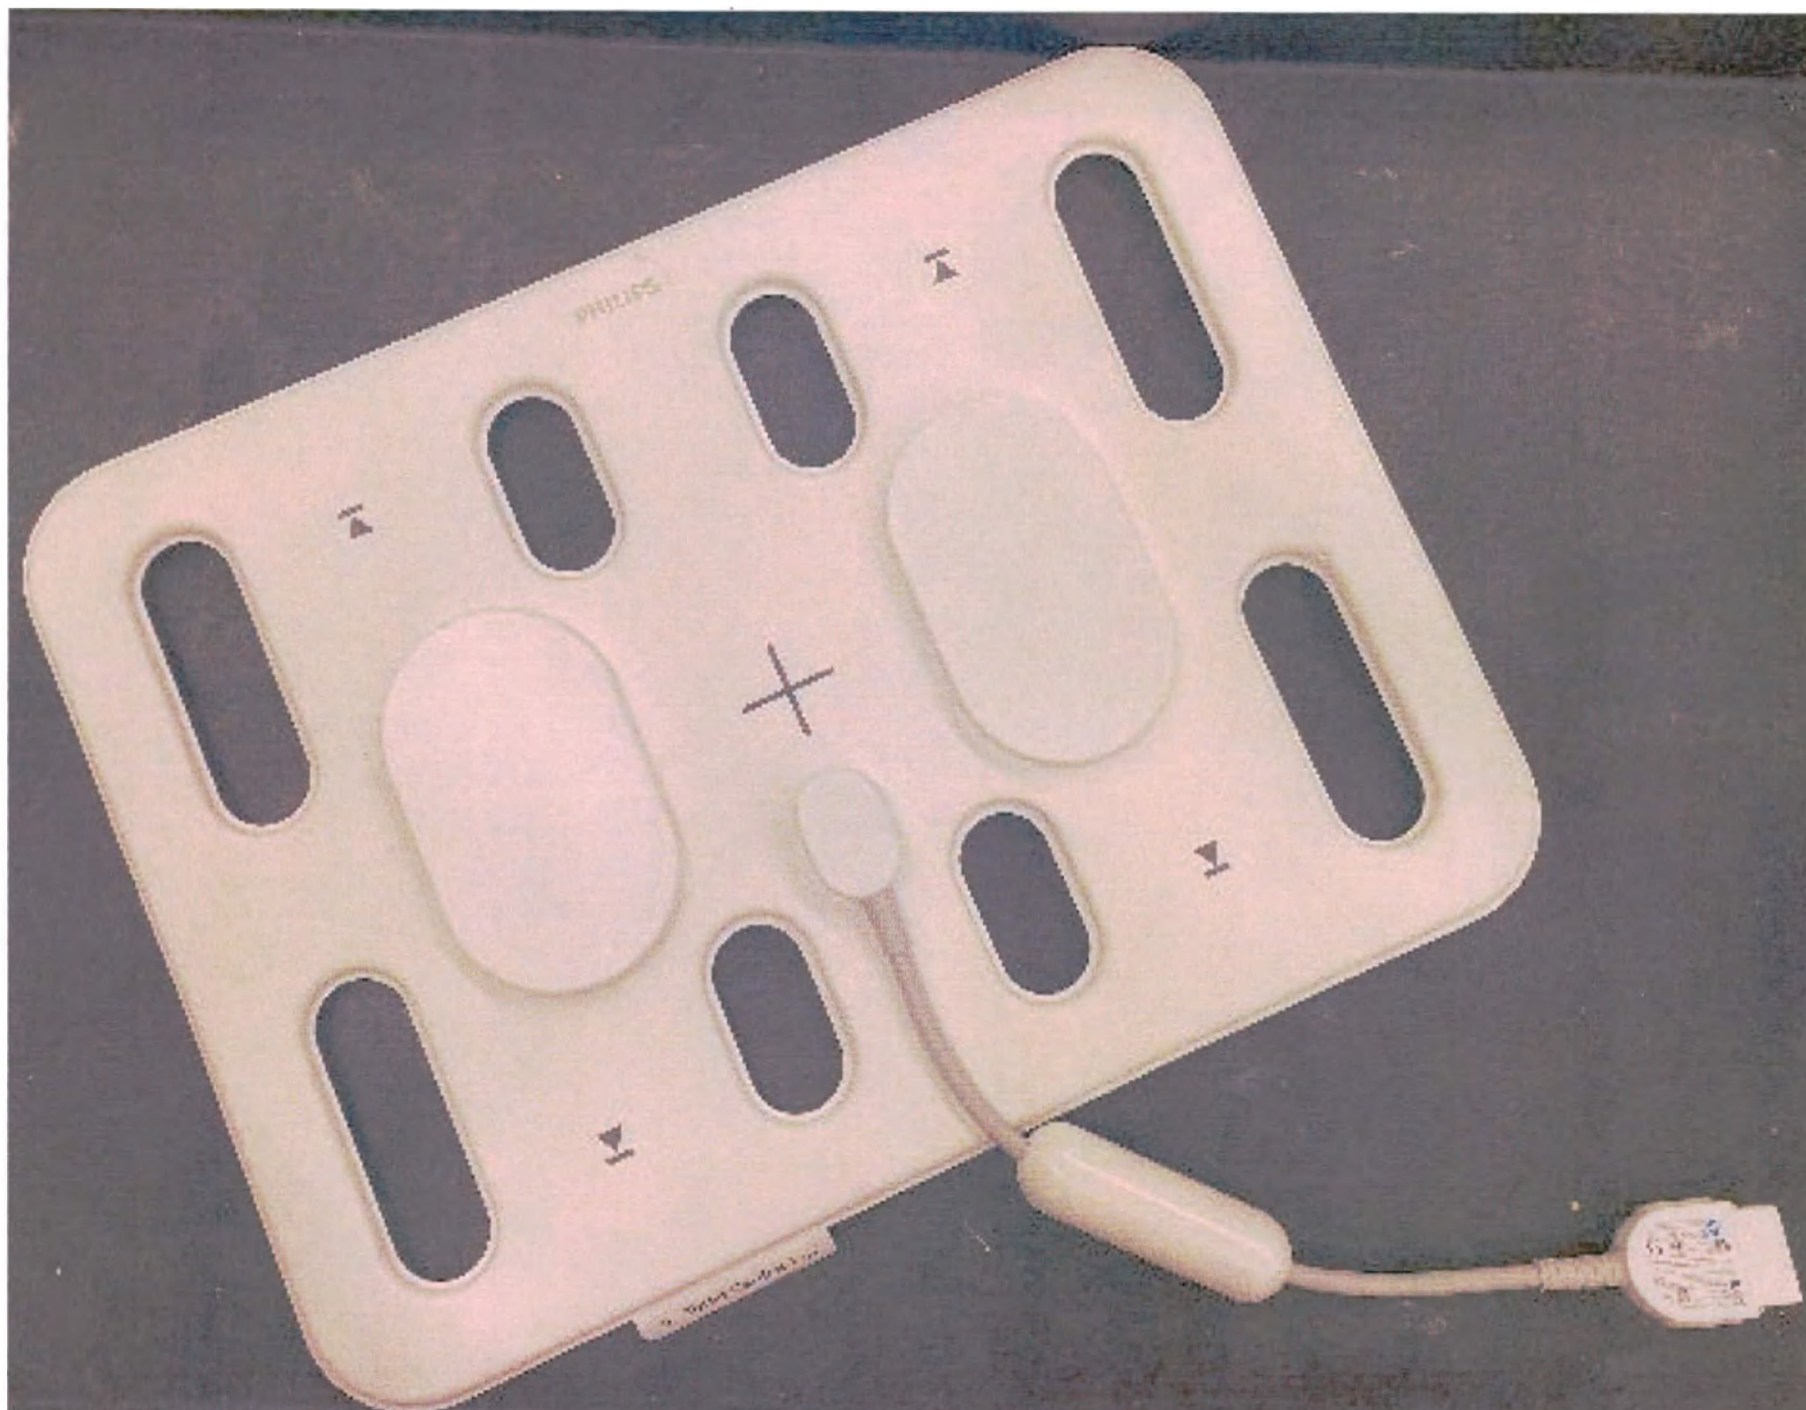

6.5. Катушка dS Breast 7ch 1.5T, в составе:




6.5.2. Прокладки для молочных желез, в составе:




6.5.2.1. Верхняя прокладка для катушки Breast 7ch.





6.5.2.2. Подголовник.

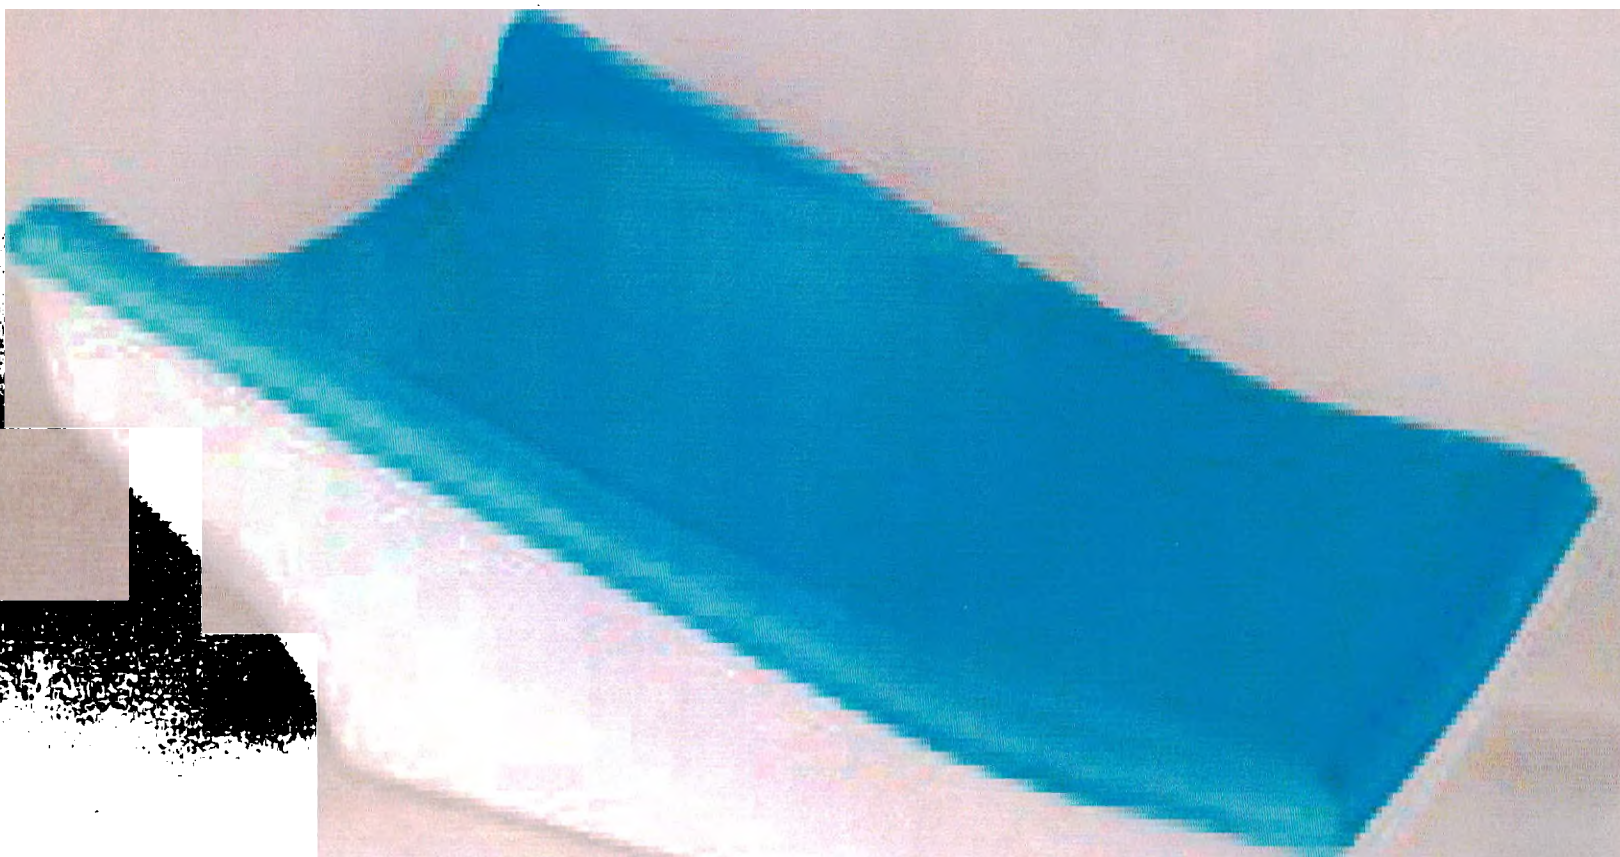




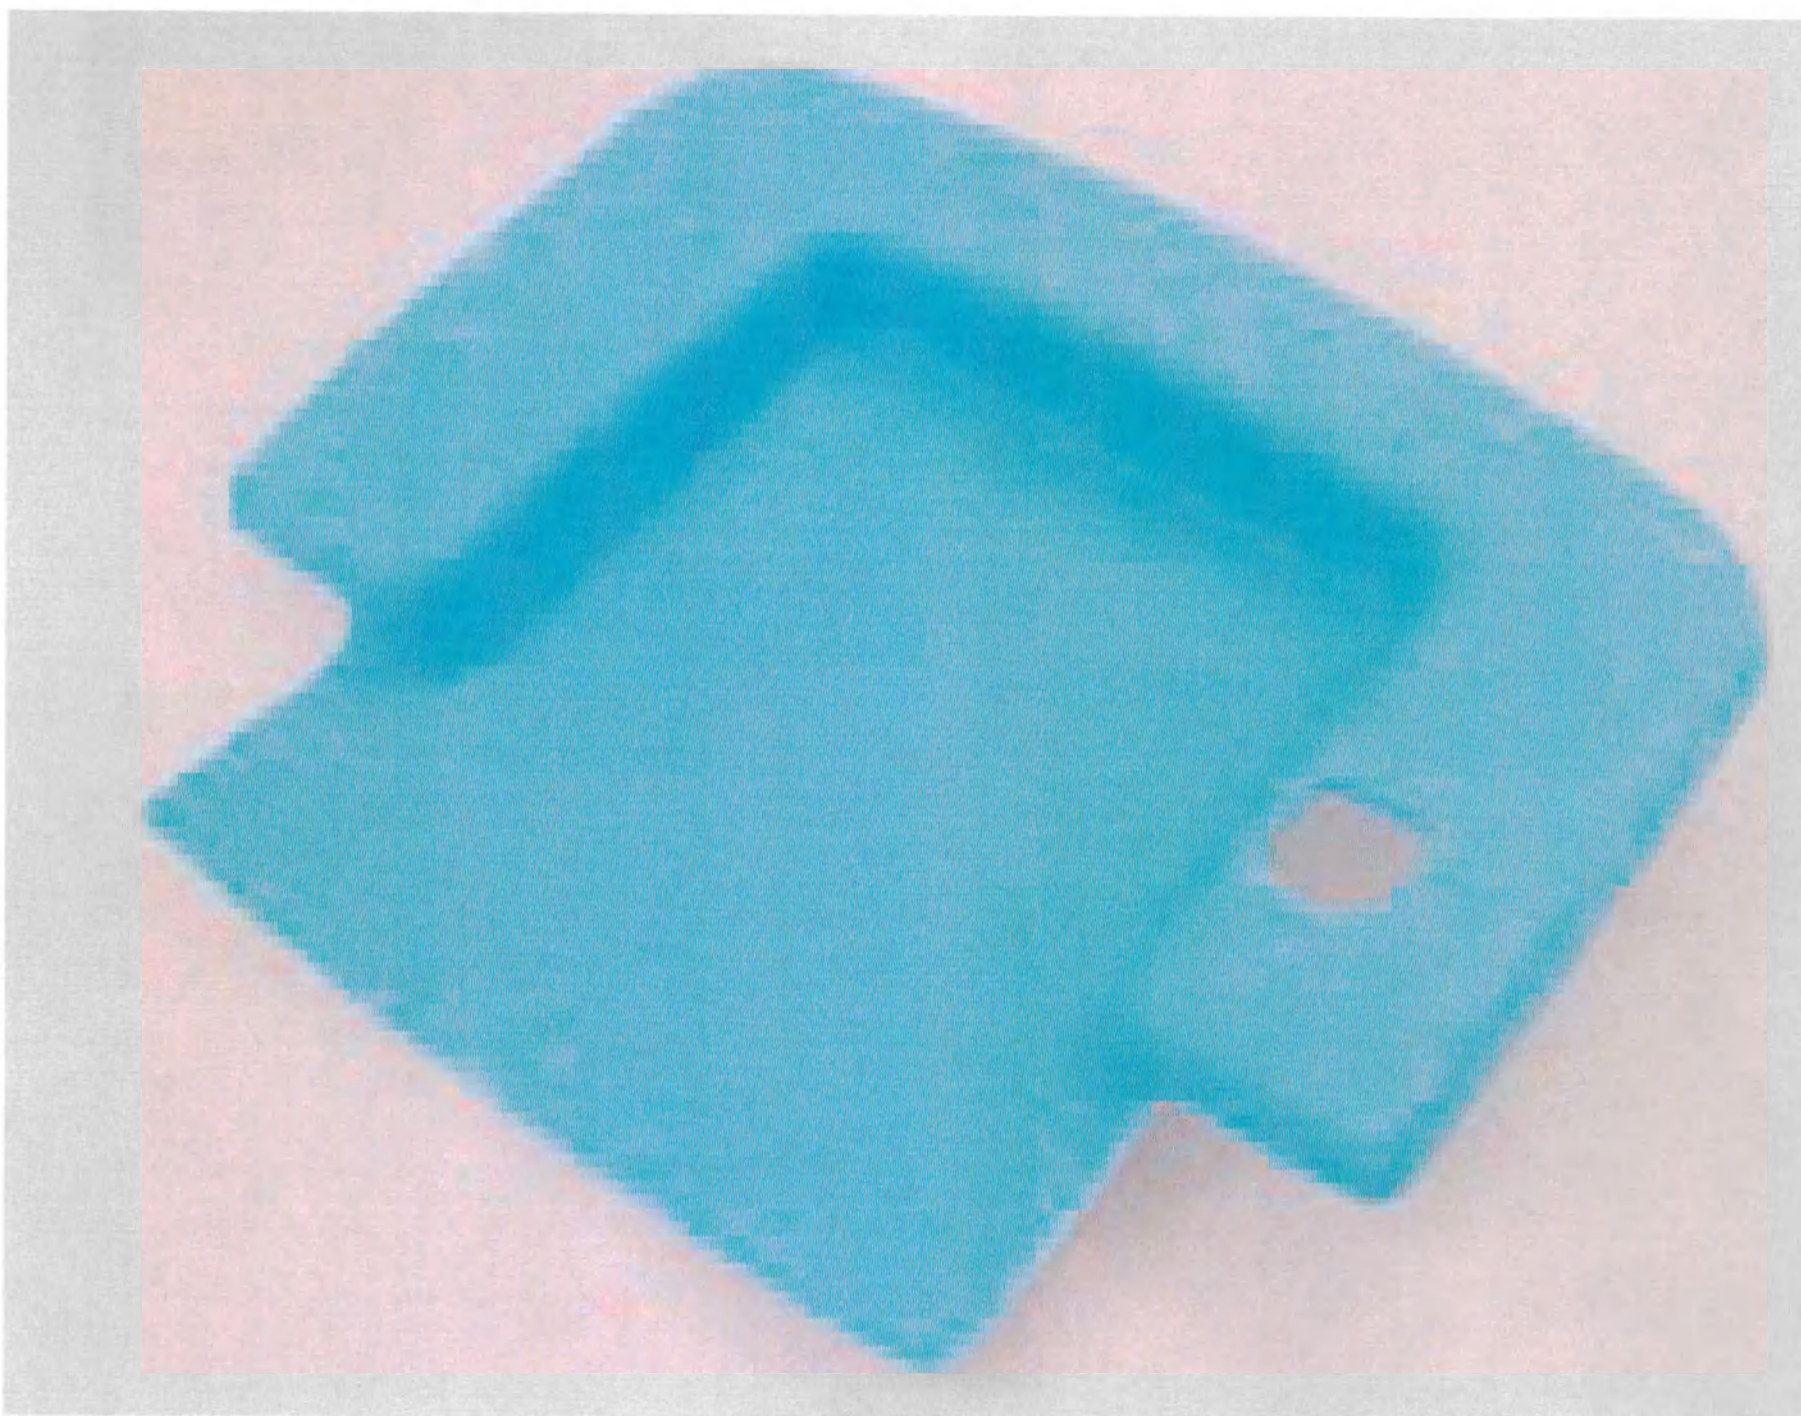


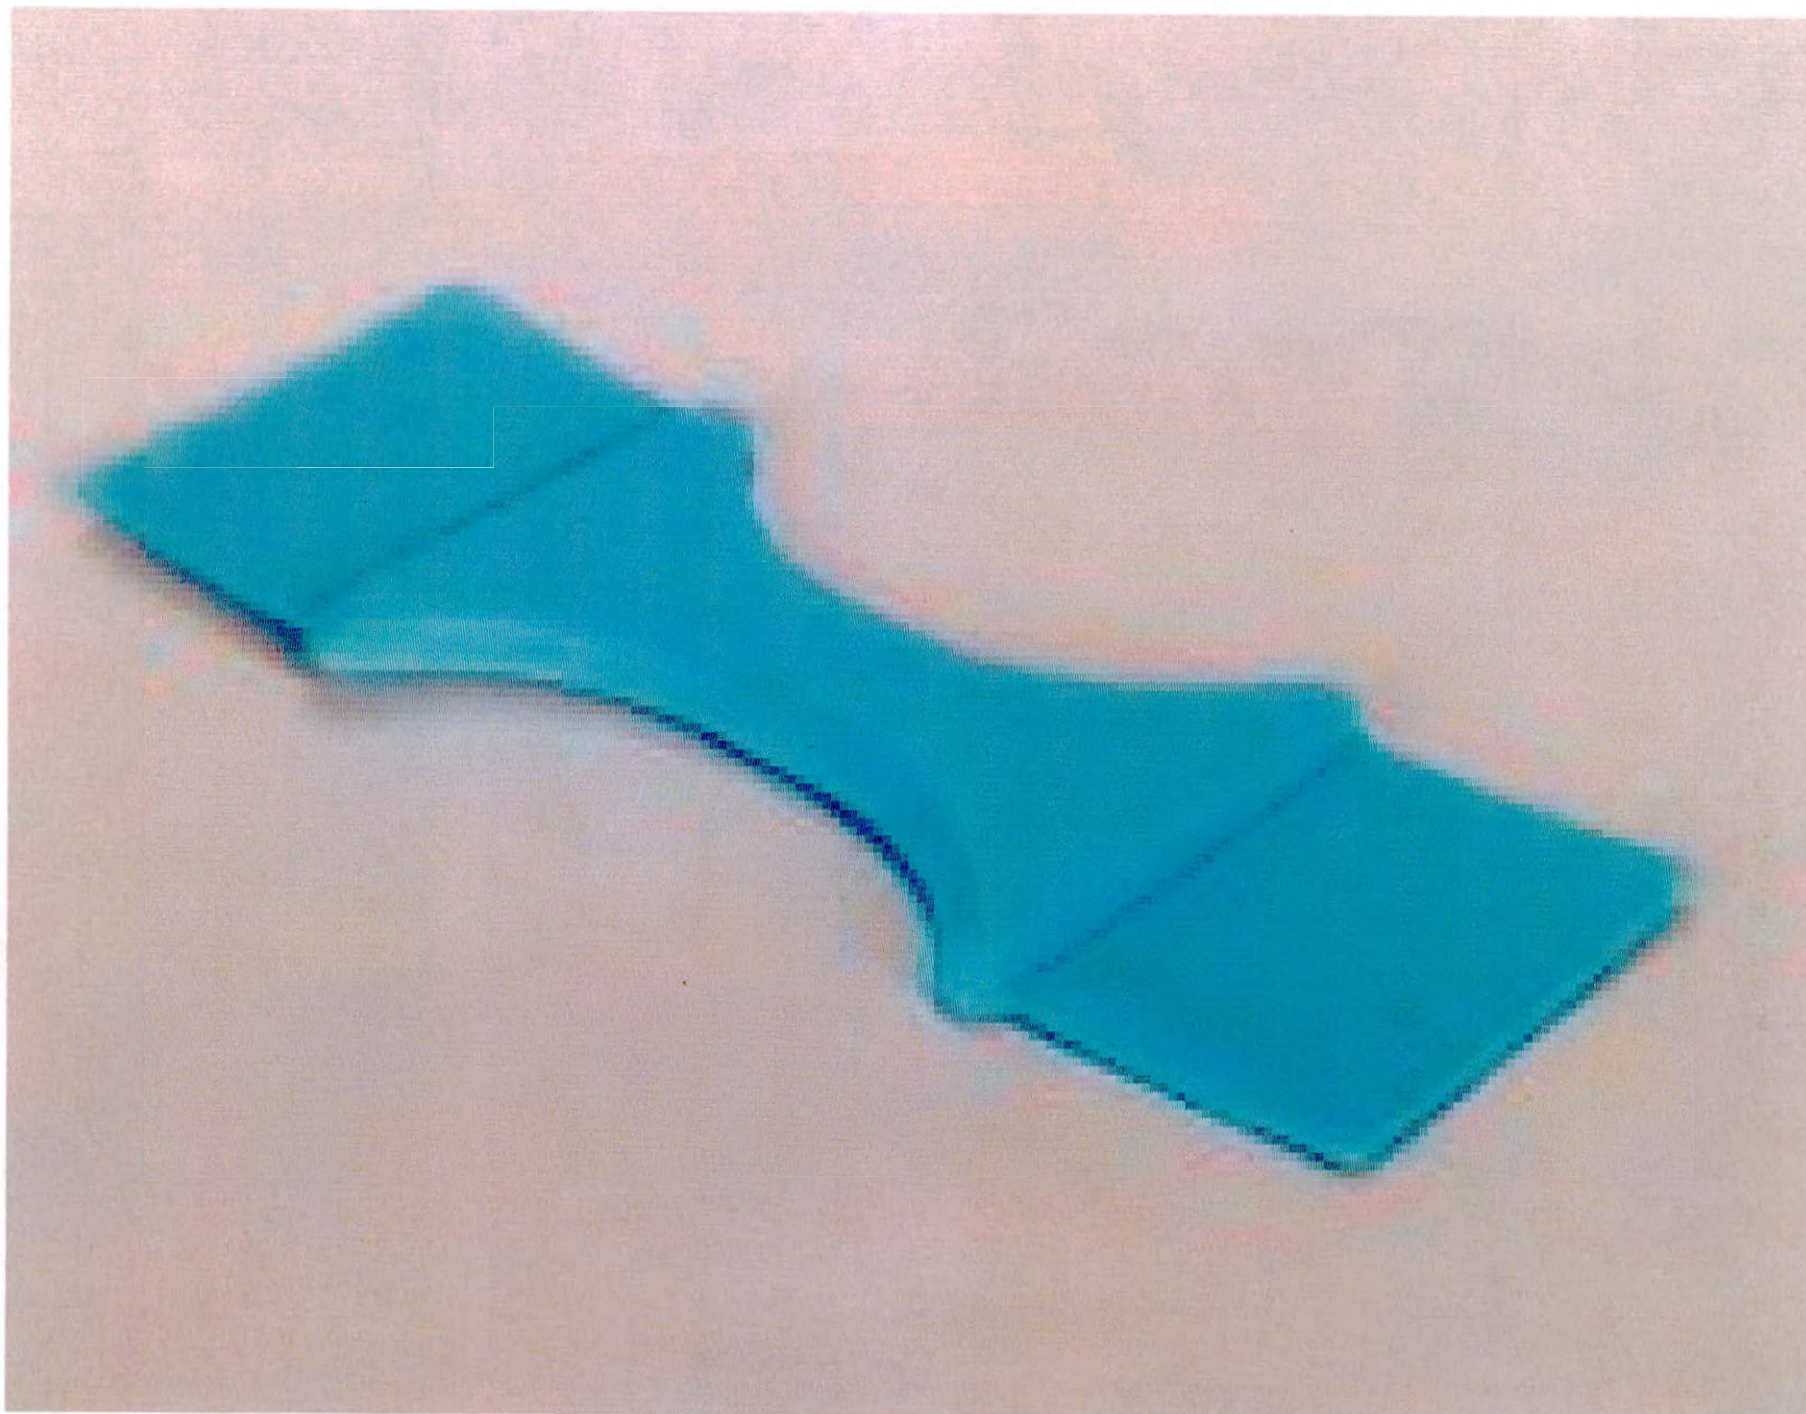

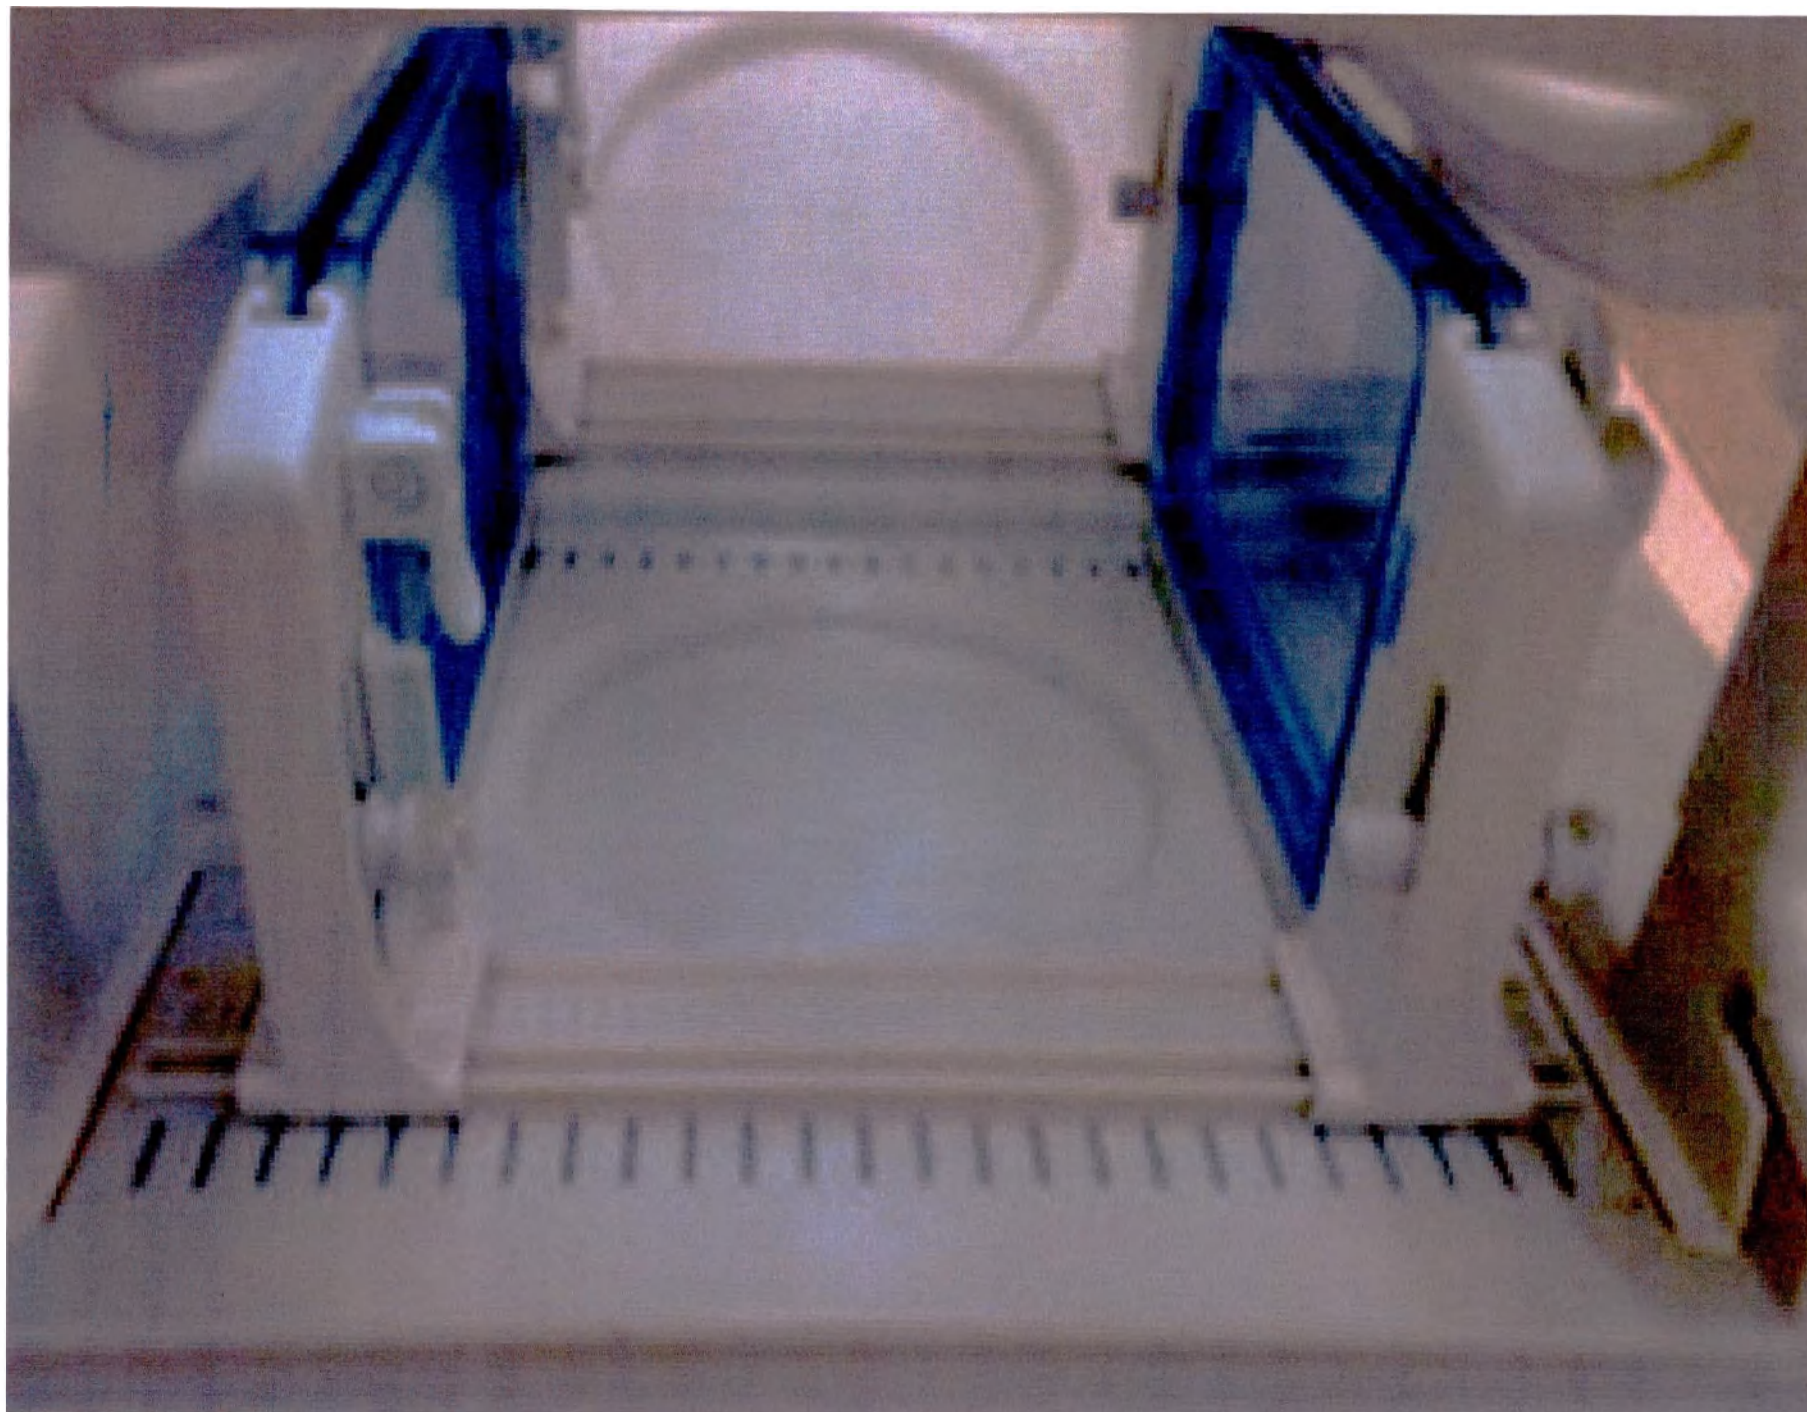


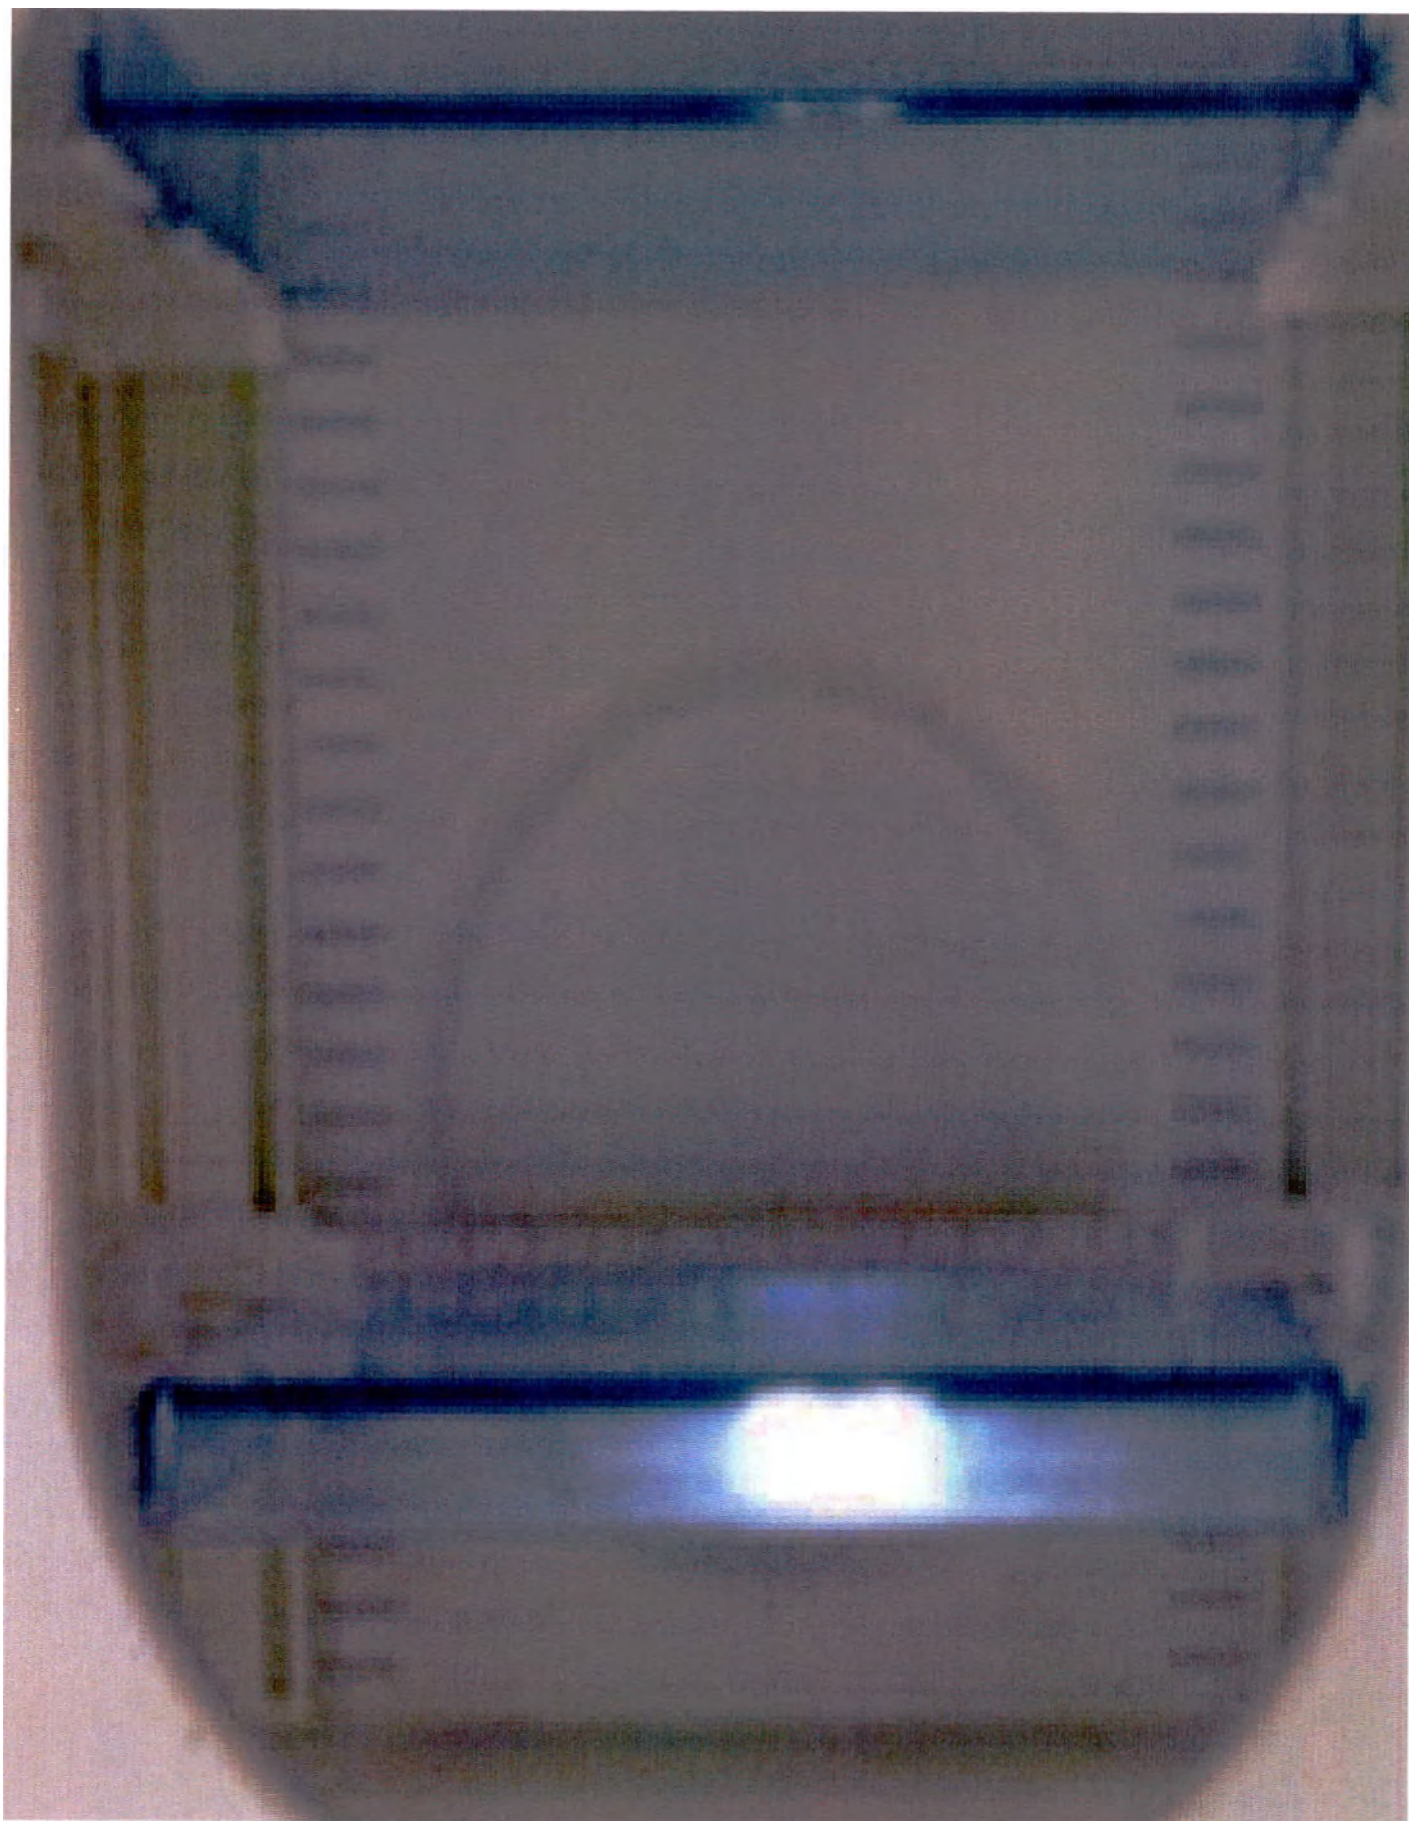


6.5.4. Набор для двусторонней иммобилизации M-L.

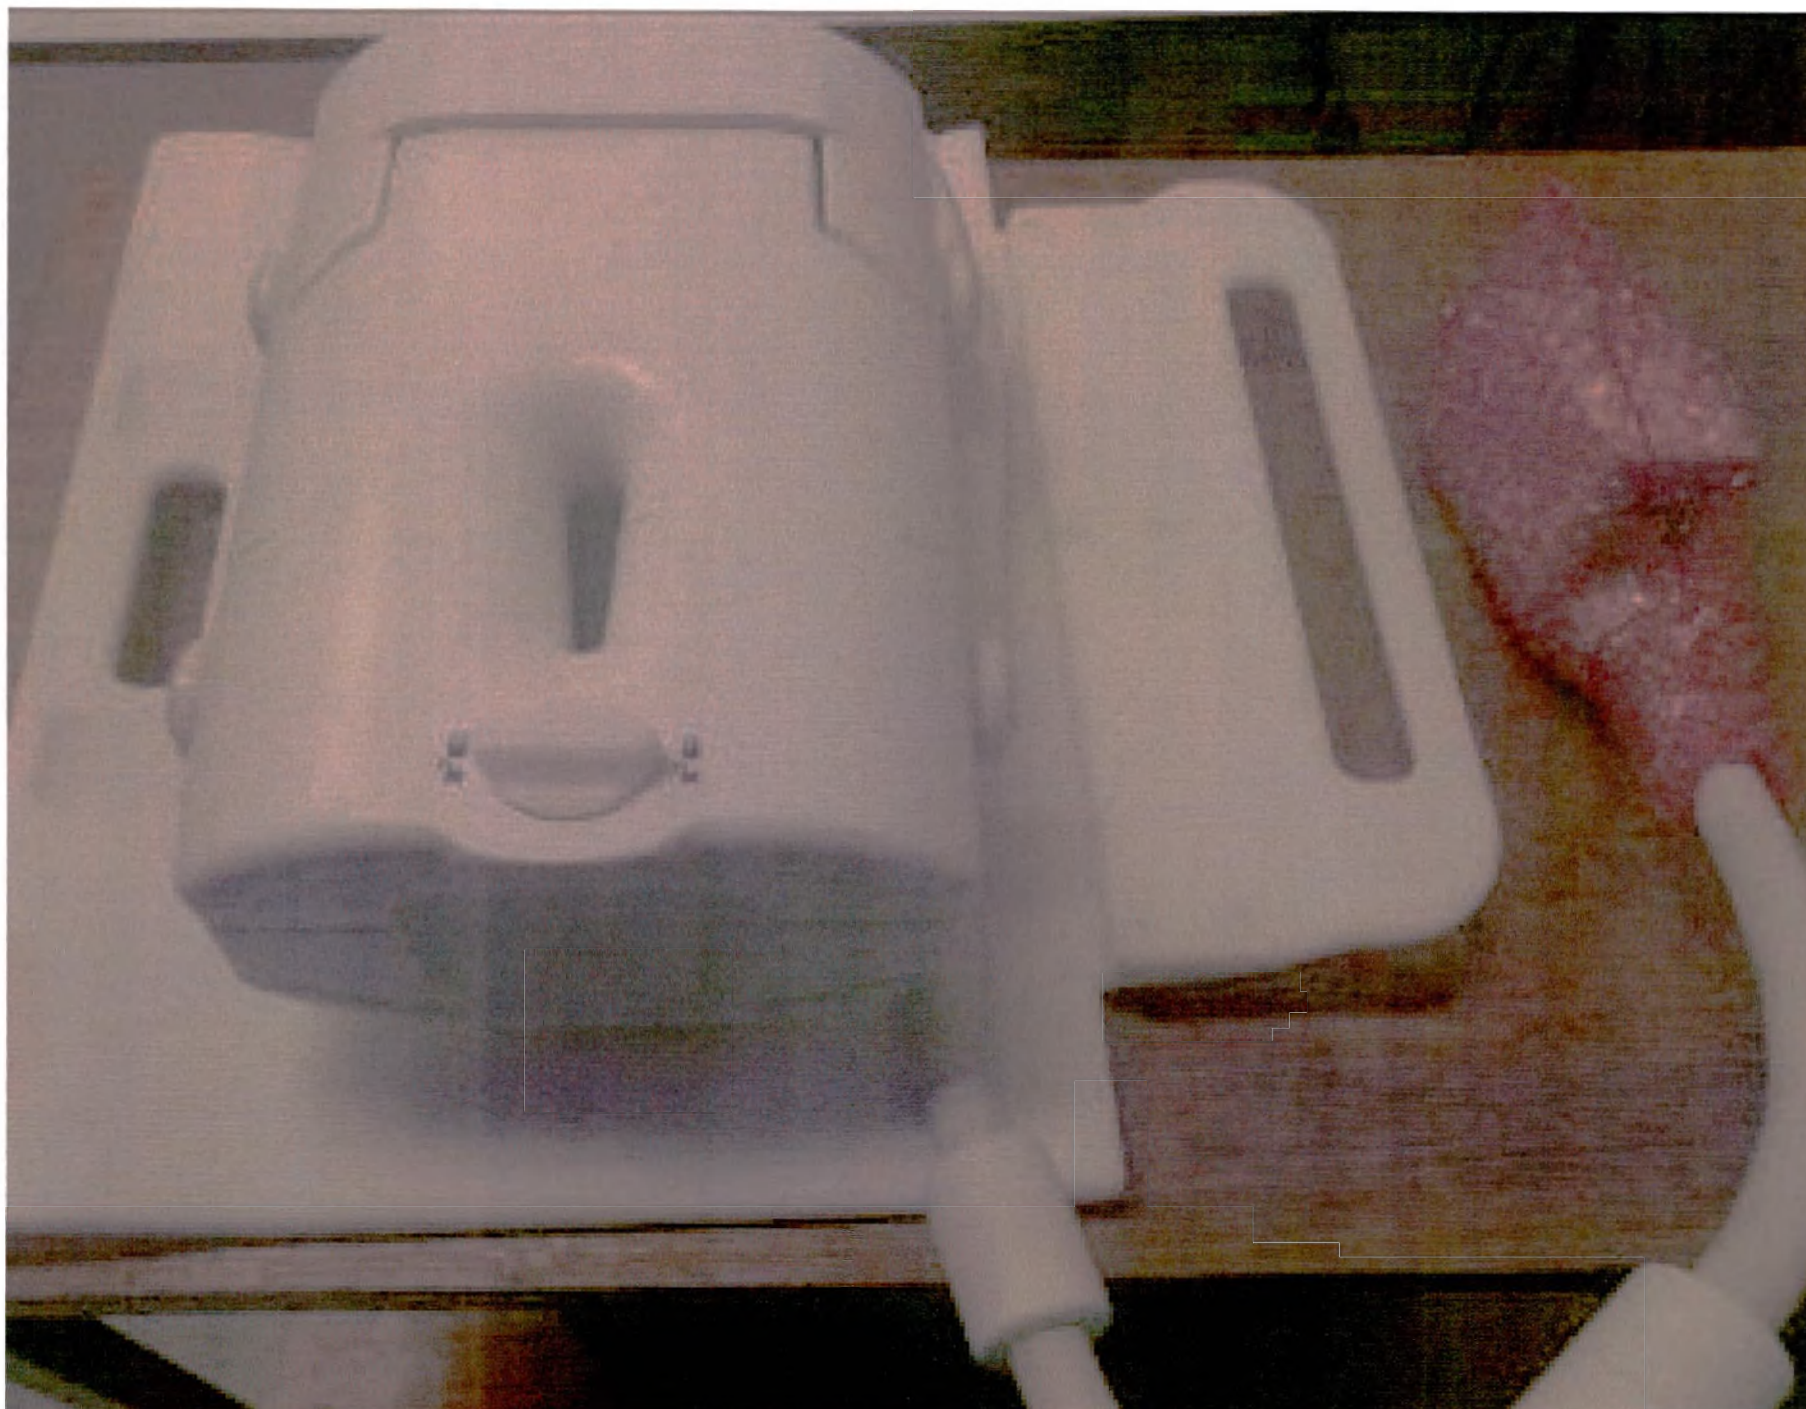





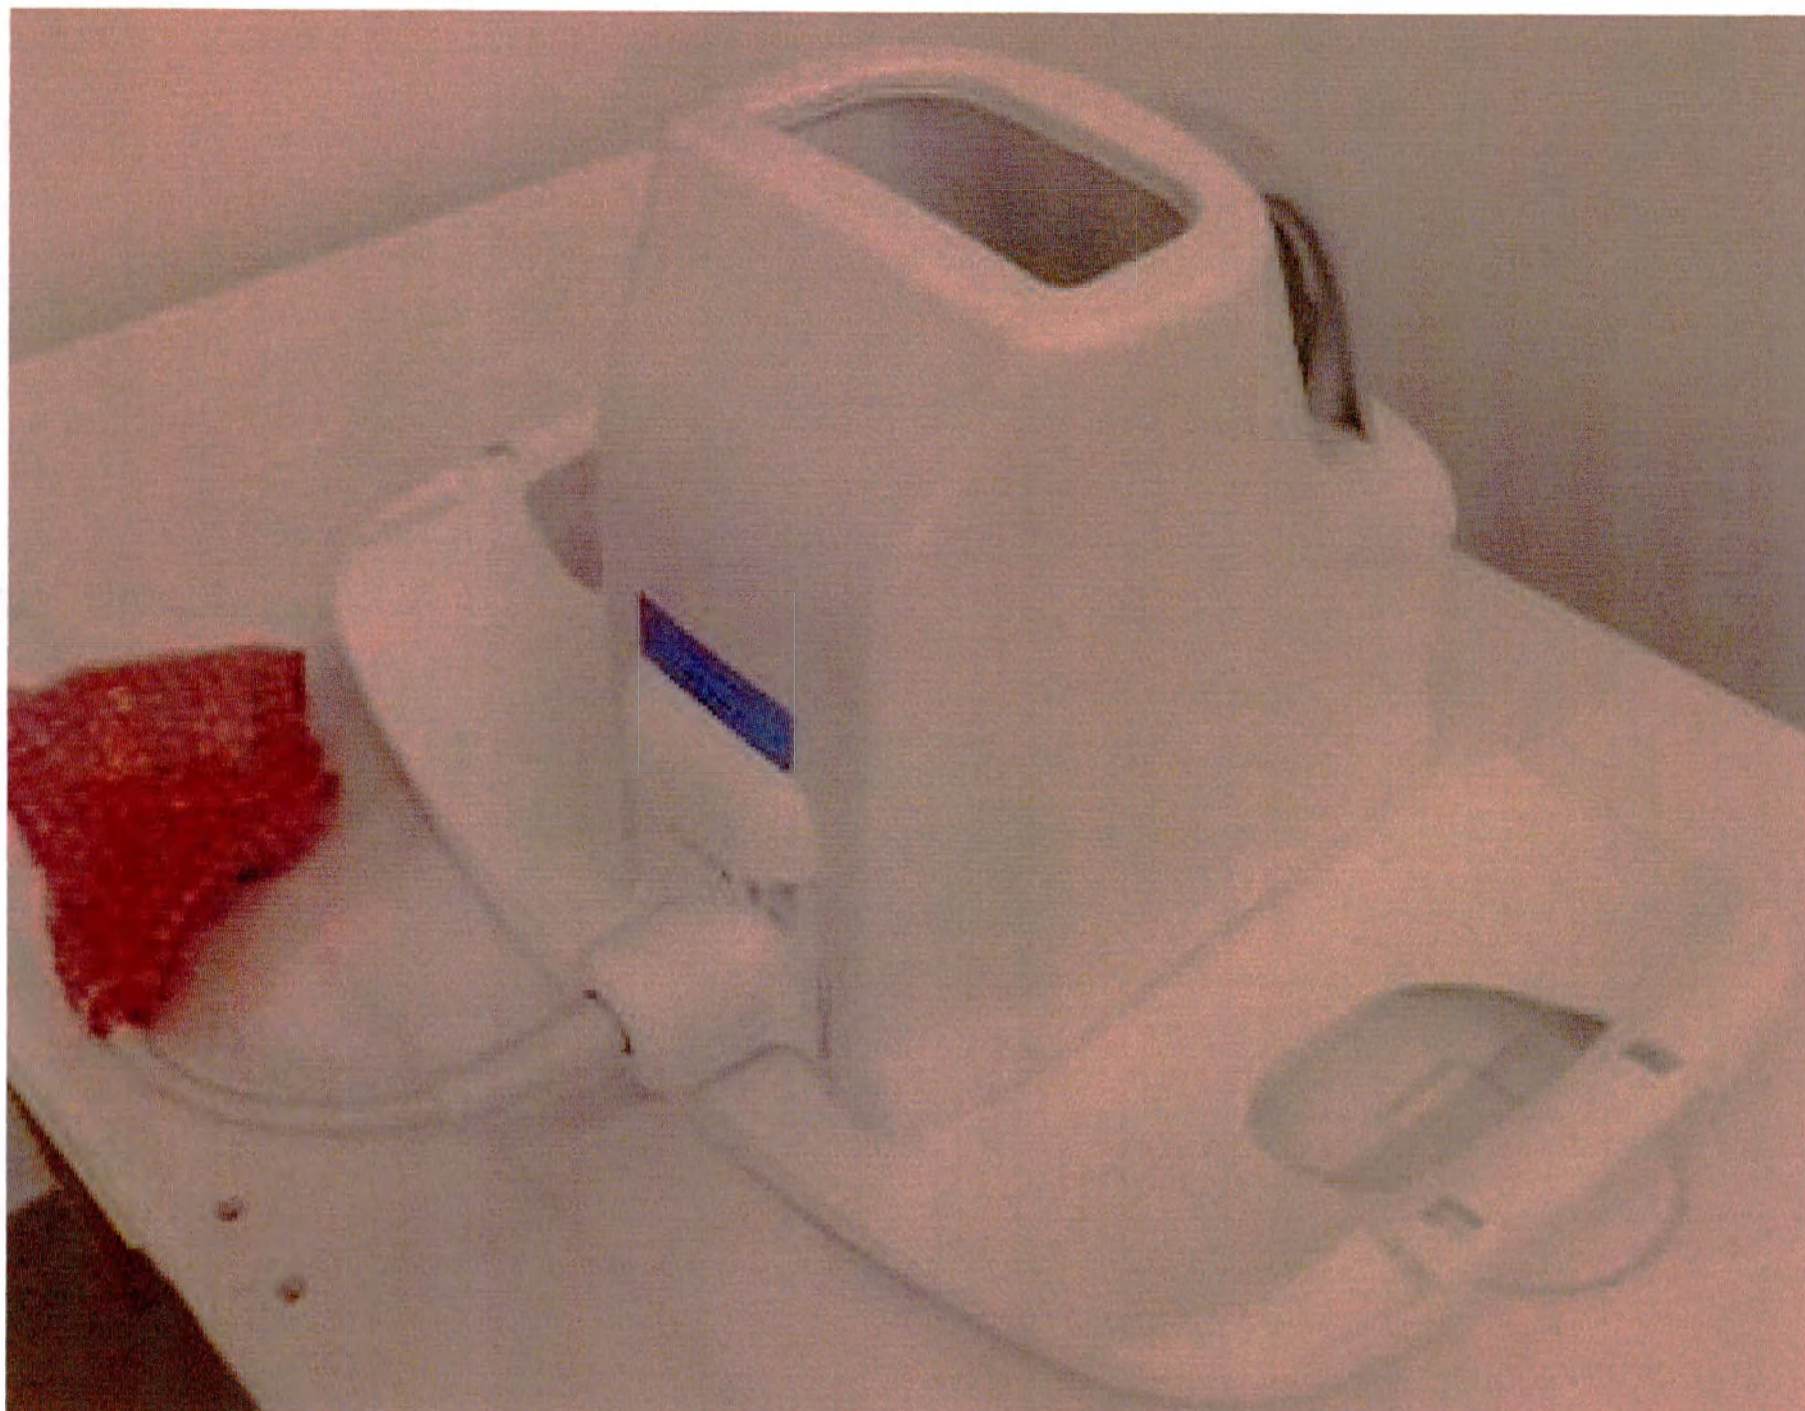


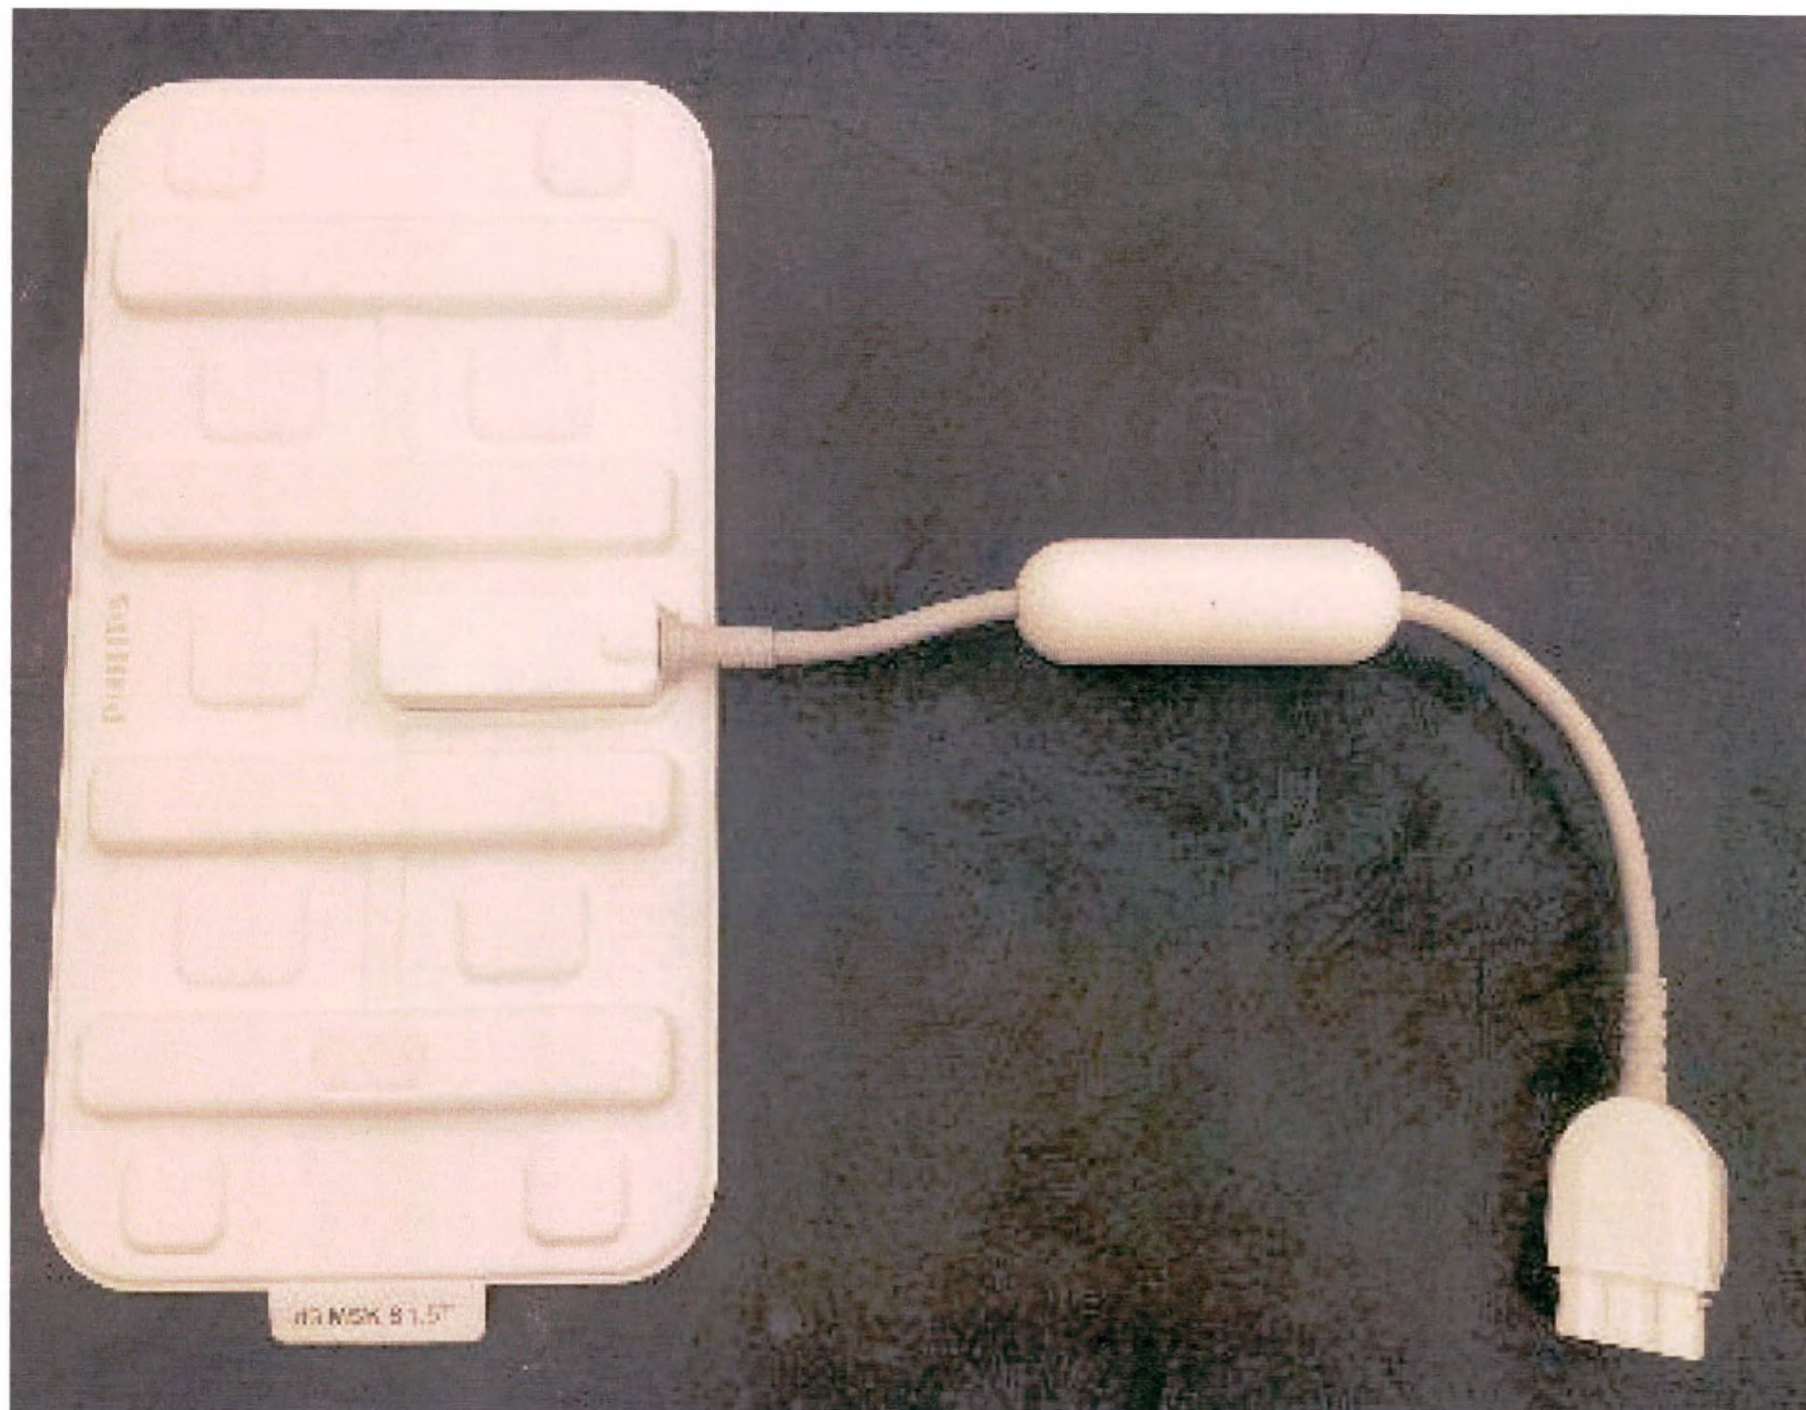


6.9. Катушка dS MSK S 1.5T.

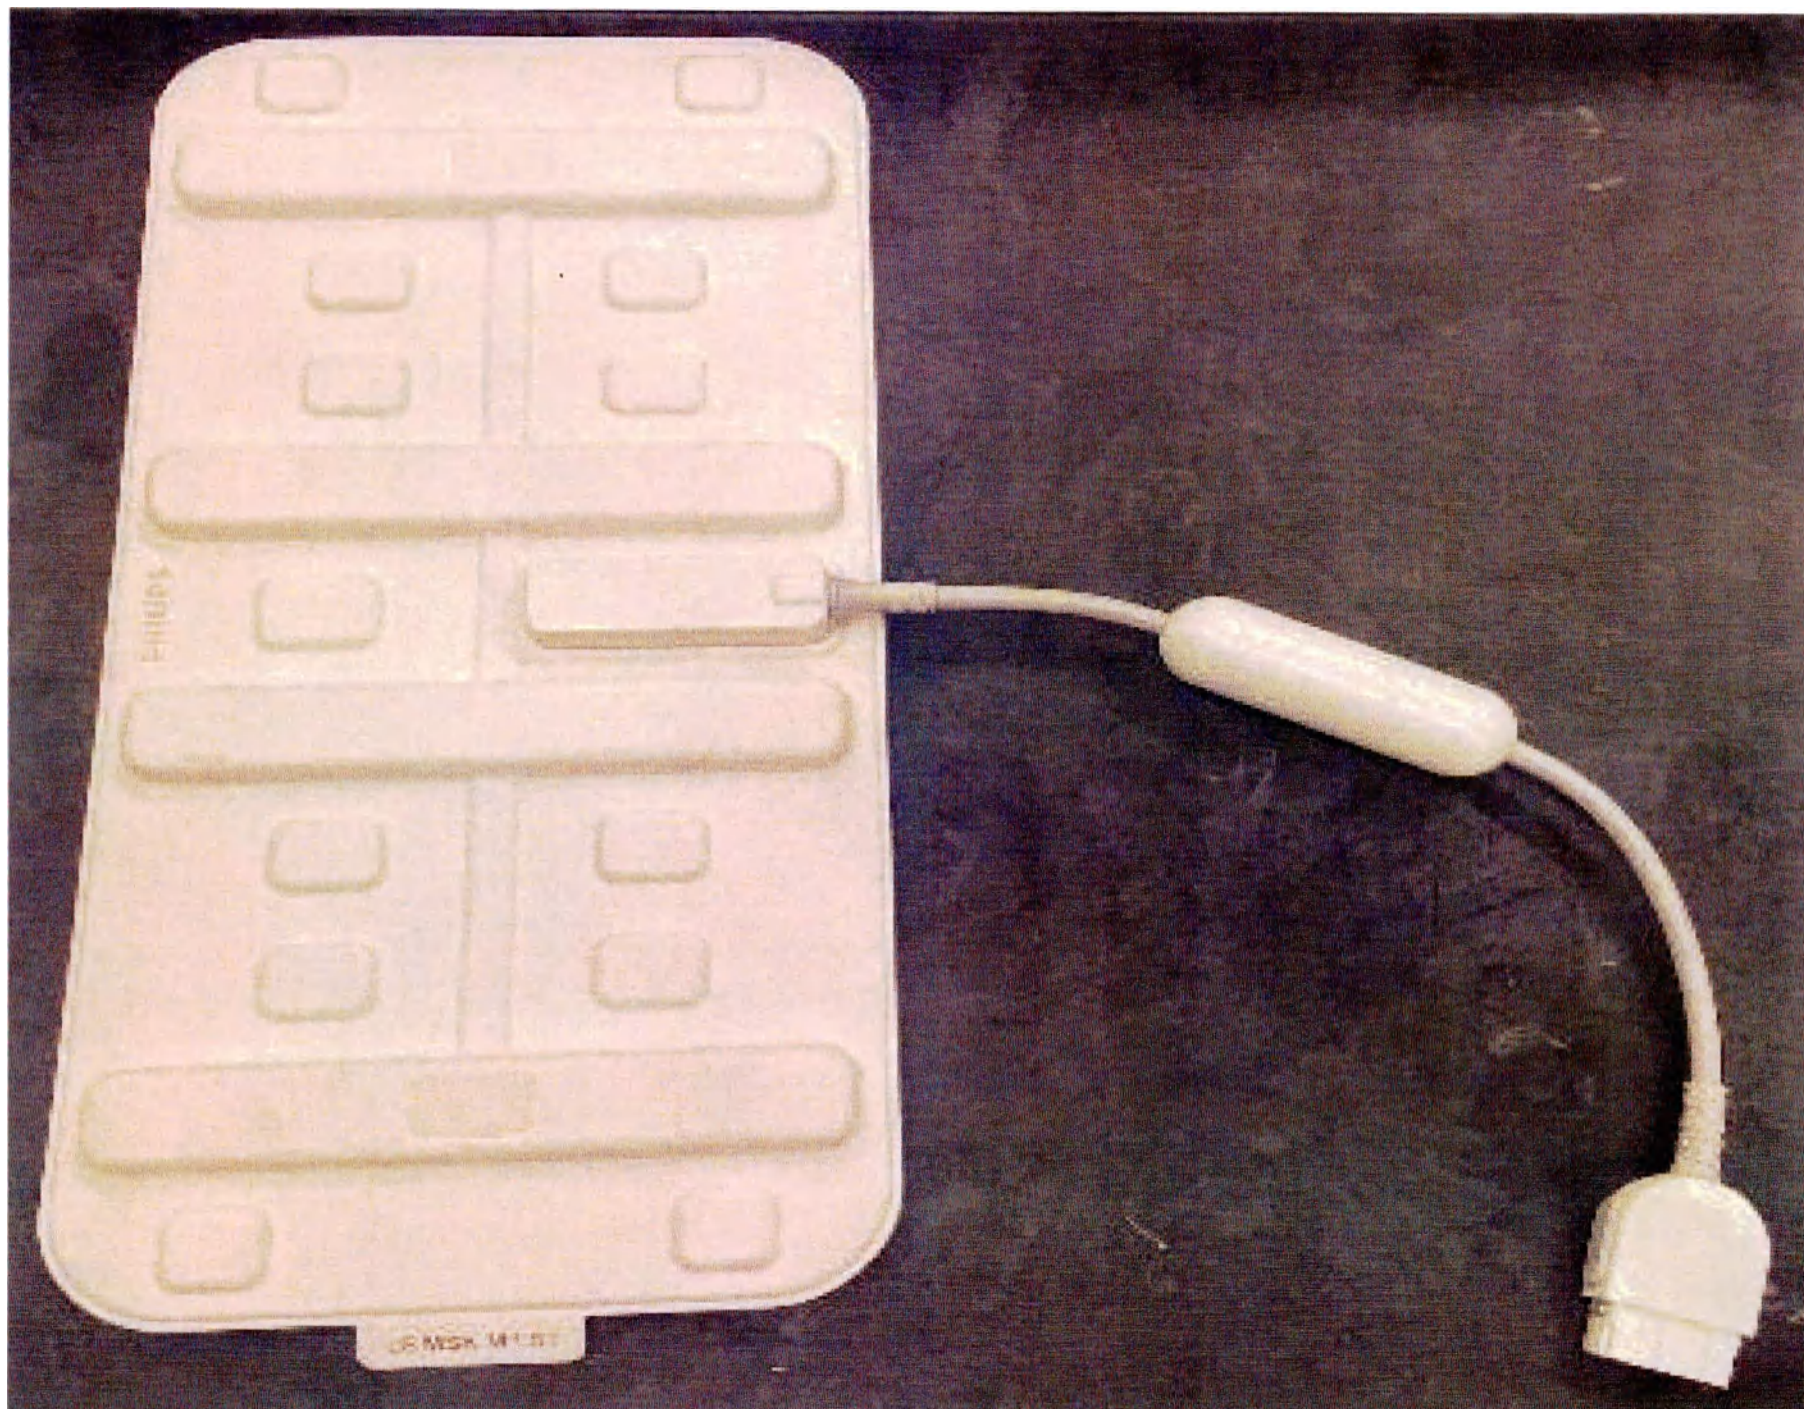

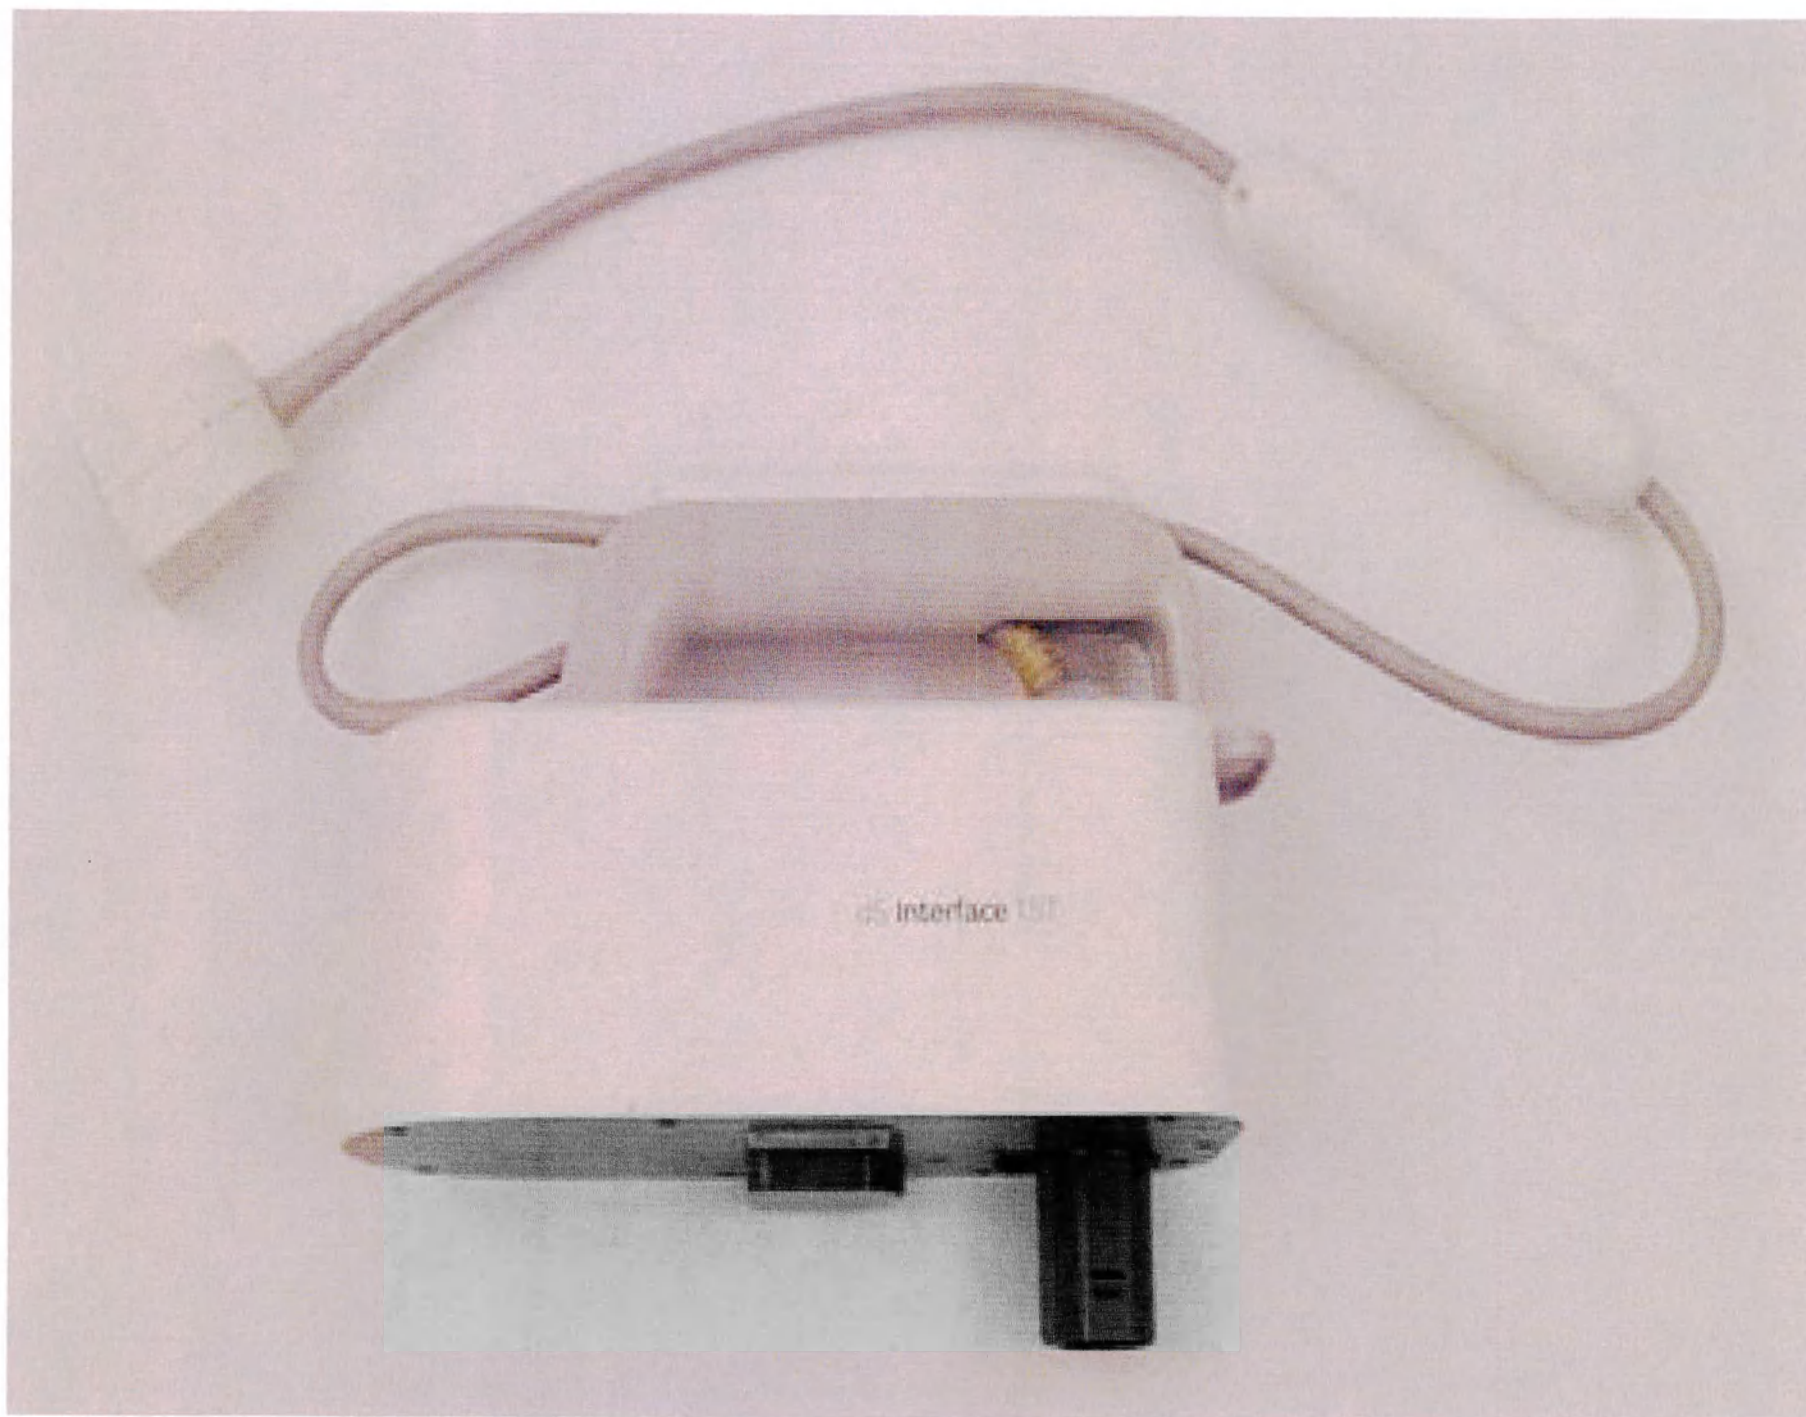


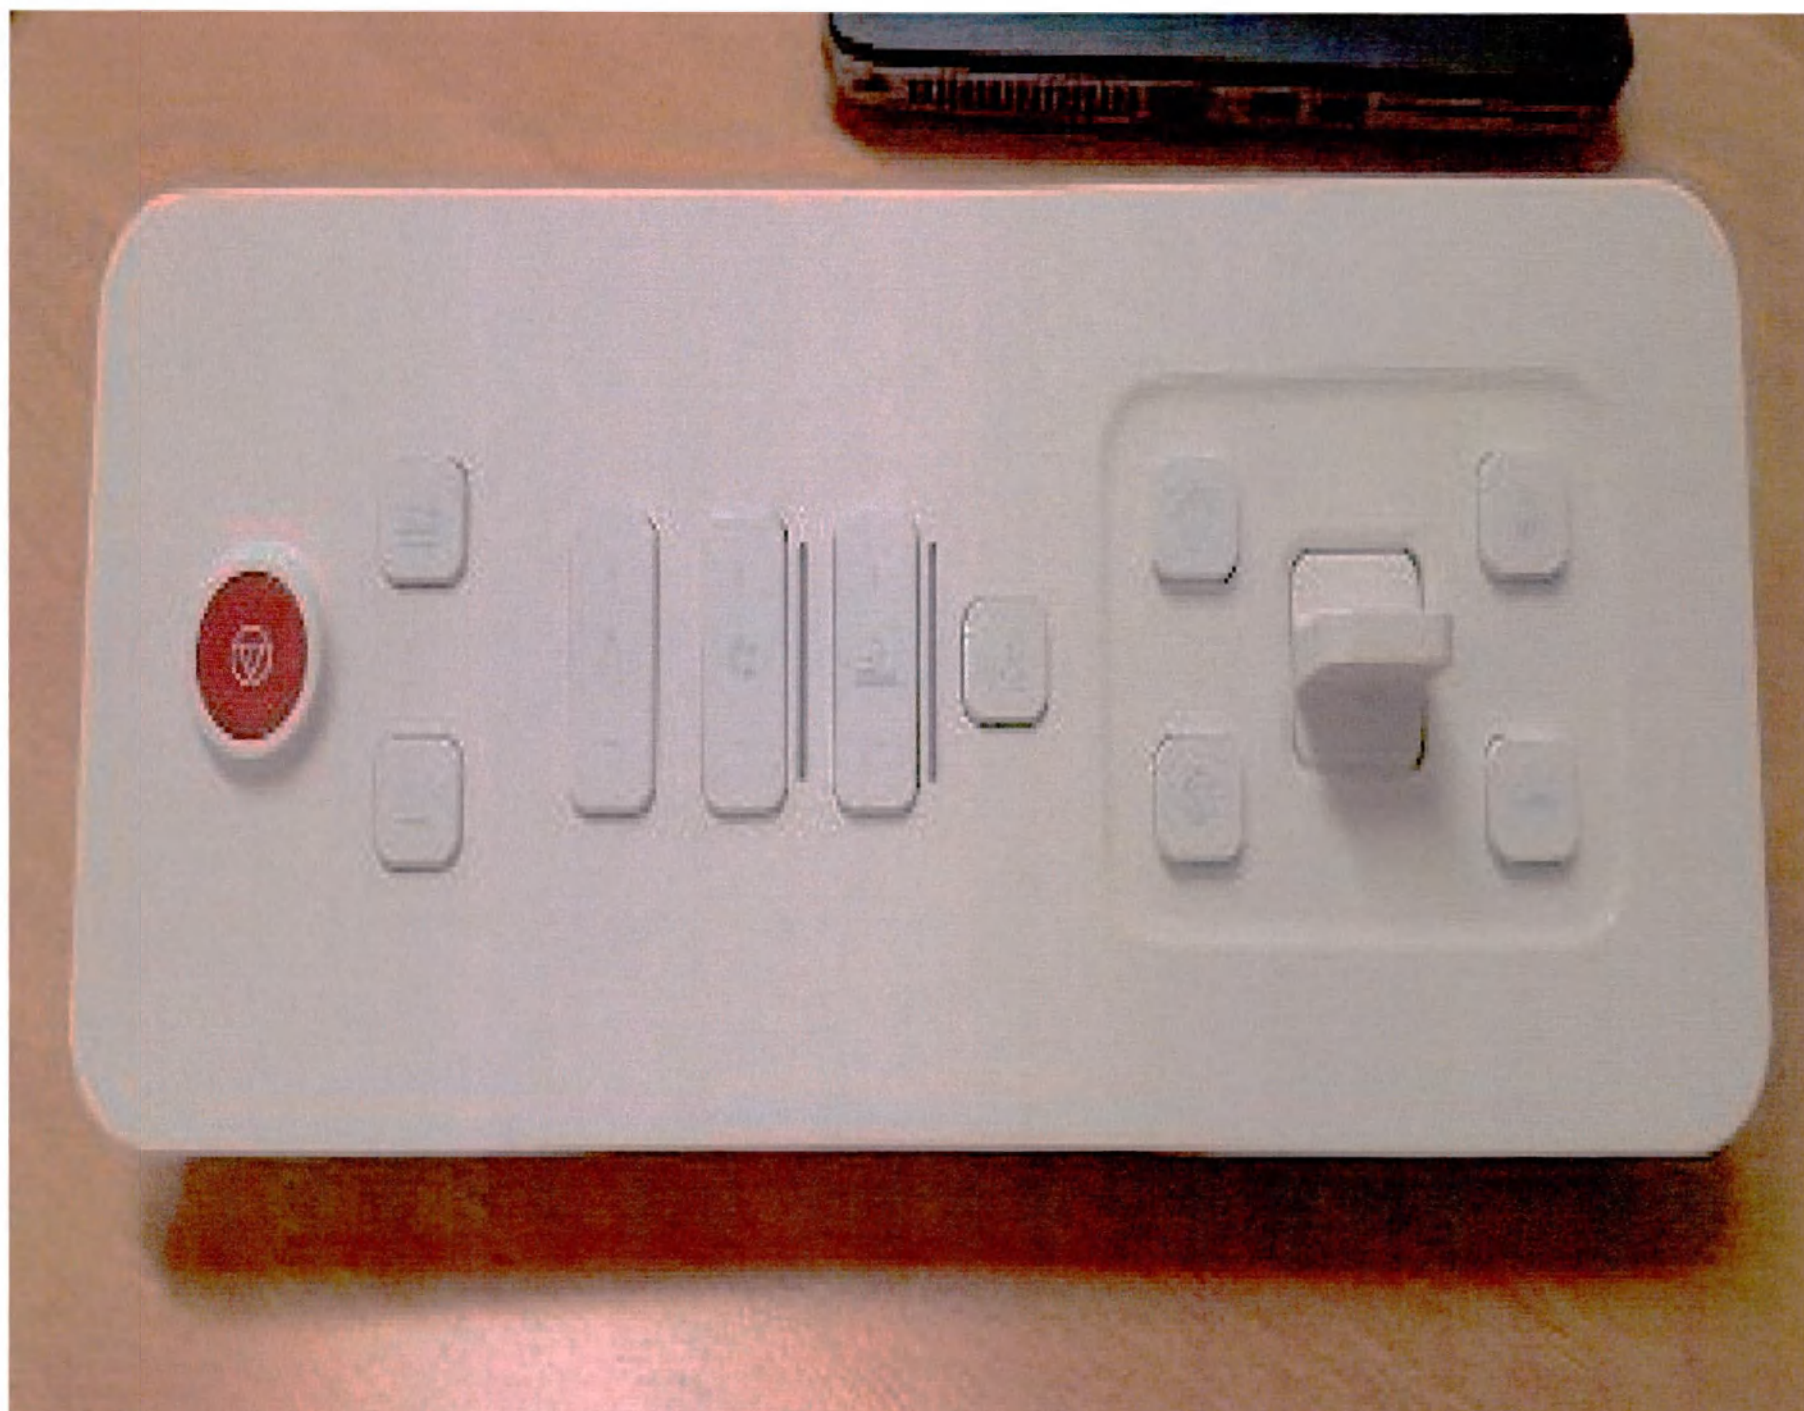


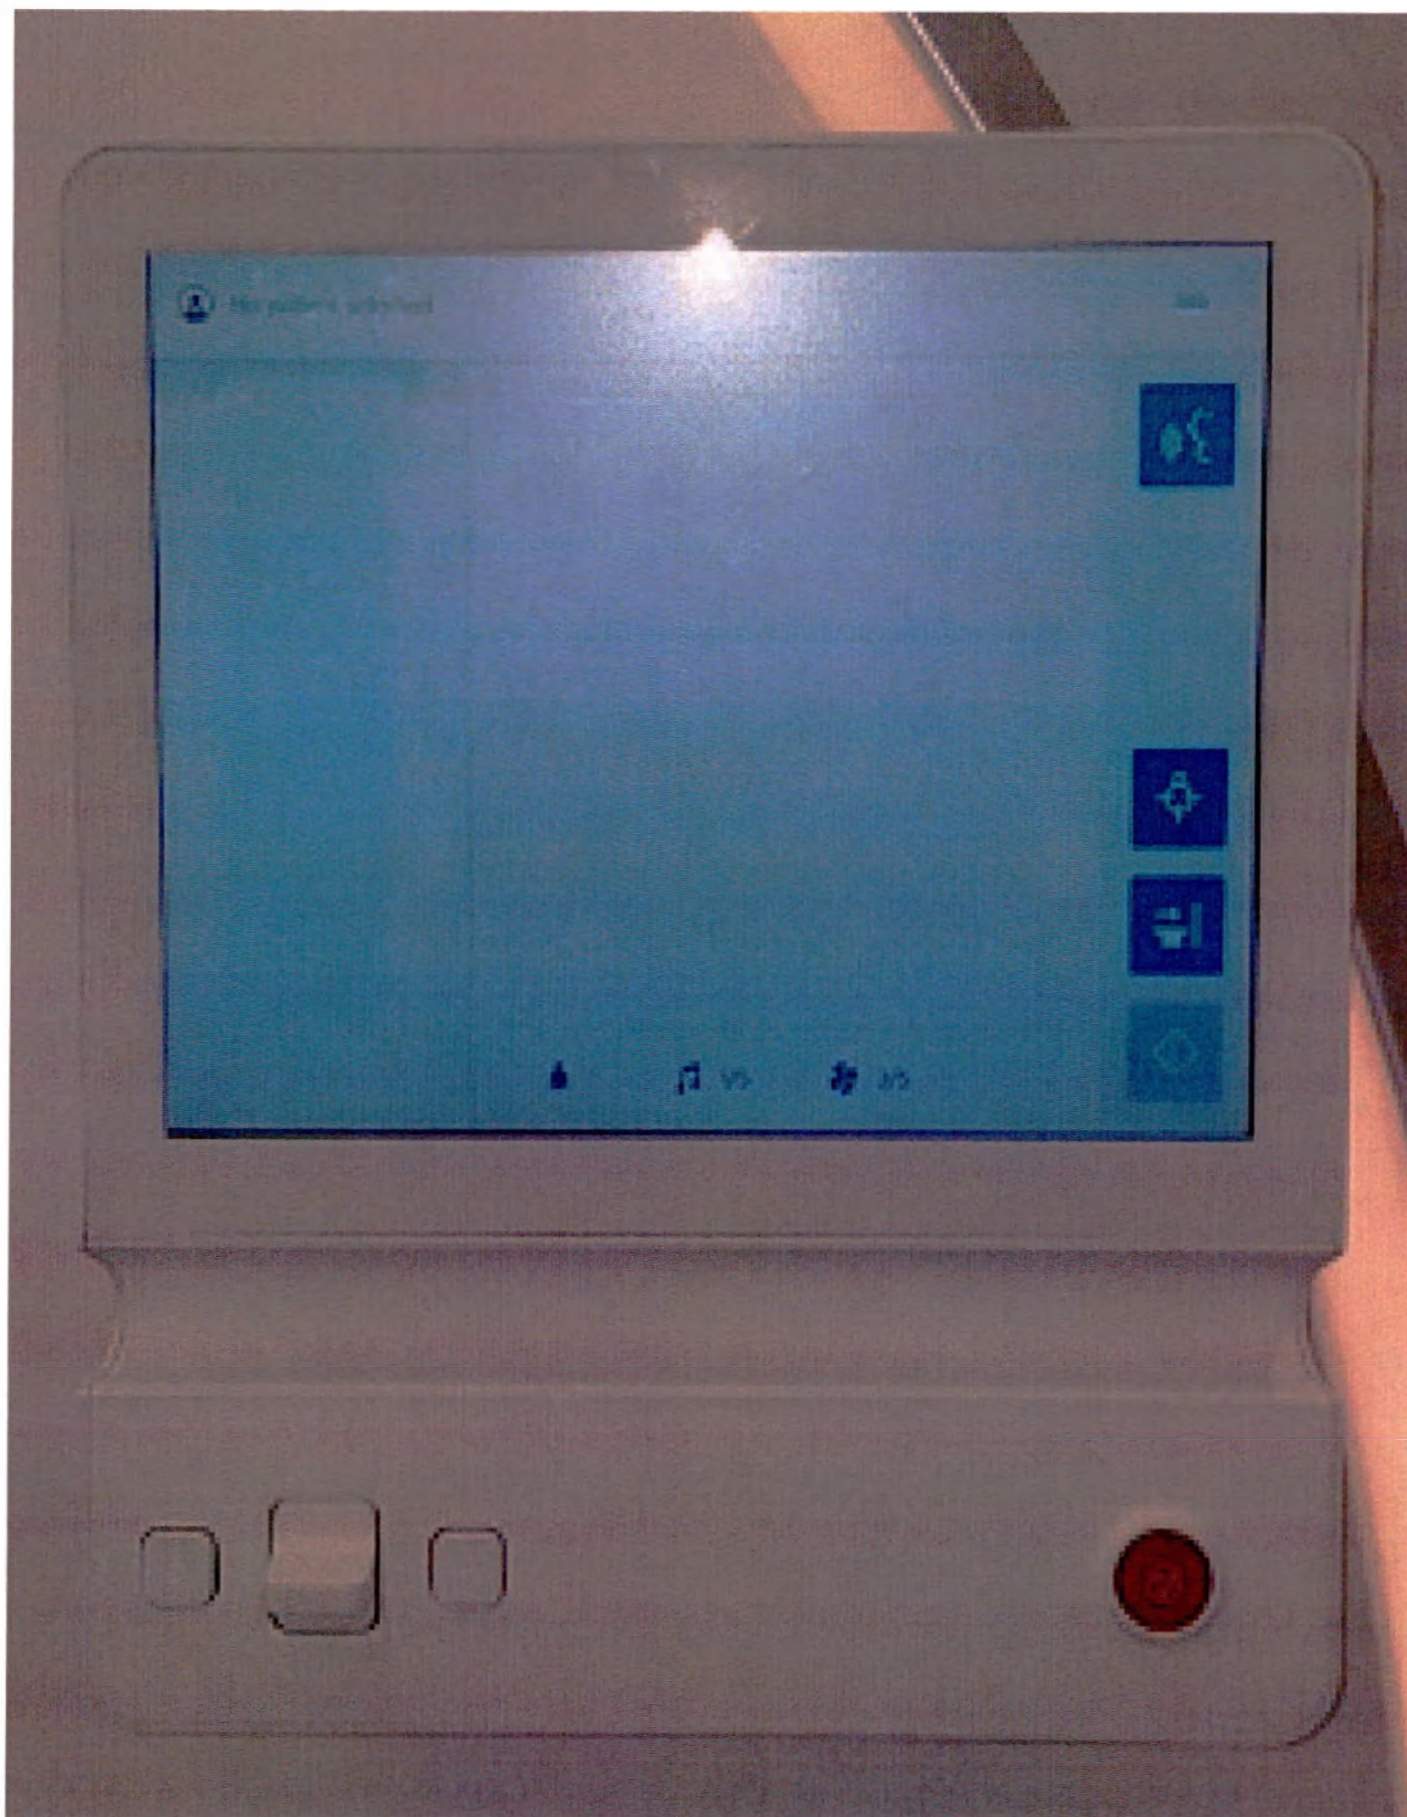


8. Модули пользовательского интерфейса UIM или устройства VitalScreen. Устройство управления VitalScreen.



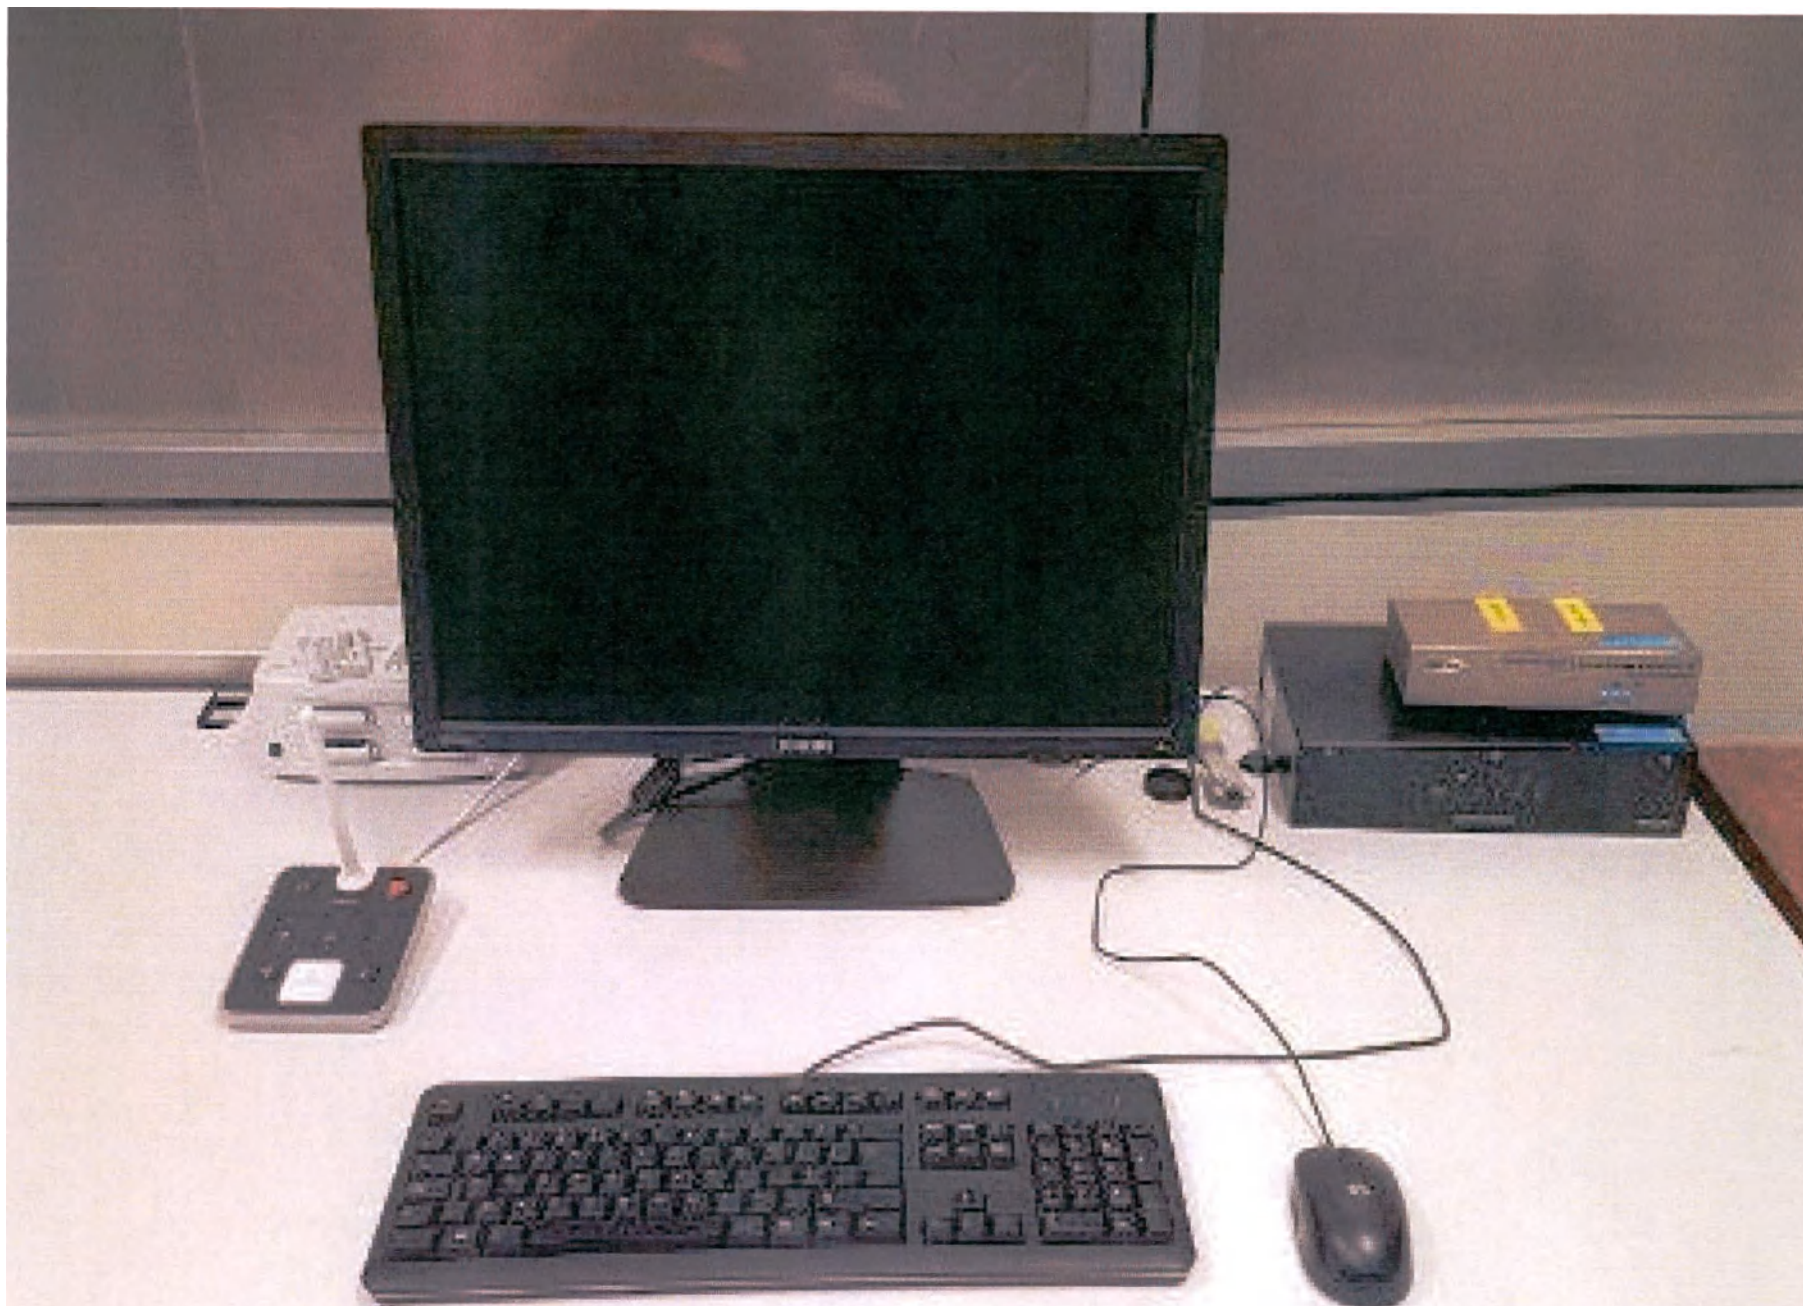


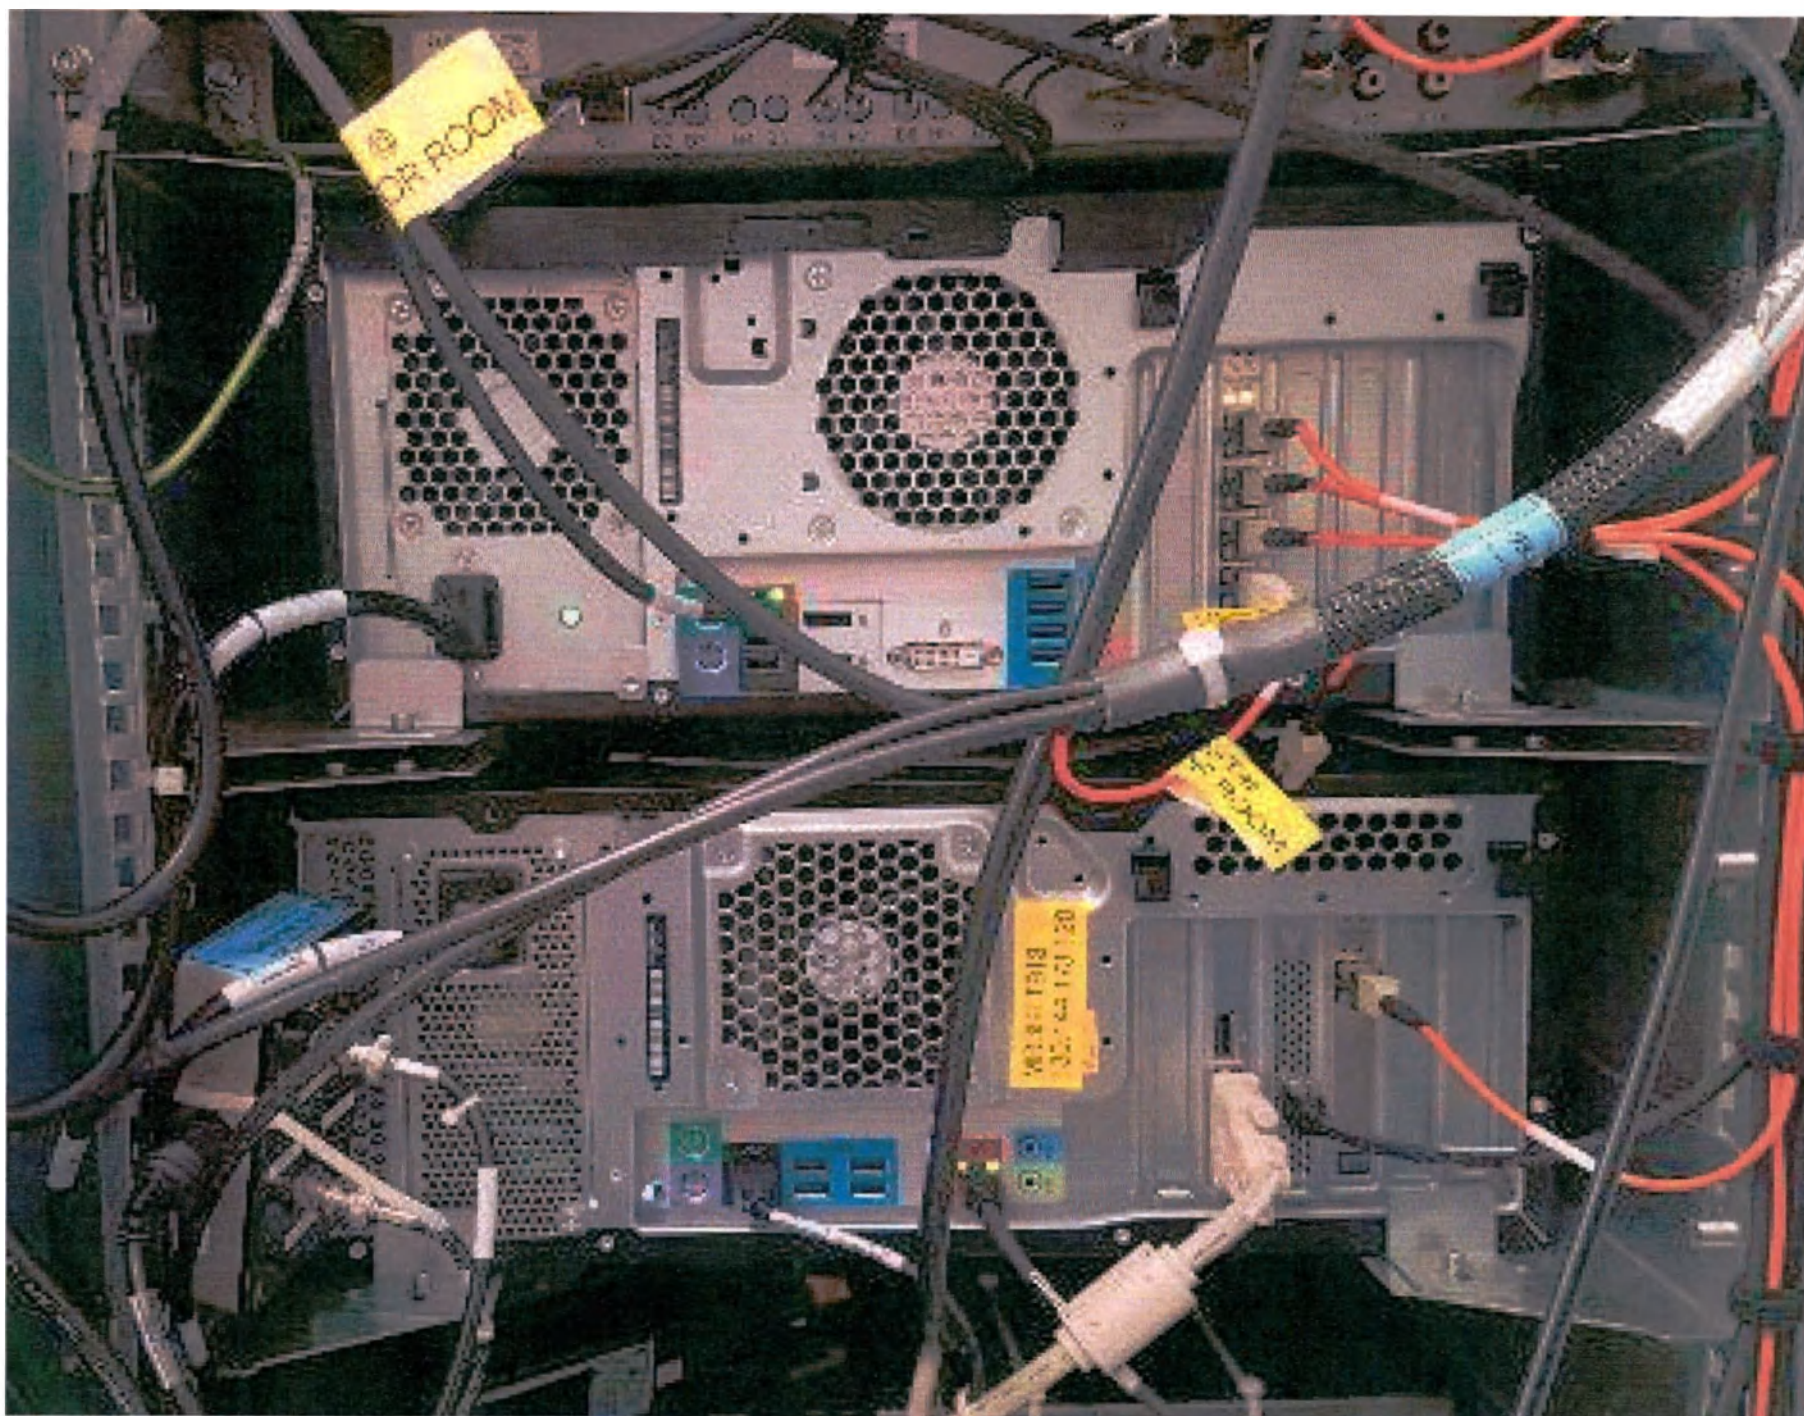



10.1. Компьютерная система (системный блок с оперативной системой Windows и ПО МР-системы версии R 11.1 и выше на электронных и/или виртуальных носителях).

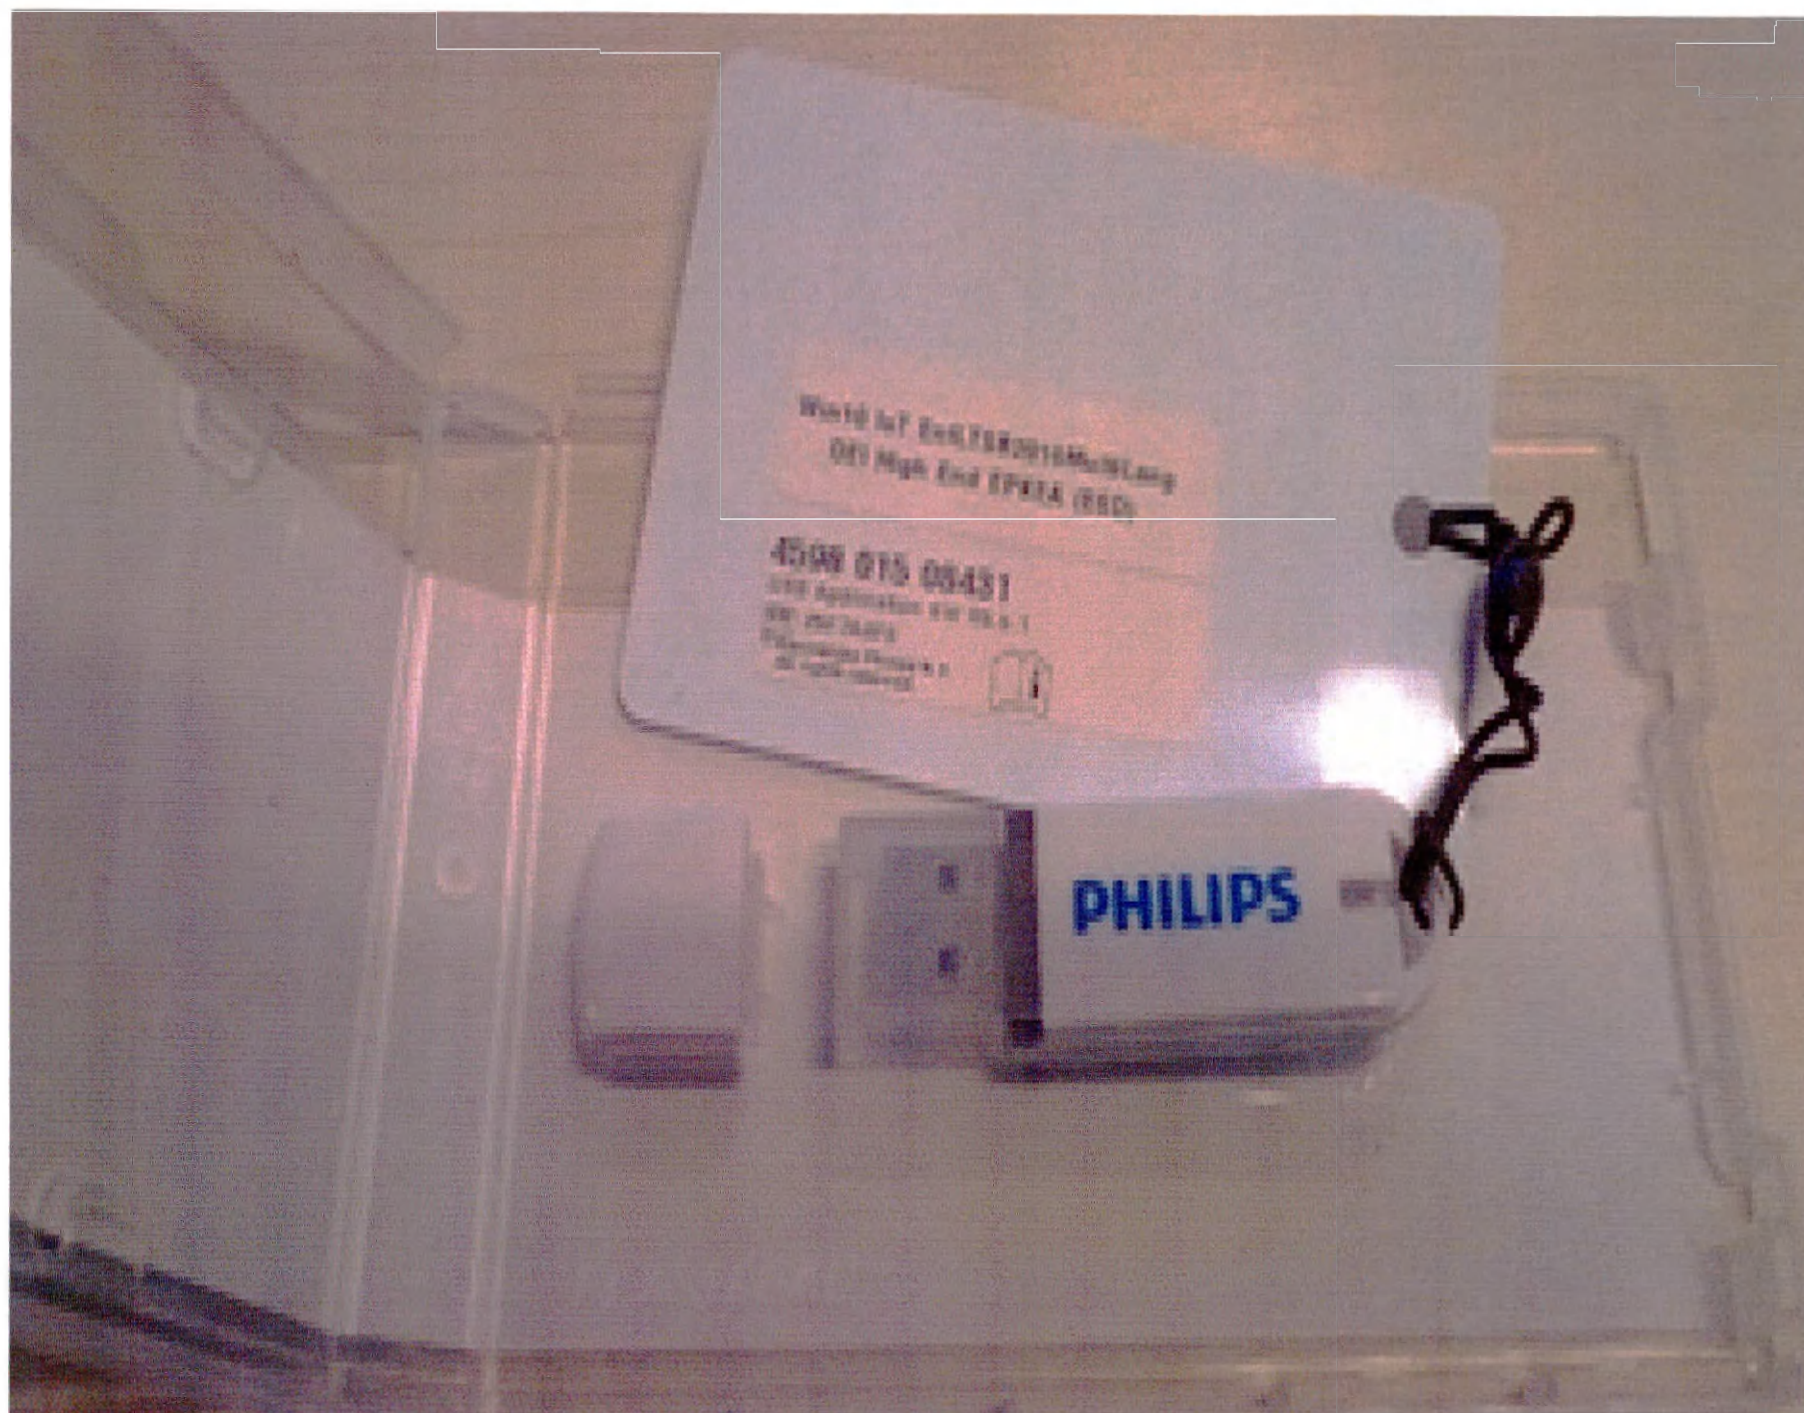

10.2. Программные обеспечения для программных приложений к системе МР томографа на оптических и/или электронных и/или на виртуальных носителях.

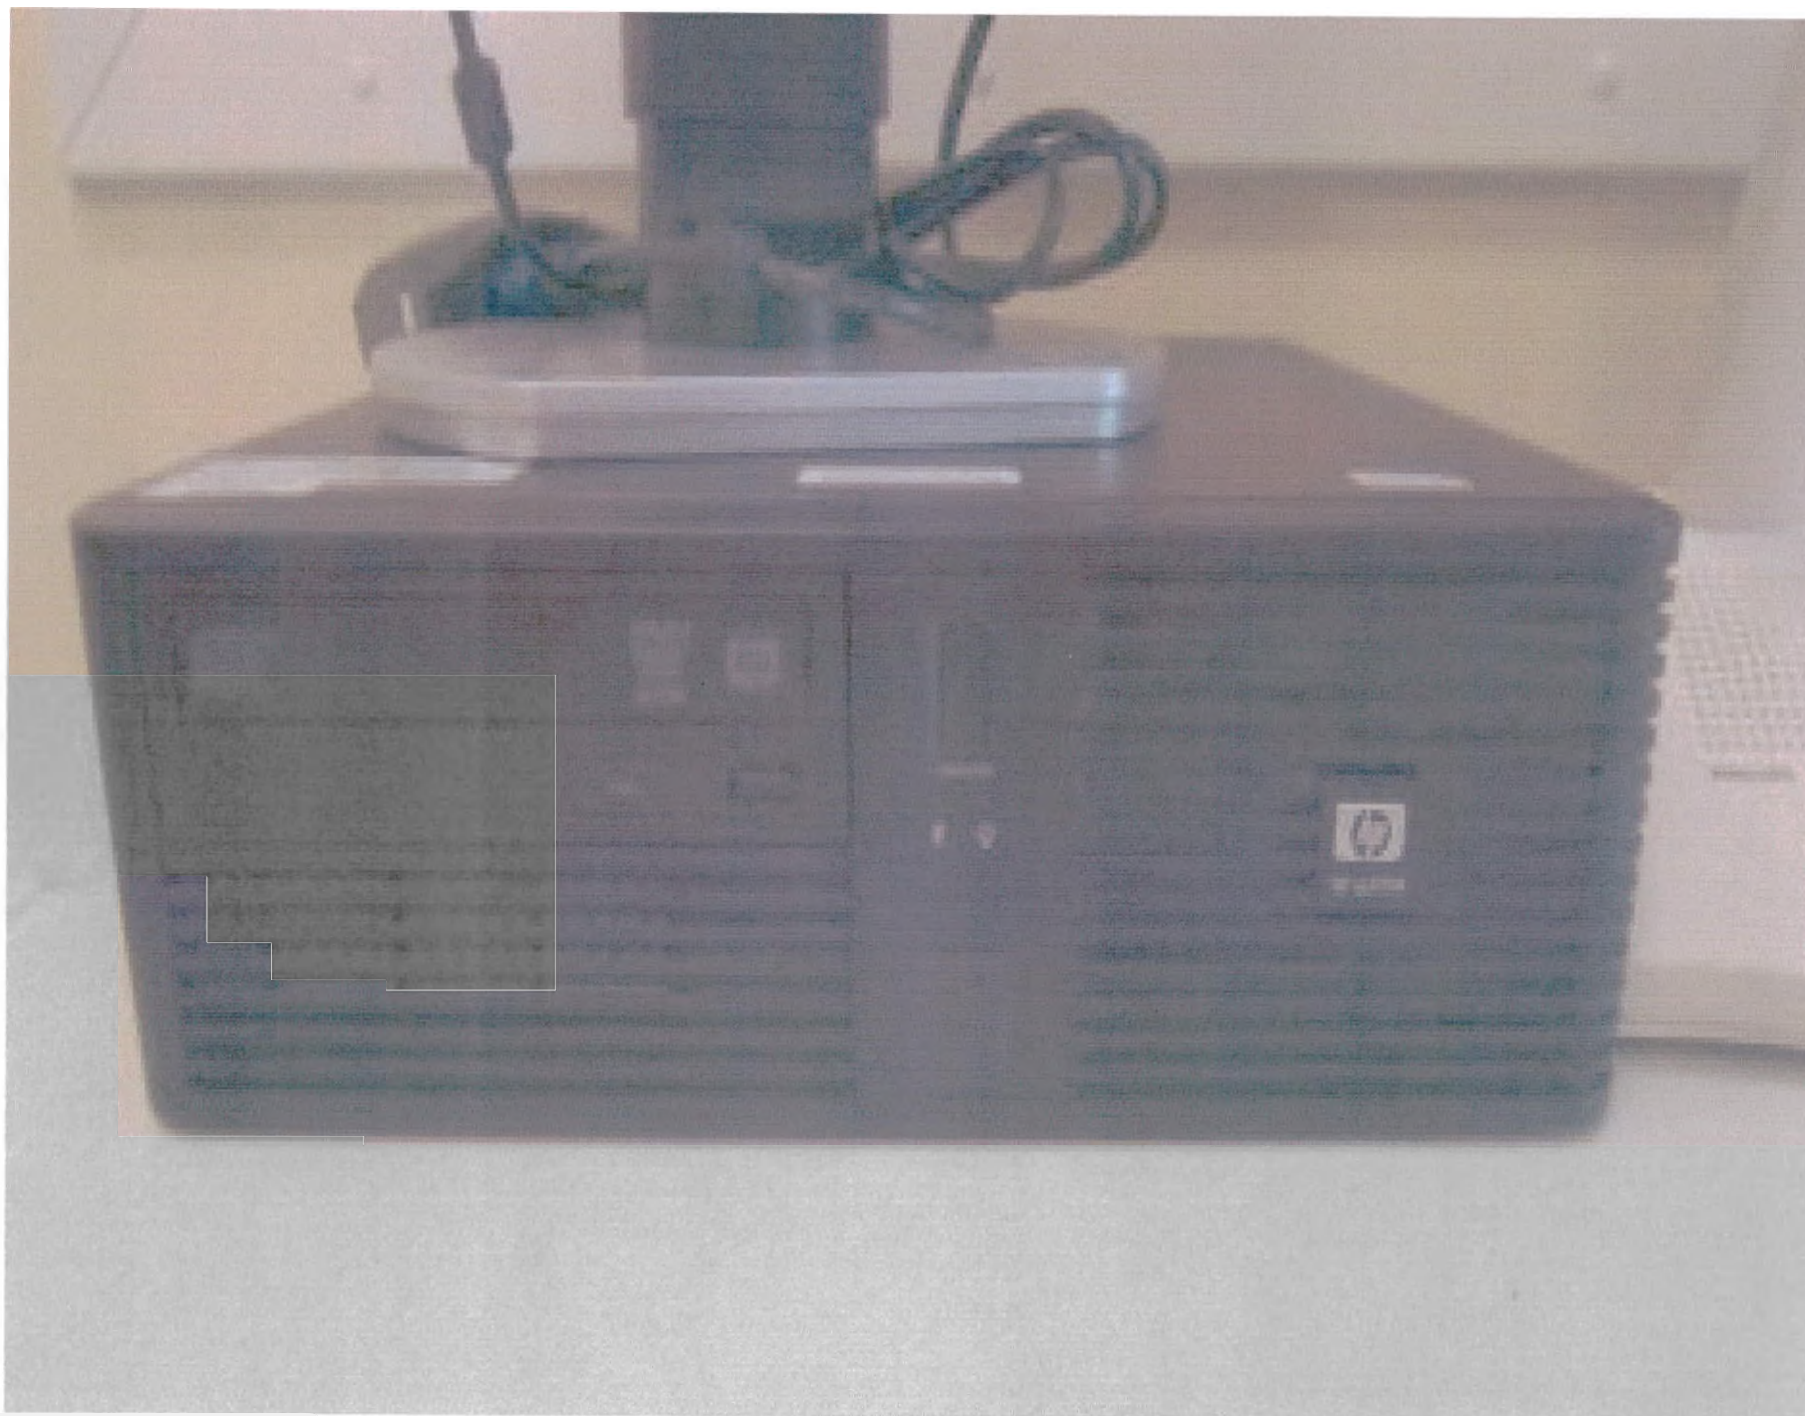

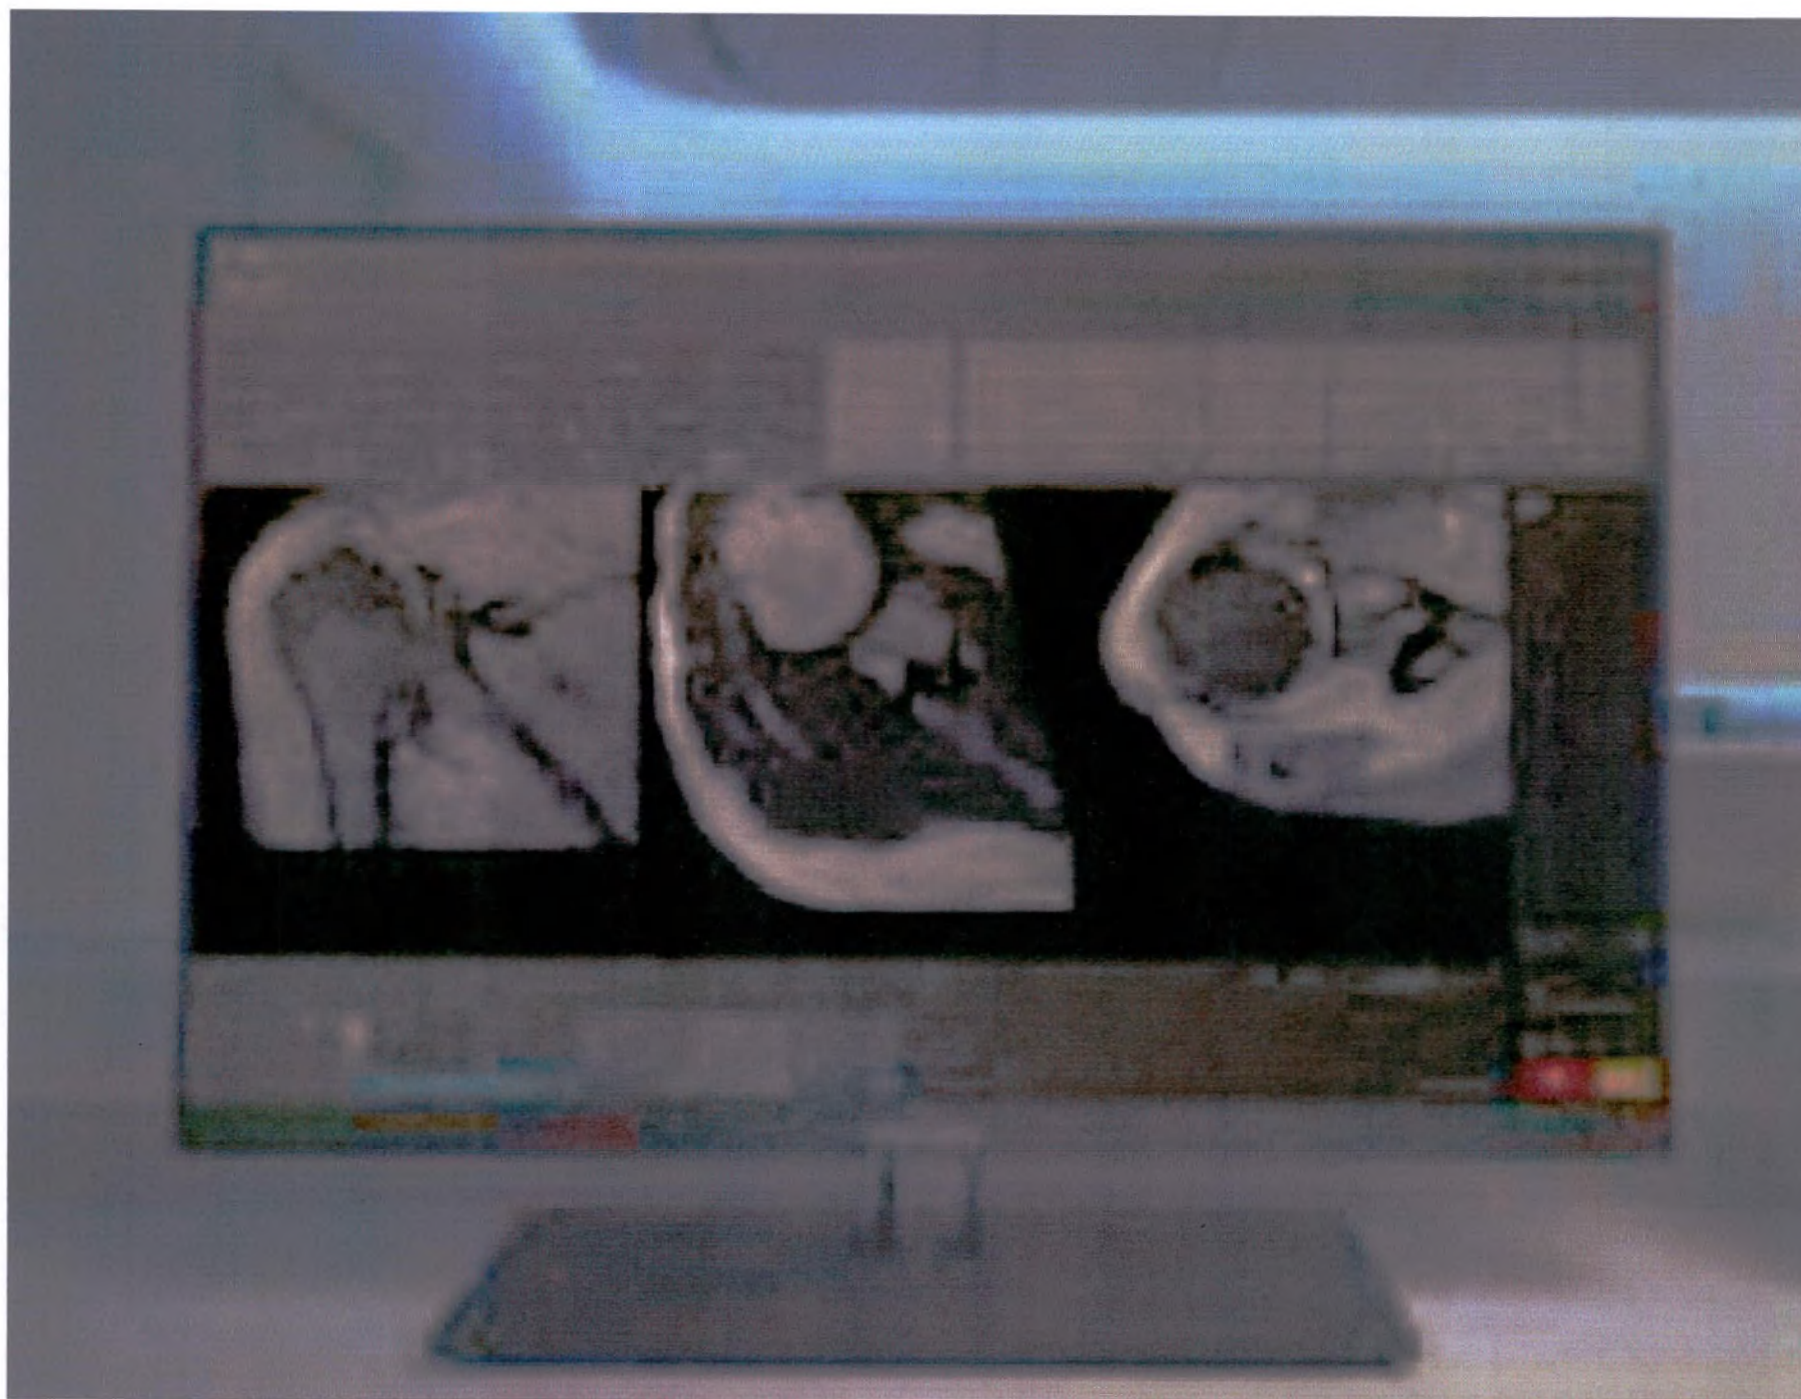

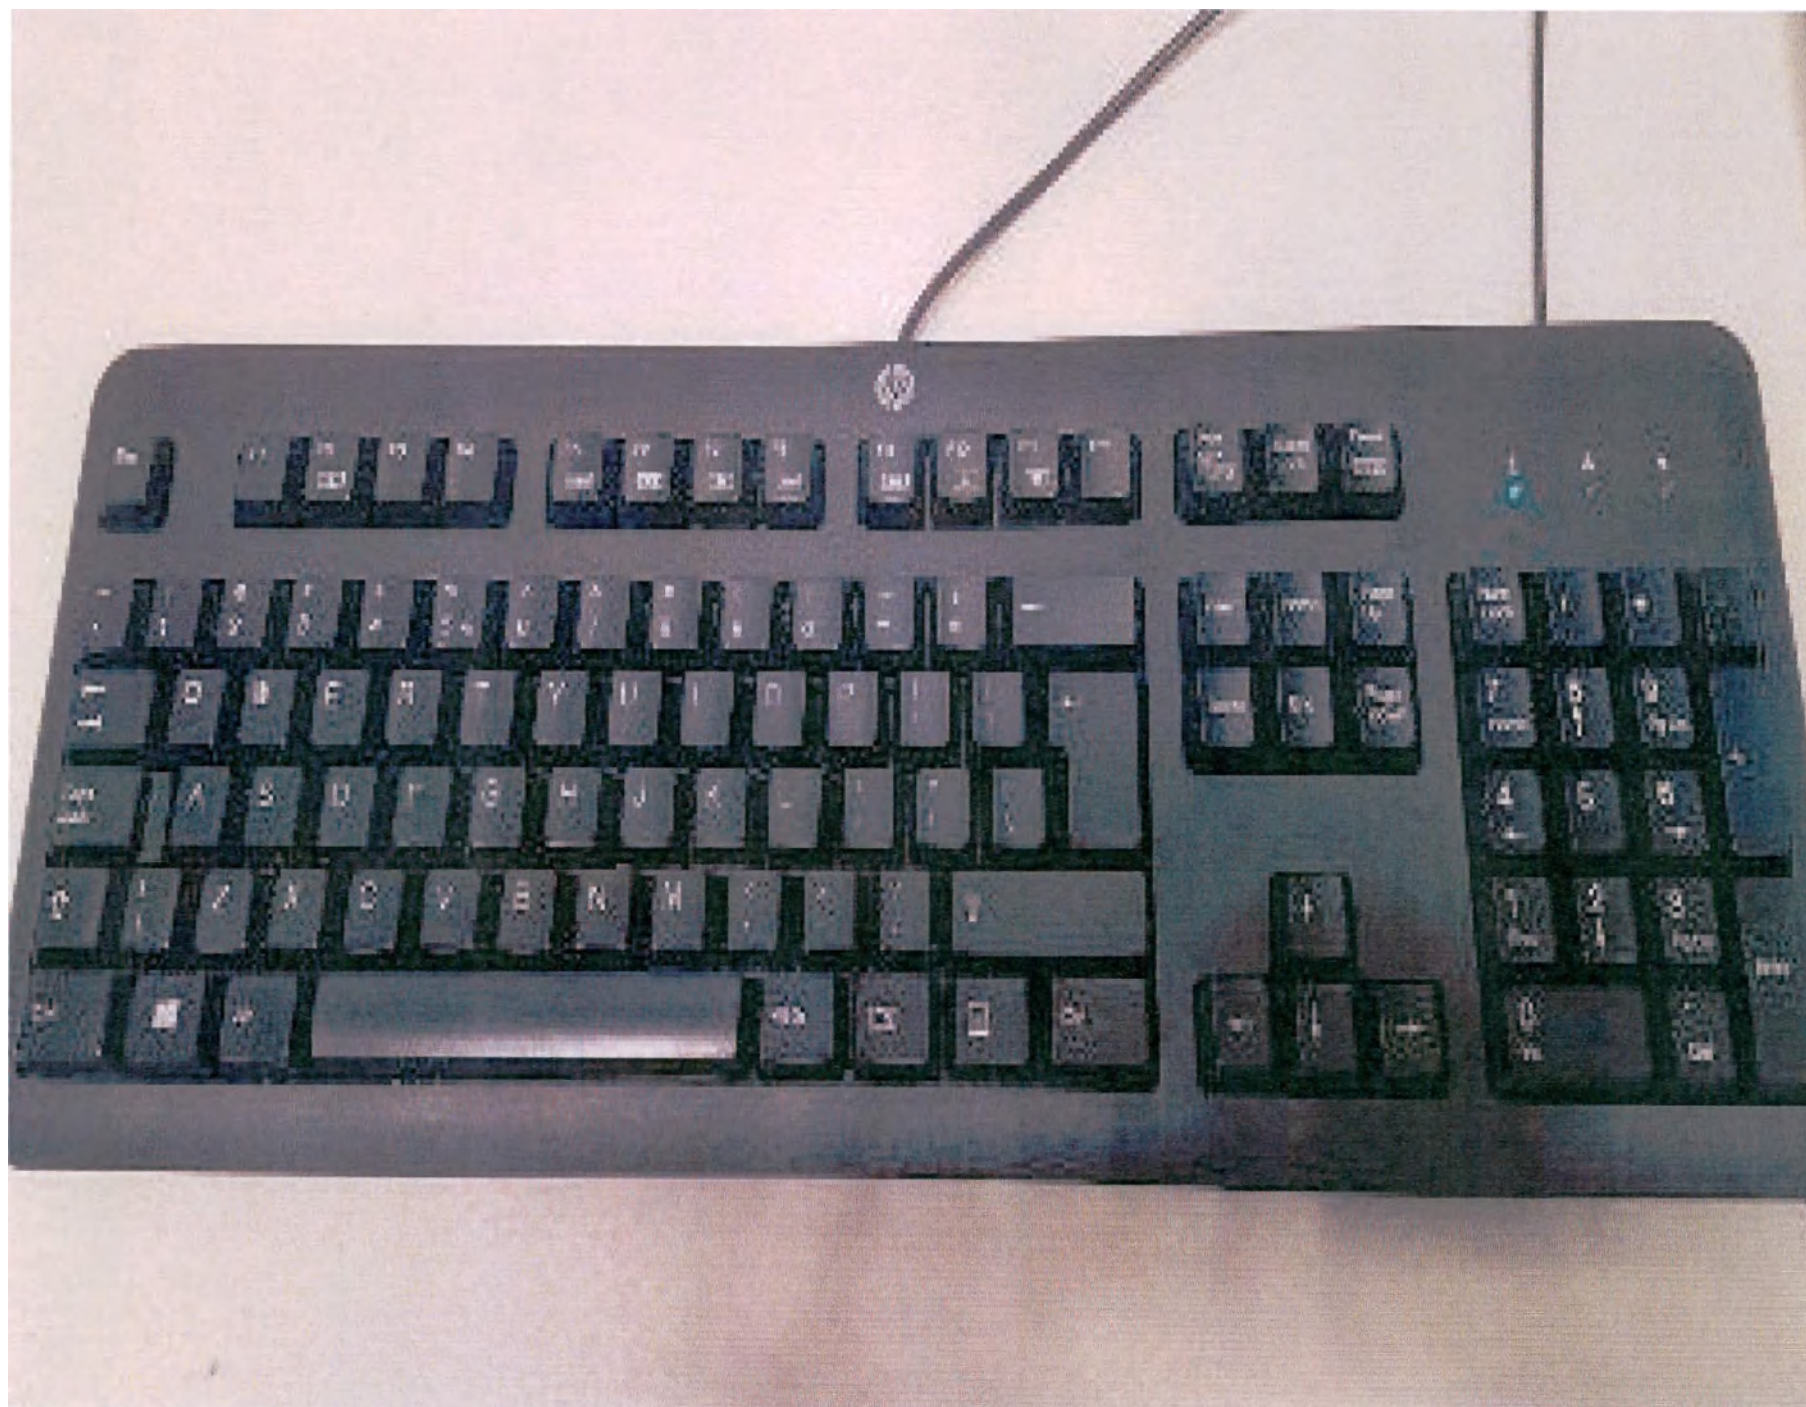




10.6. Мышь.




10.7. Система связи «оператор-пациент».


11. Средства позиционирования пациента.

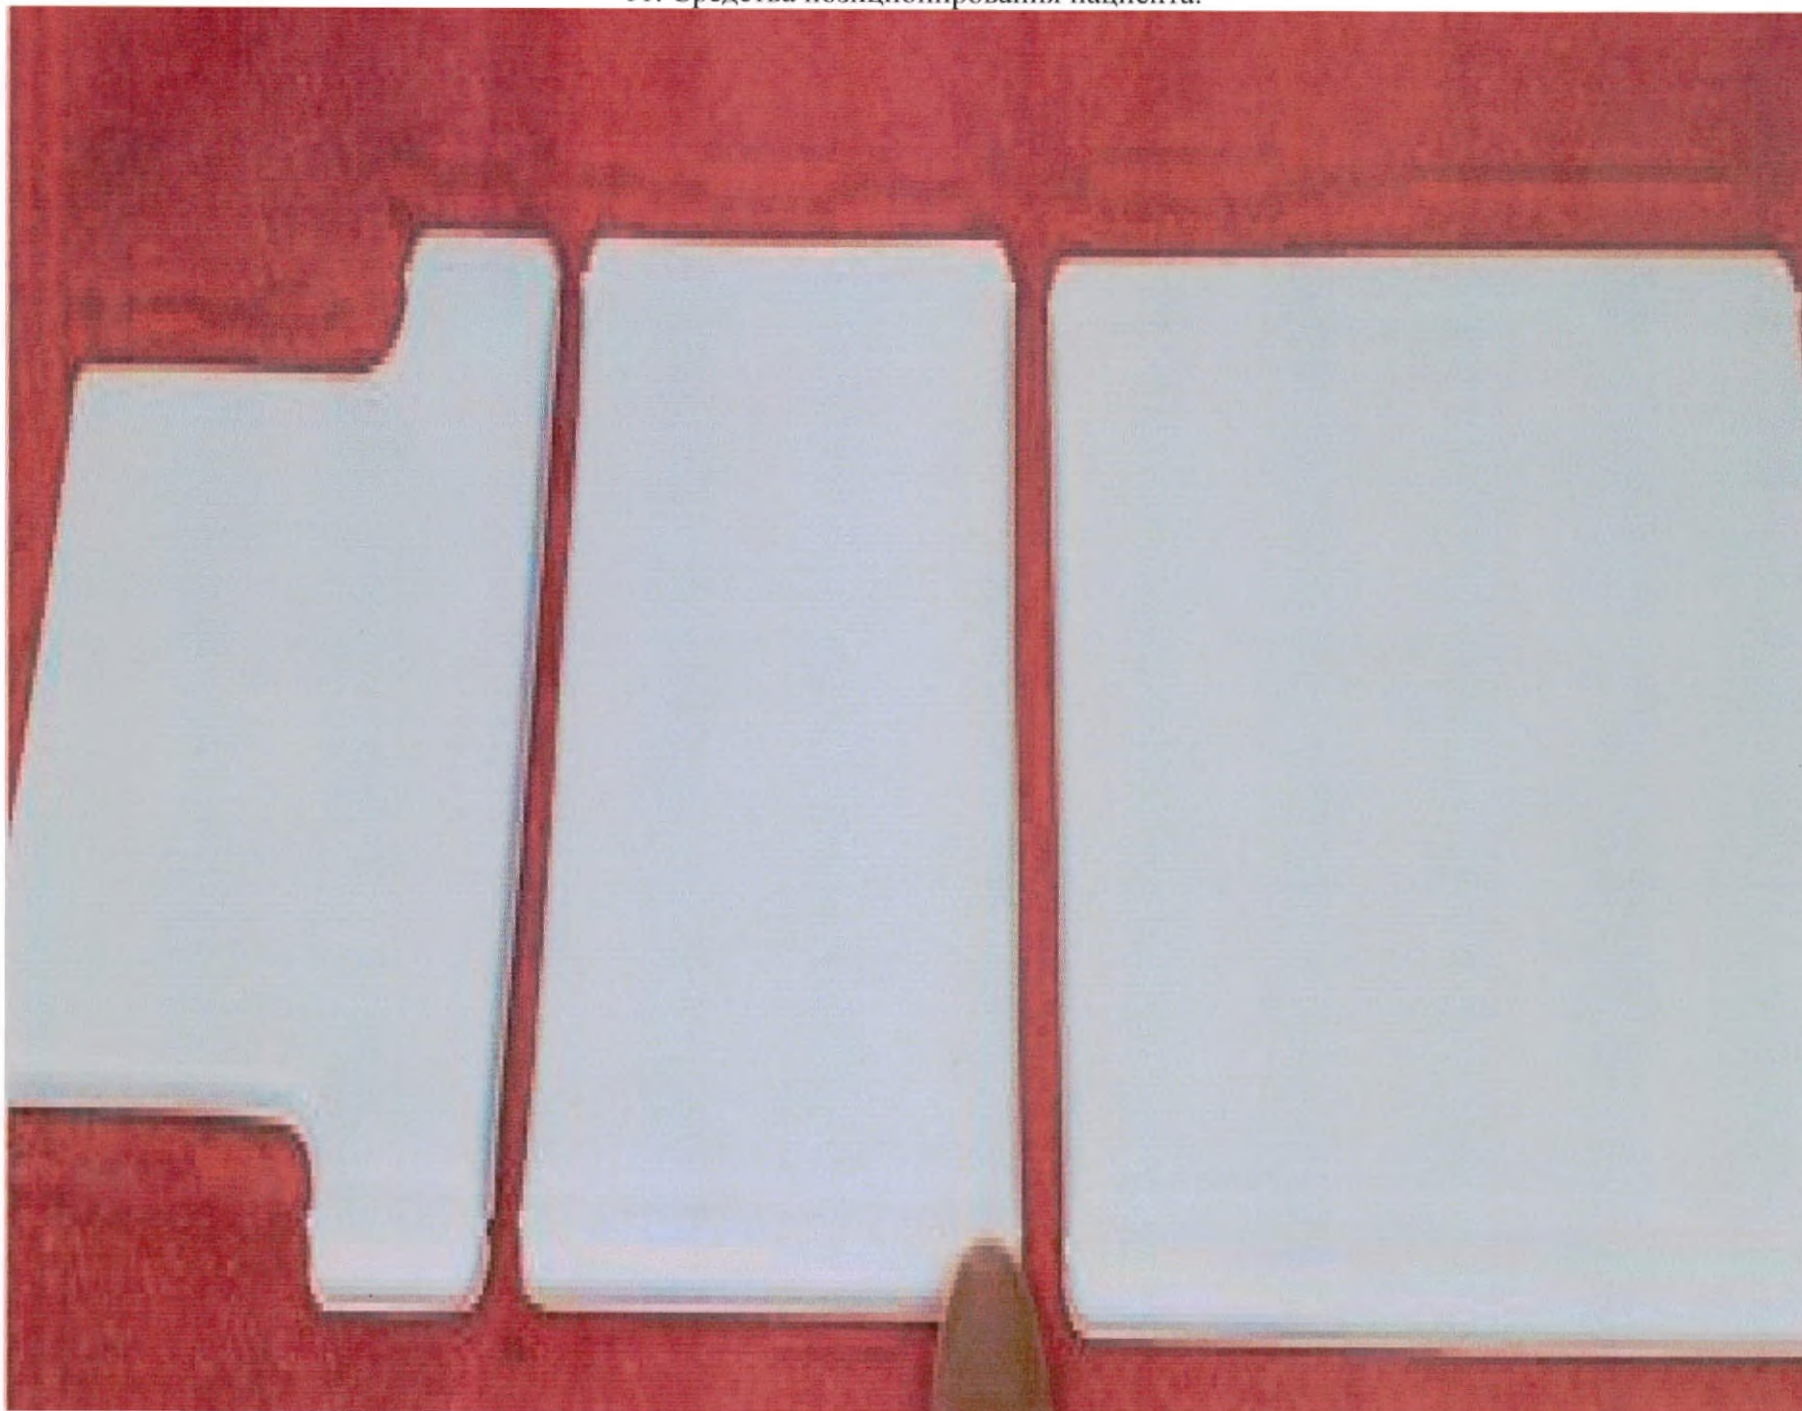






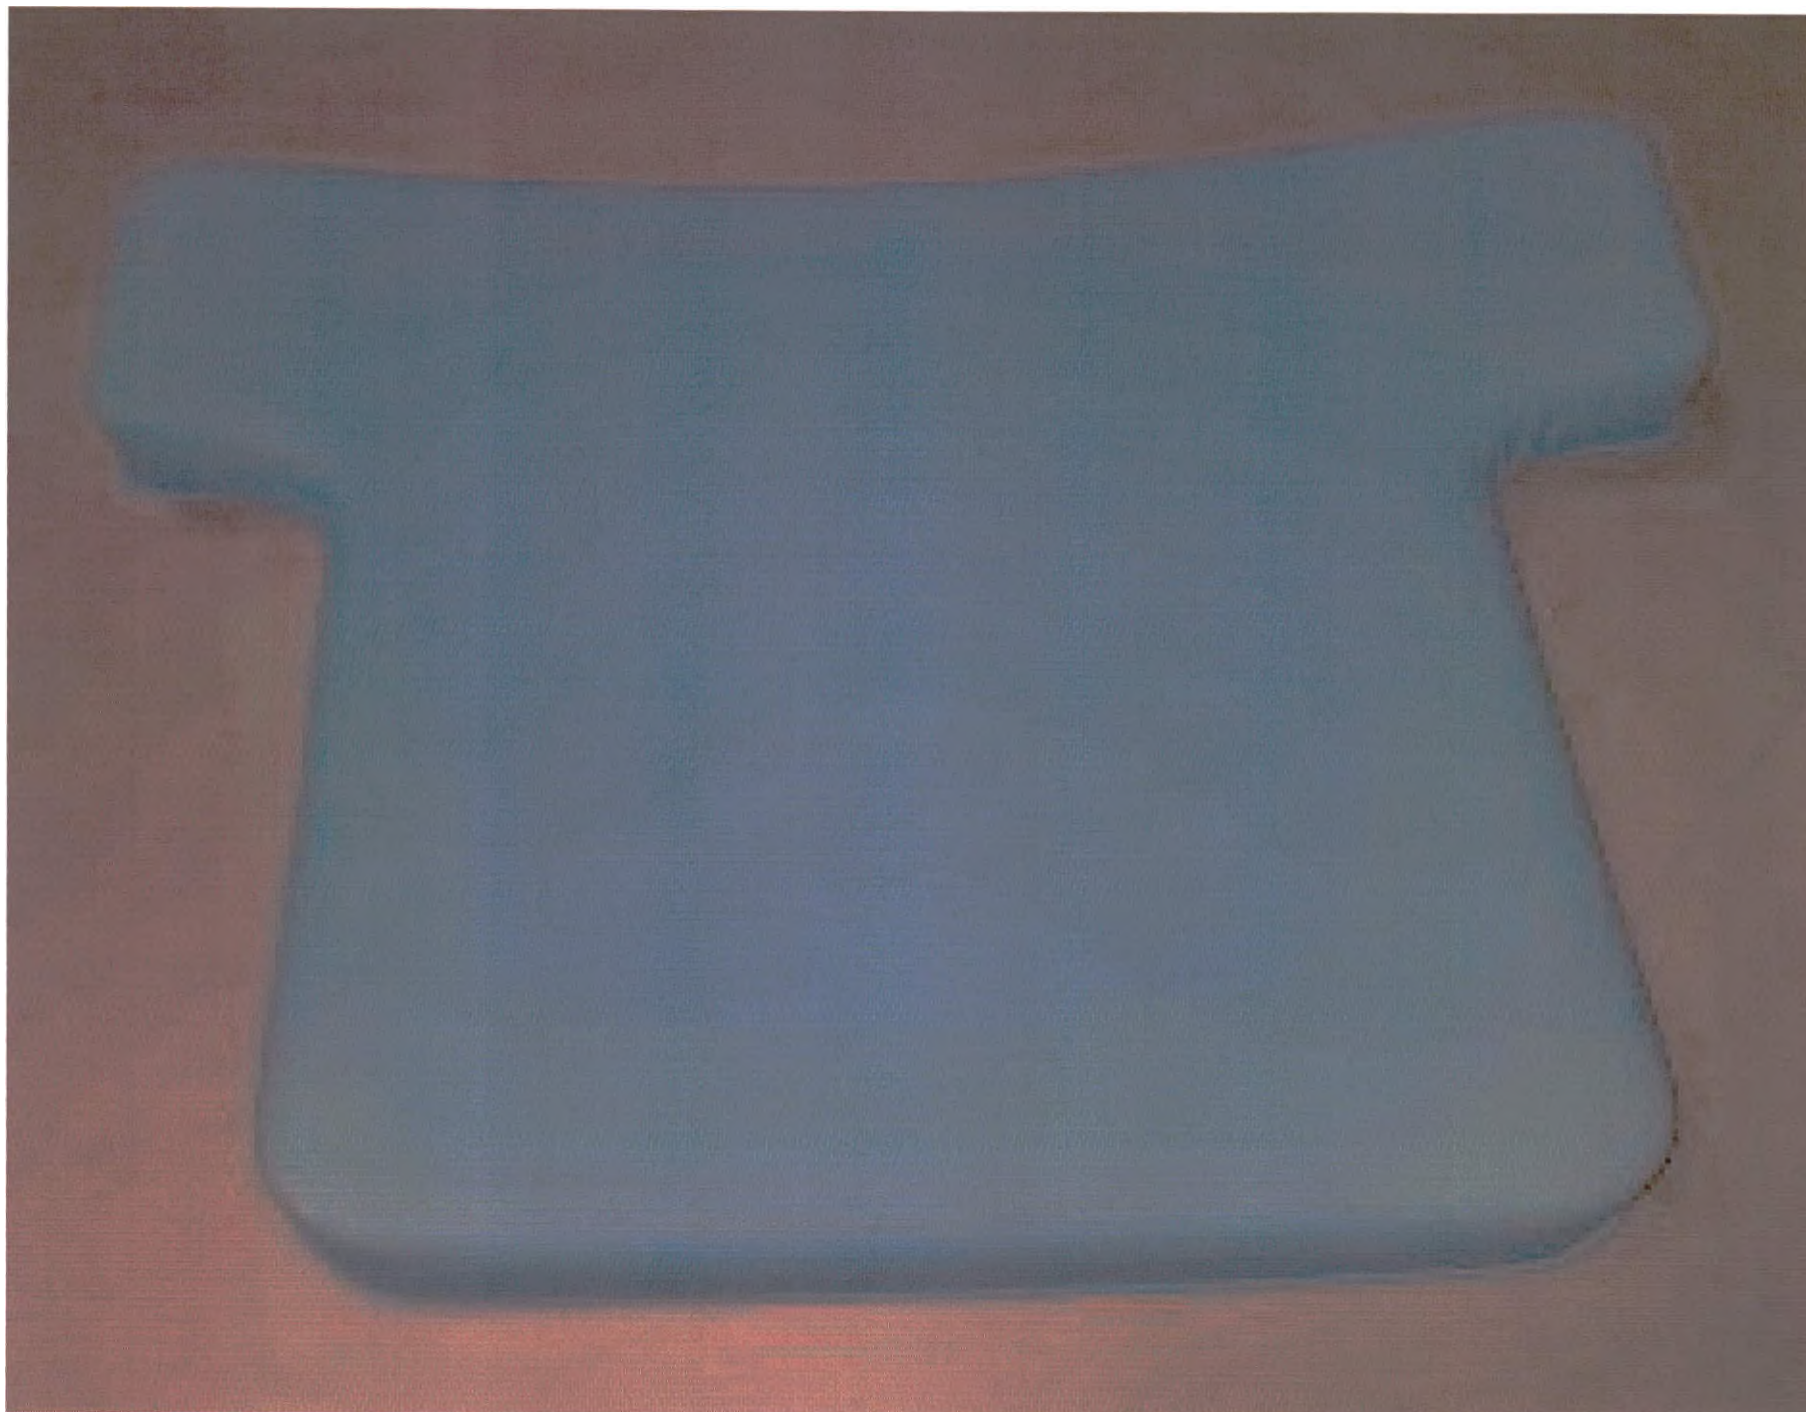


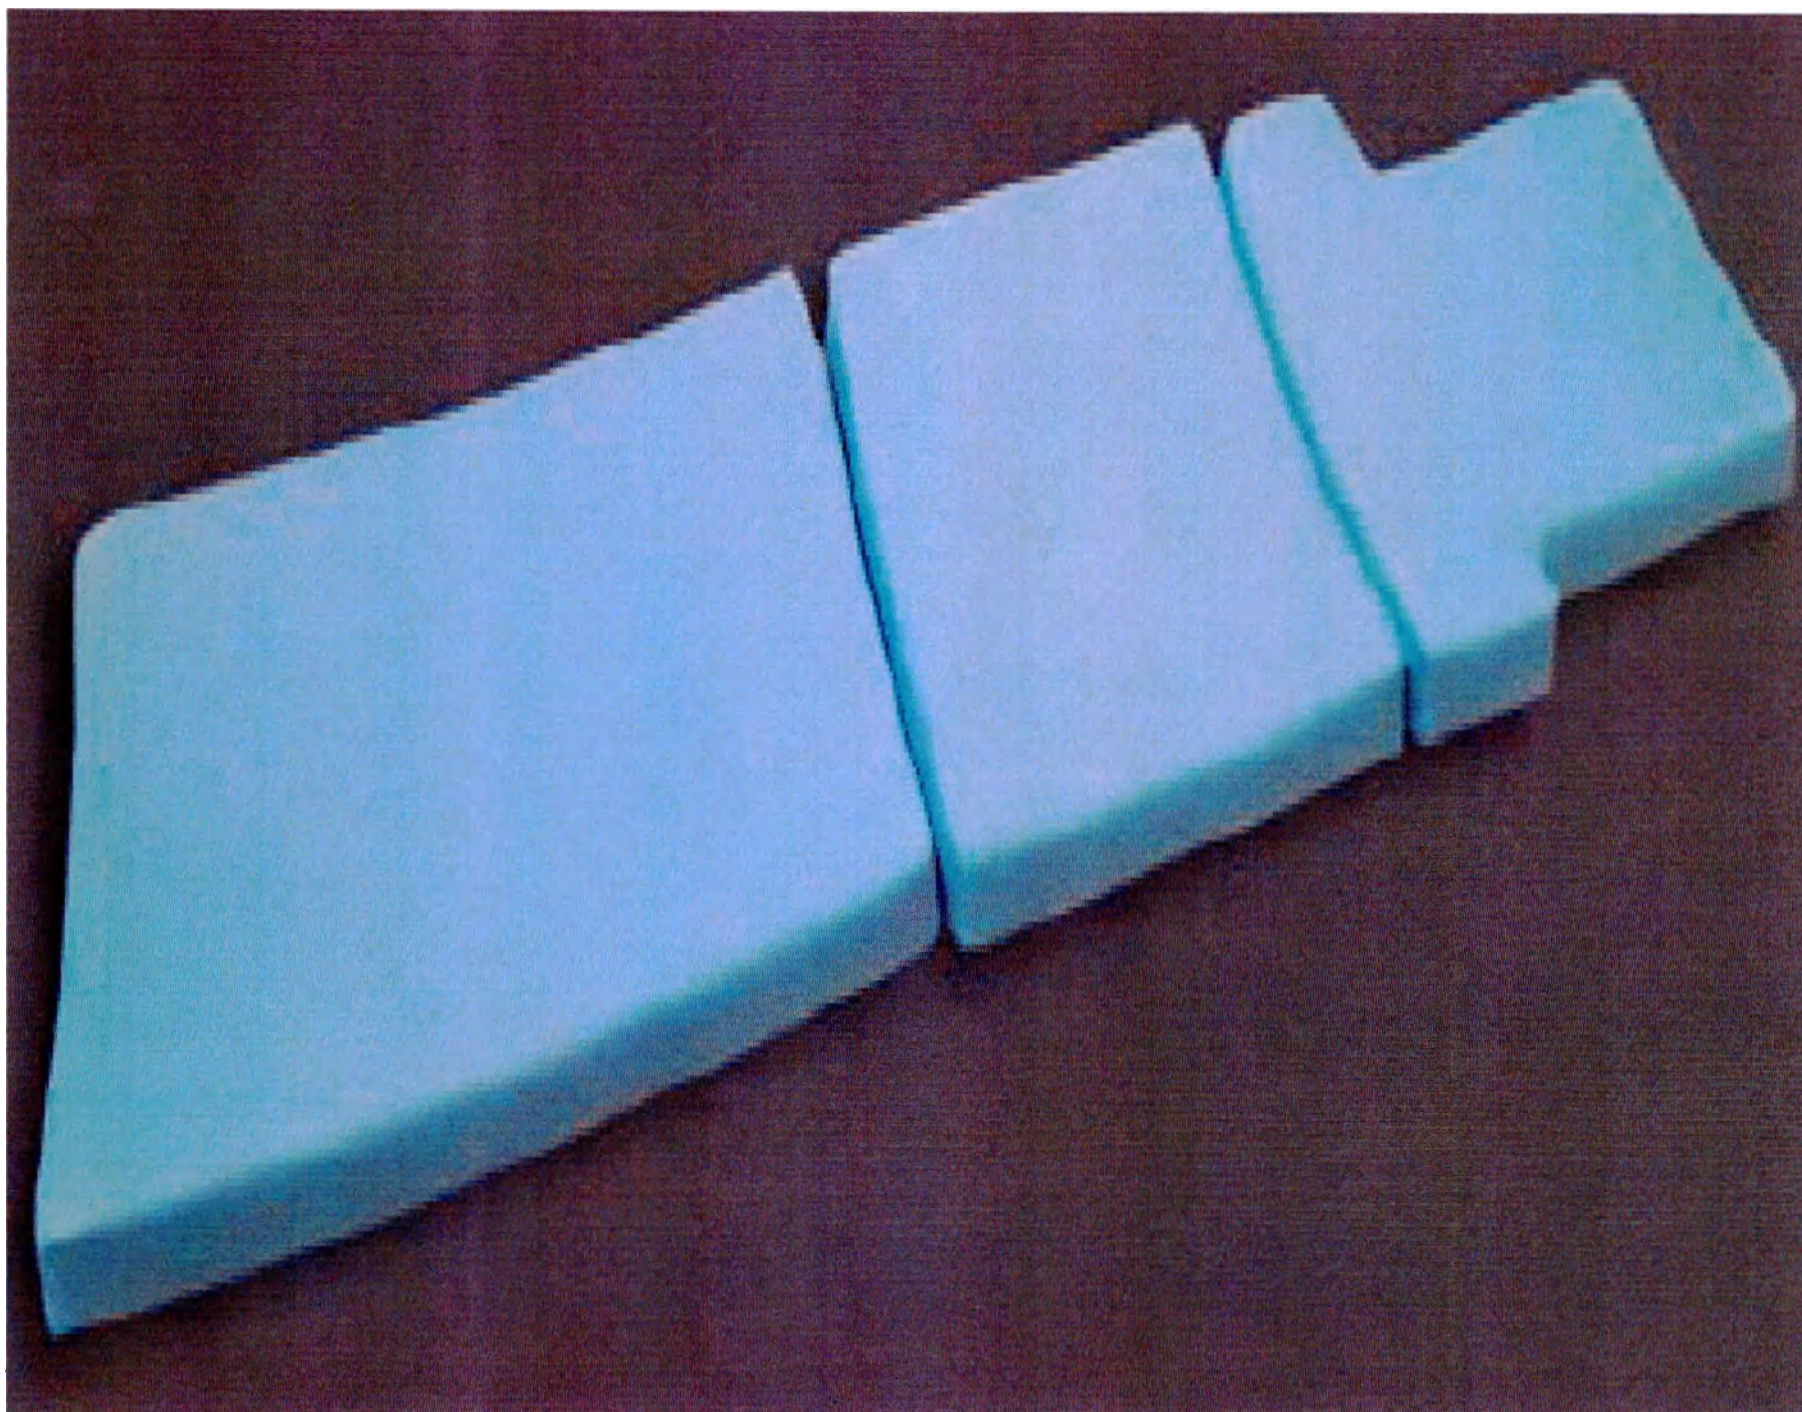





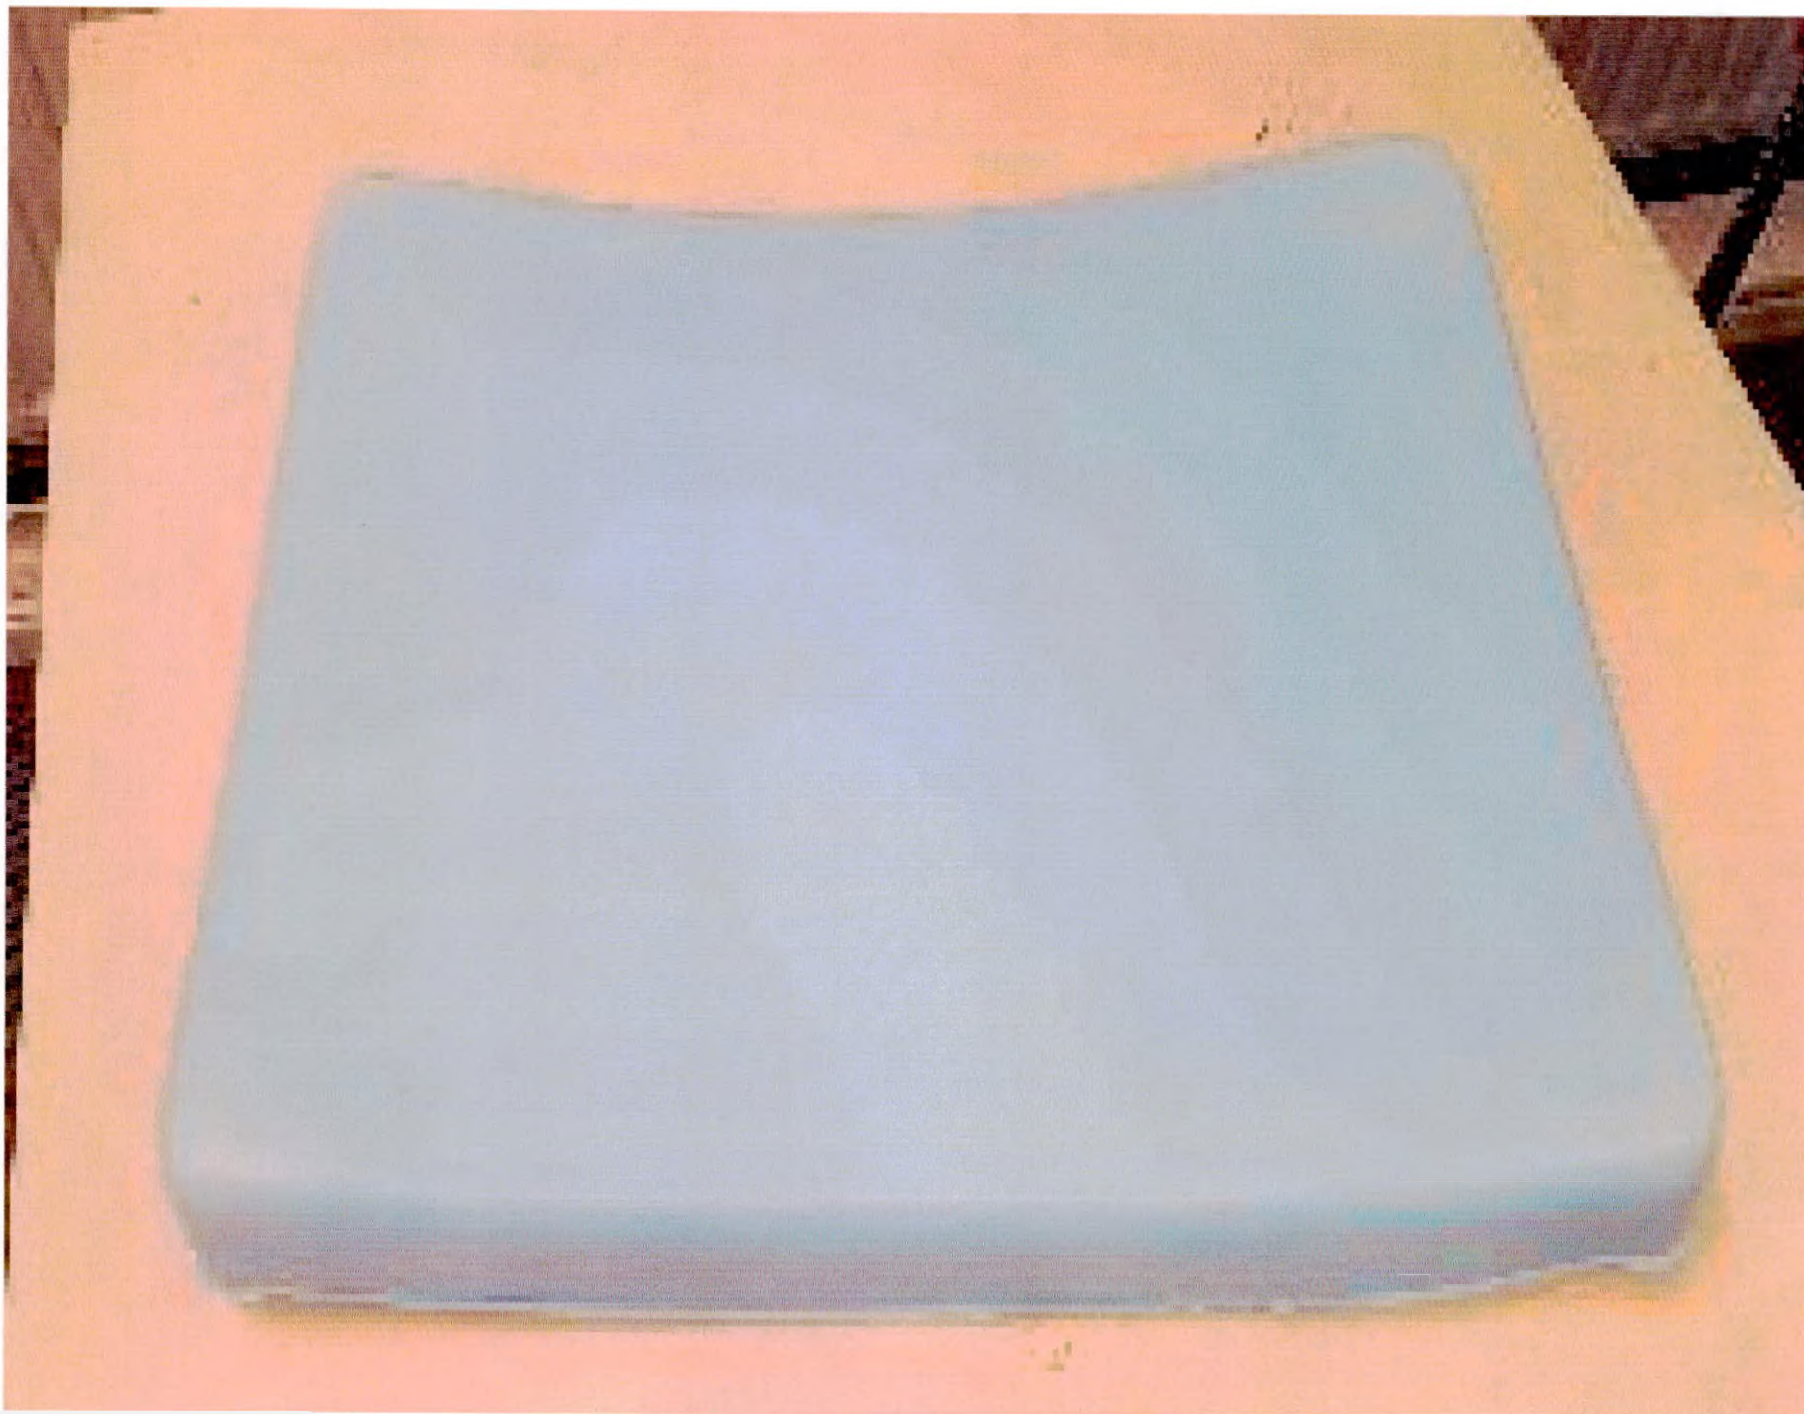




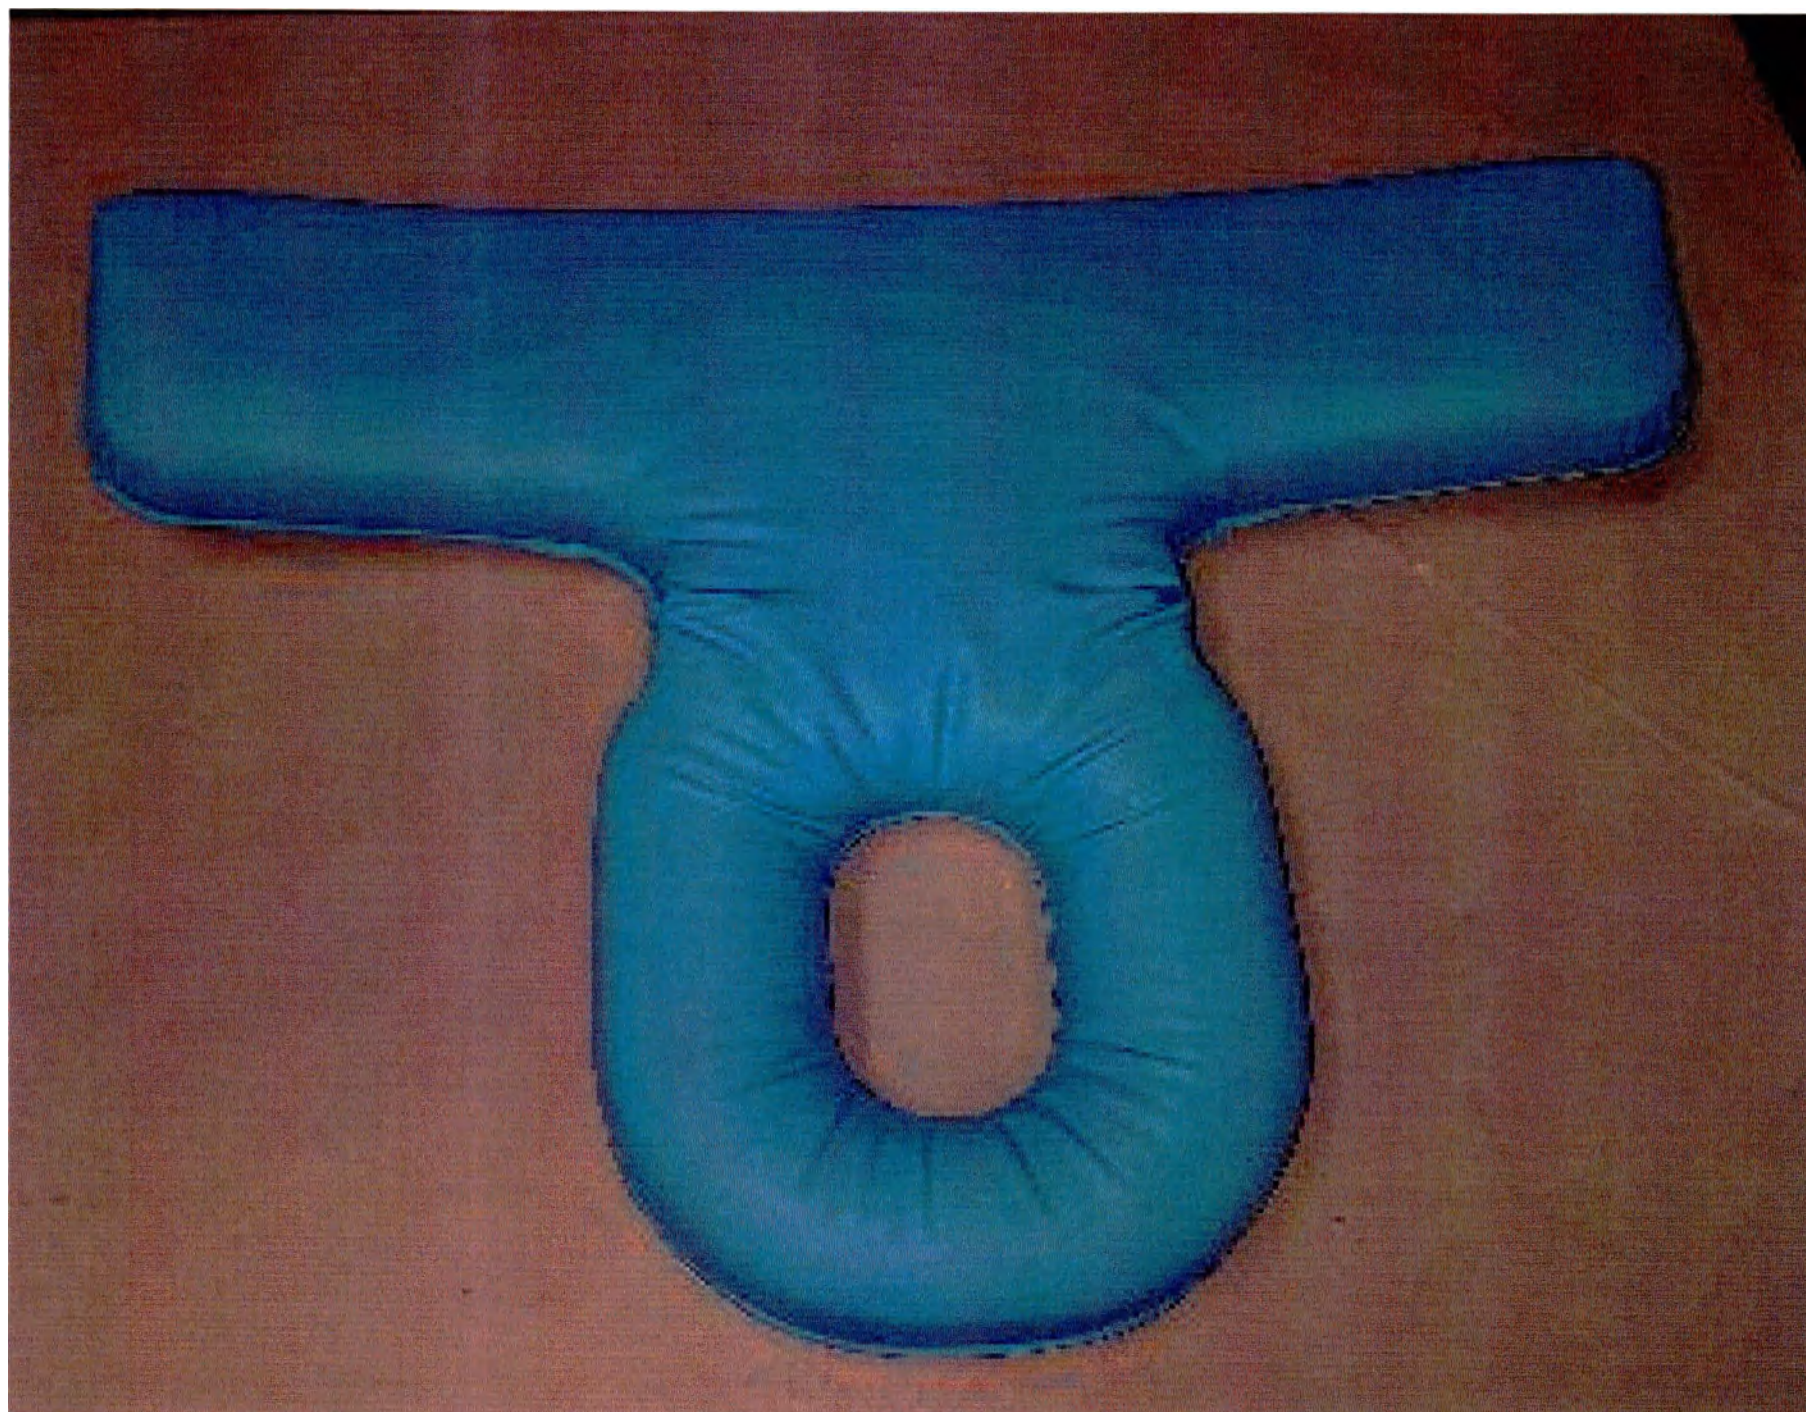

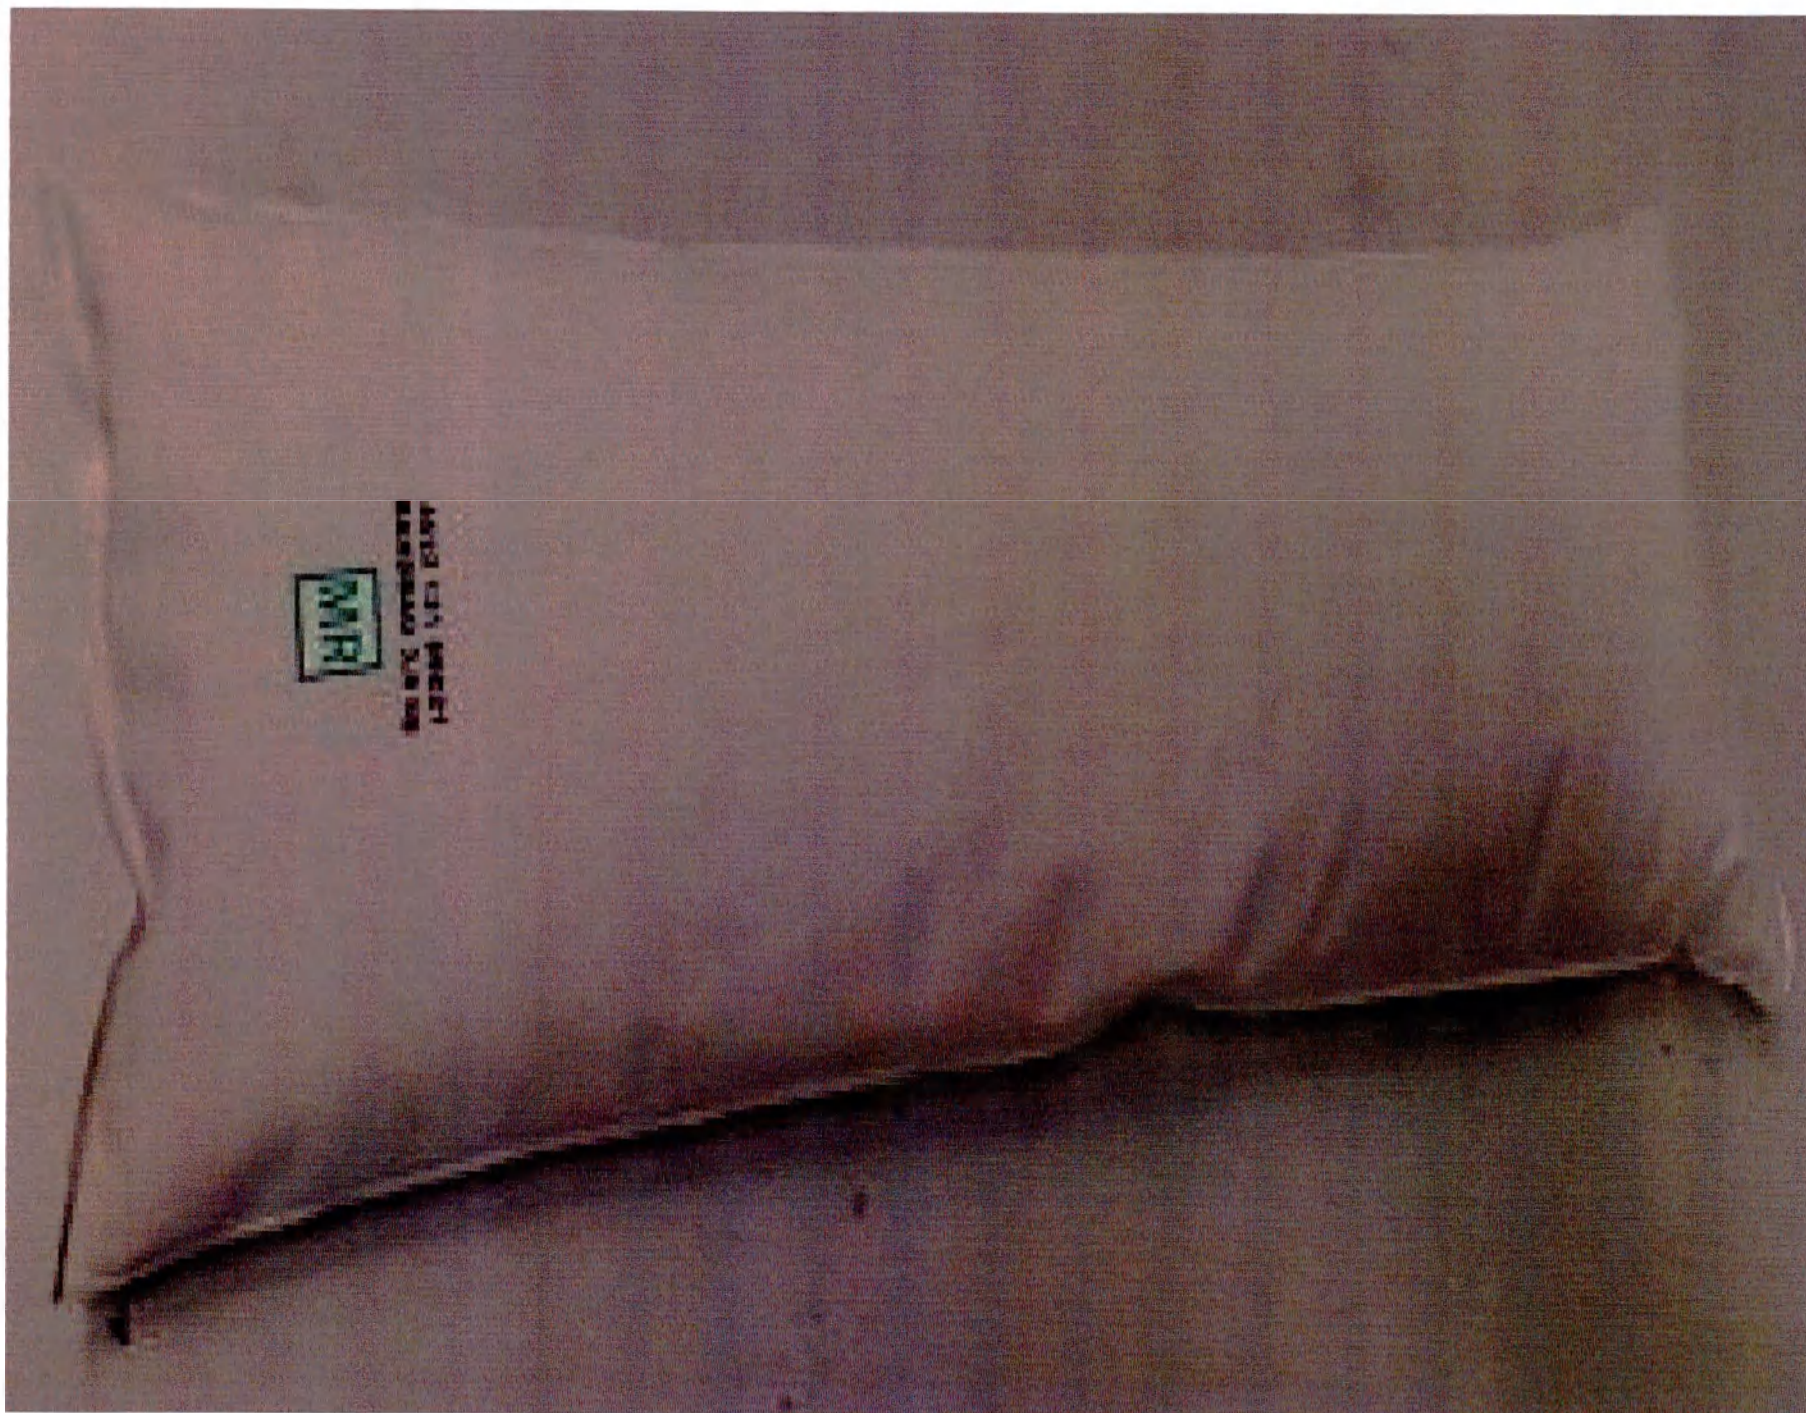


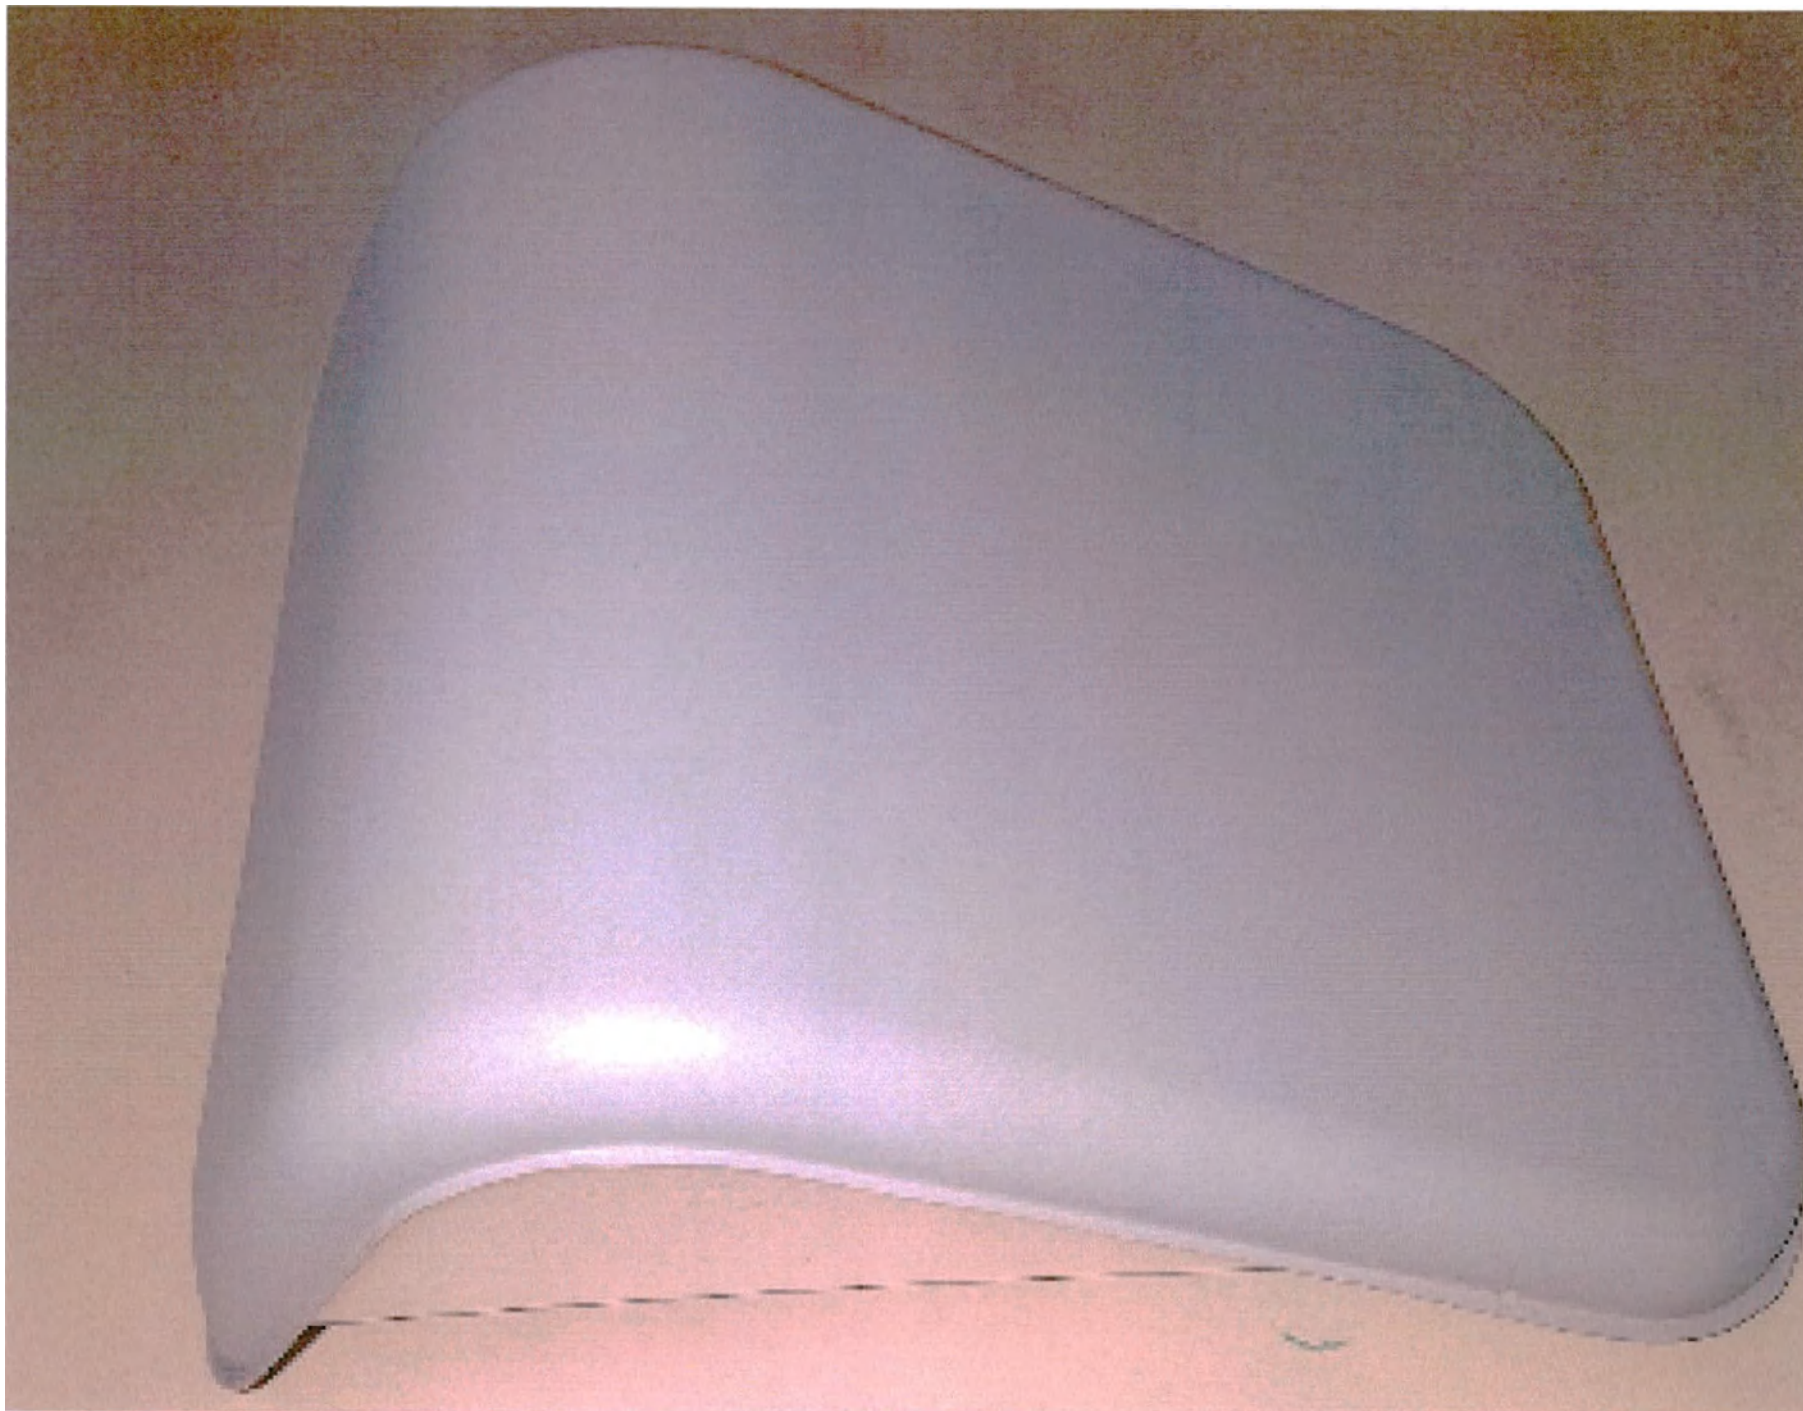





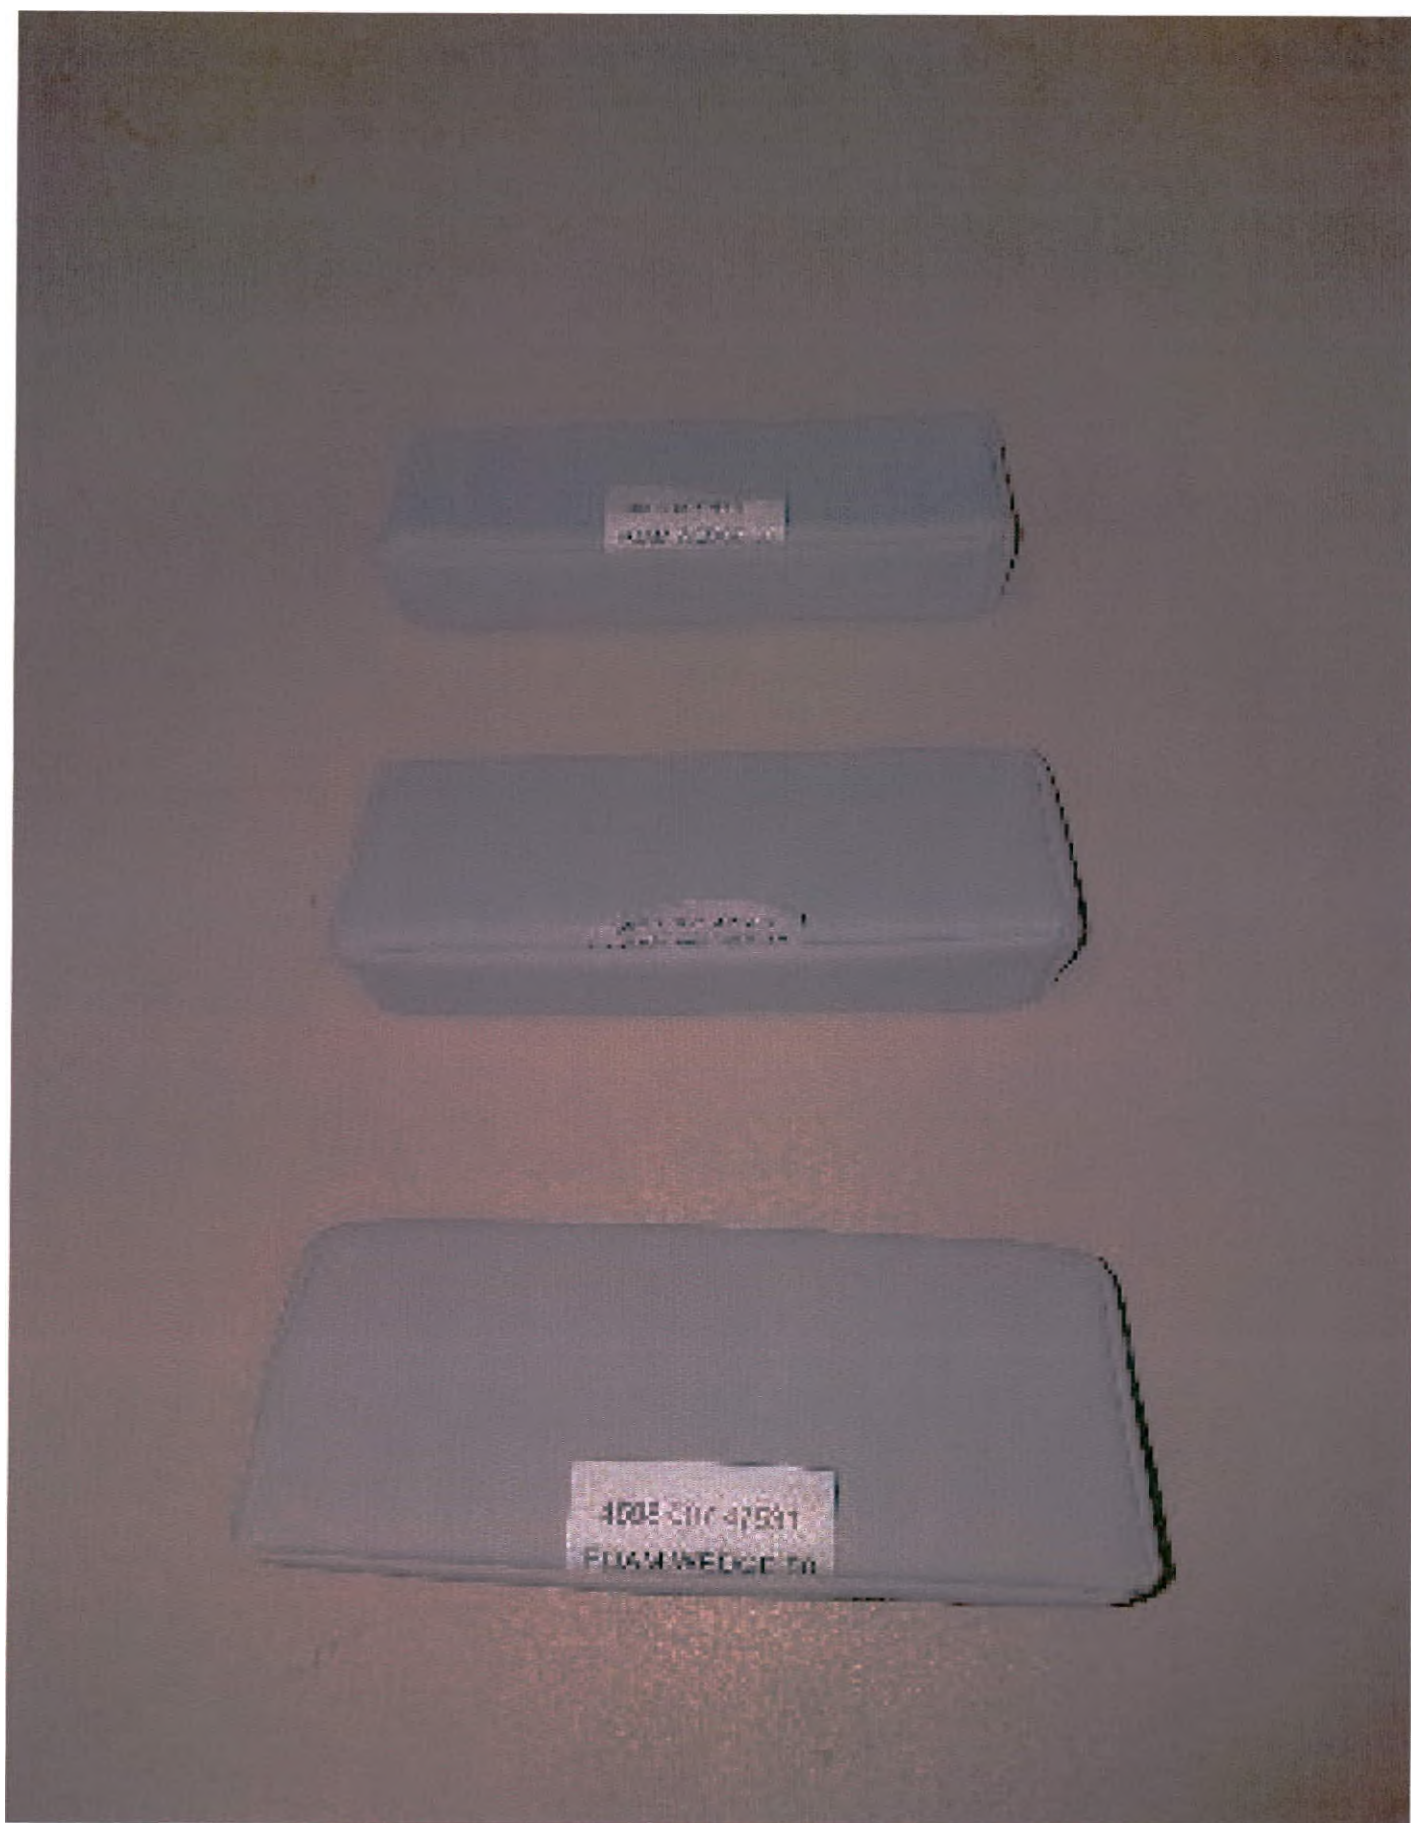

11.7. Клинья из пеноматериала.

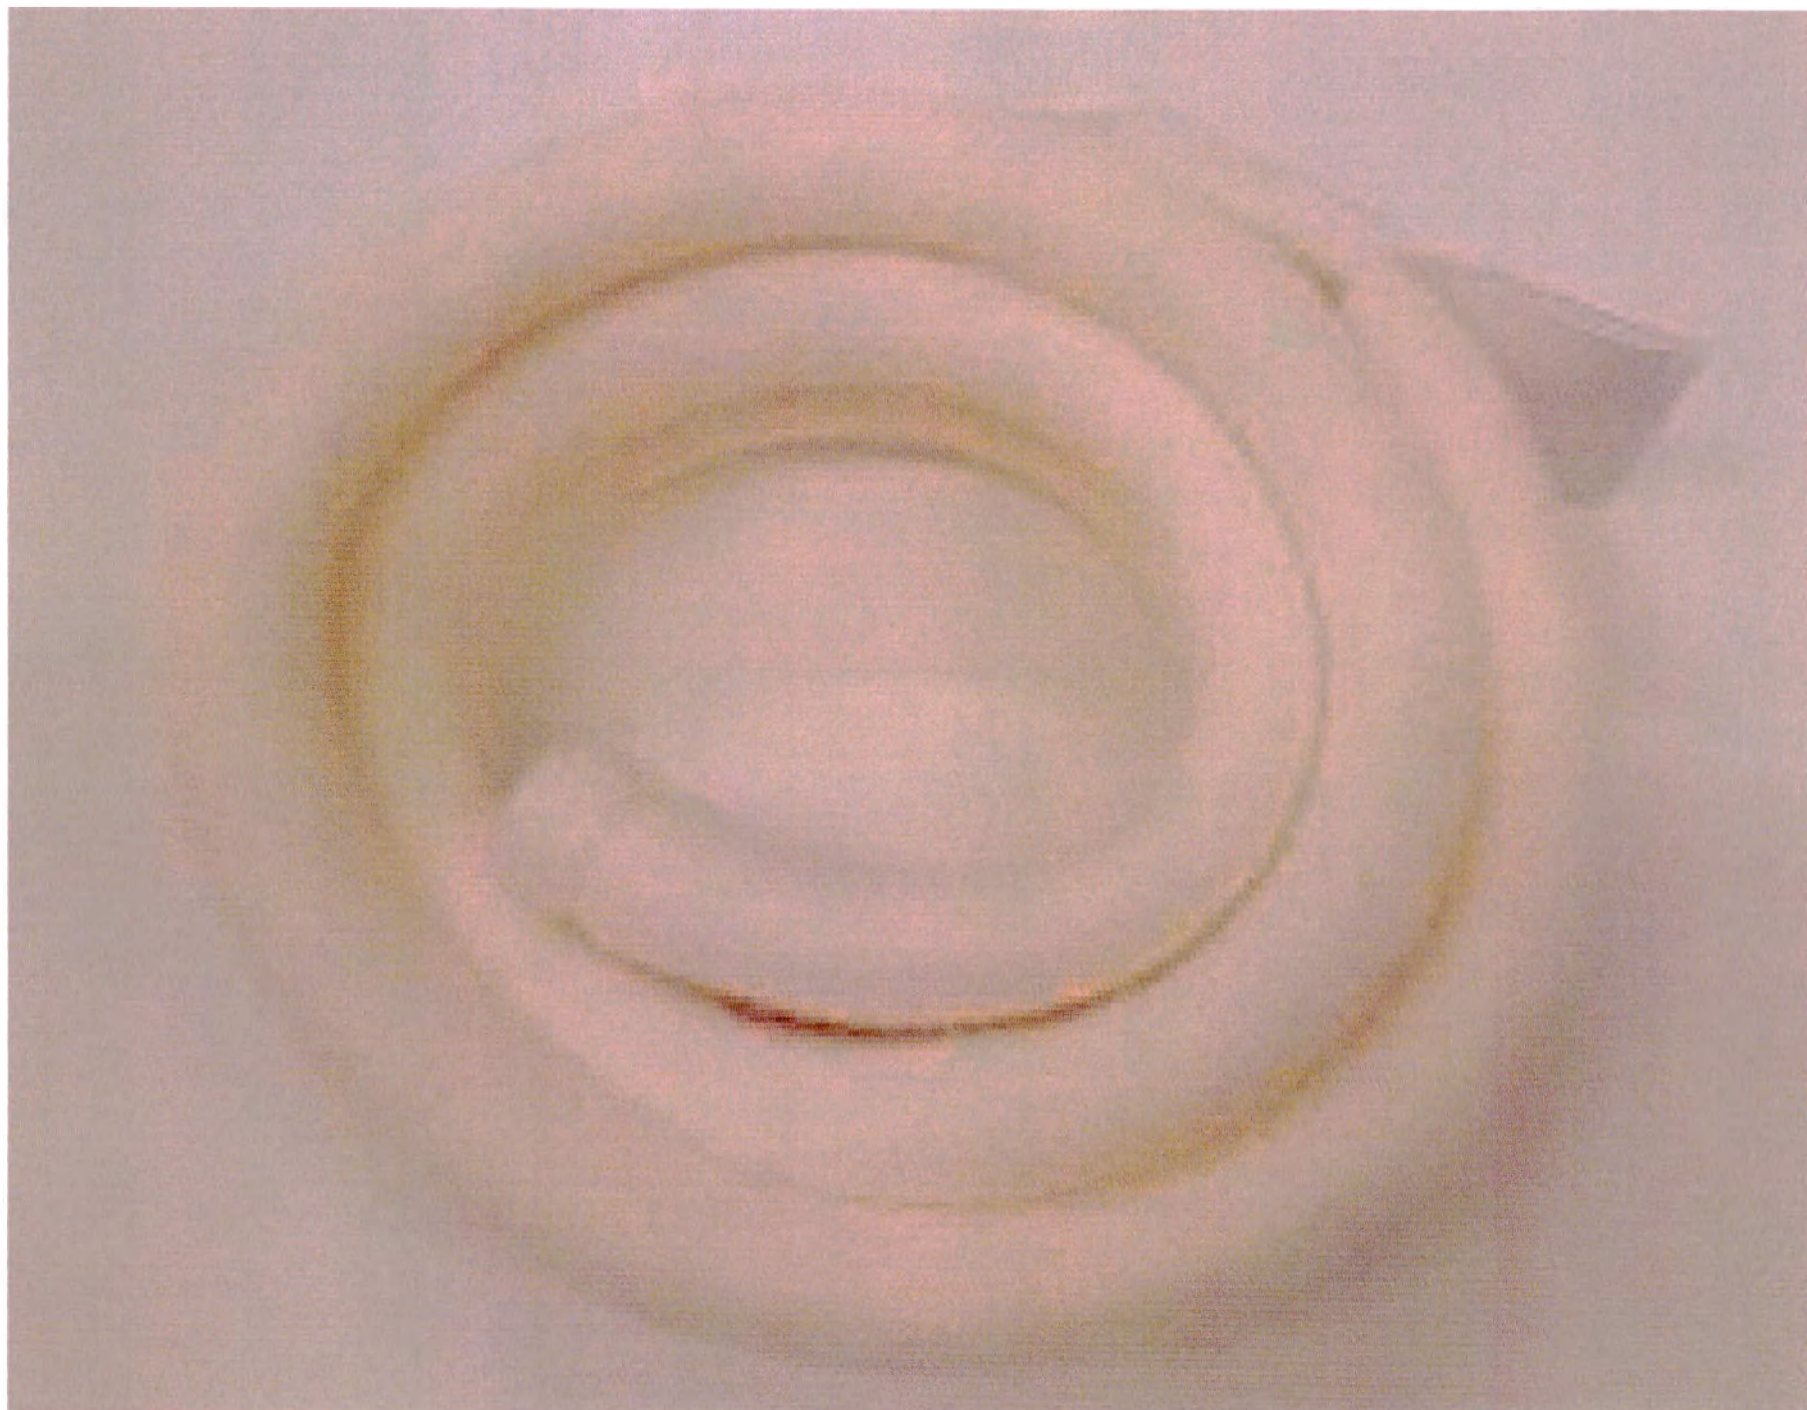

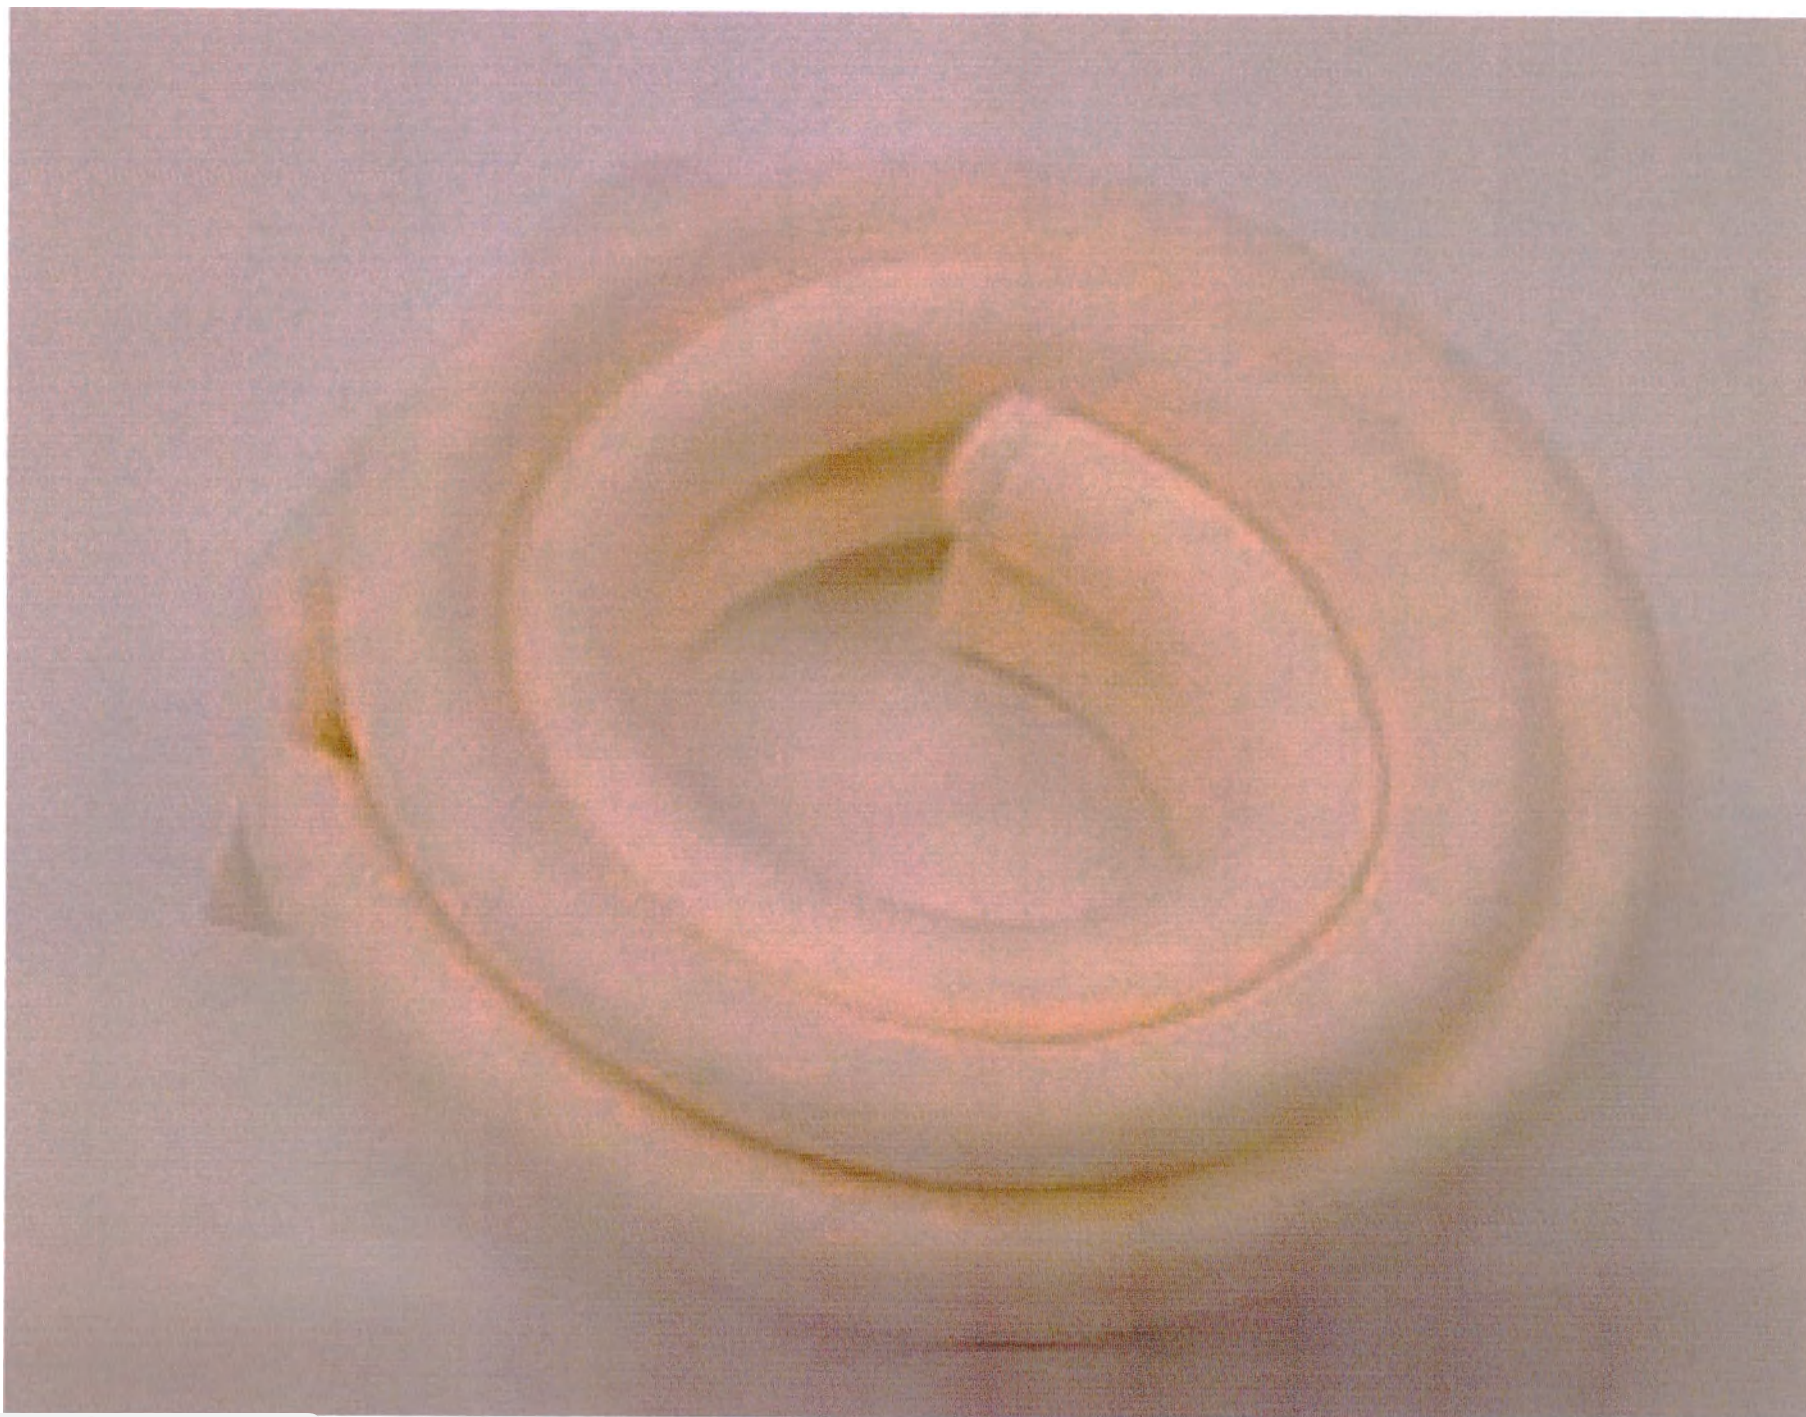

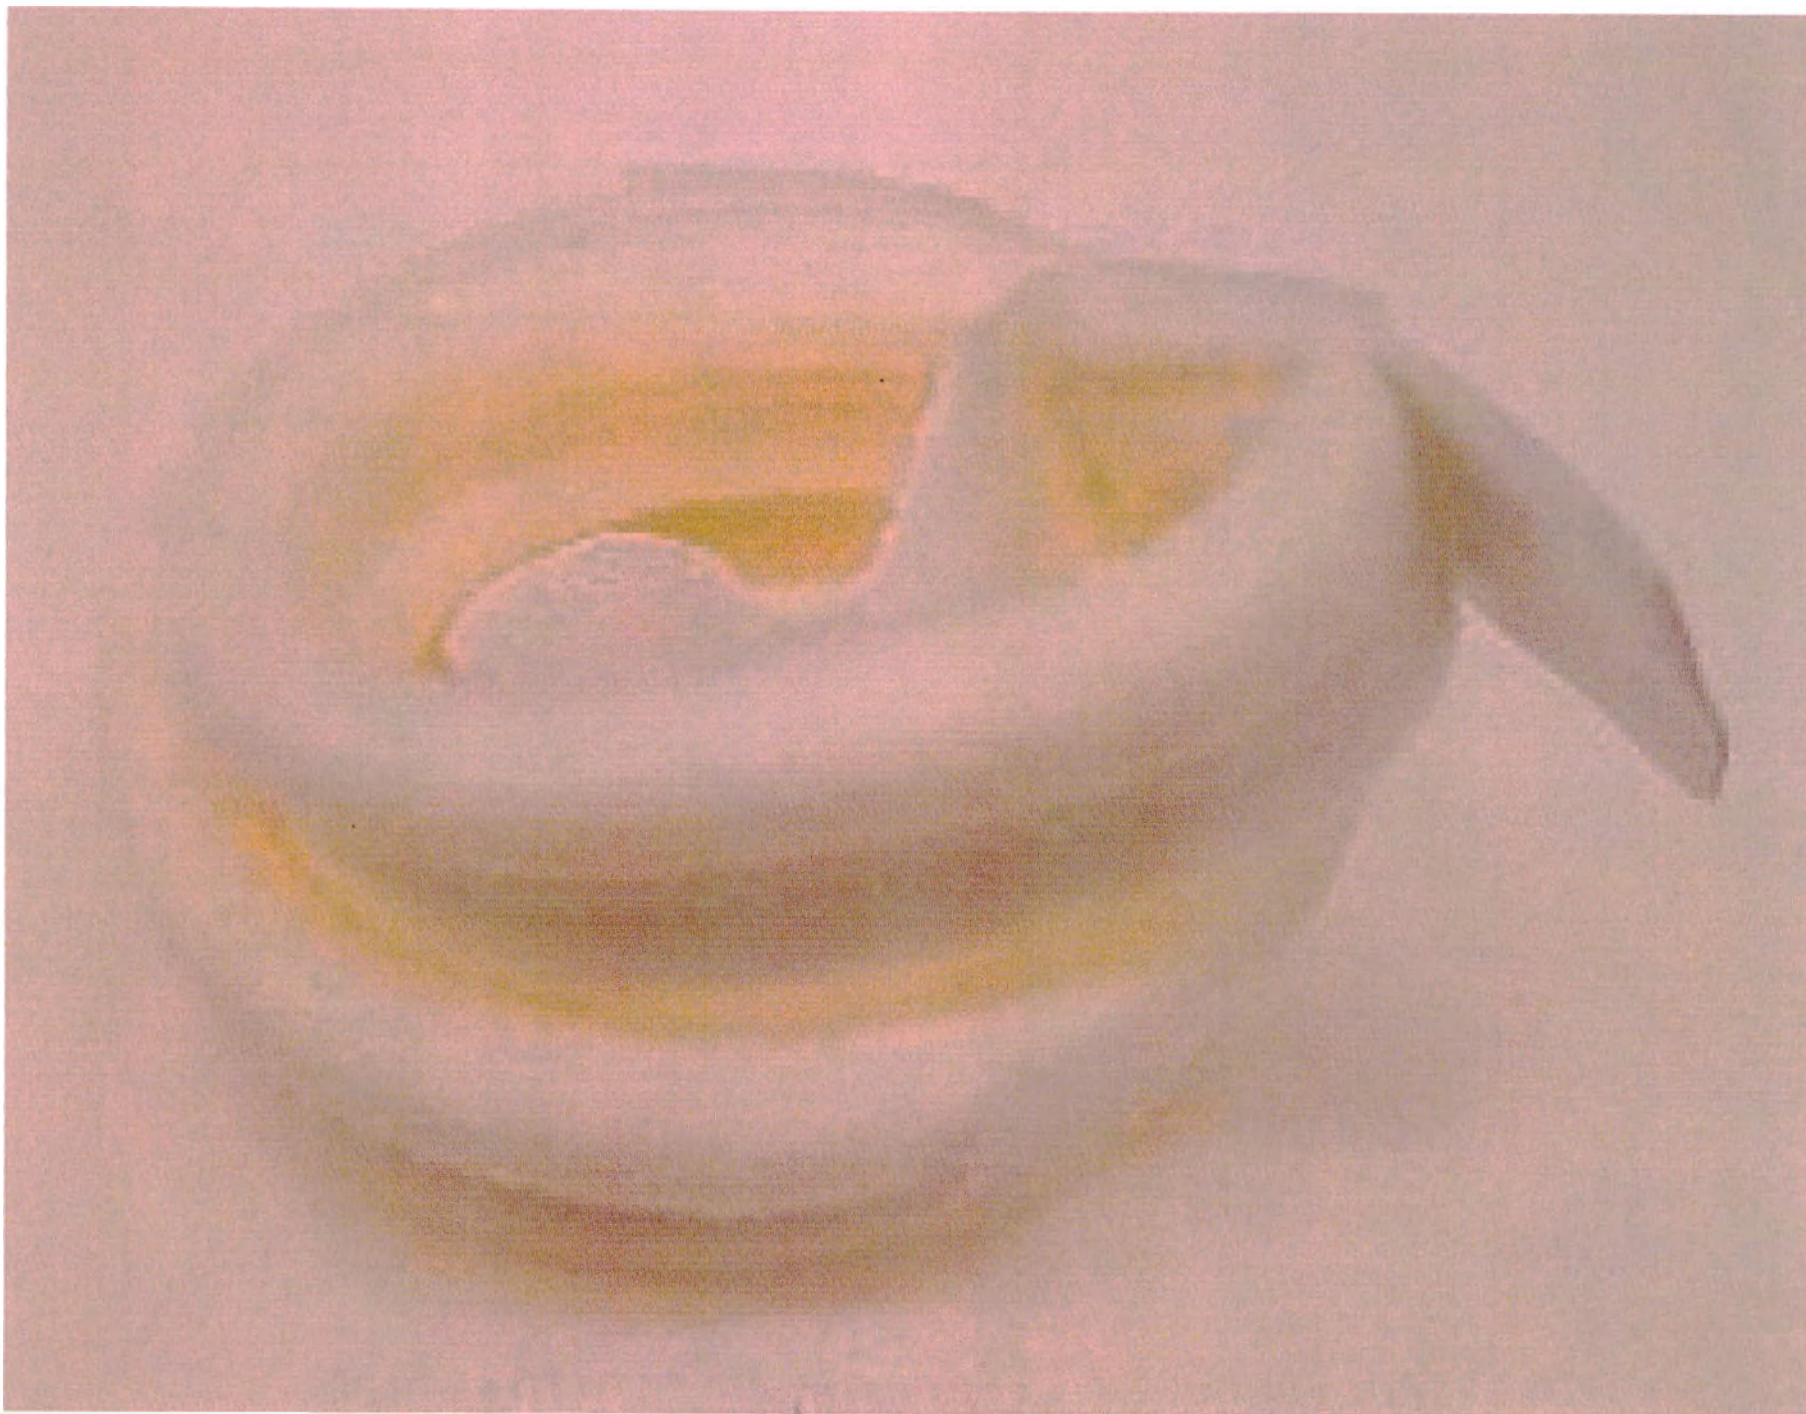











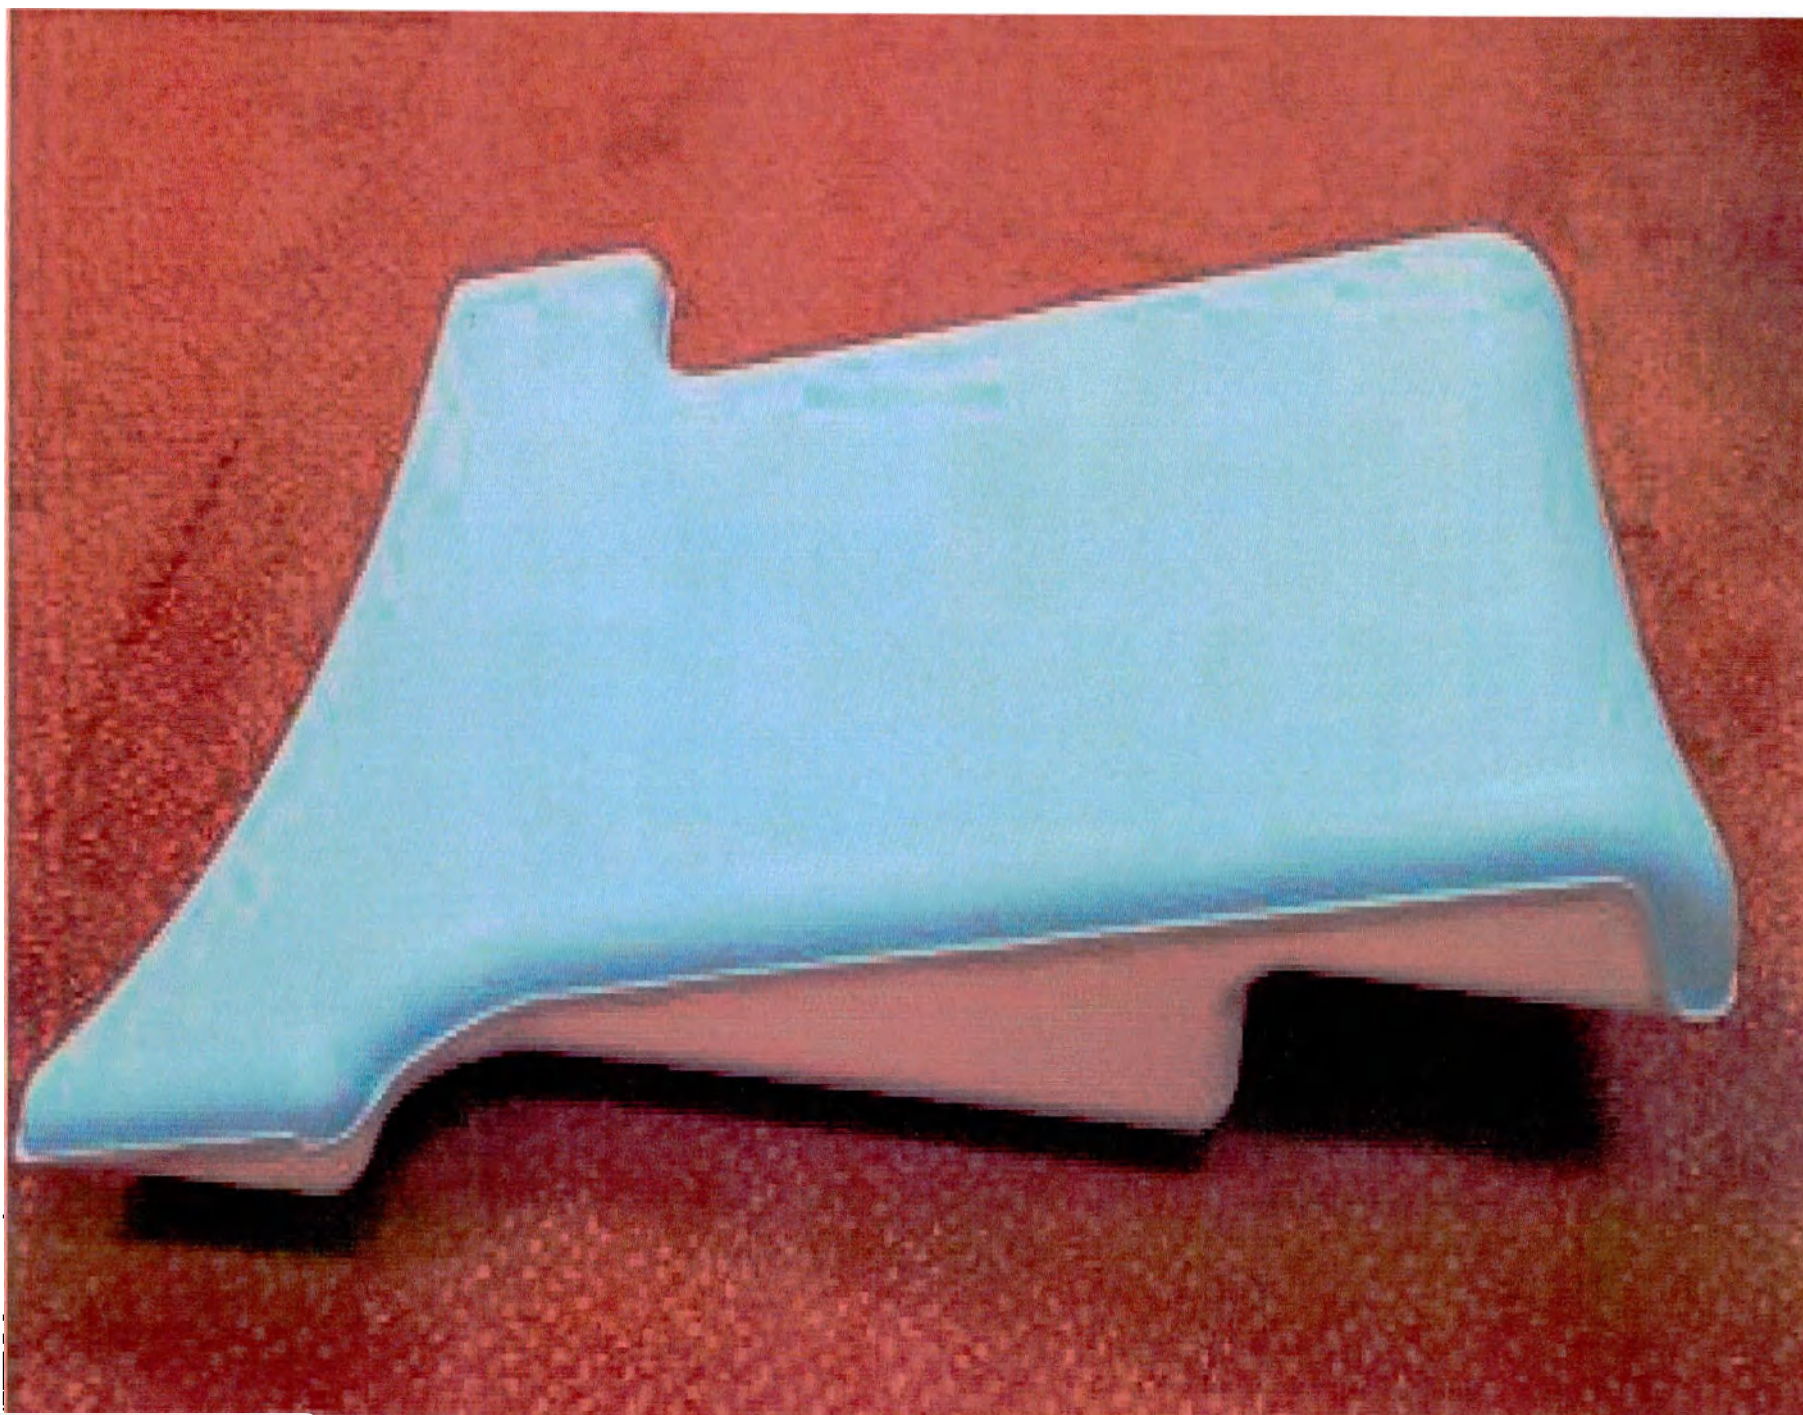








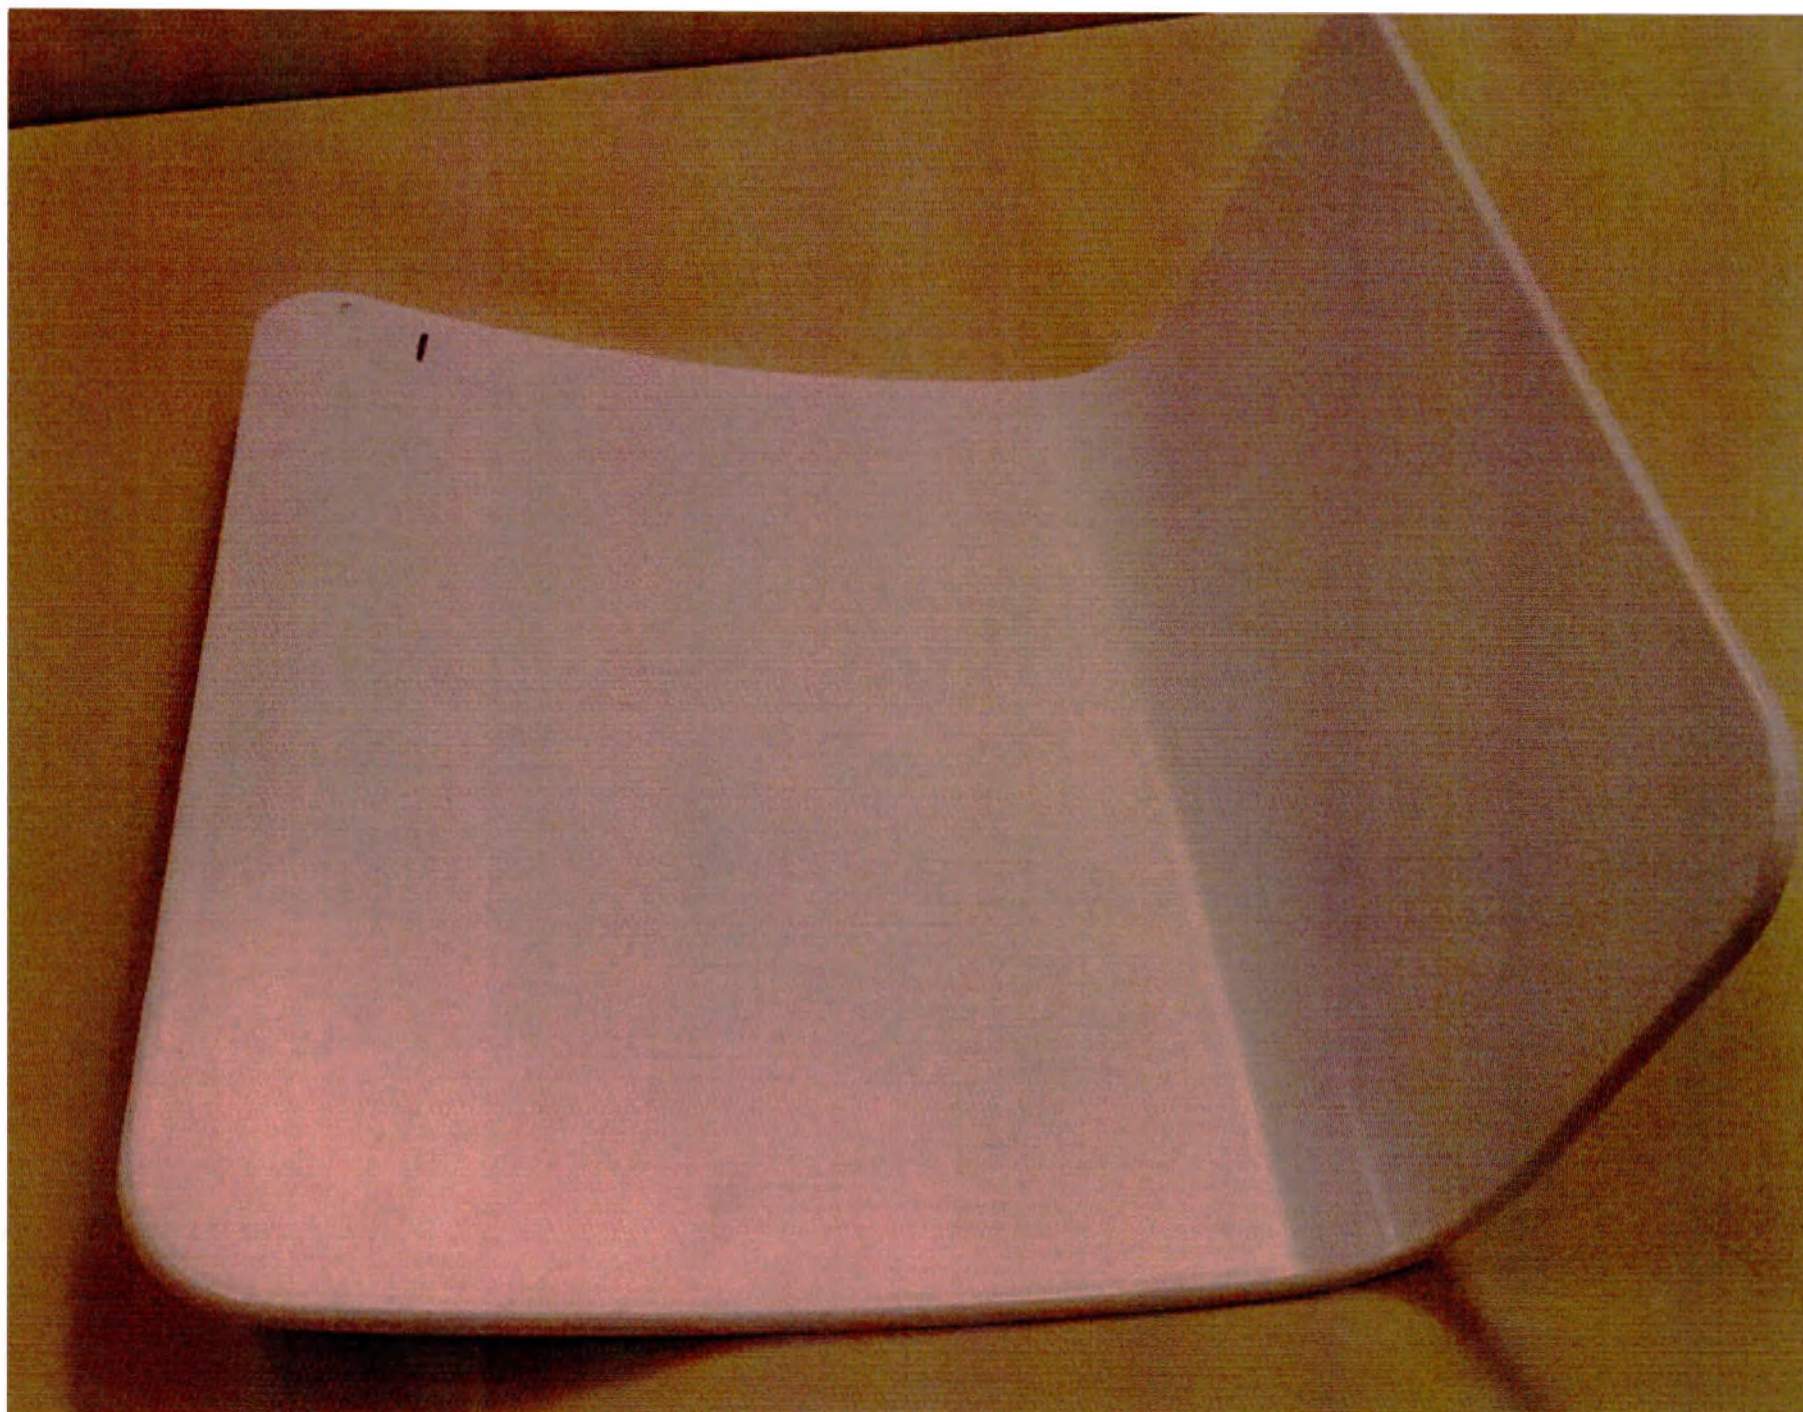




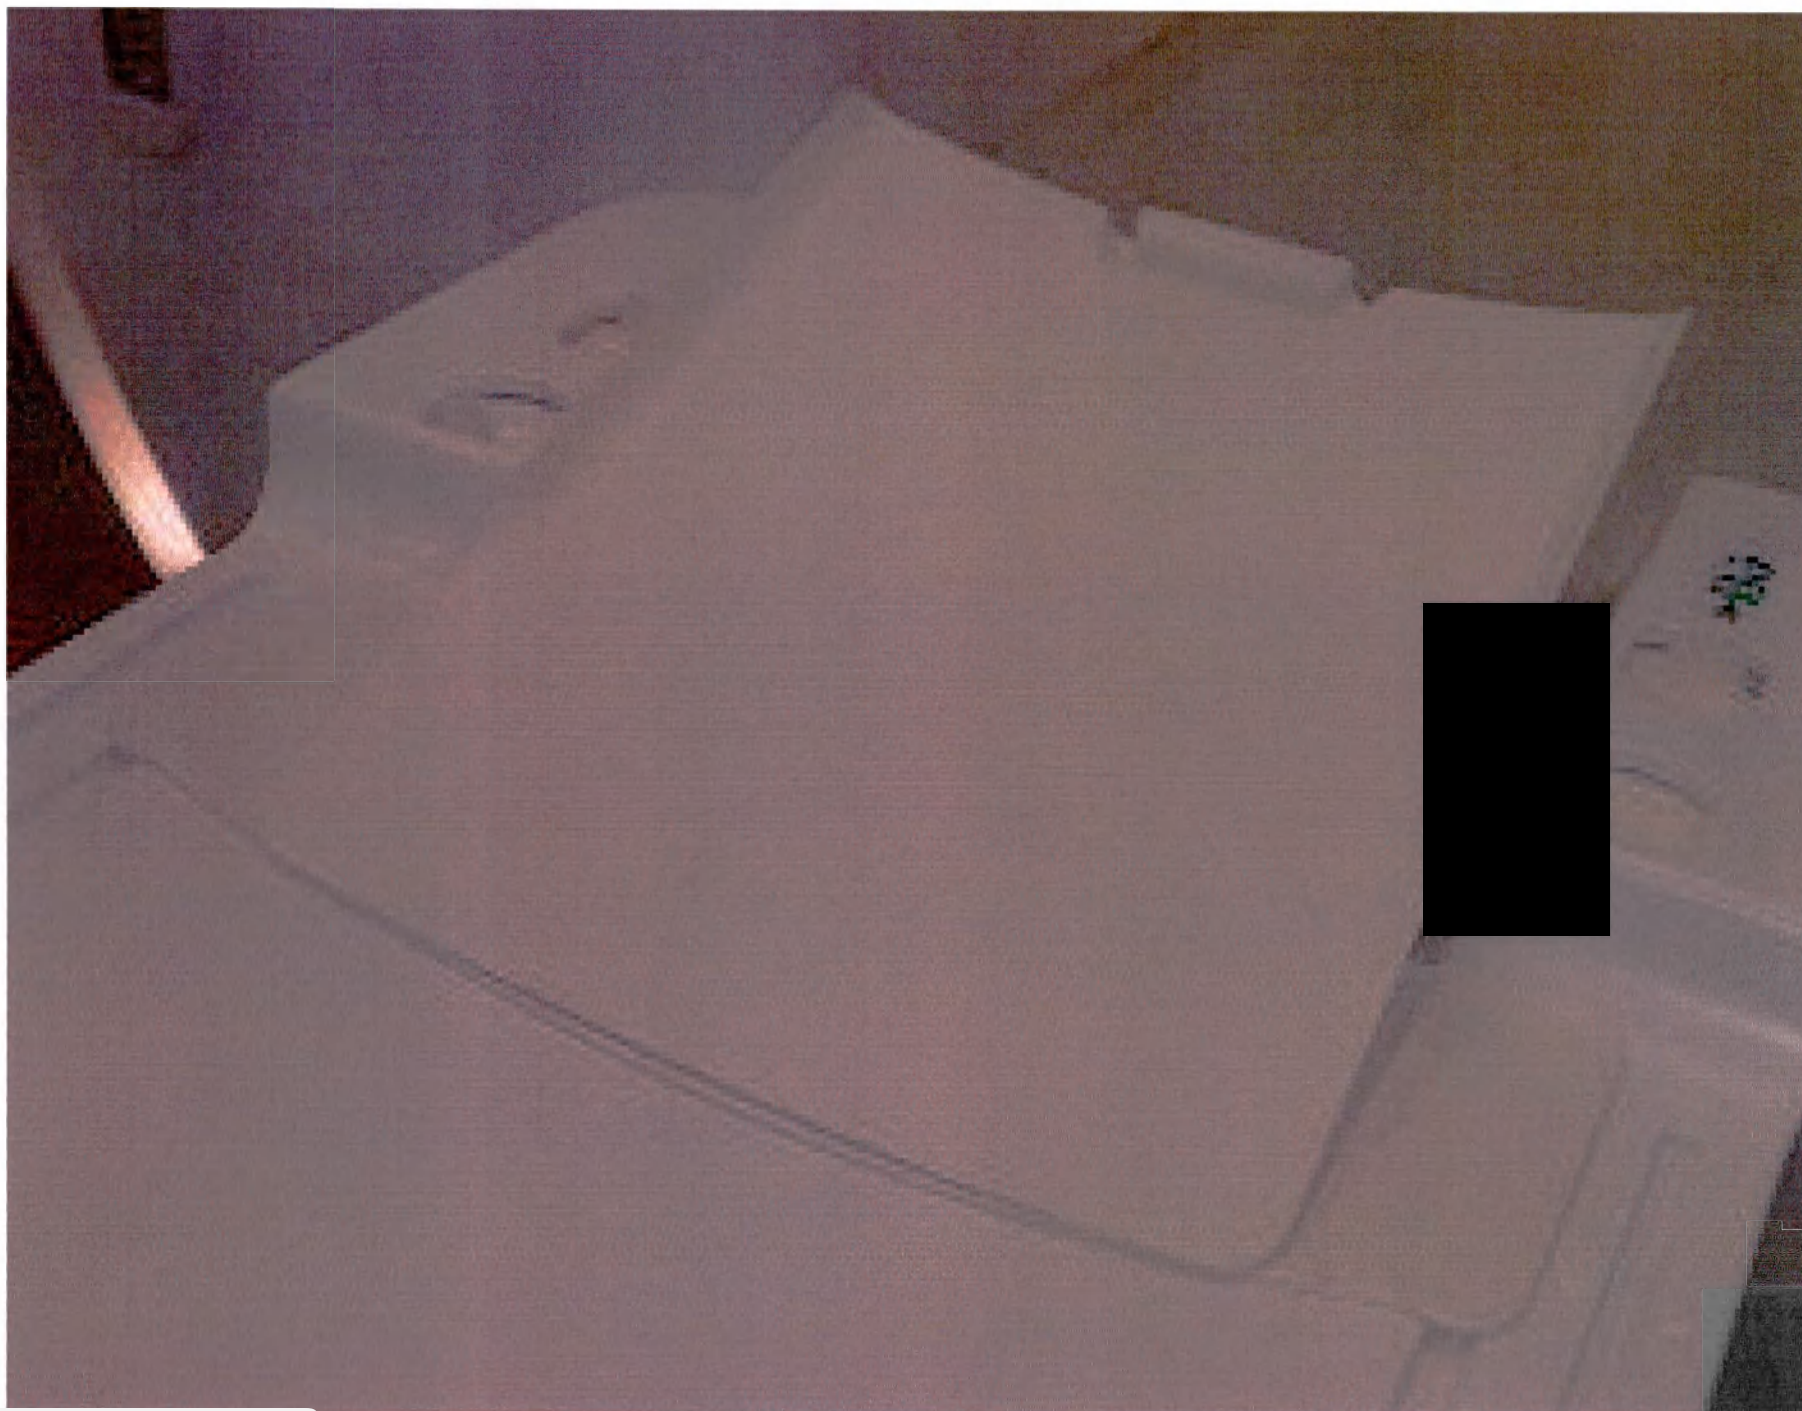

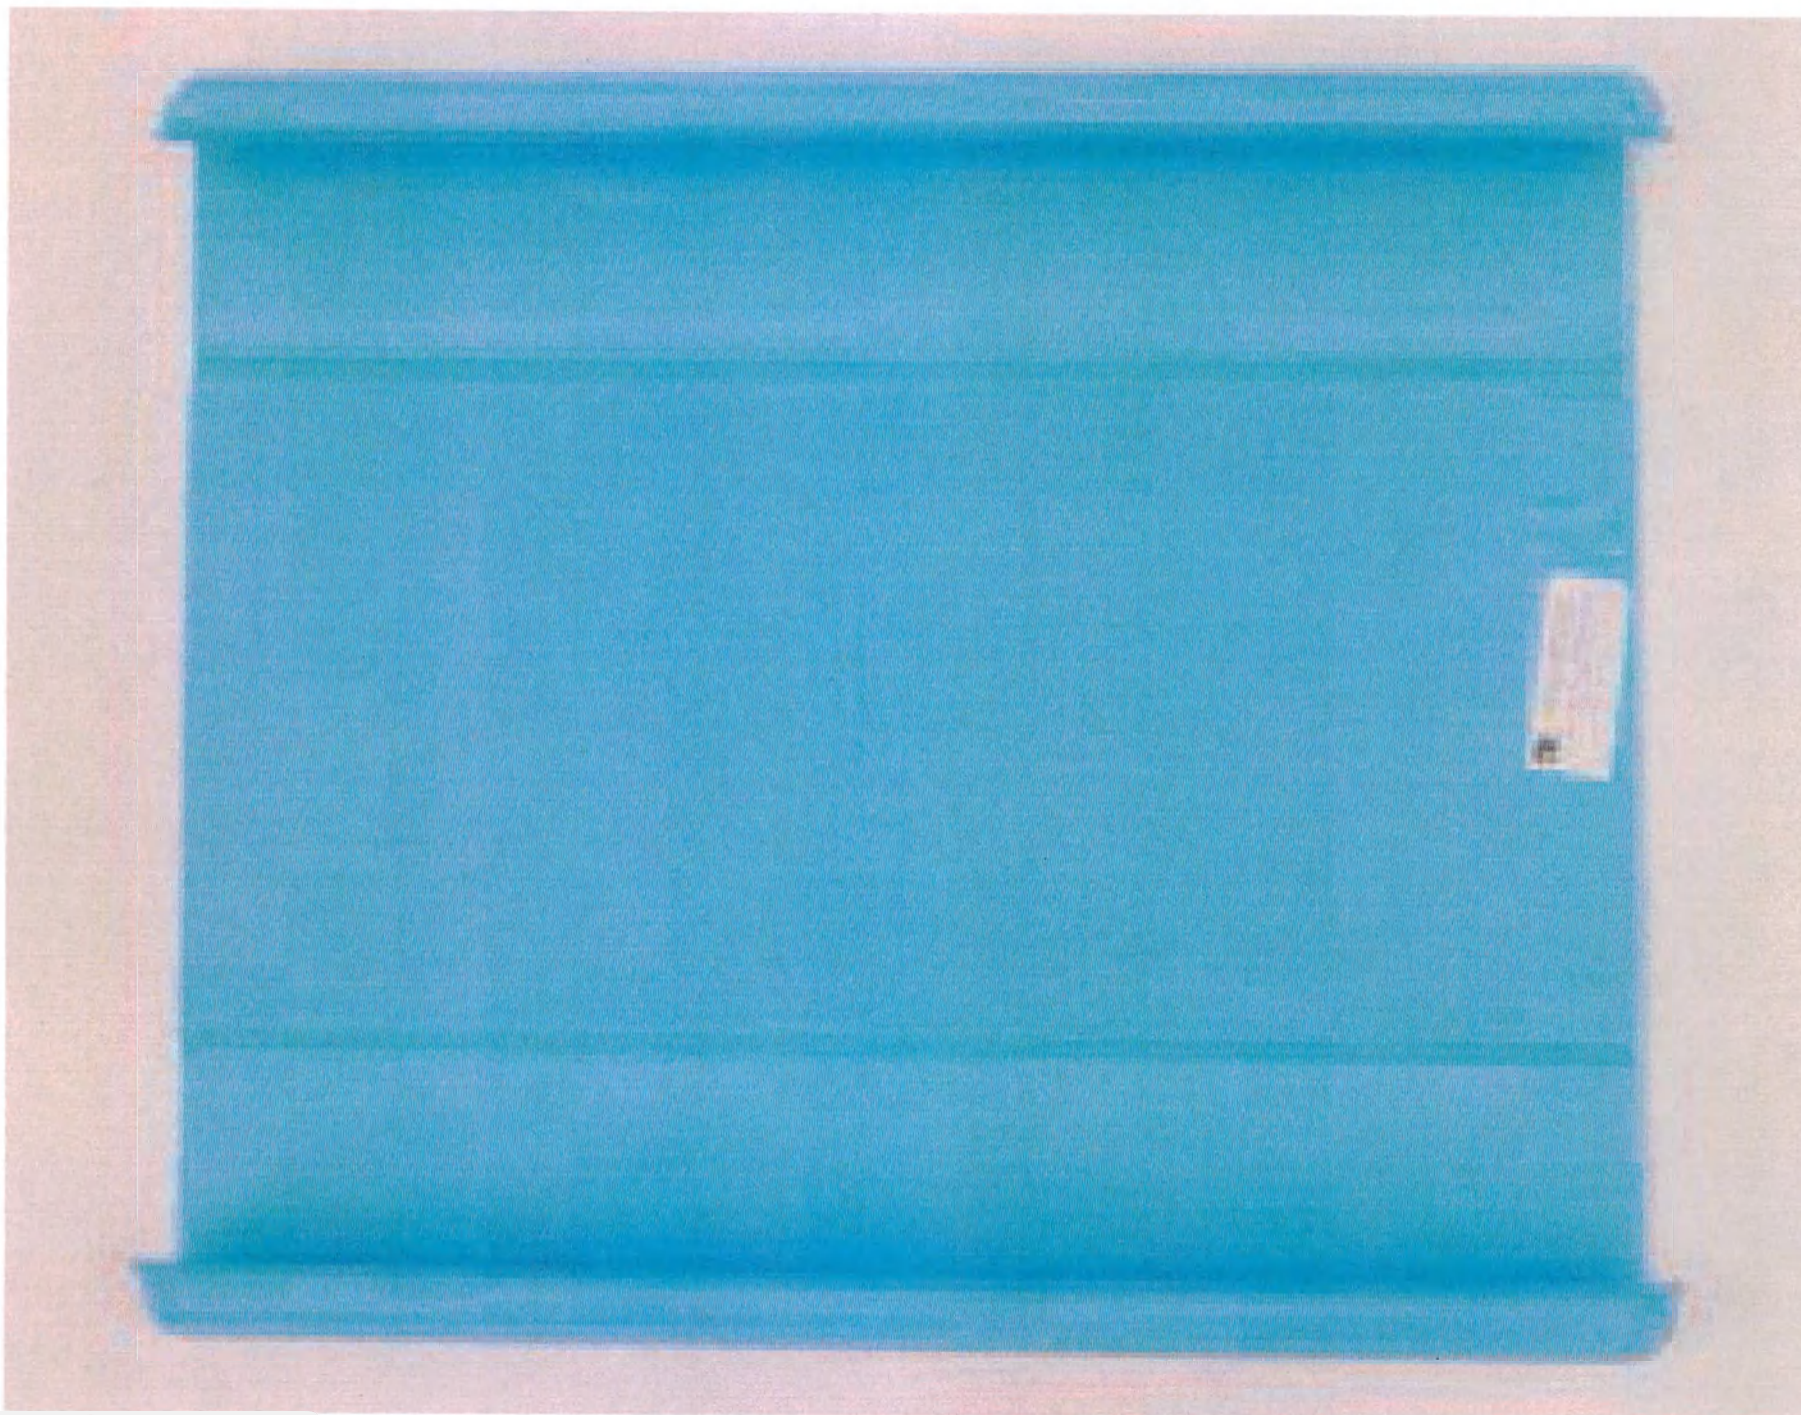


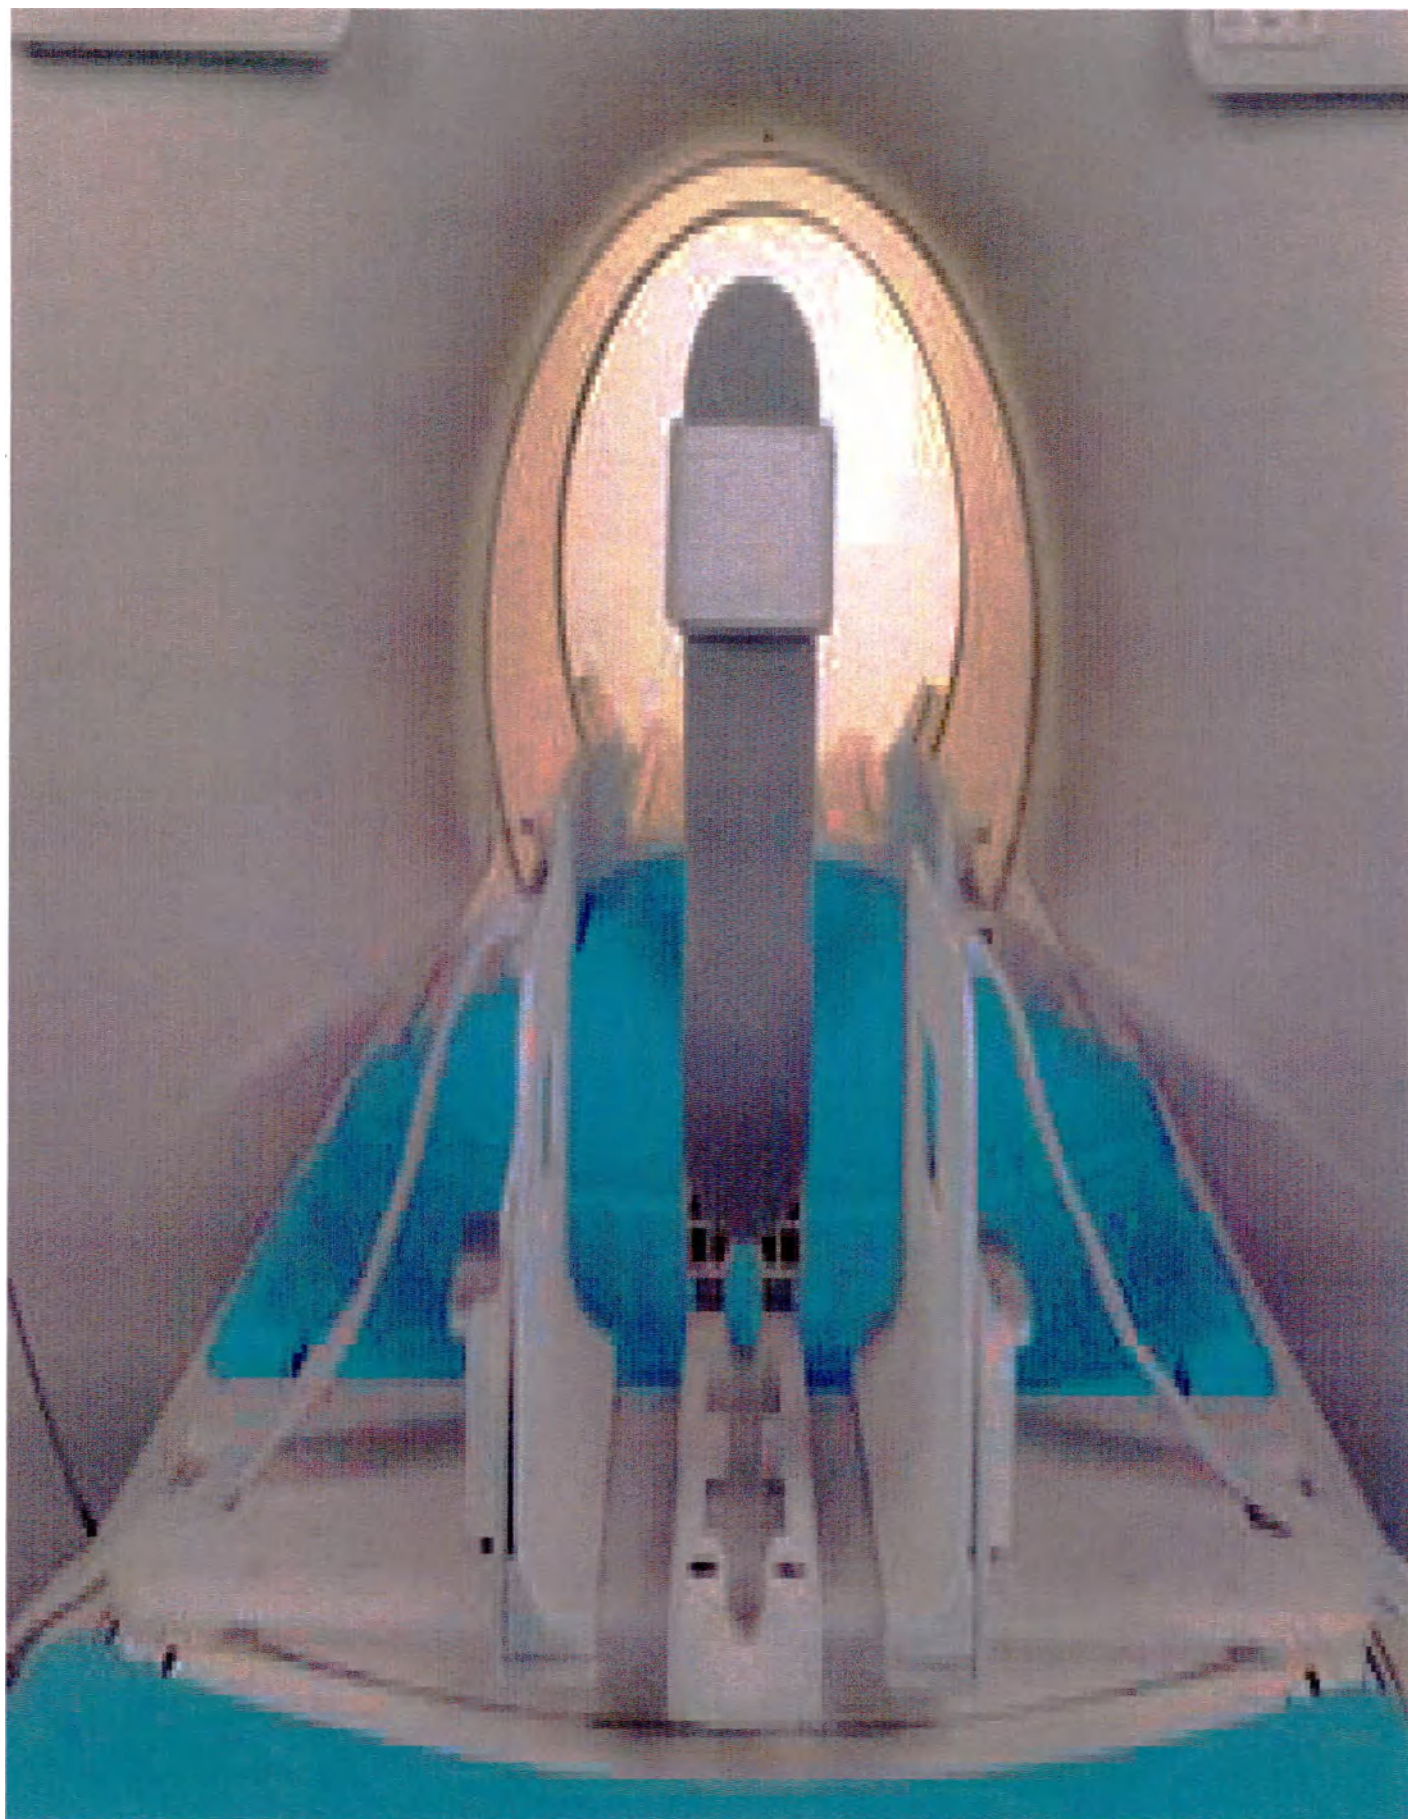


11.22. Универсальное позиционирующее устройство.

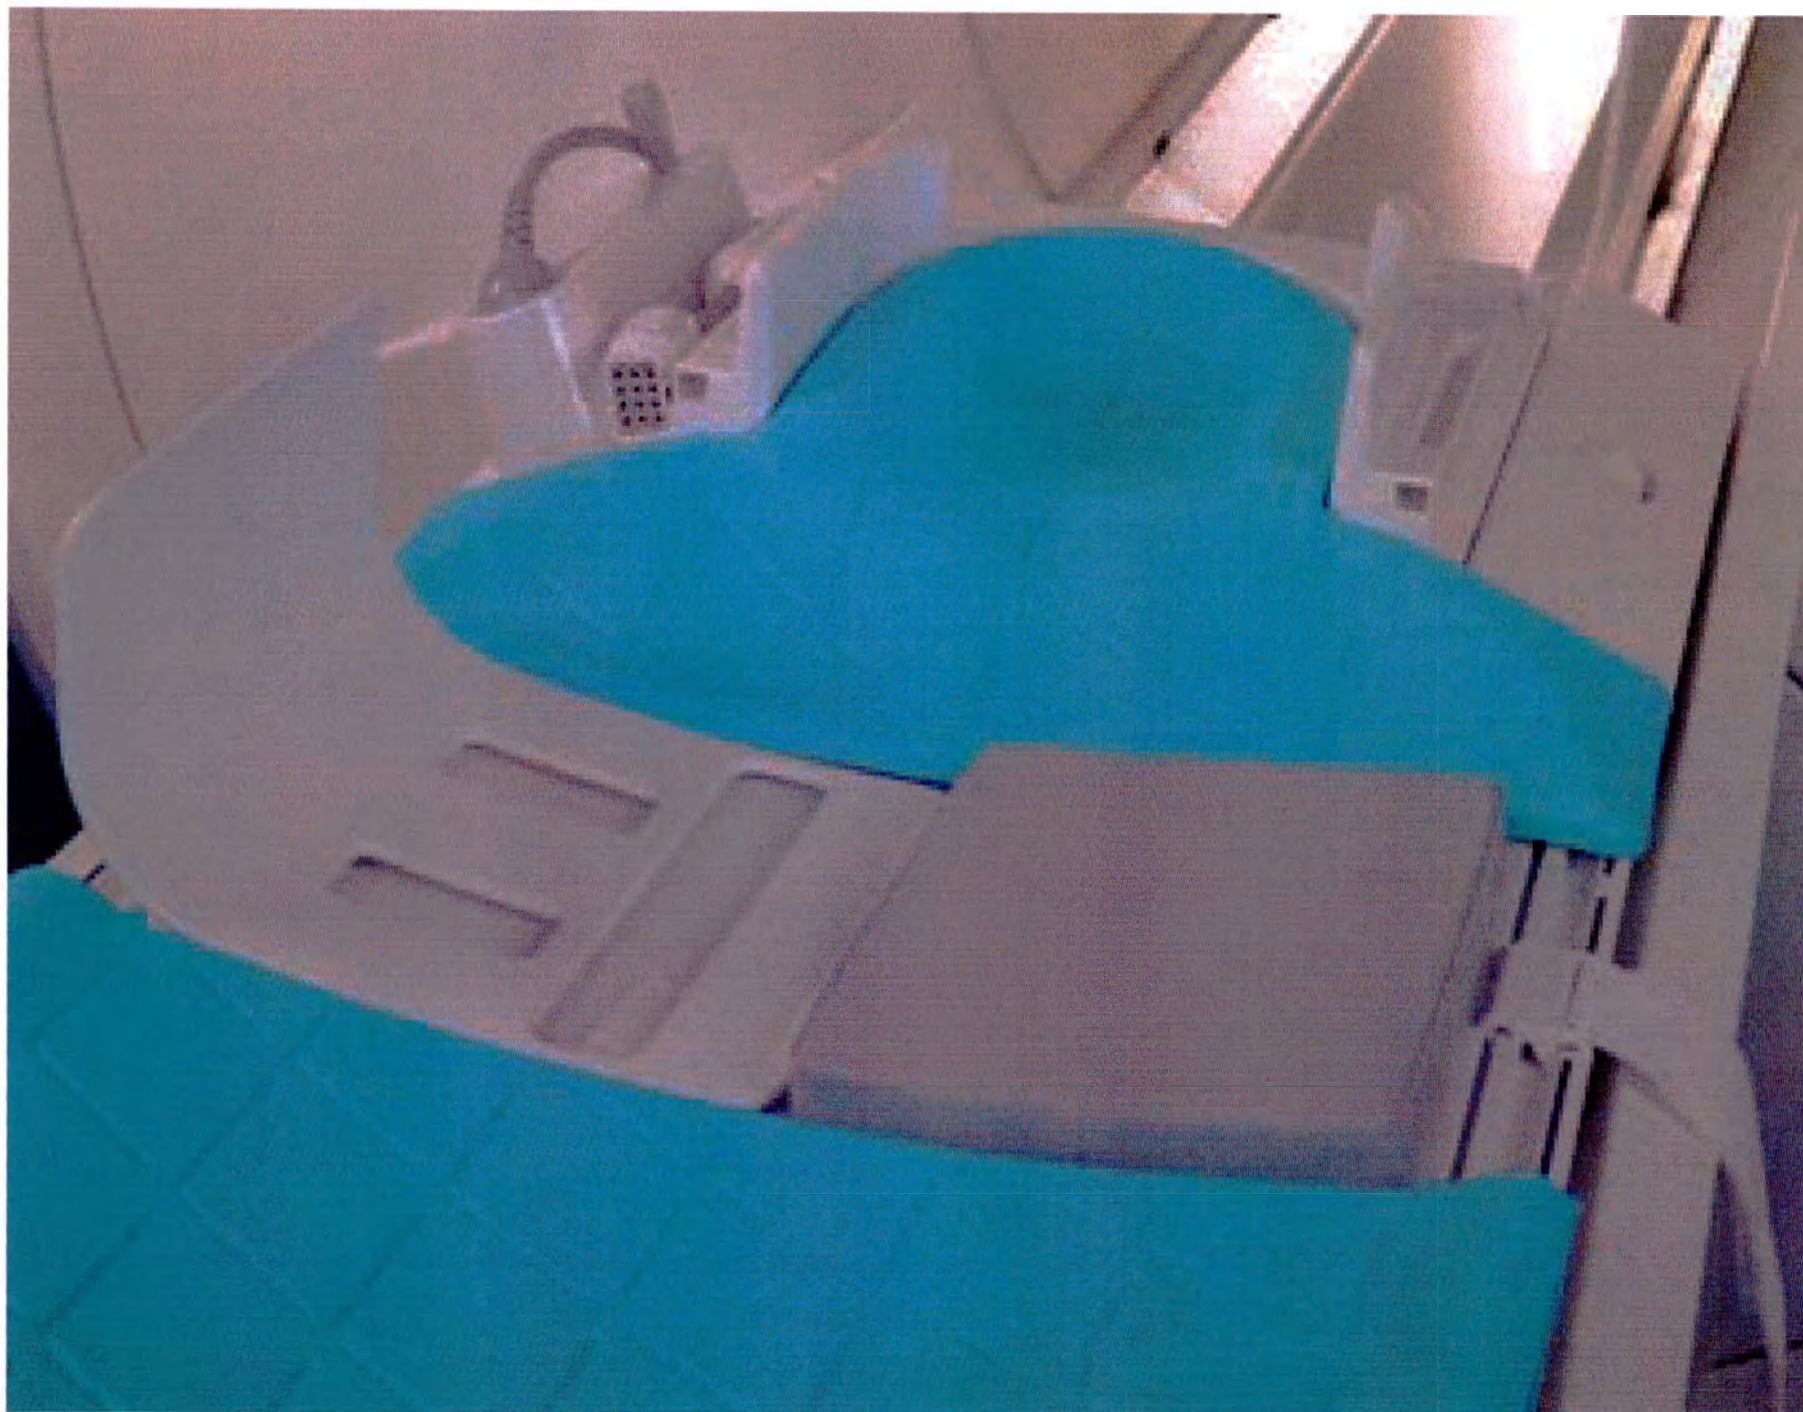




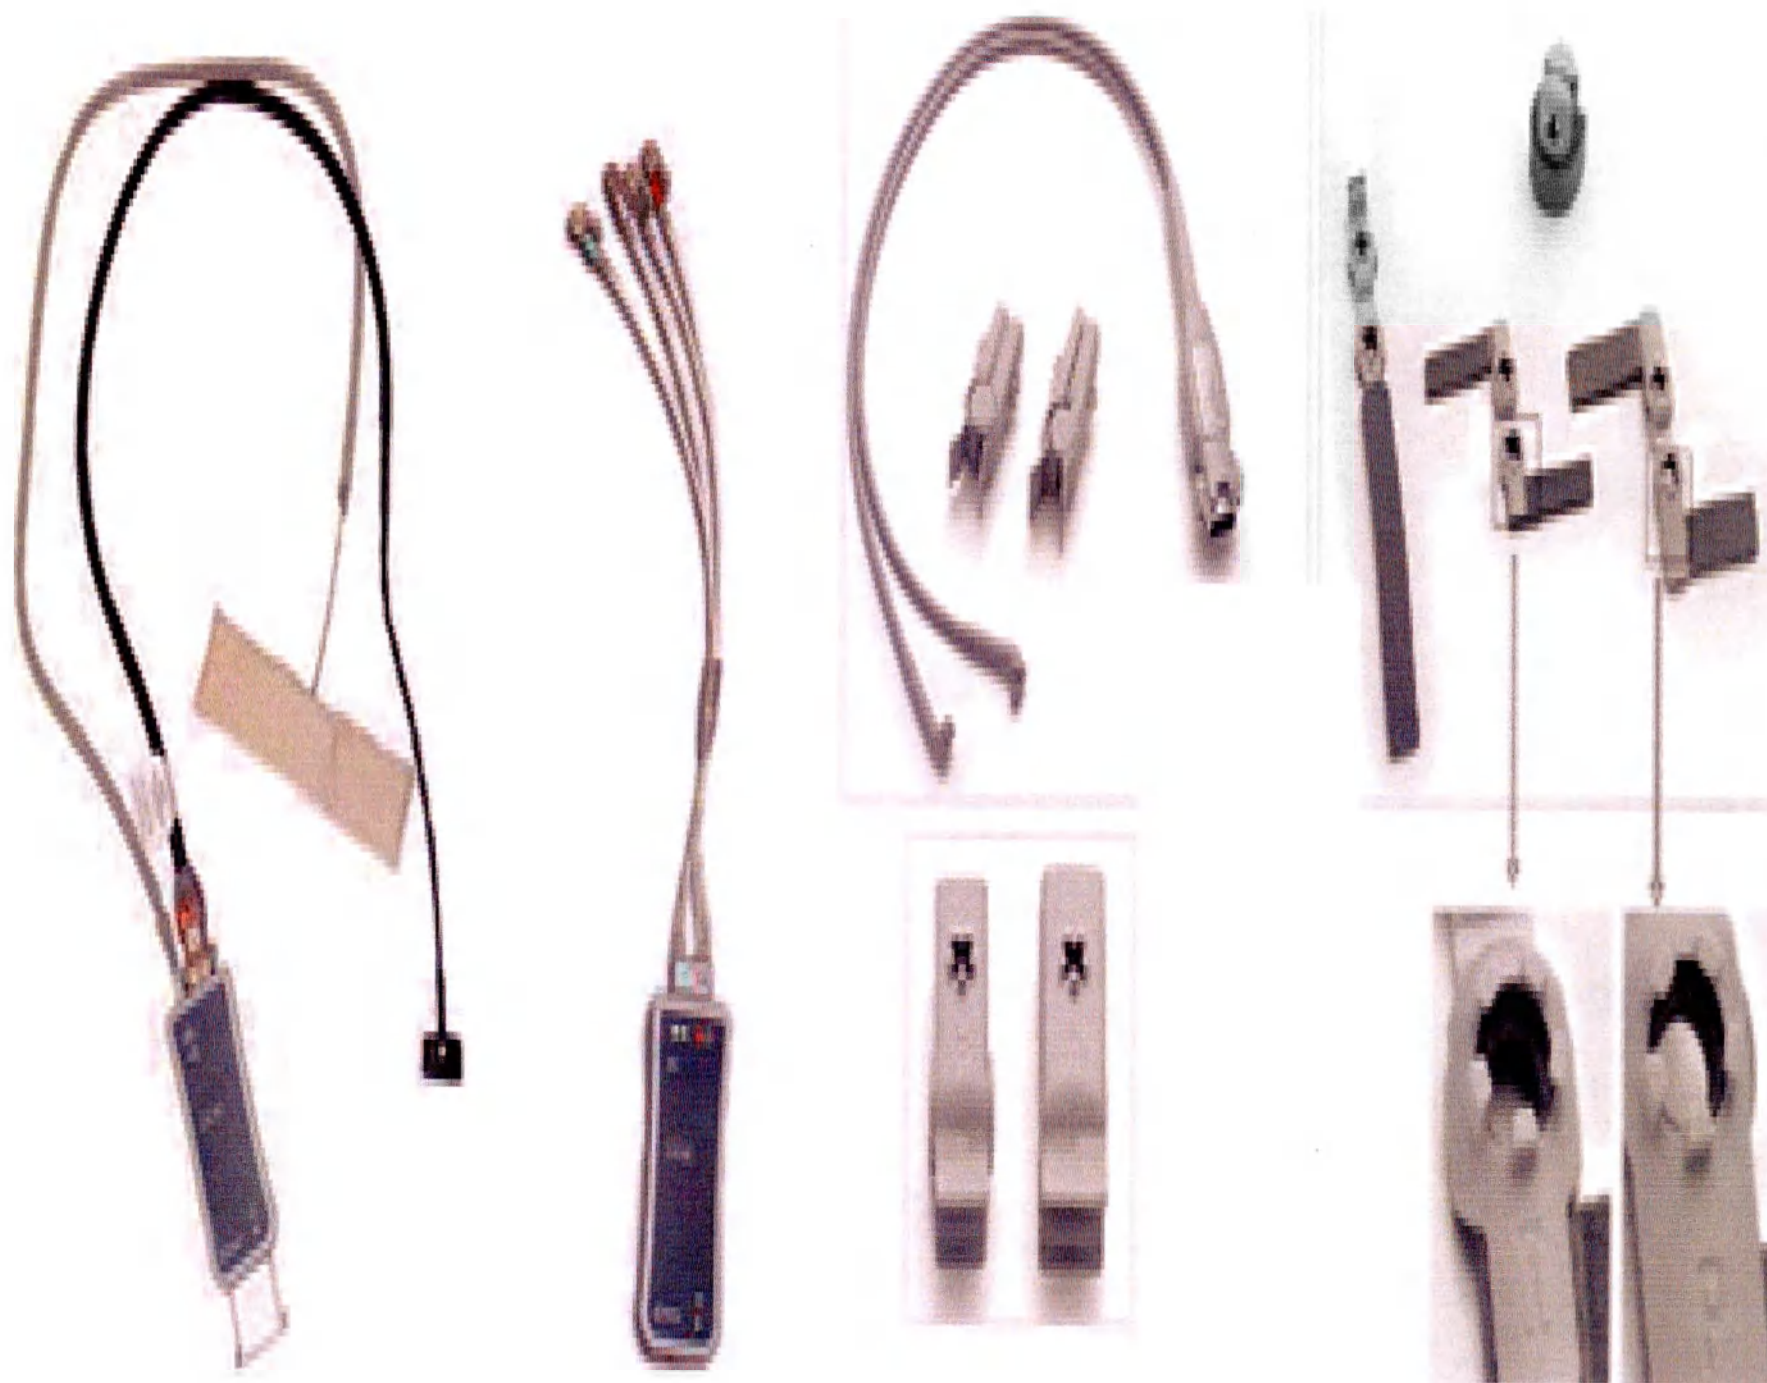


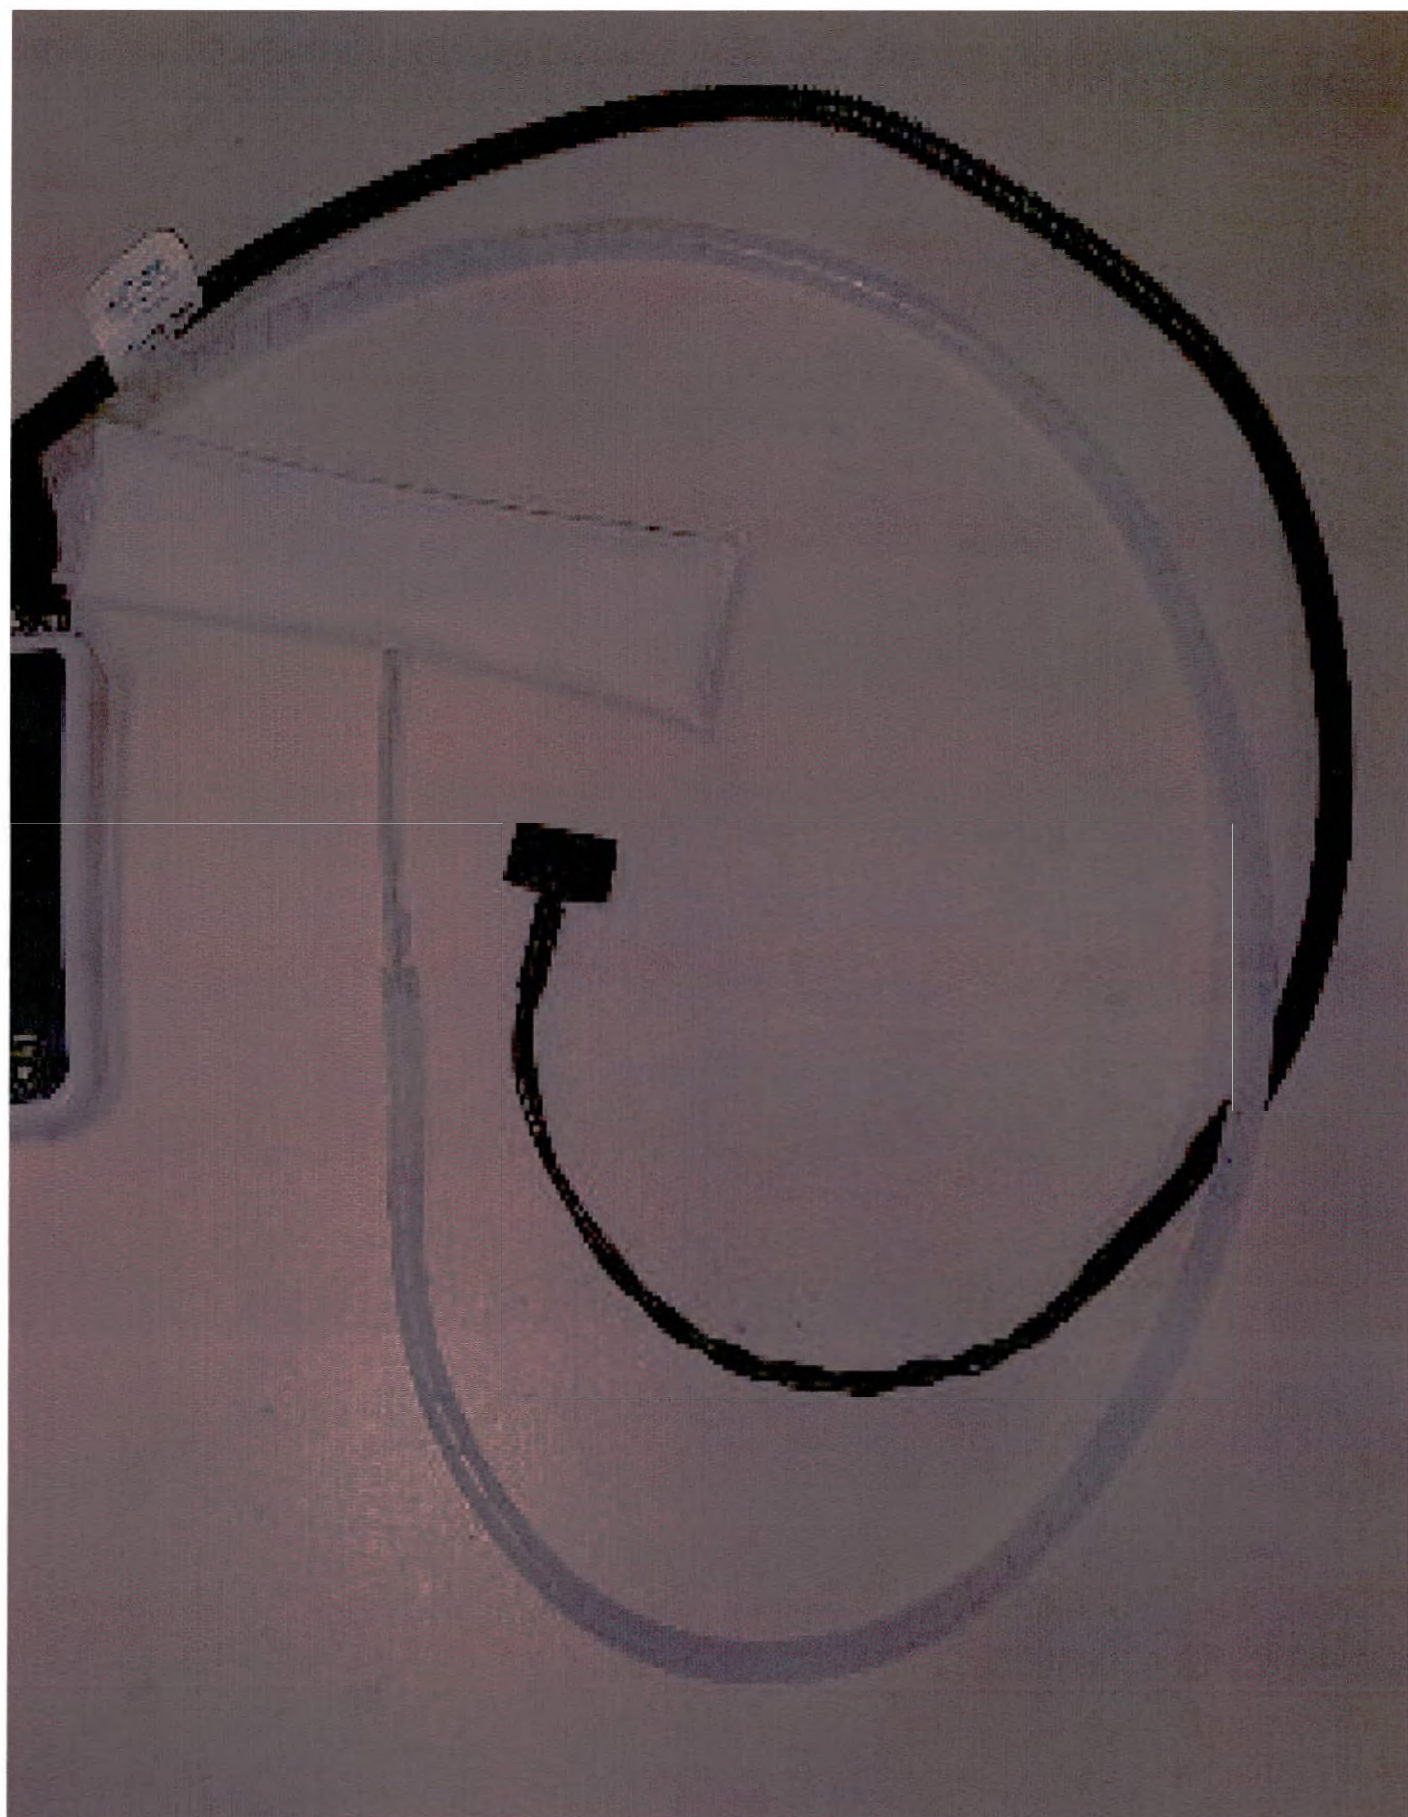


12.1. Дыхательный пояс.

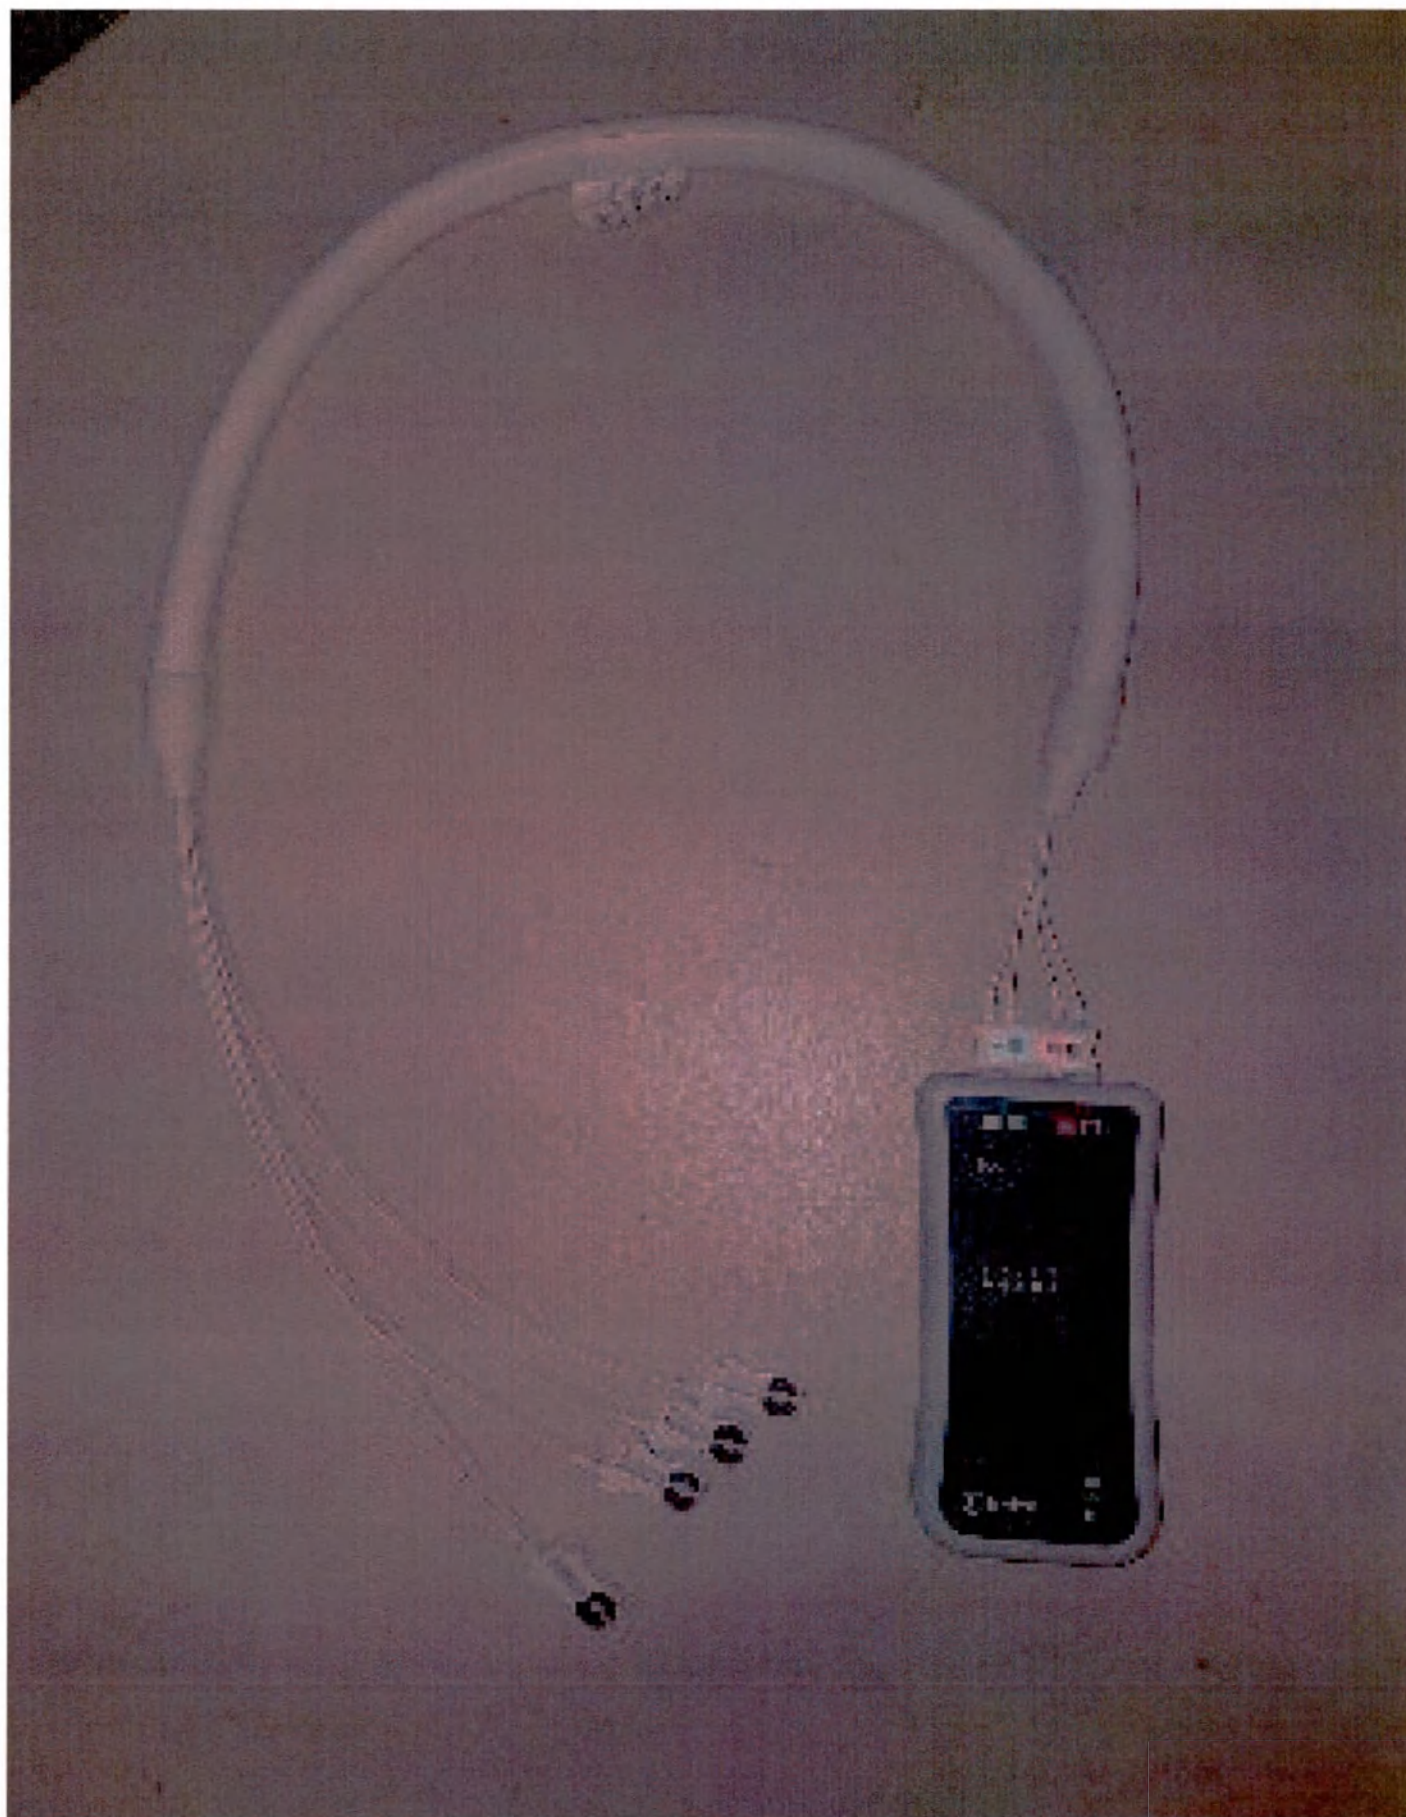

12.2. Беспроводной модуль ВКГ. Вид 1.

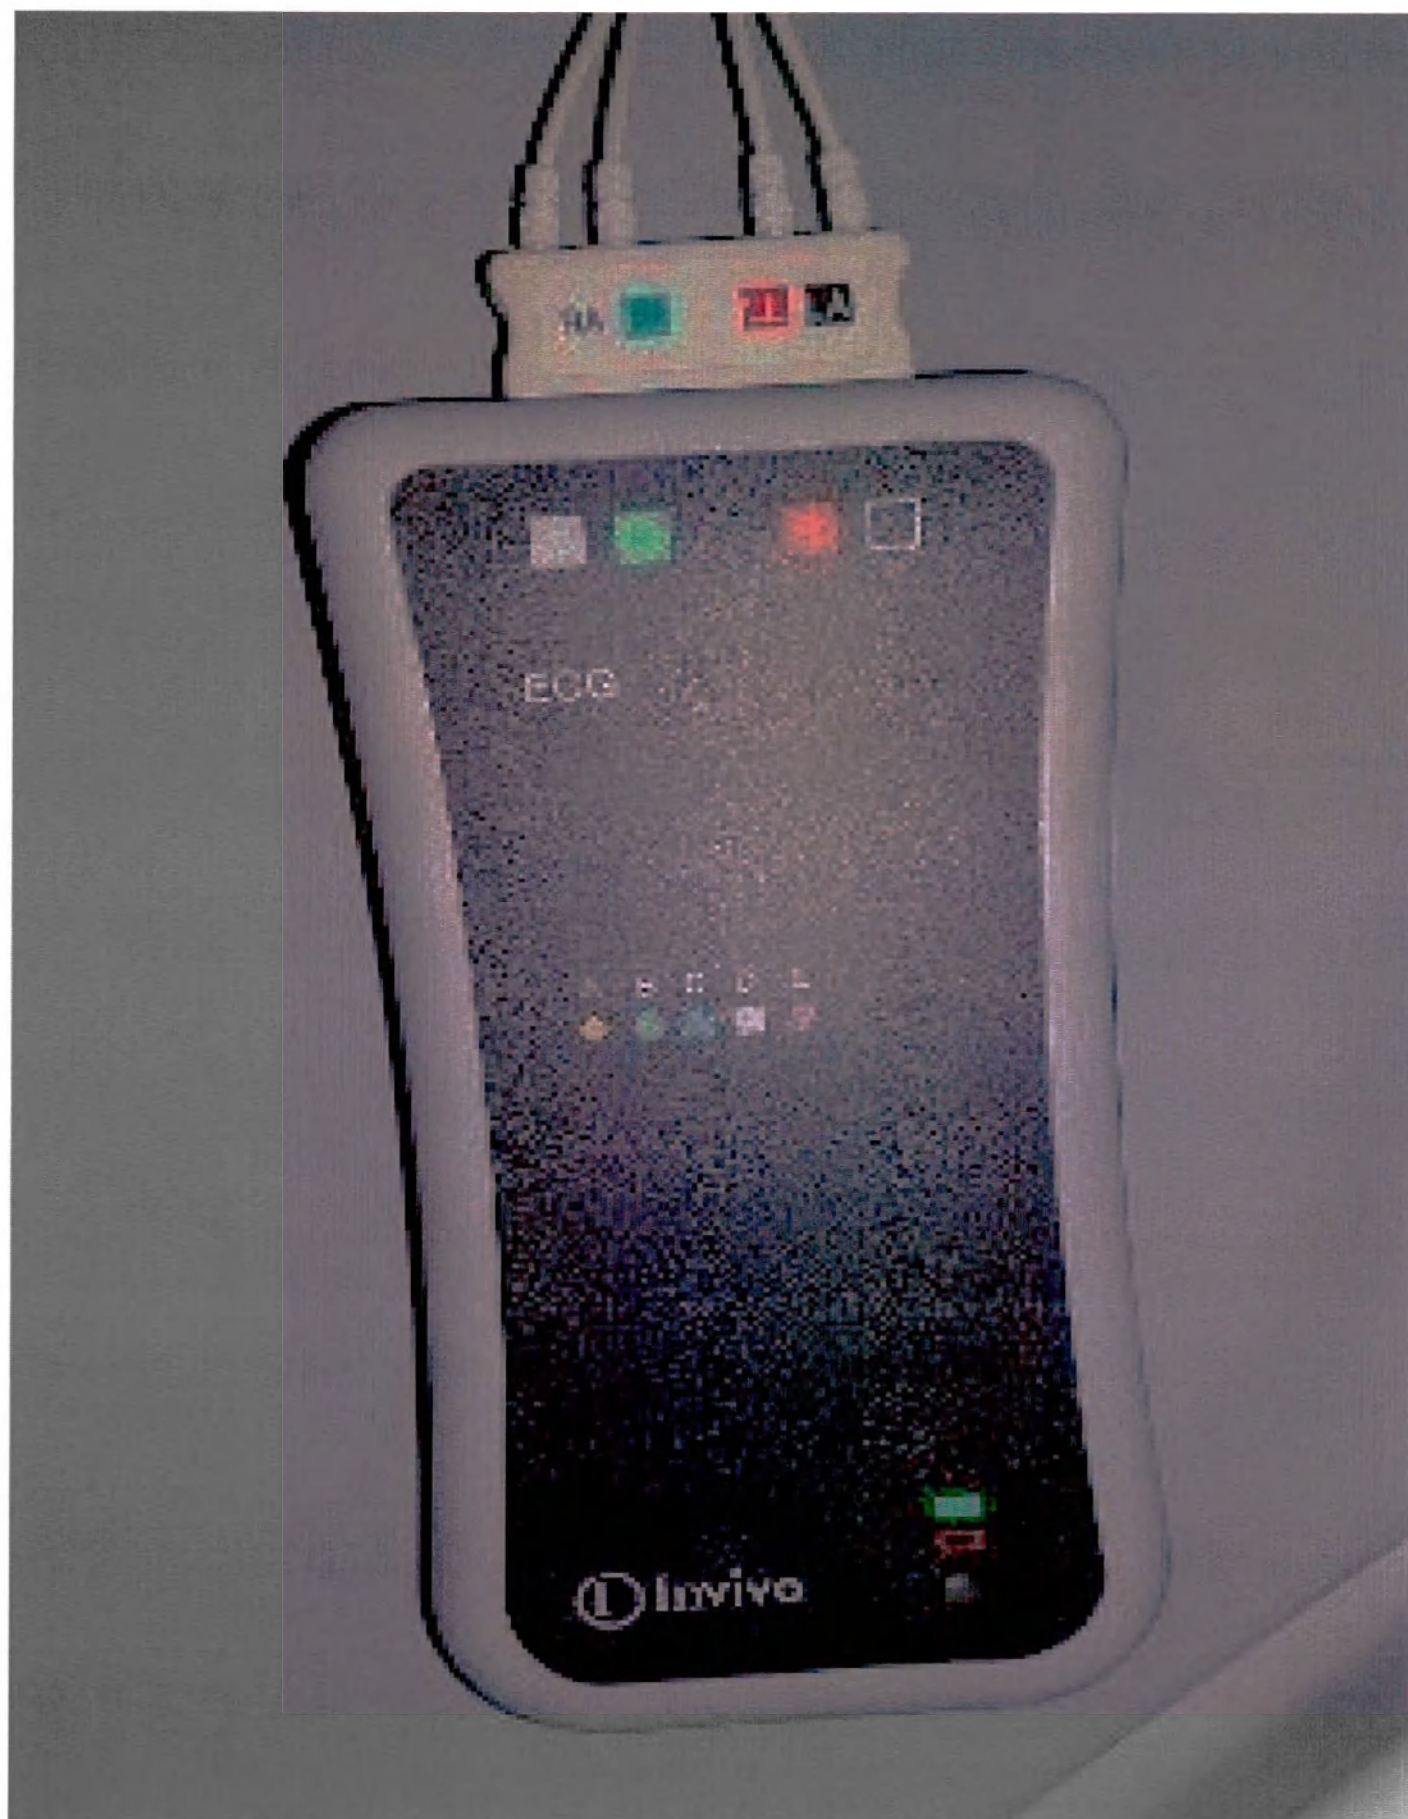


12.2. Беспроводной модуль ВКГ. Вид 2.

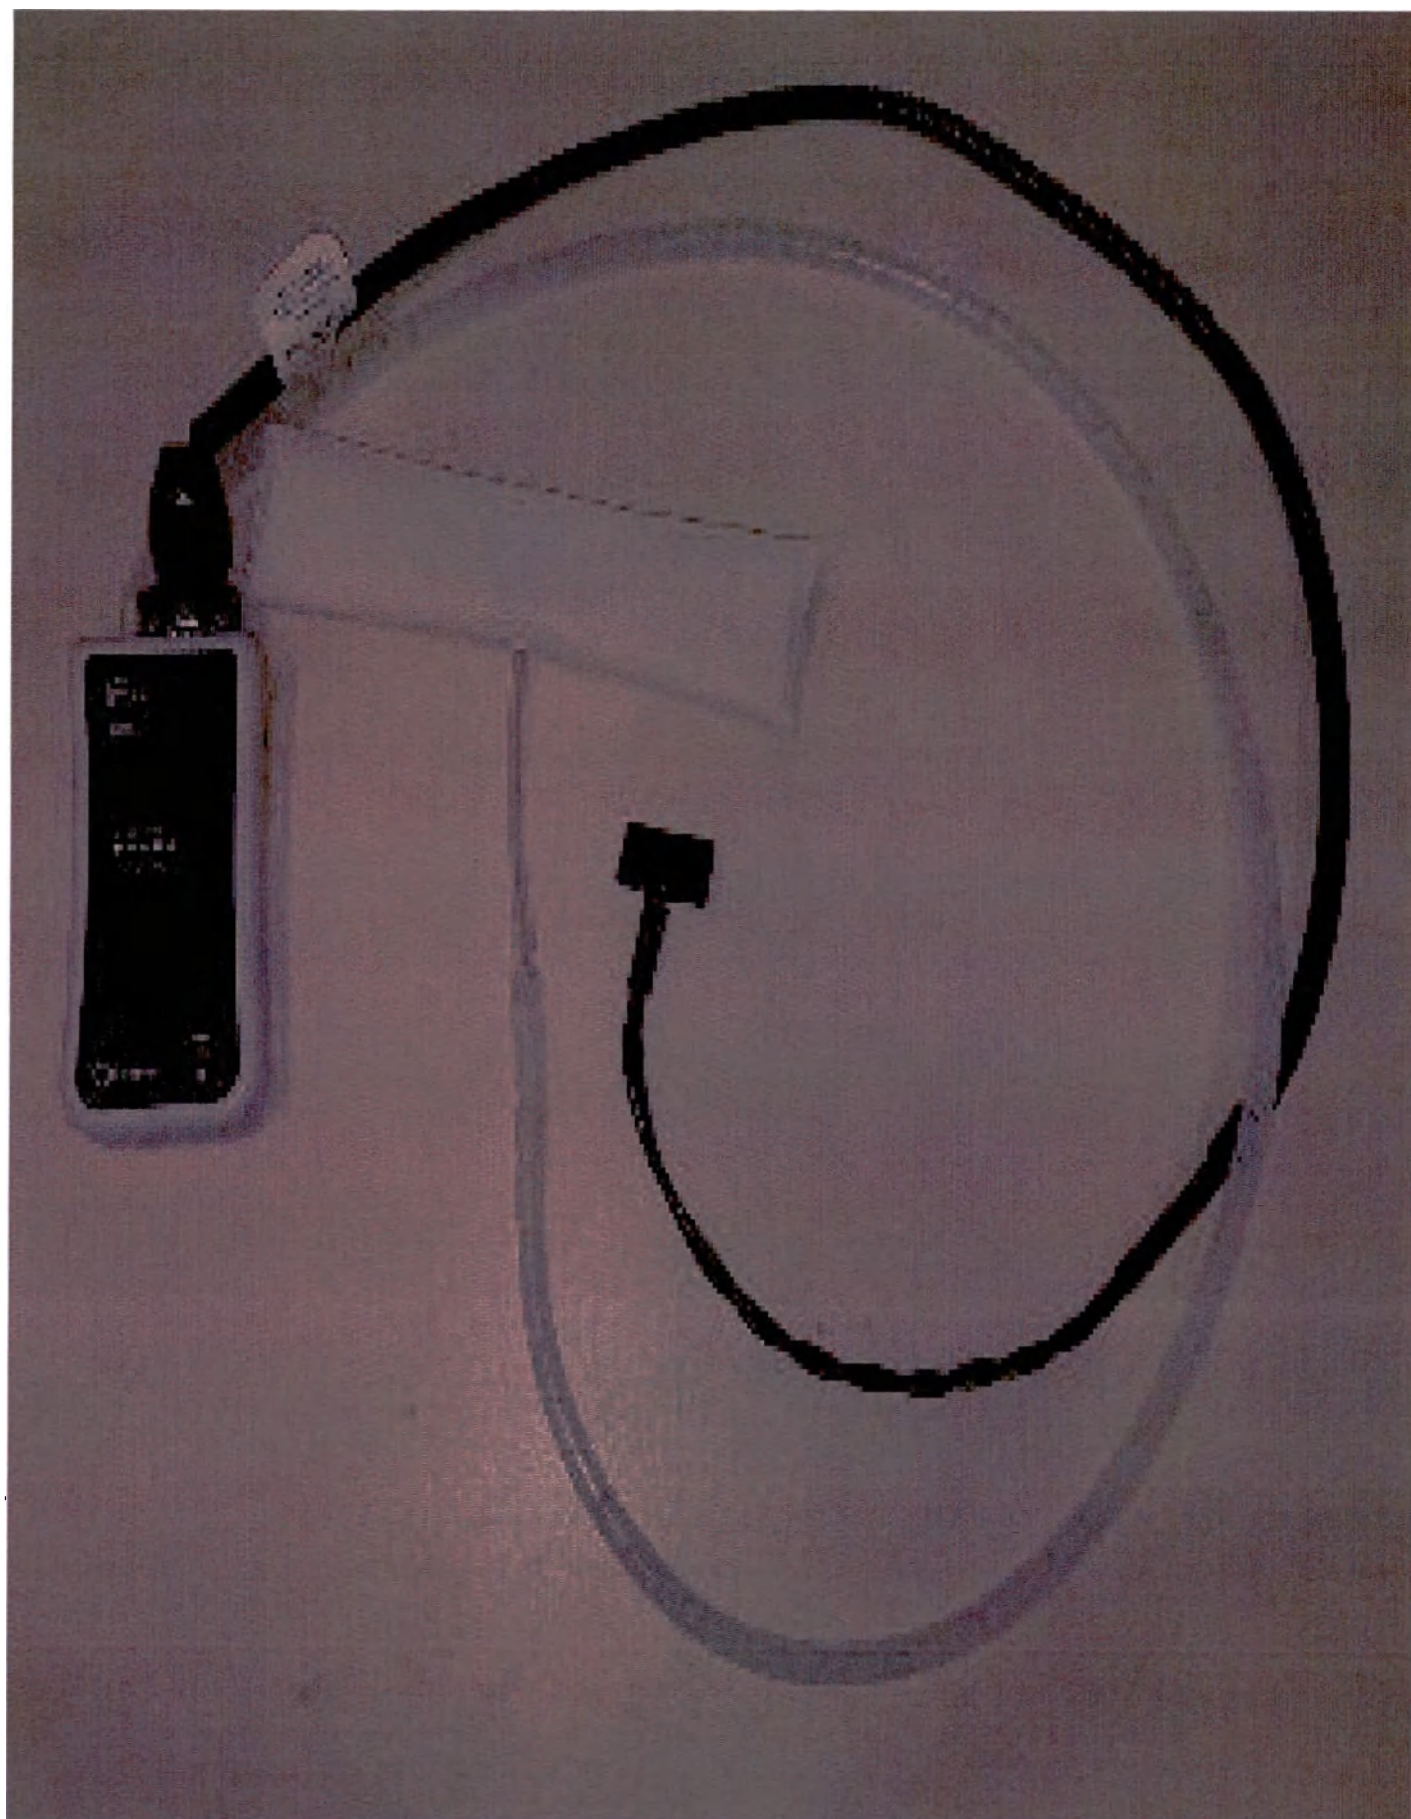


12.3. Беспроводной модуль PPU. Вид 1.




12.3. Беспроводной модуль PPU. Вид 2.

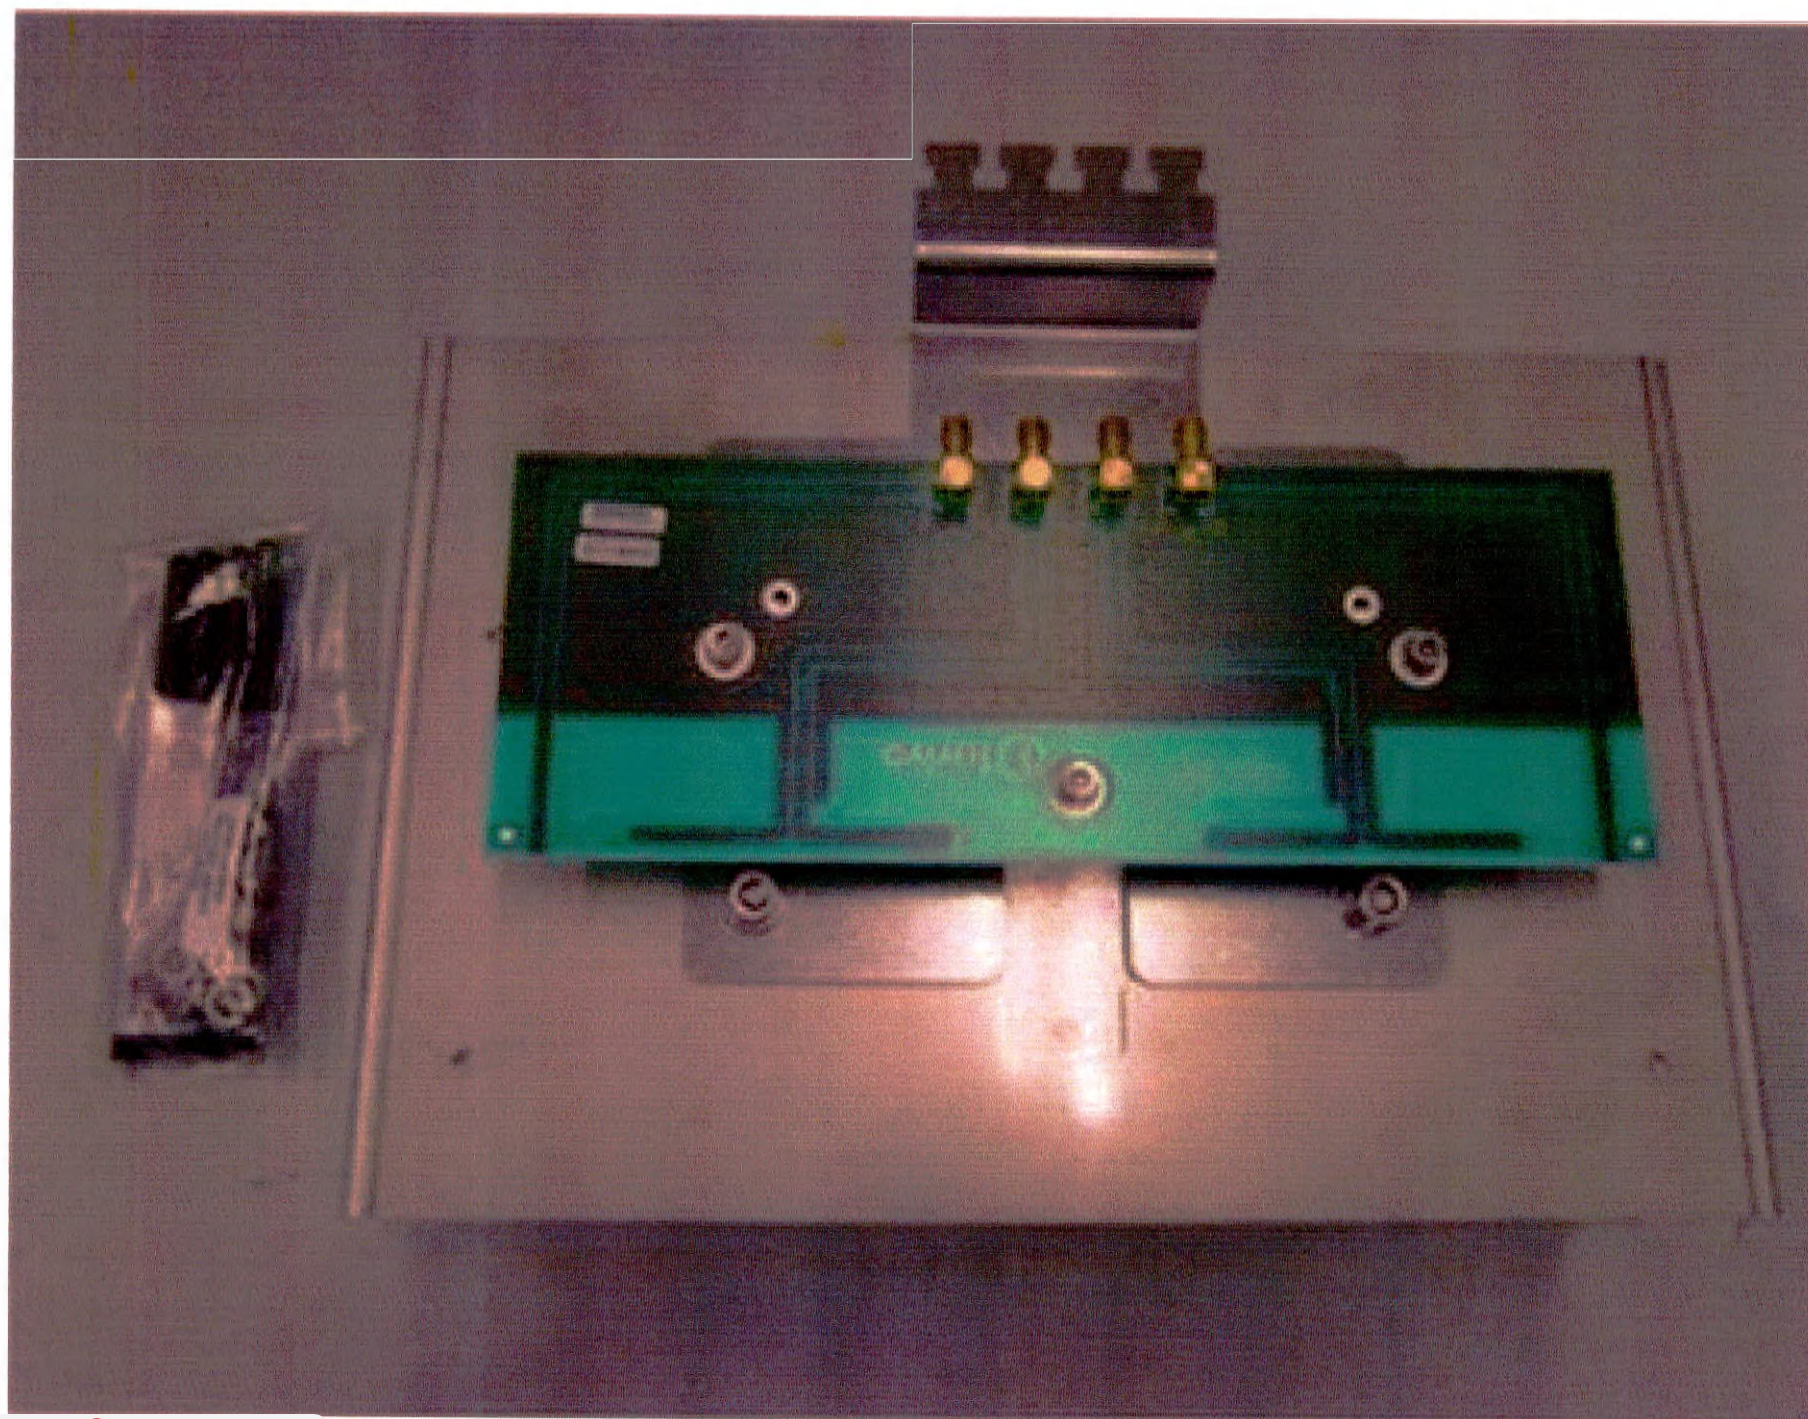


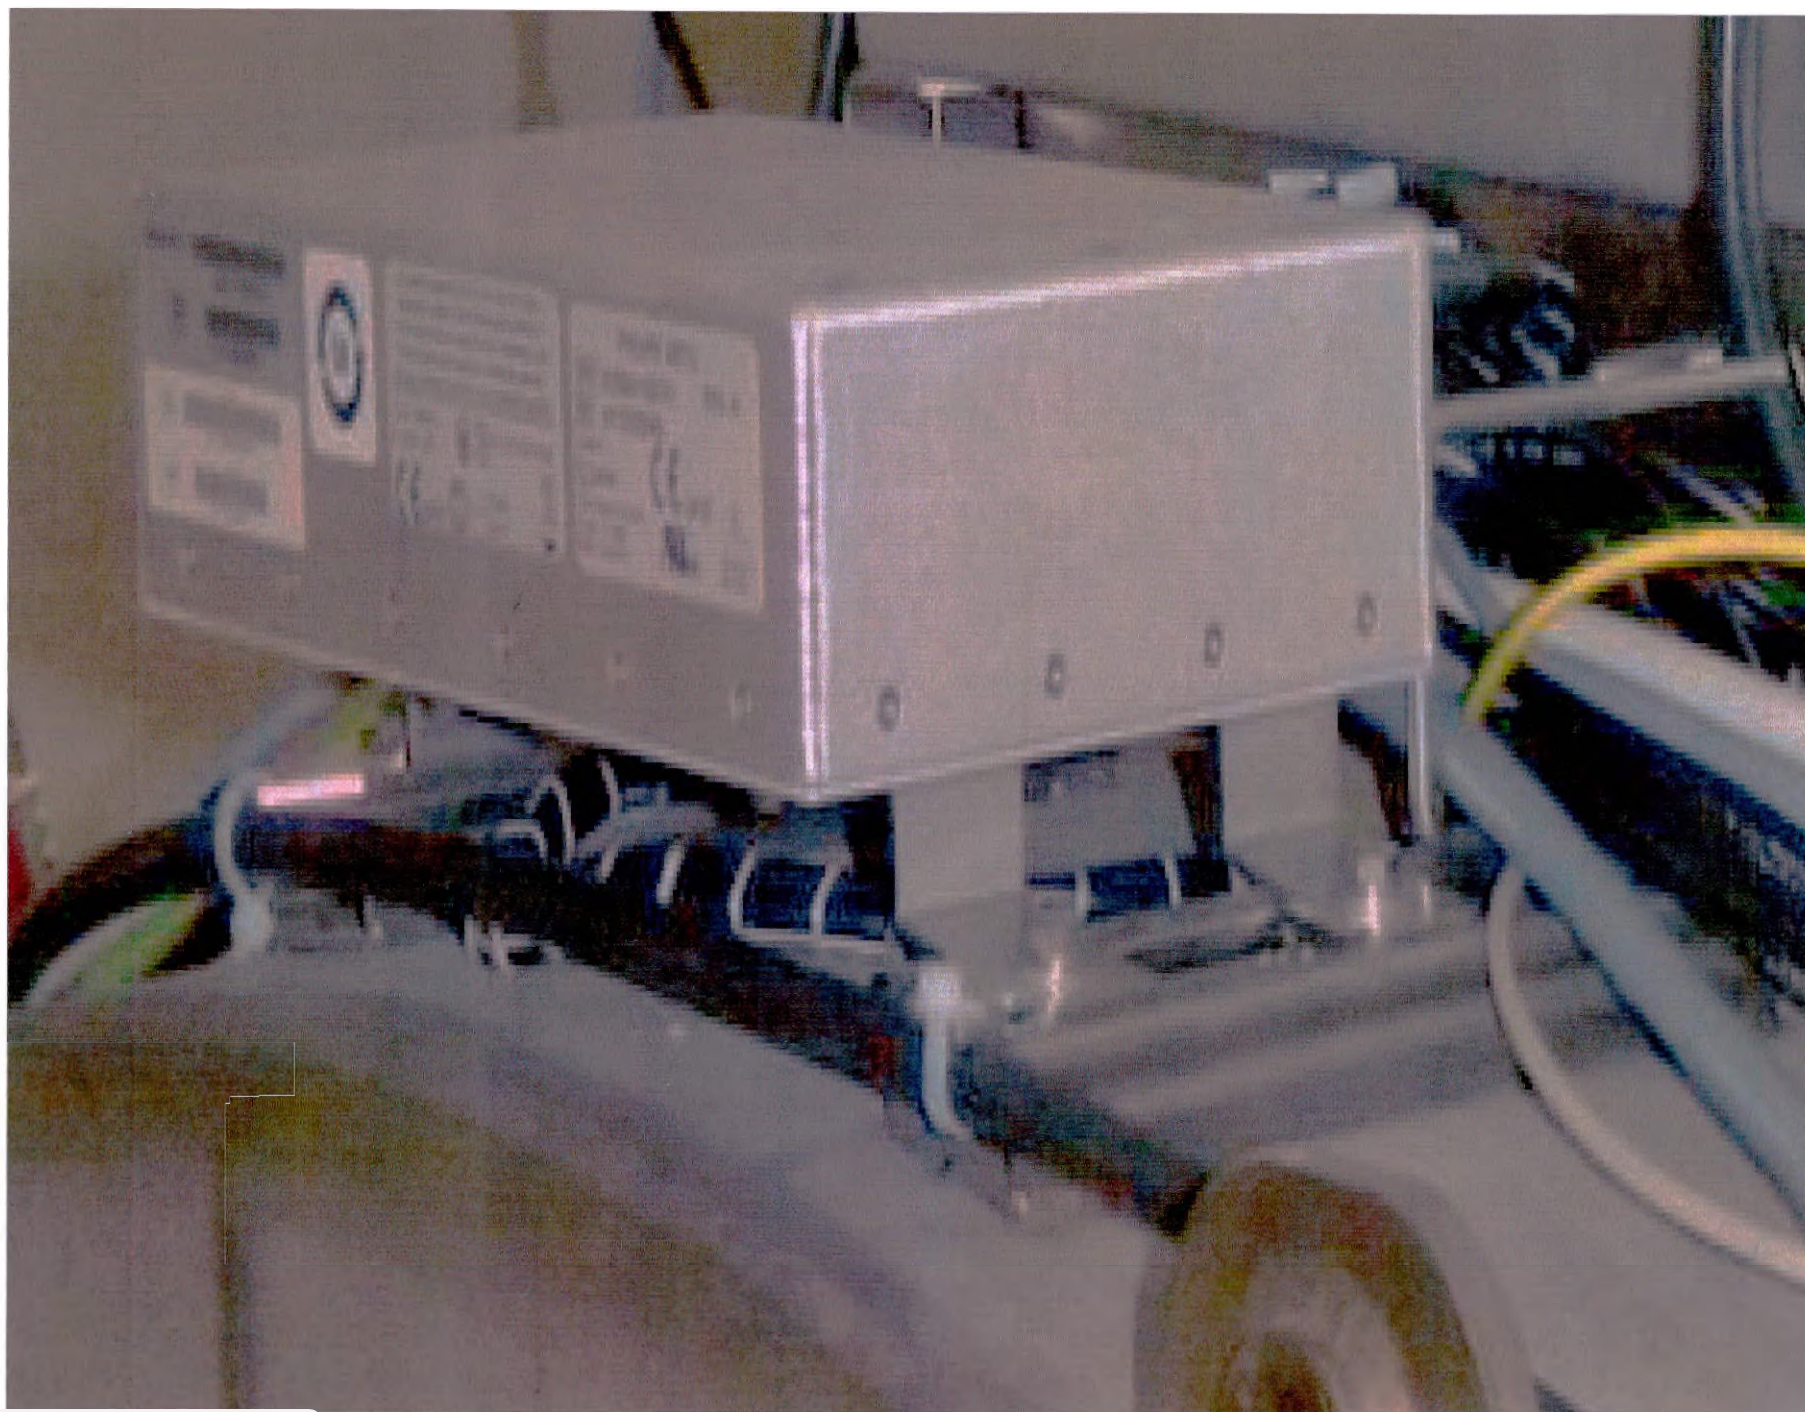




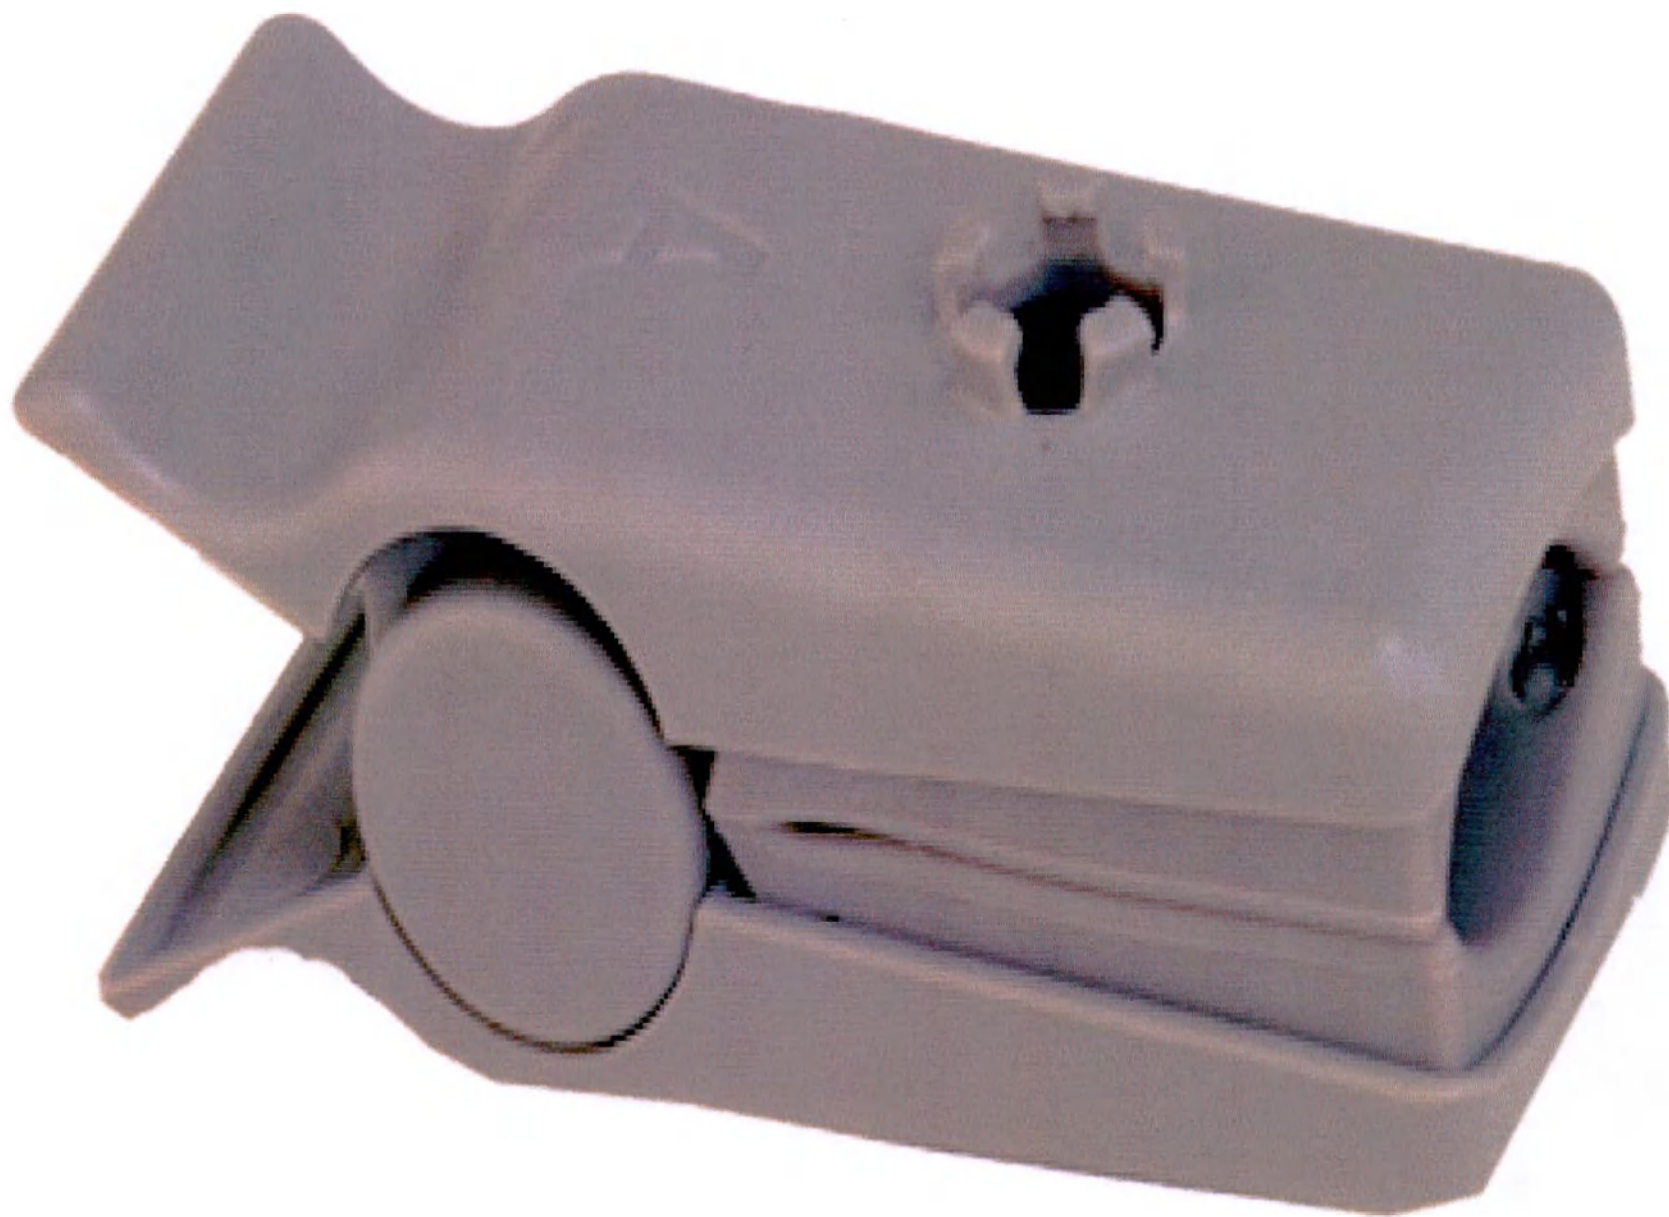


12.6. Многоразовые датчики SPO2 с охватывающим зажимом для взрослых.

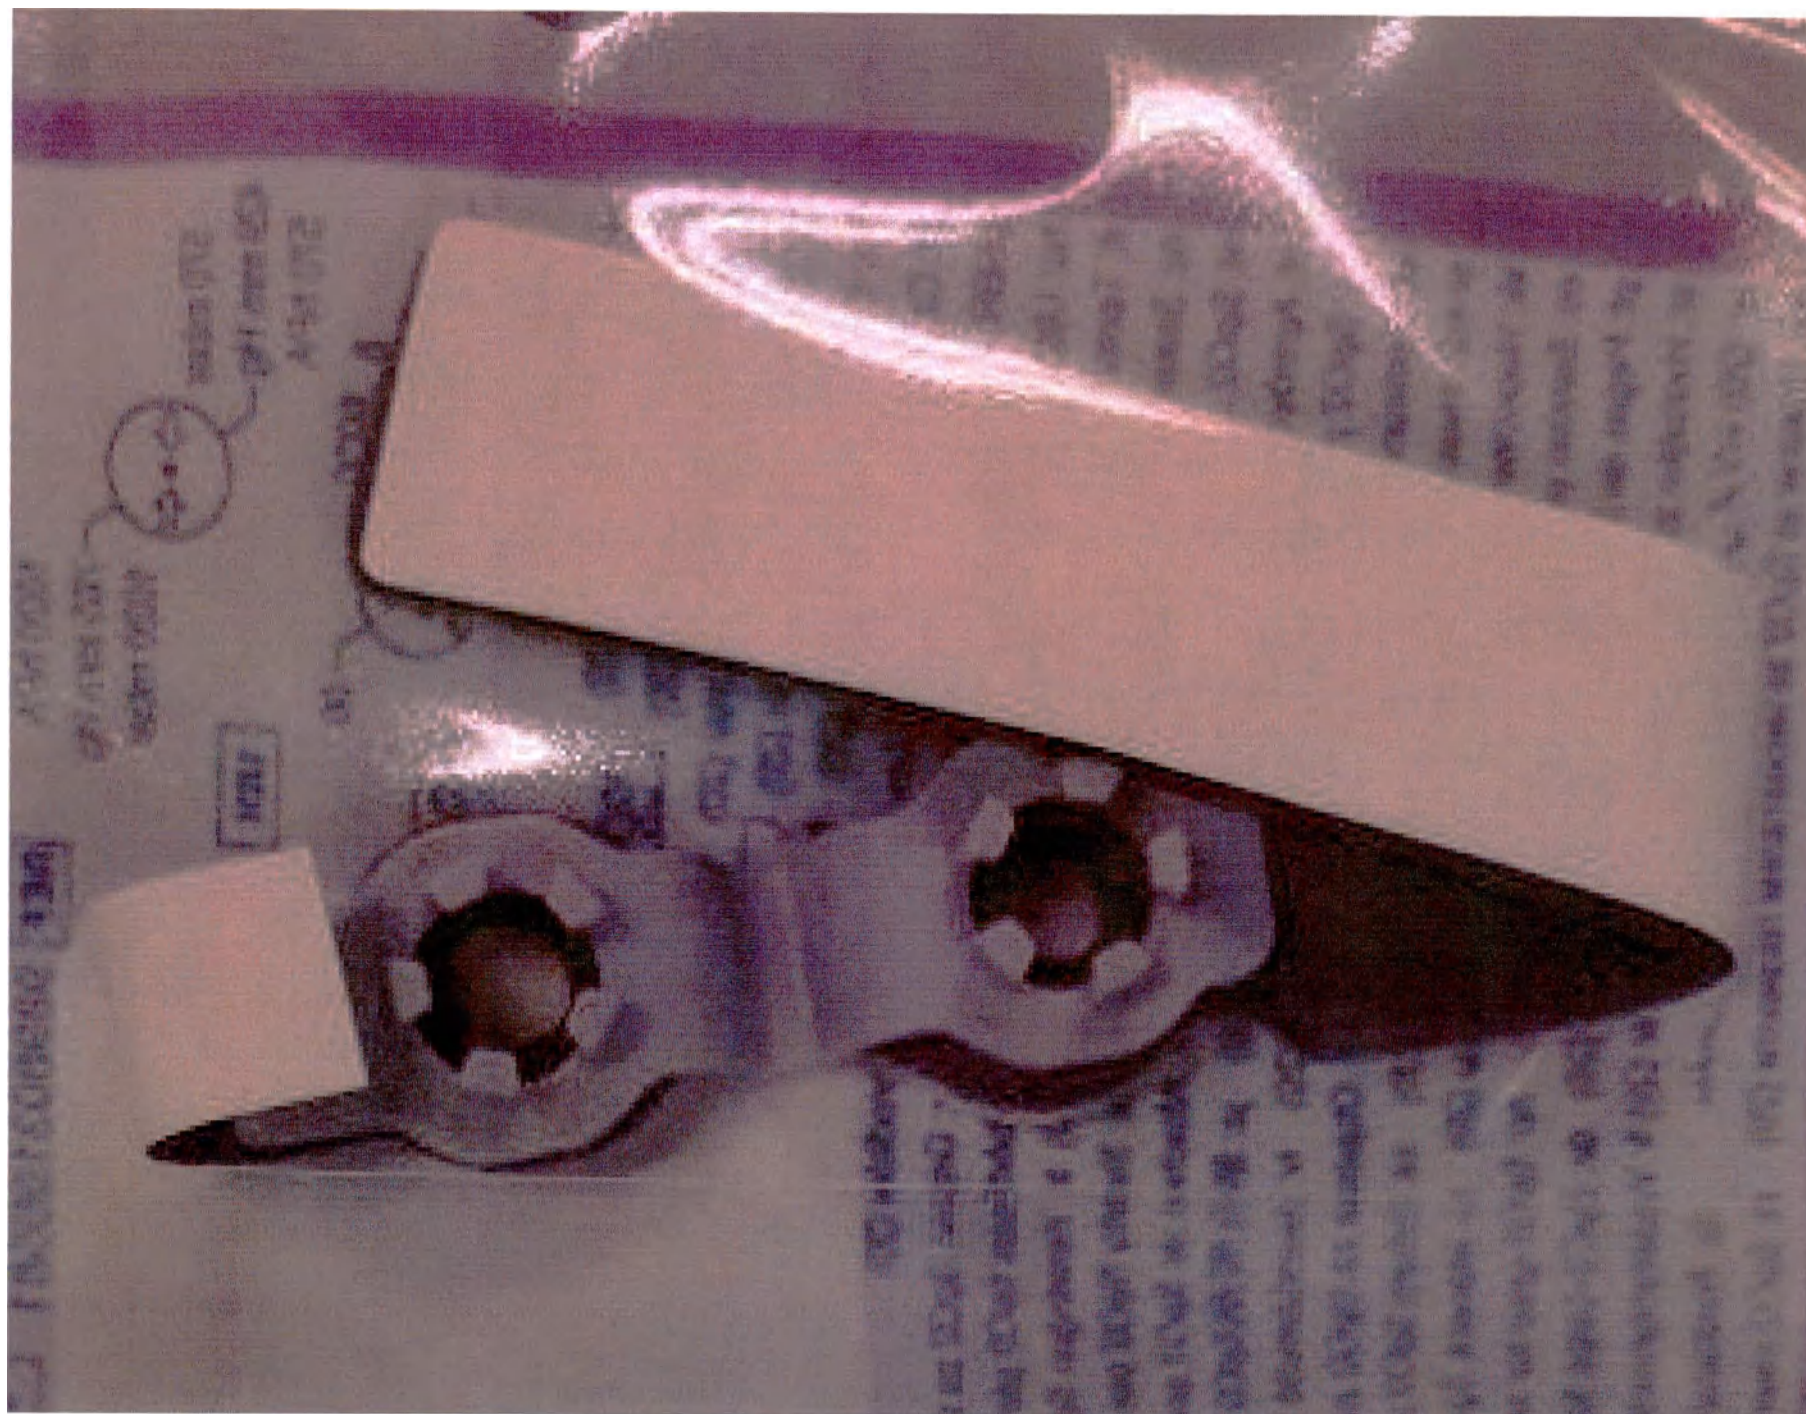


12.7. Одноразовые датчики SPO2 с охватывающим зажимом для новорожденных.

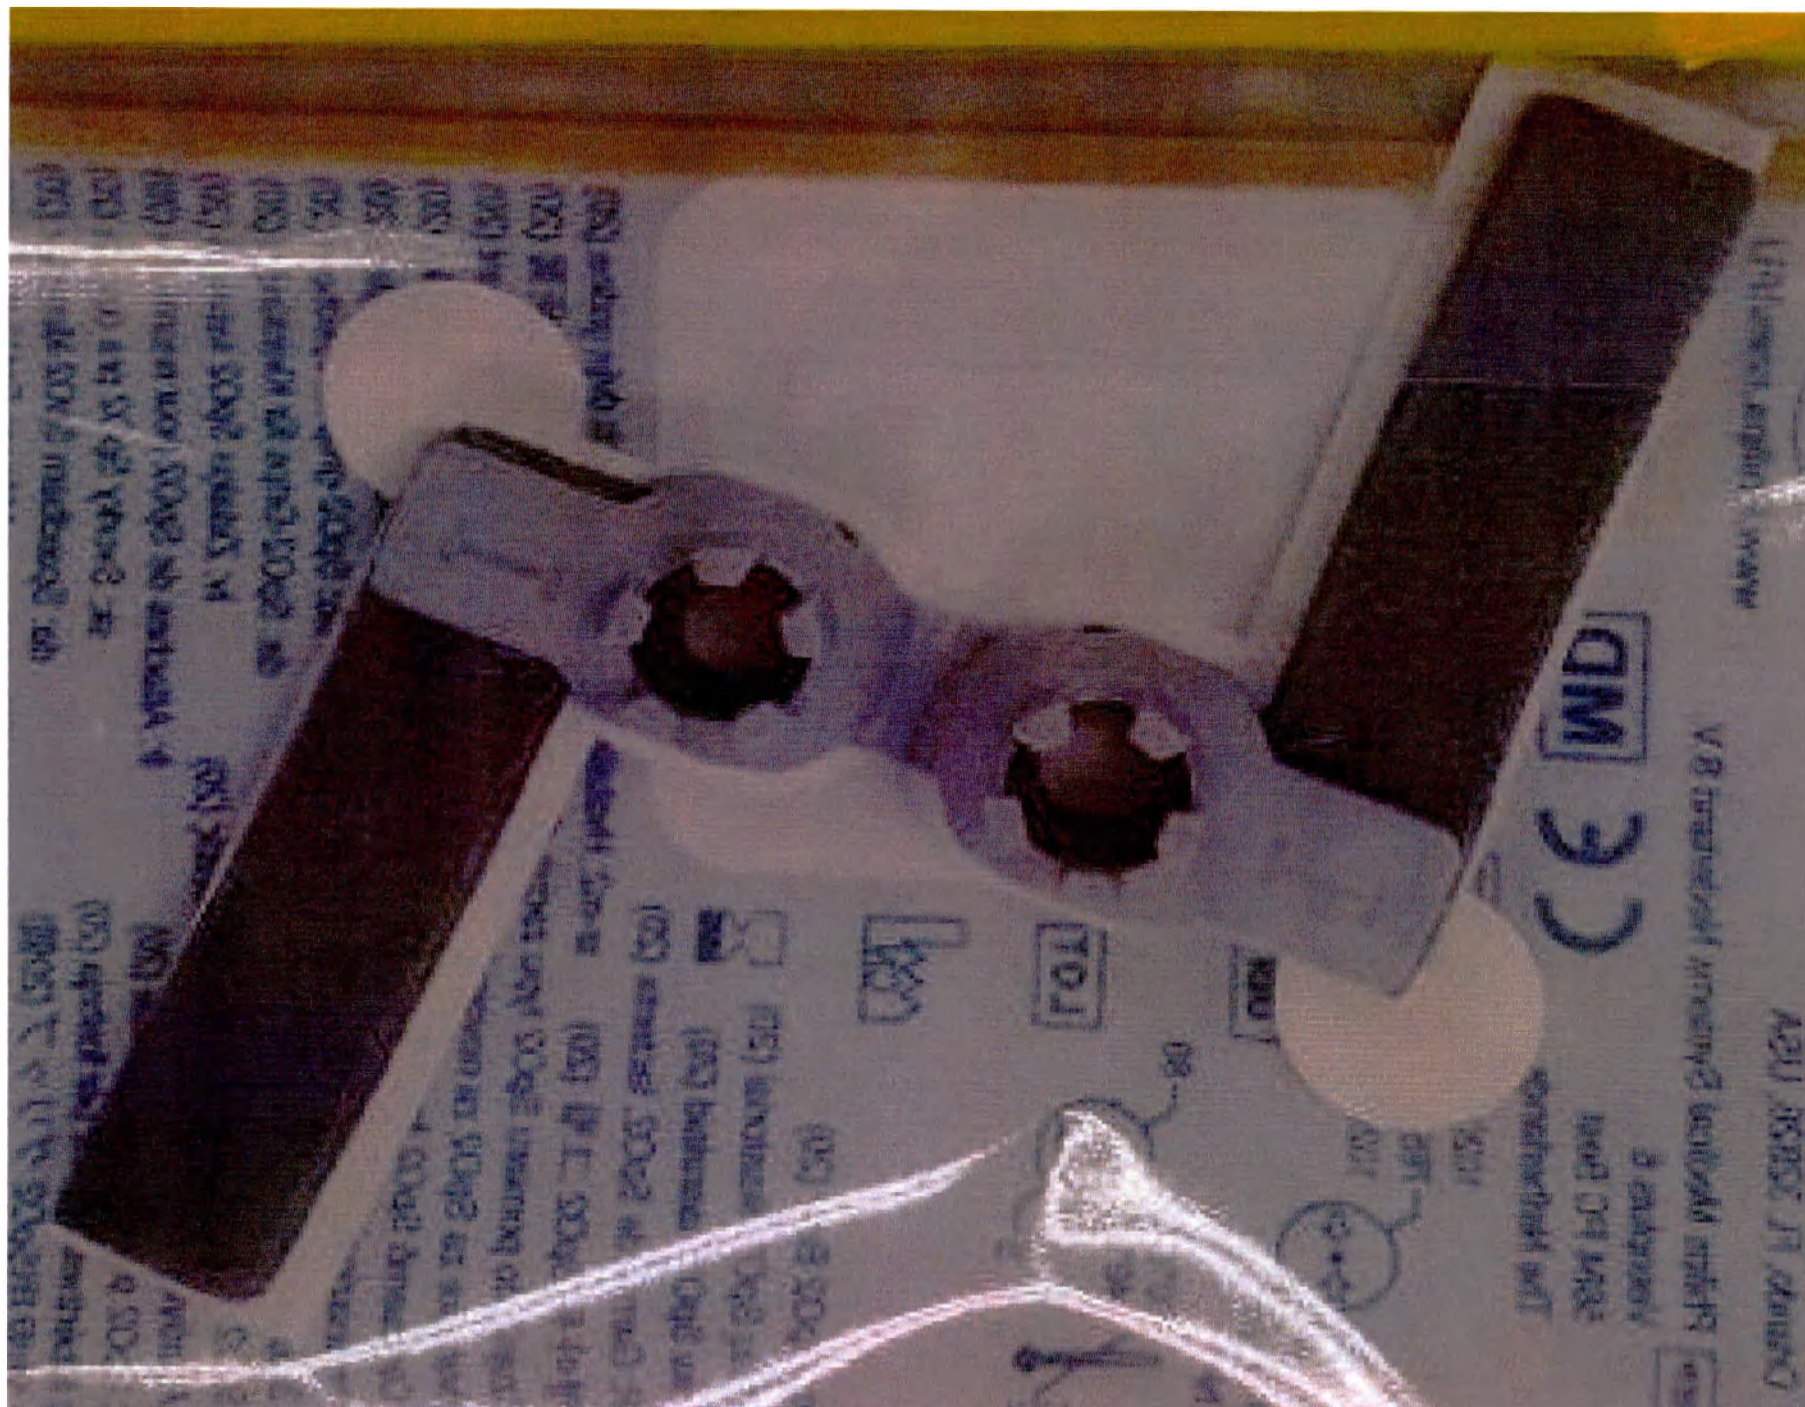



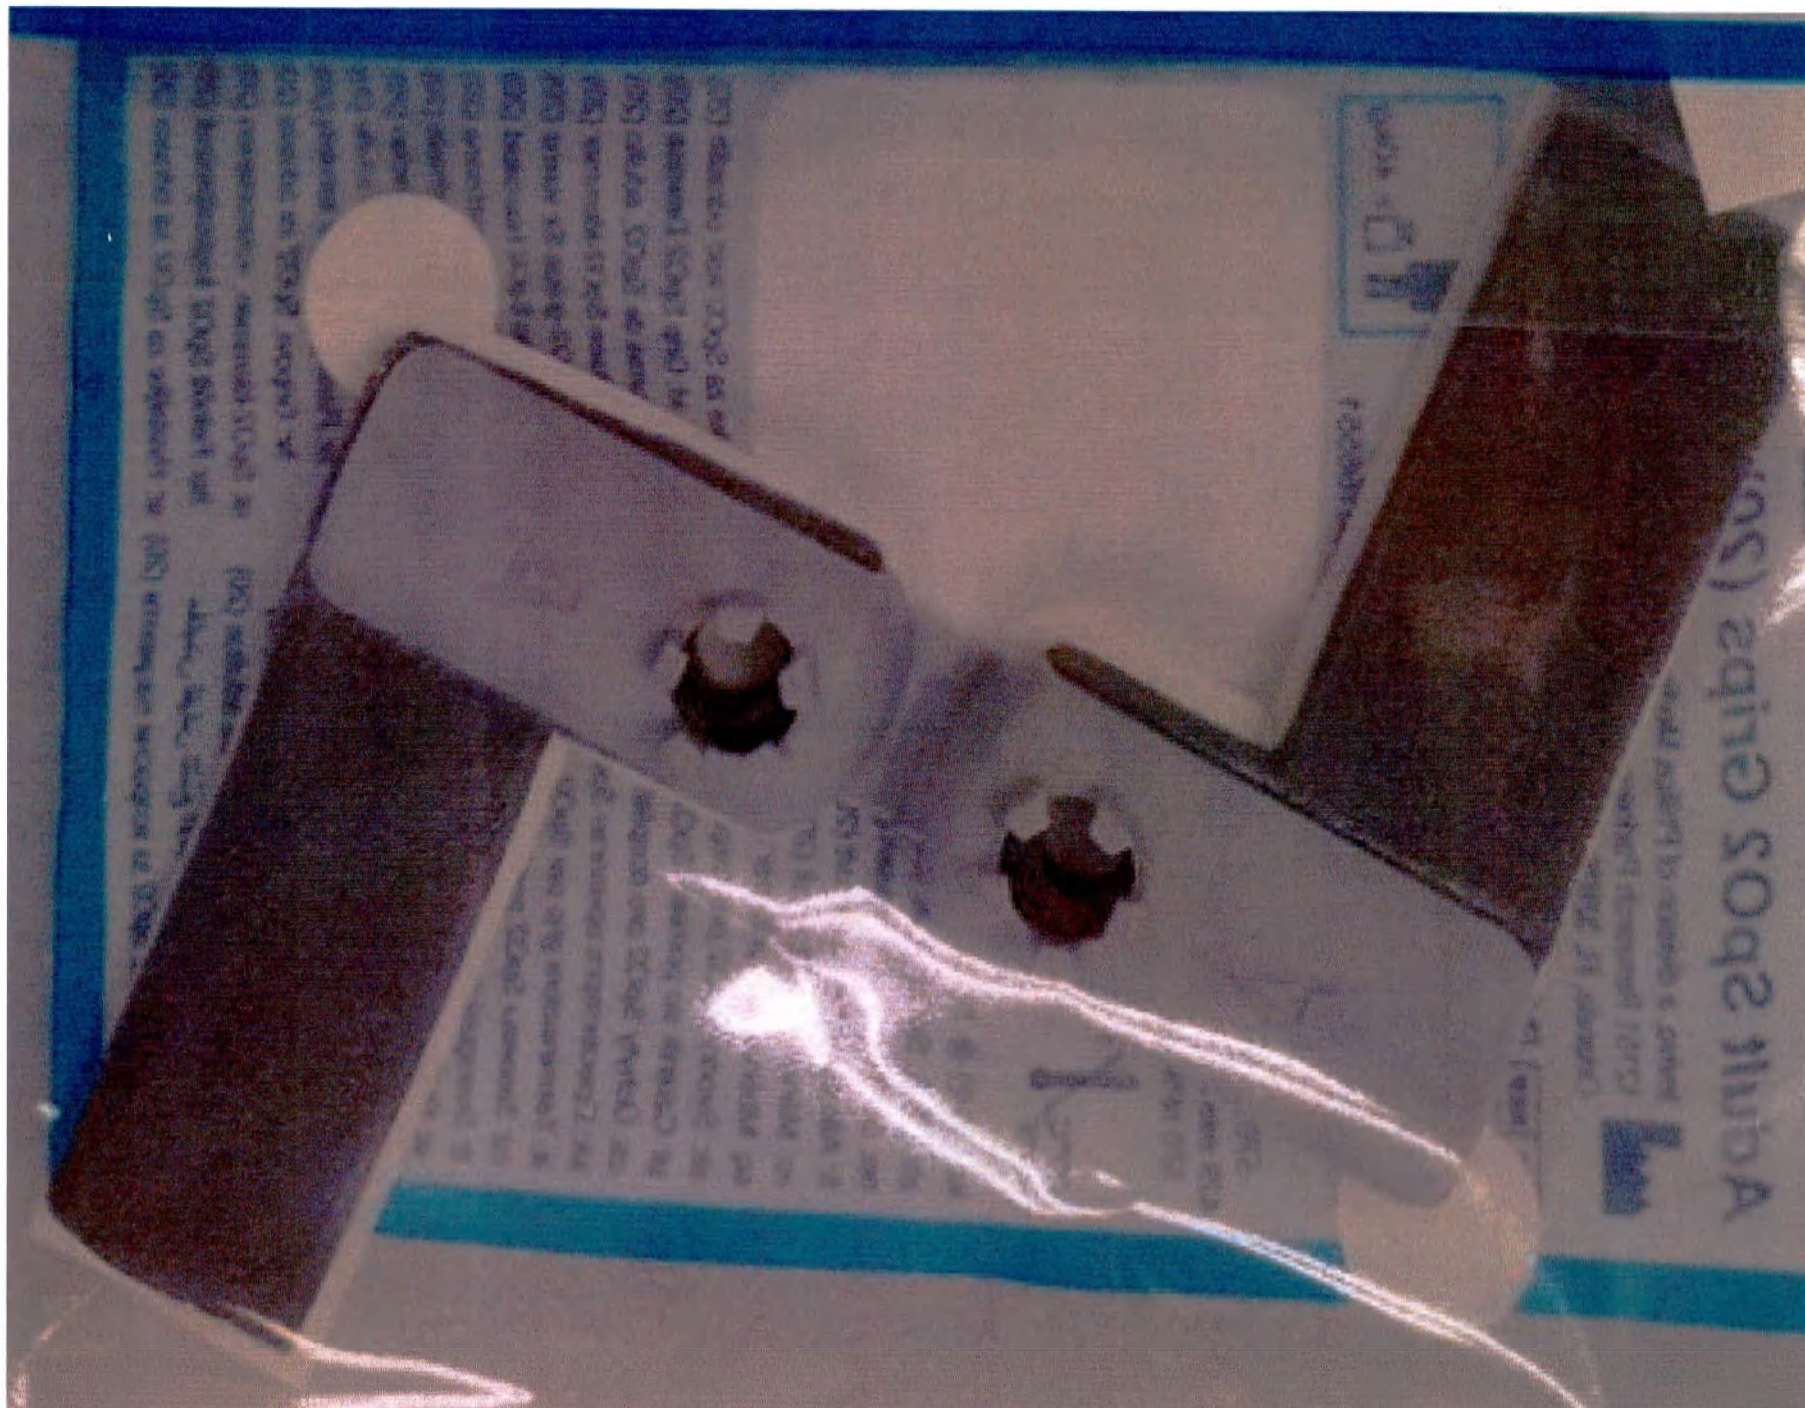





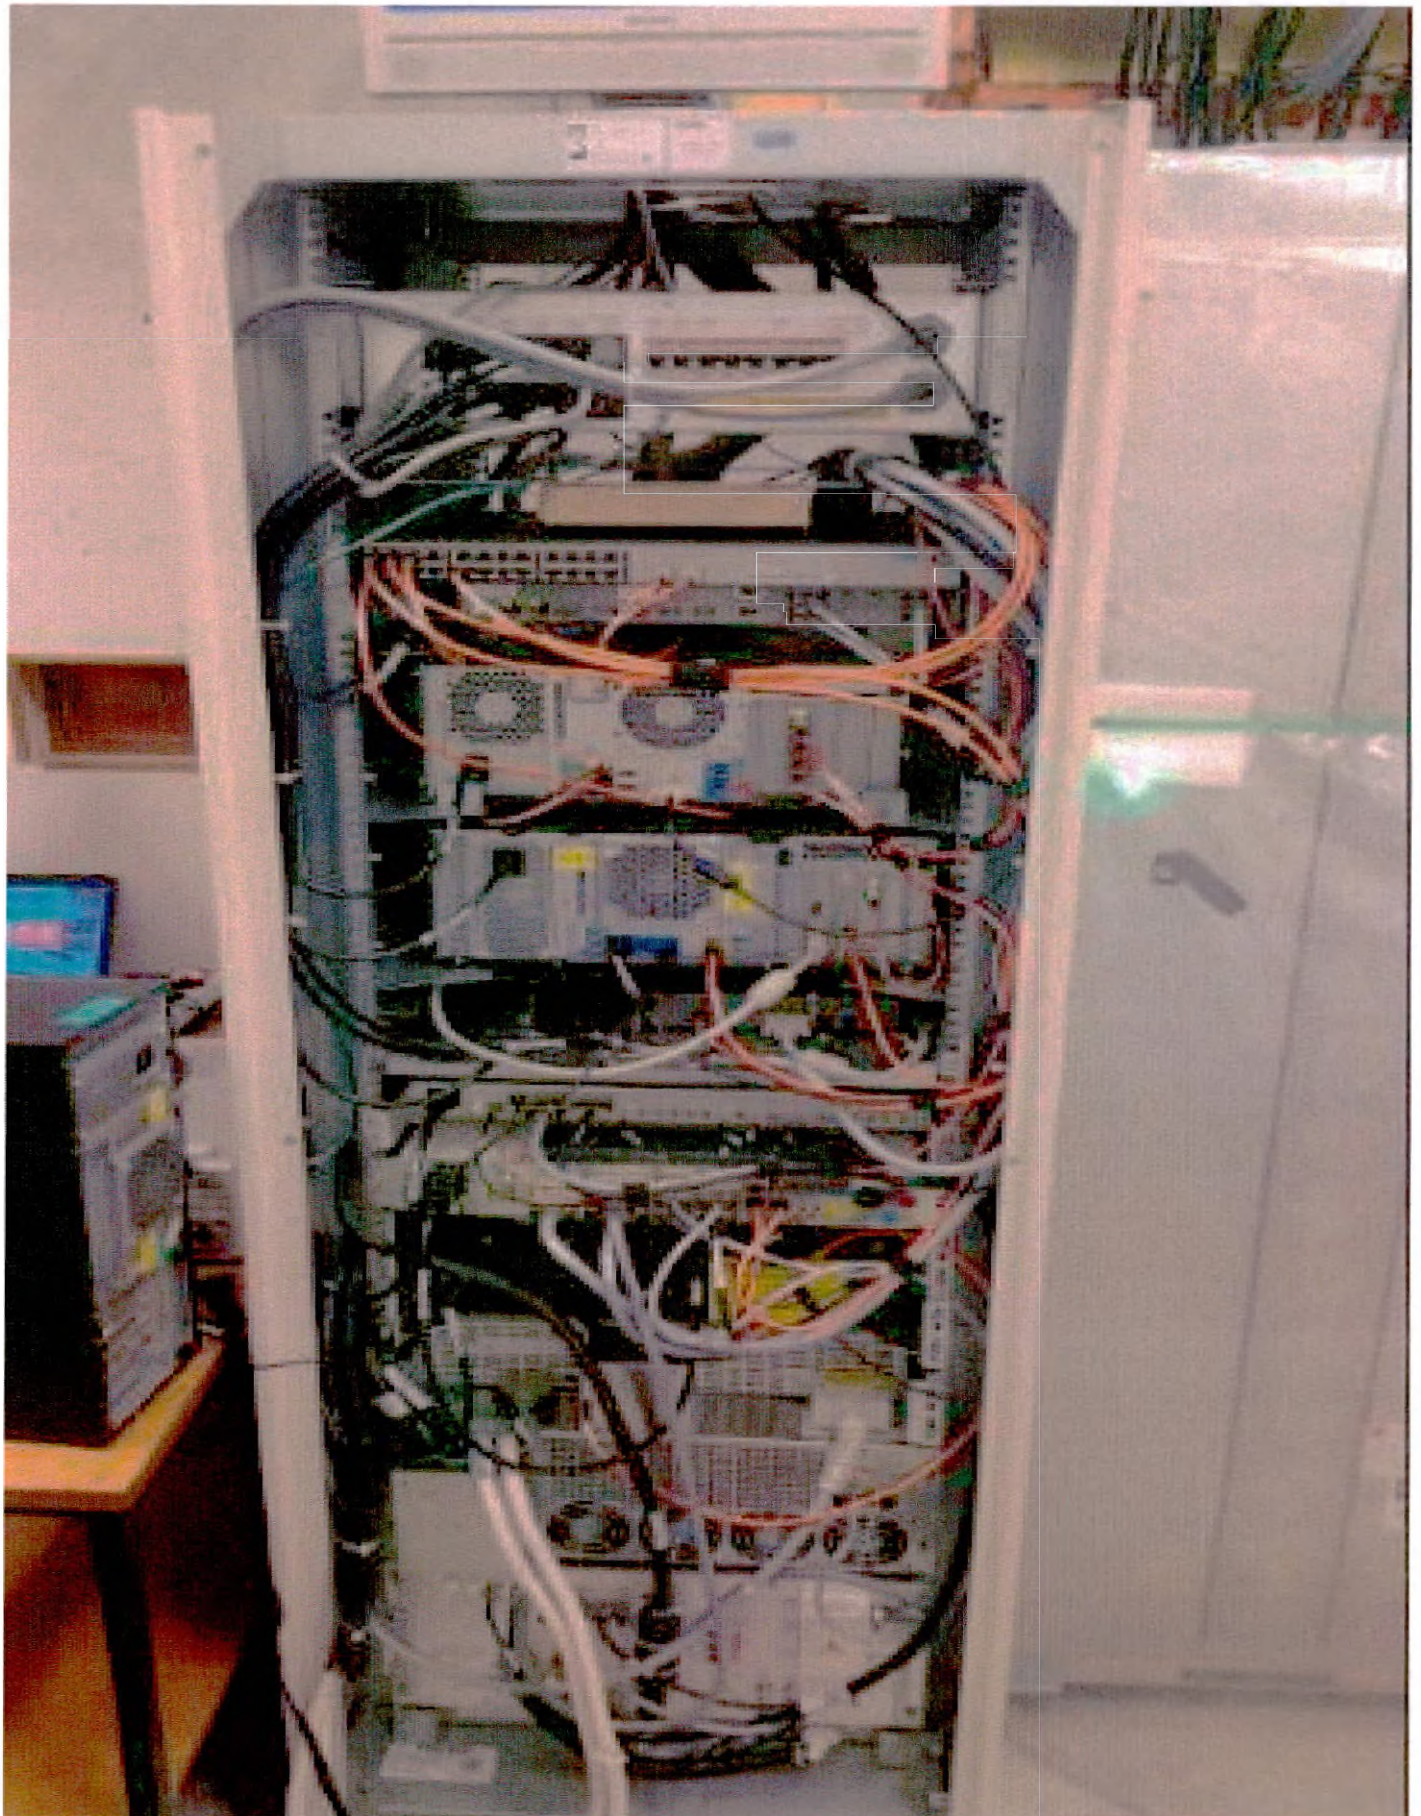


13. Система сбора и управления данными DACC.




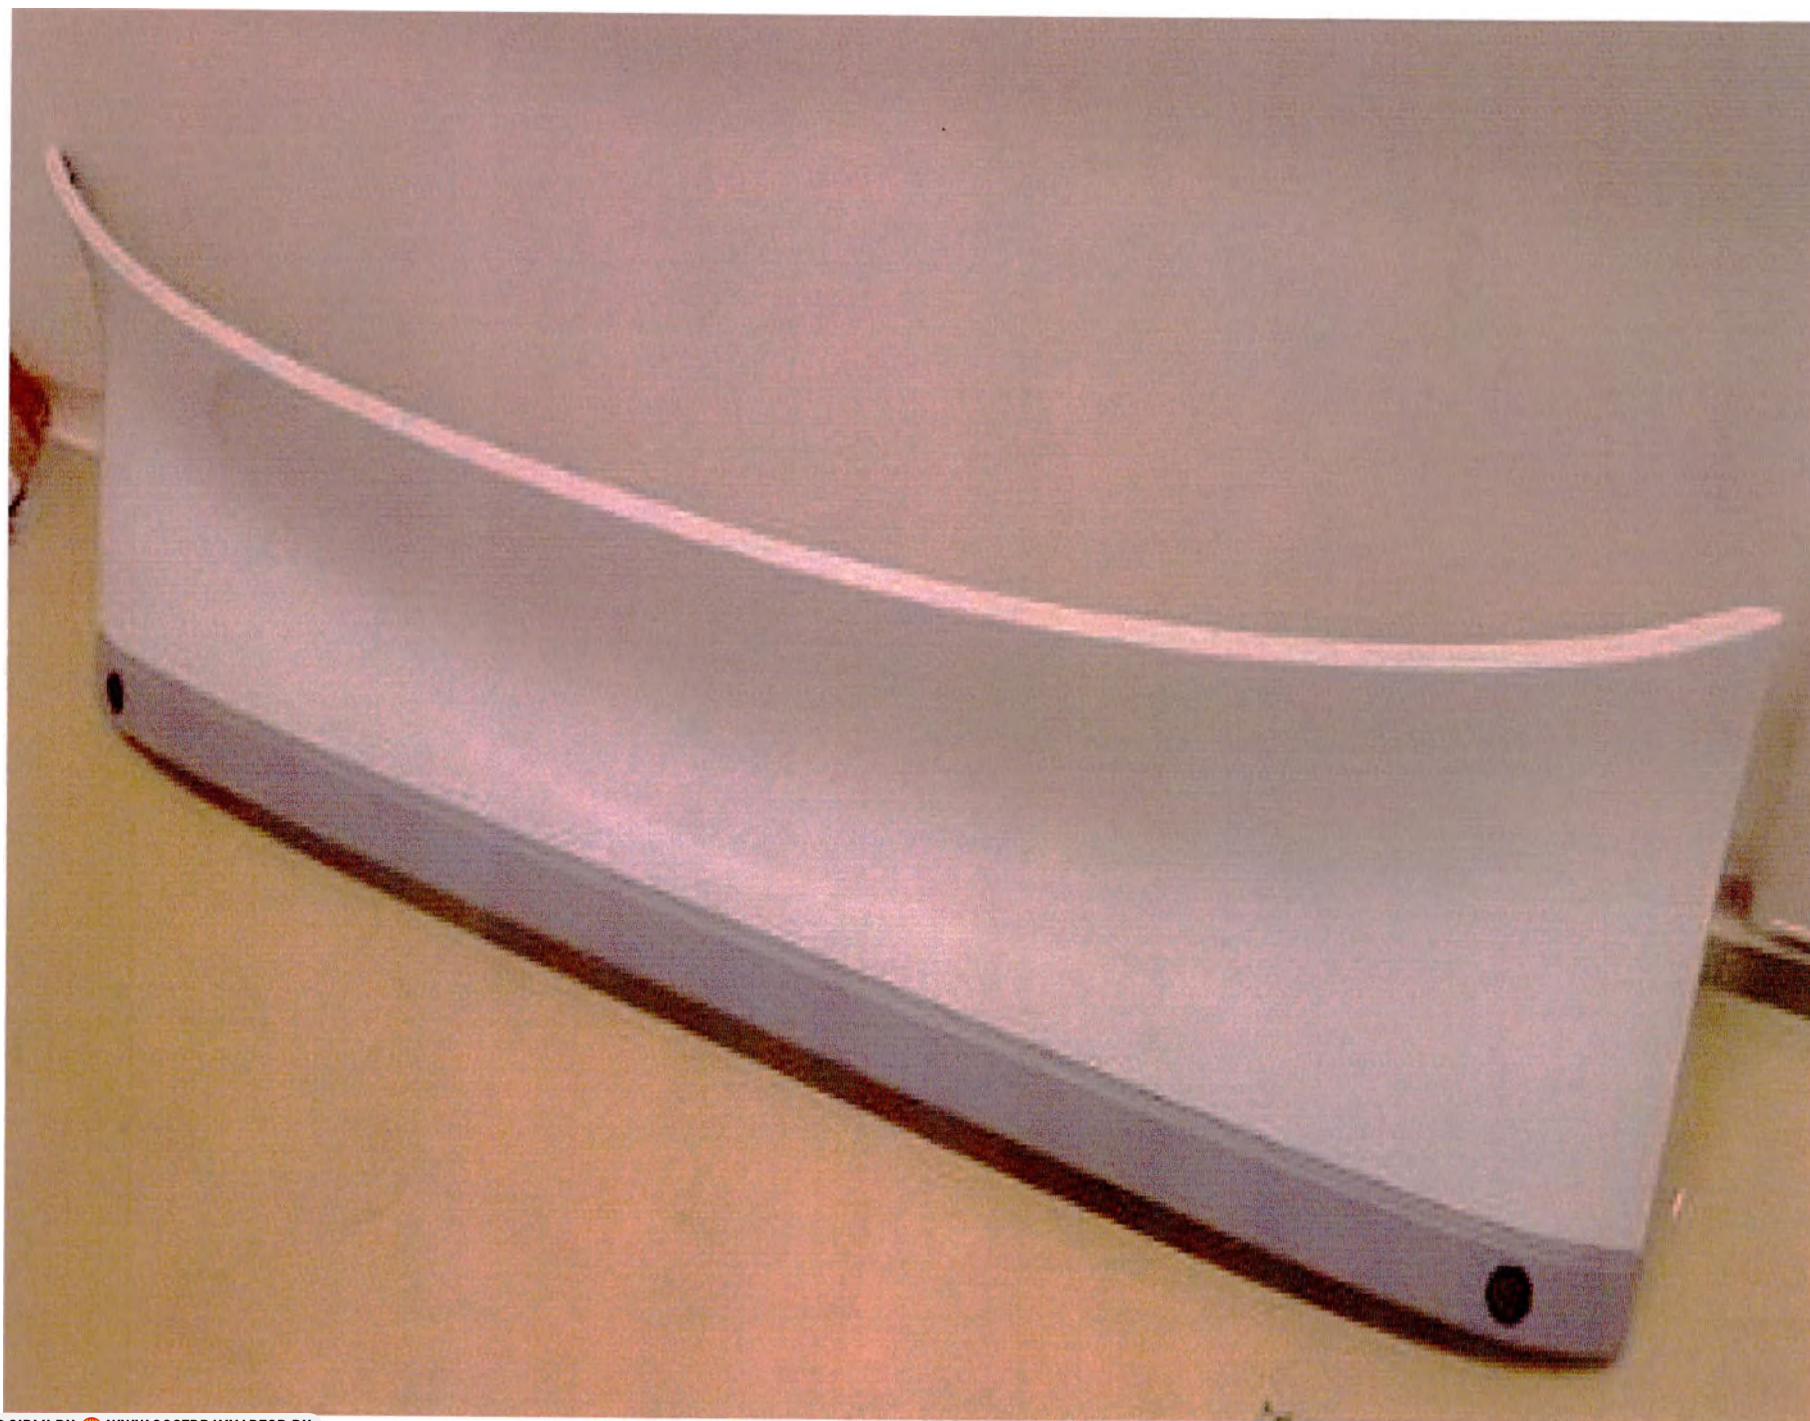

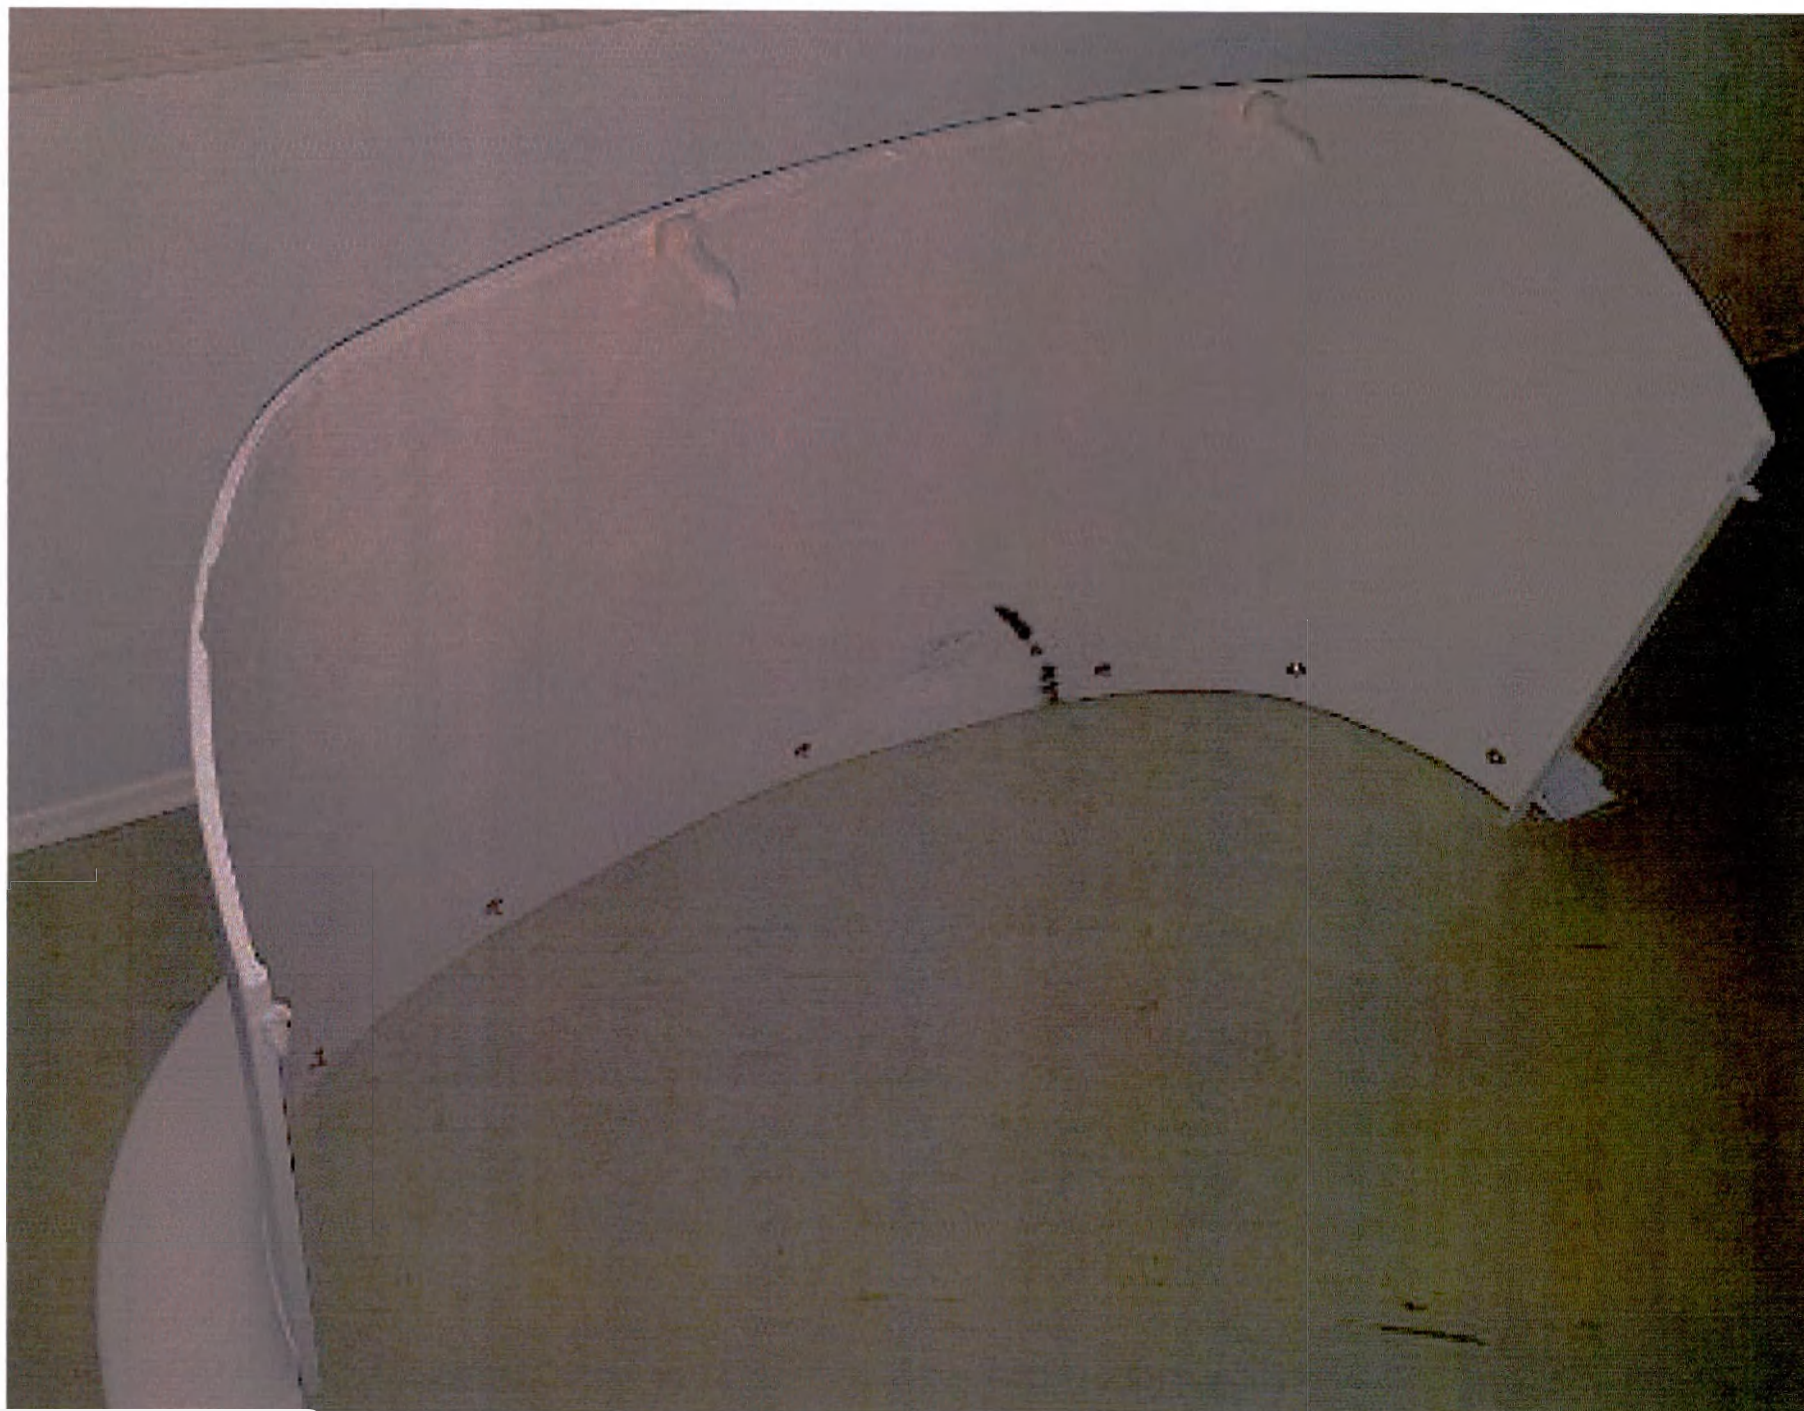

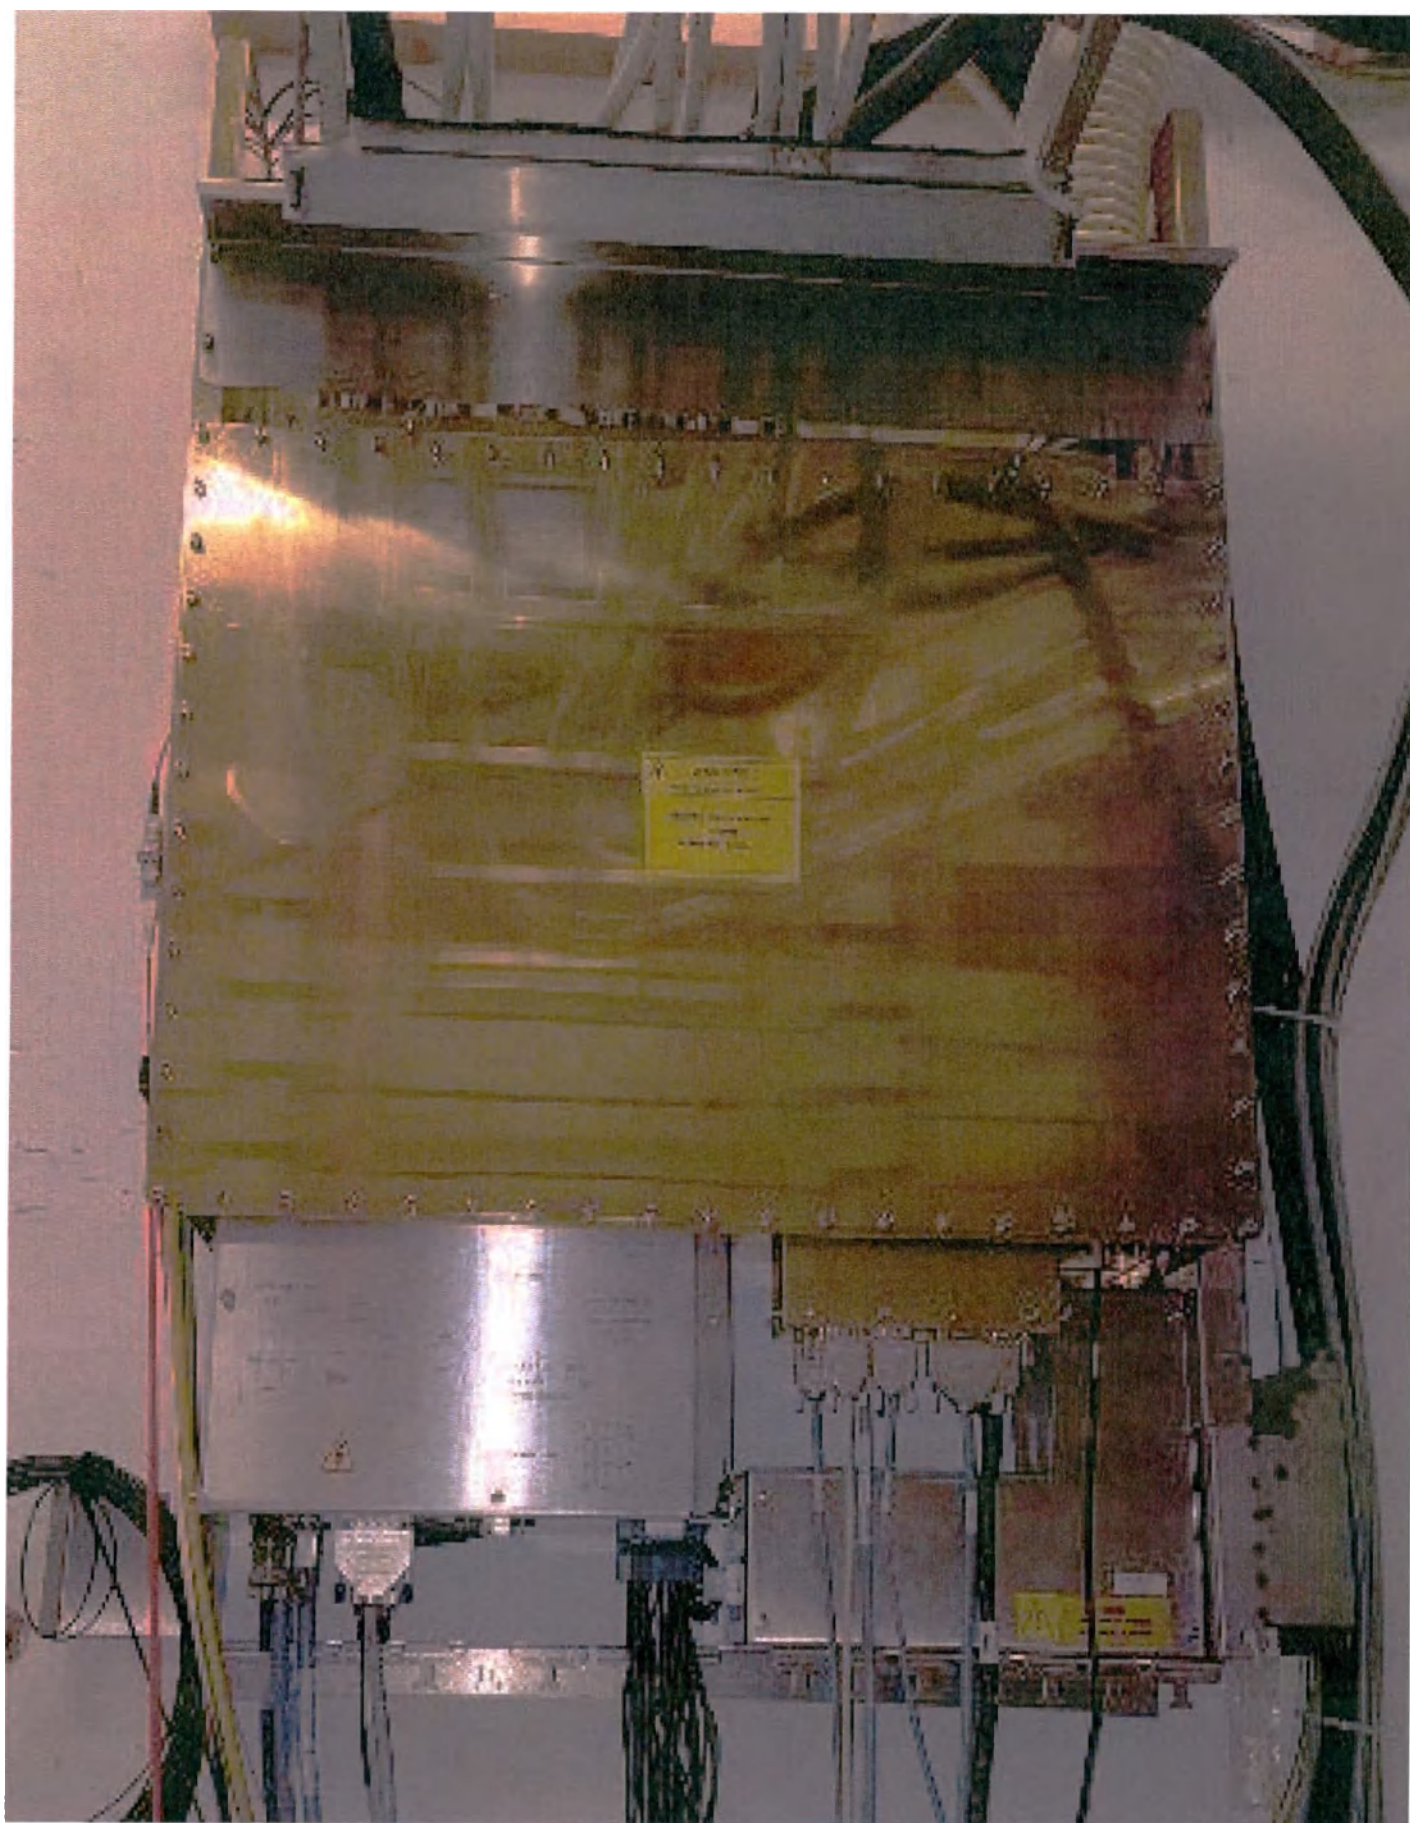

16. Системный фильтрующий блок.

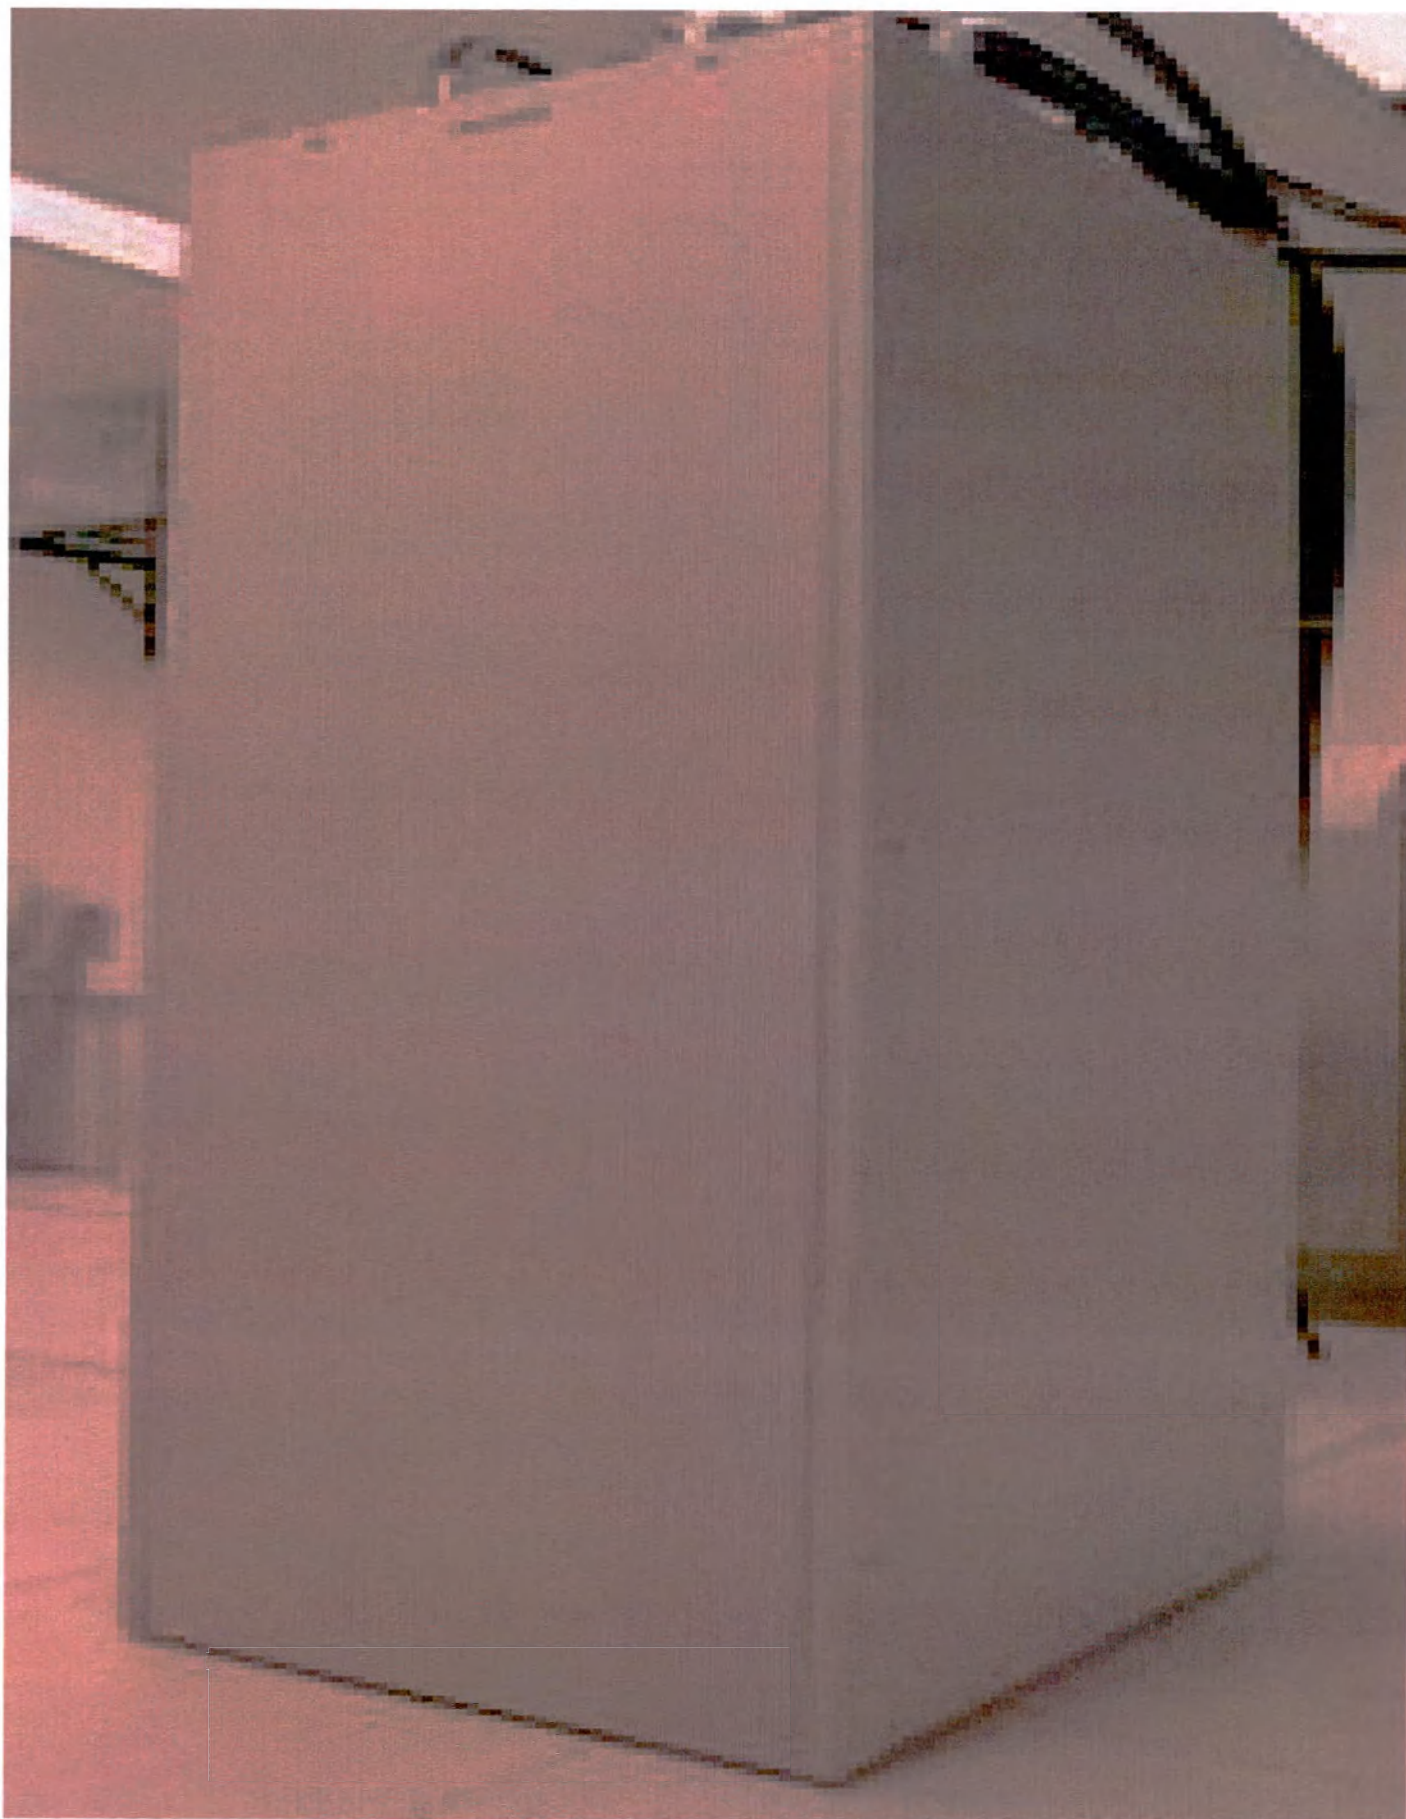


17. Система охлаждения. Вид 1.




17. Система охлаждения. Вид 2.



18. Низкотемпературный компрессор.

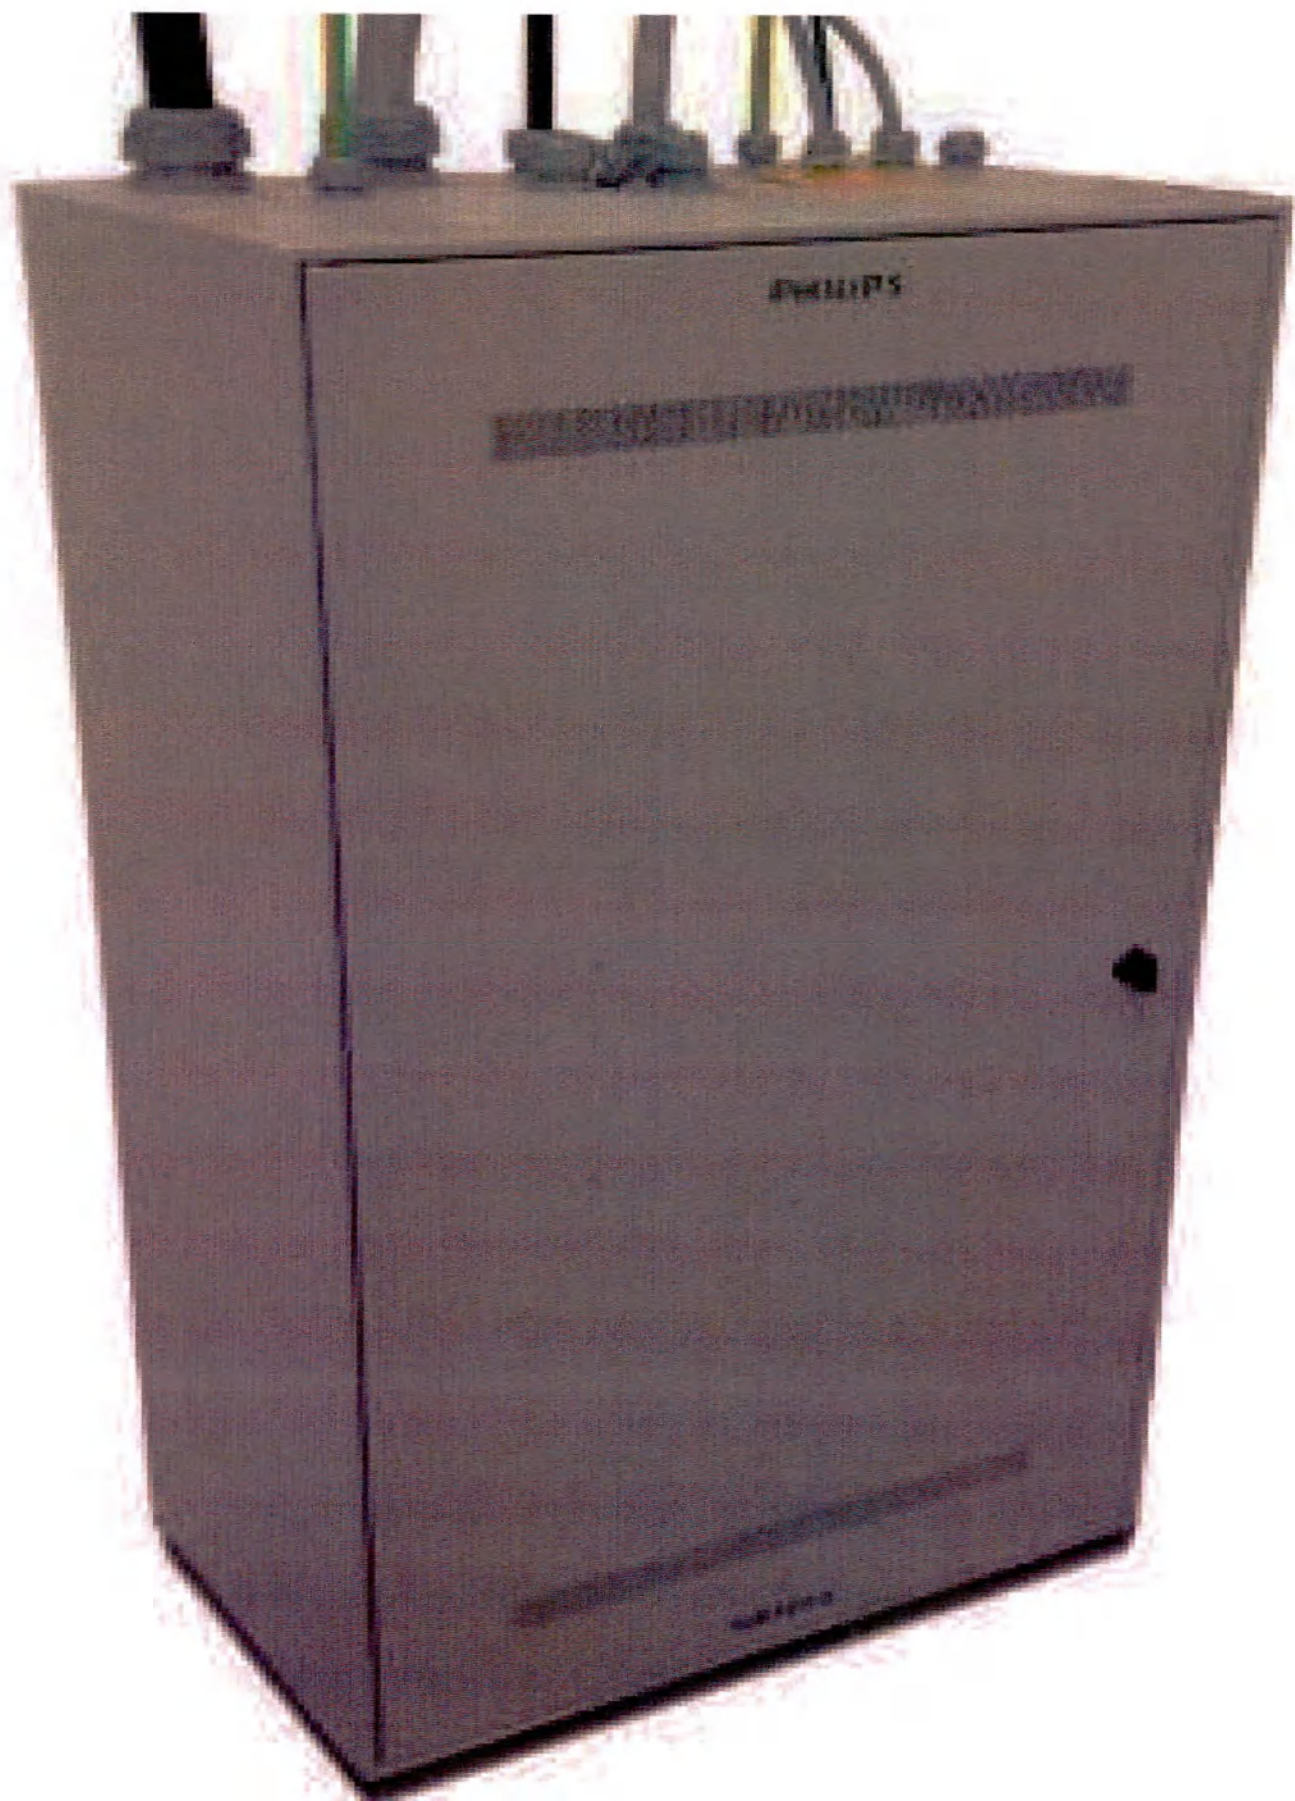

19. Универсальные электрораспределительные щиты uMDU. Вид снаружи.

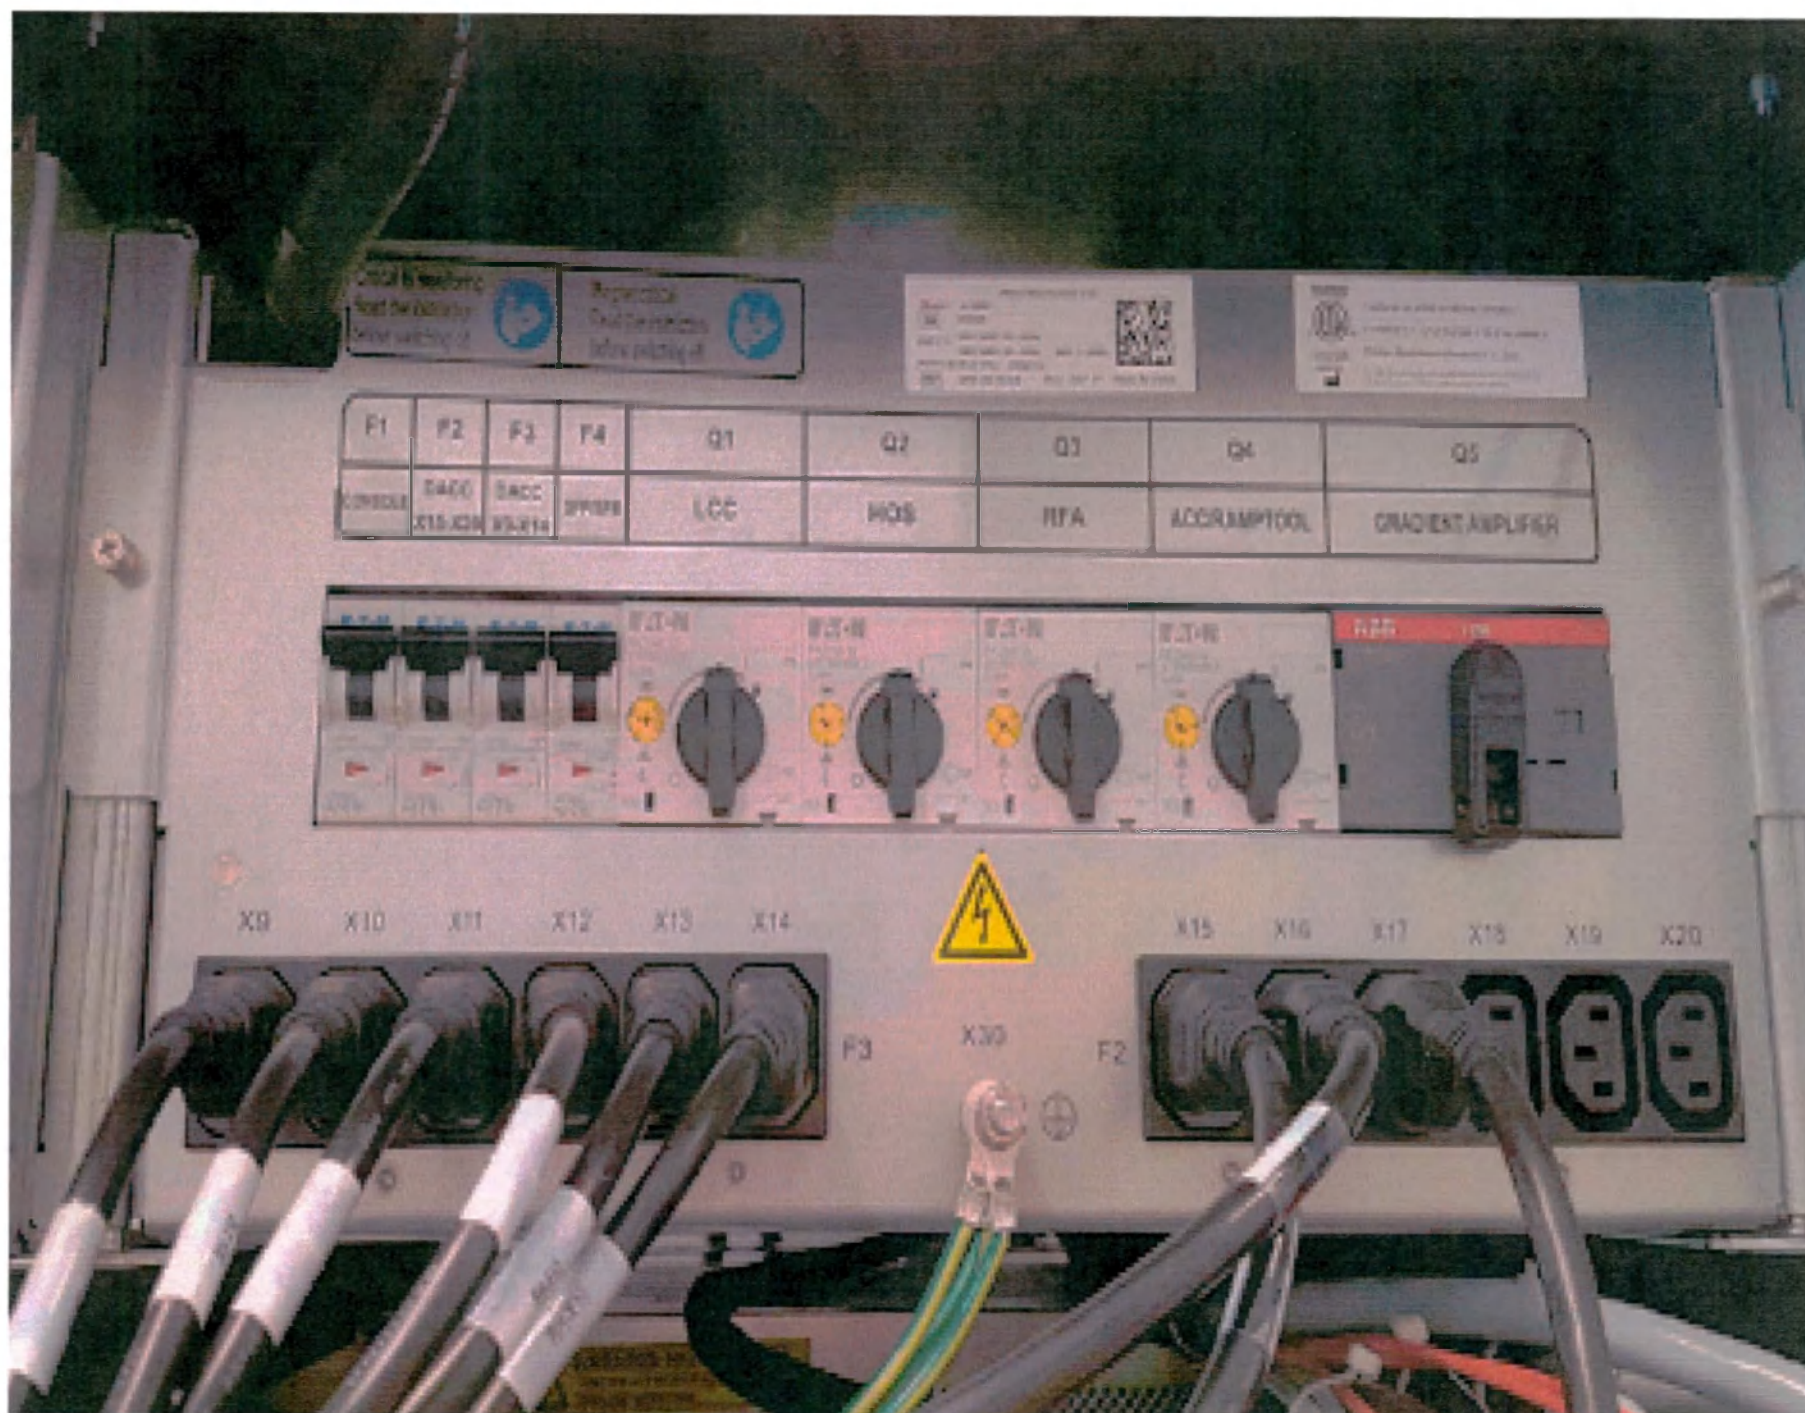



20. Источники бесперебойного питания.



21. Портативные металлодетекторы. Вариант 1.




21. Портативные металлодетекторы. Вариант 2.










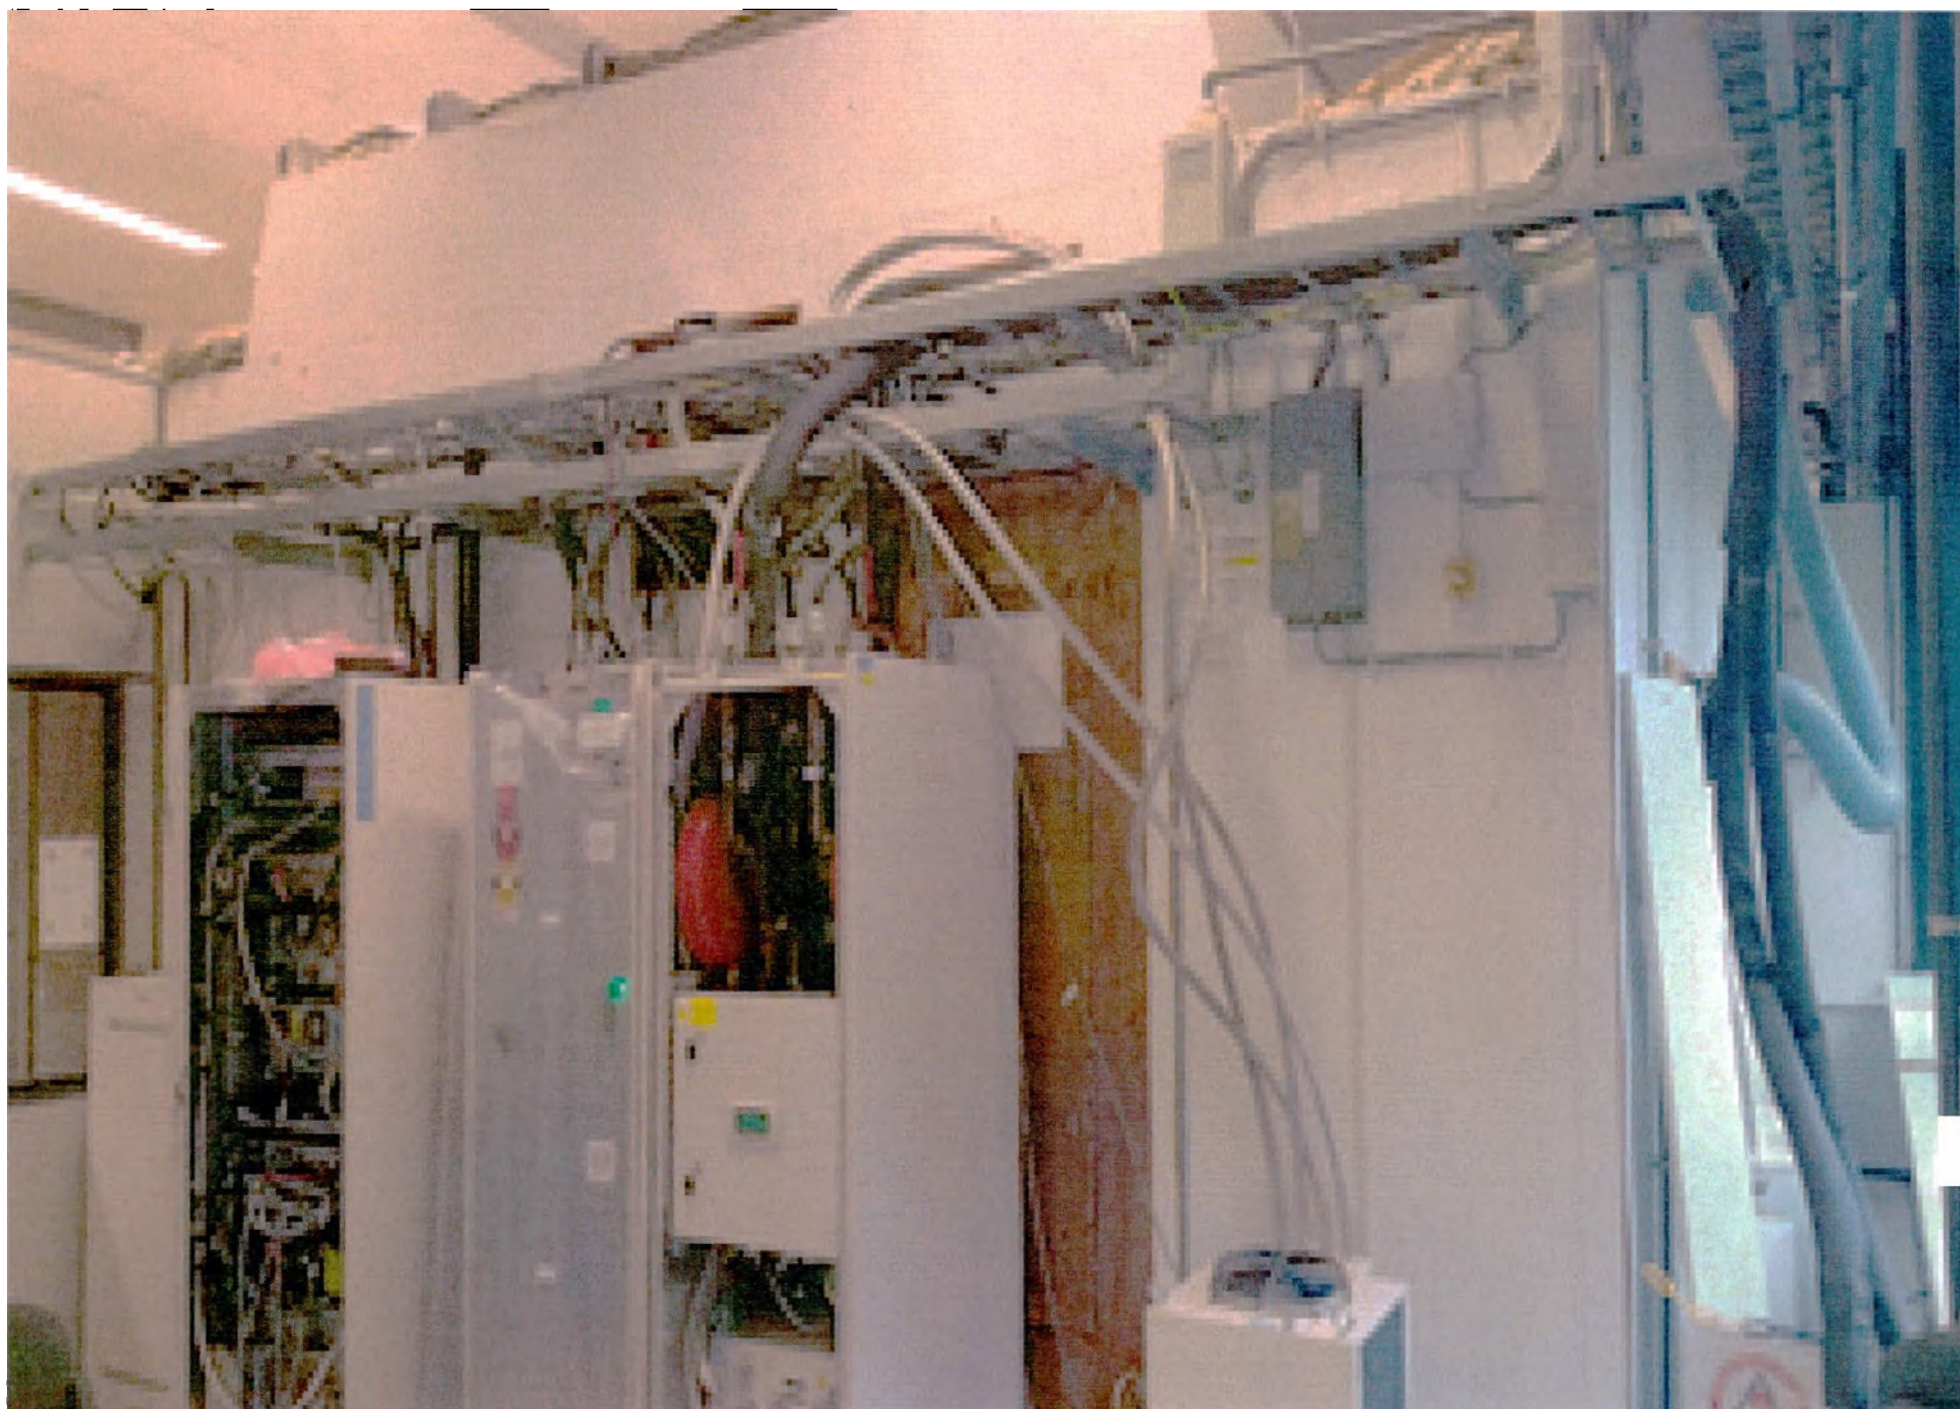

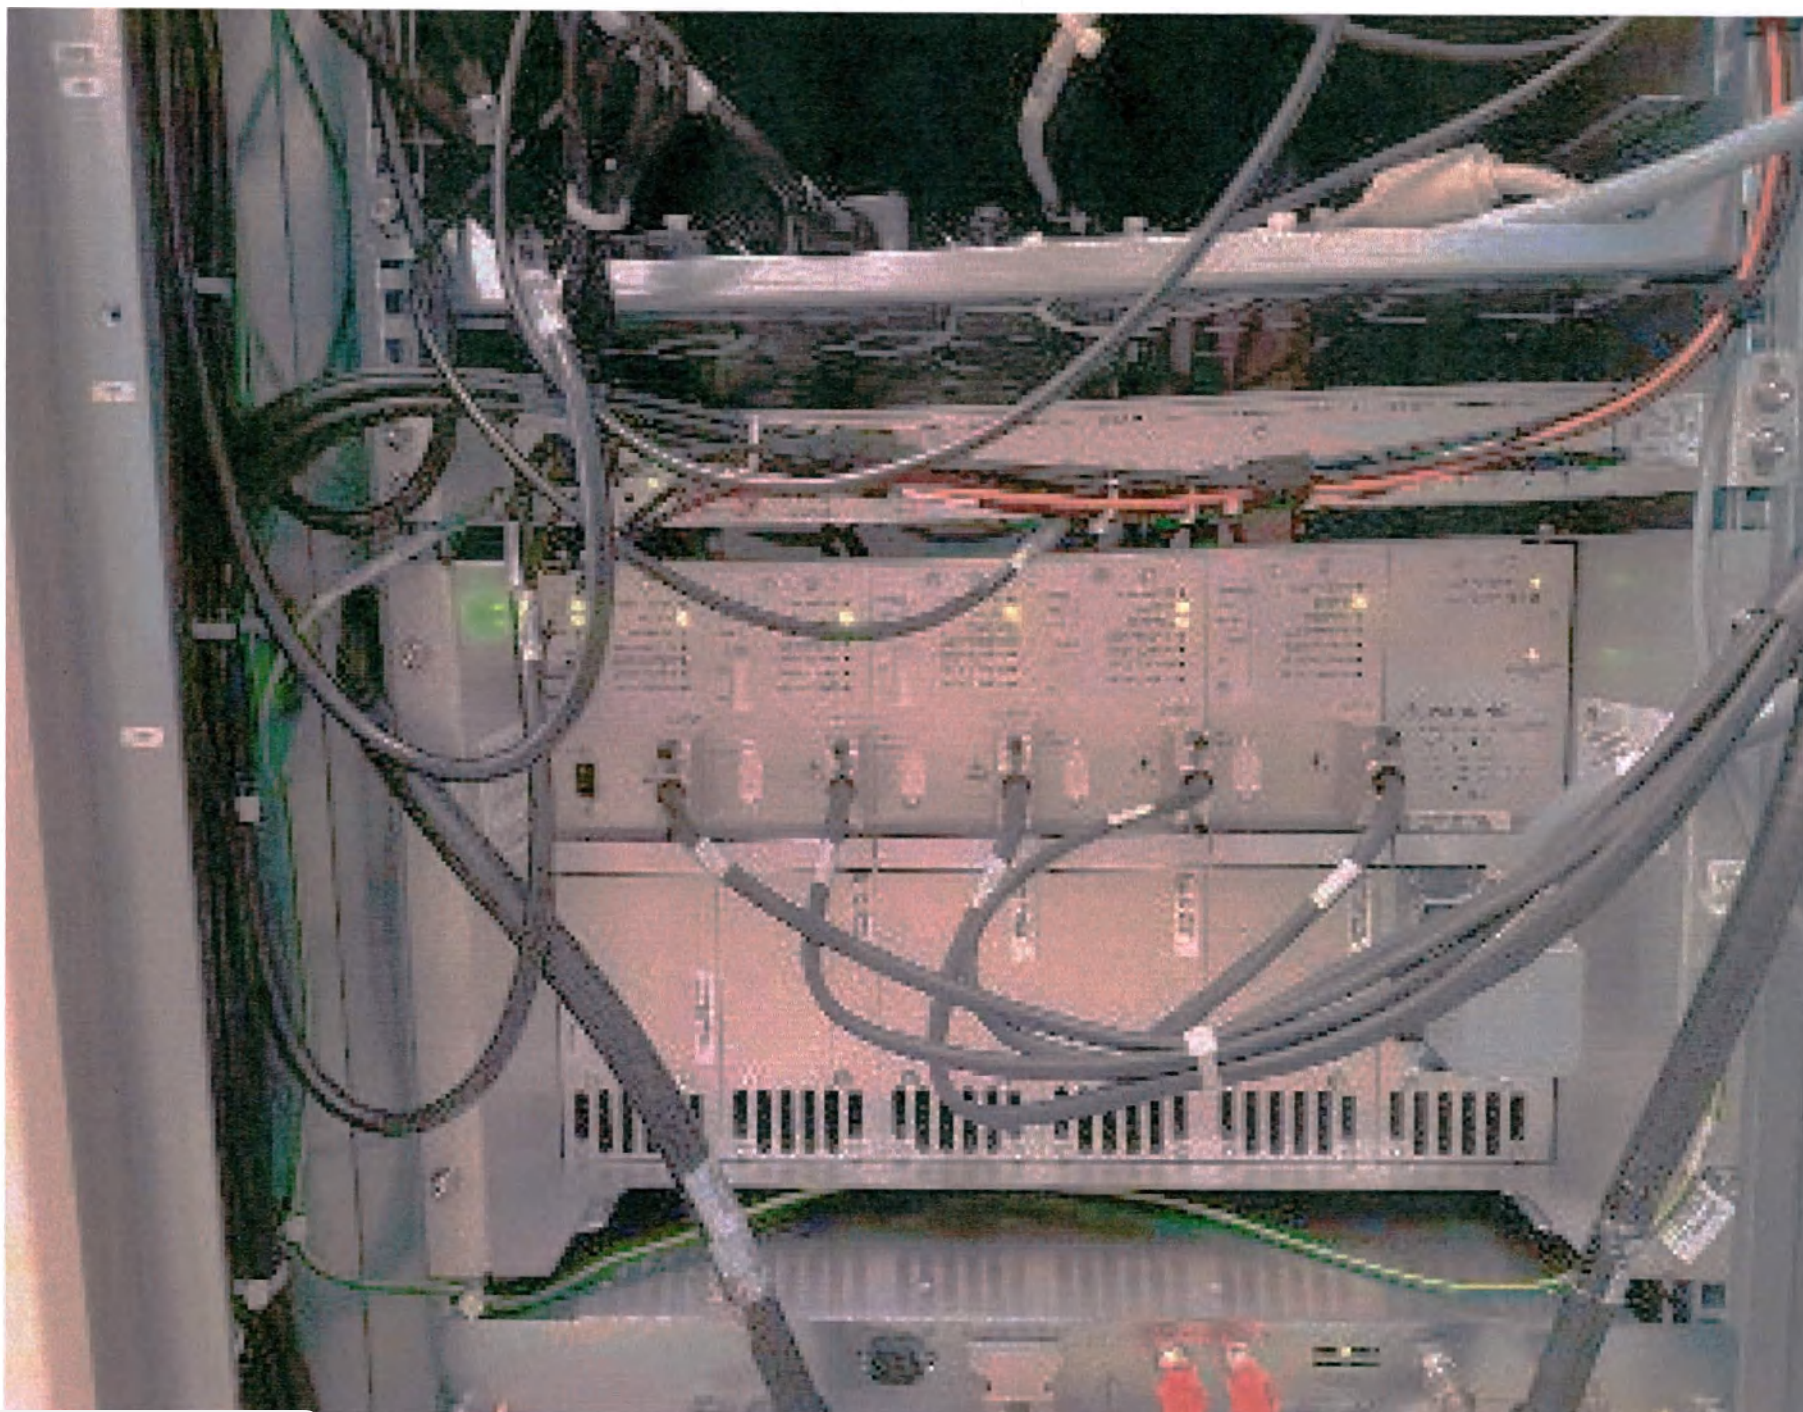



Руководство по
эксплуатации

Русский

Release 11.1

MR 5300

3000 091 83991

PHILIPS

28. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях.





English (United States)

IntelliSpace Portal

Image and Information Management Software
Version 12.1

LOT 12.1.2 REF 459801635933

Rx only

Quantity 1

© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. Copyrights and all other proprietary rights in any software and related documentation ("Software") made available to you rest exclusively with Philips or its licensors. No title or ownership in the Software is conferred to you. Use of the Software is subject to the end user license conditions as are available on request. To the maximum extent permitted by law, you shall not decompile and/or reverse engineer the software or any part thereof. Build: 12.1.2.11402



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



eIFU



2021-06-16

CE 0197

MD


UDI

(01)00884838093621
(11)210616 (10)12.1.2

30. Обеспечение программное медицинское IntelliSpace Portal для просмотра, анализа, обработки, приема и передачи медицинских изображений на

000 ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU сителях с принадлежностями, производства «Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.», Нидерланды, РУ № РЗН 2018/6795.

Принадлежности:

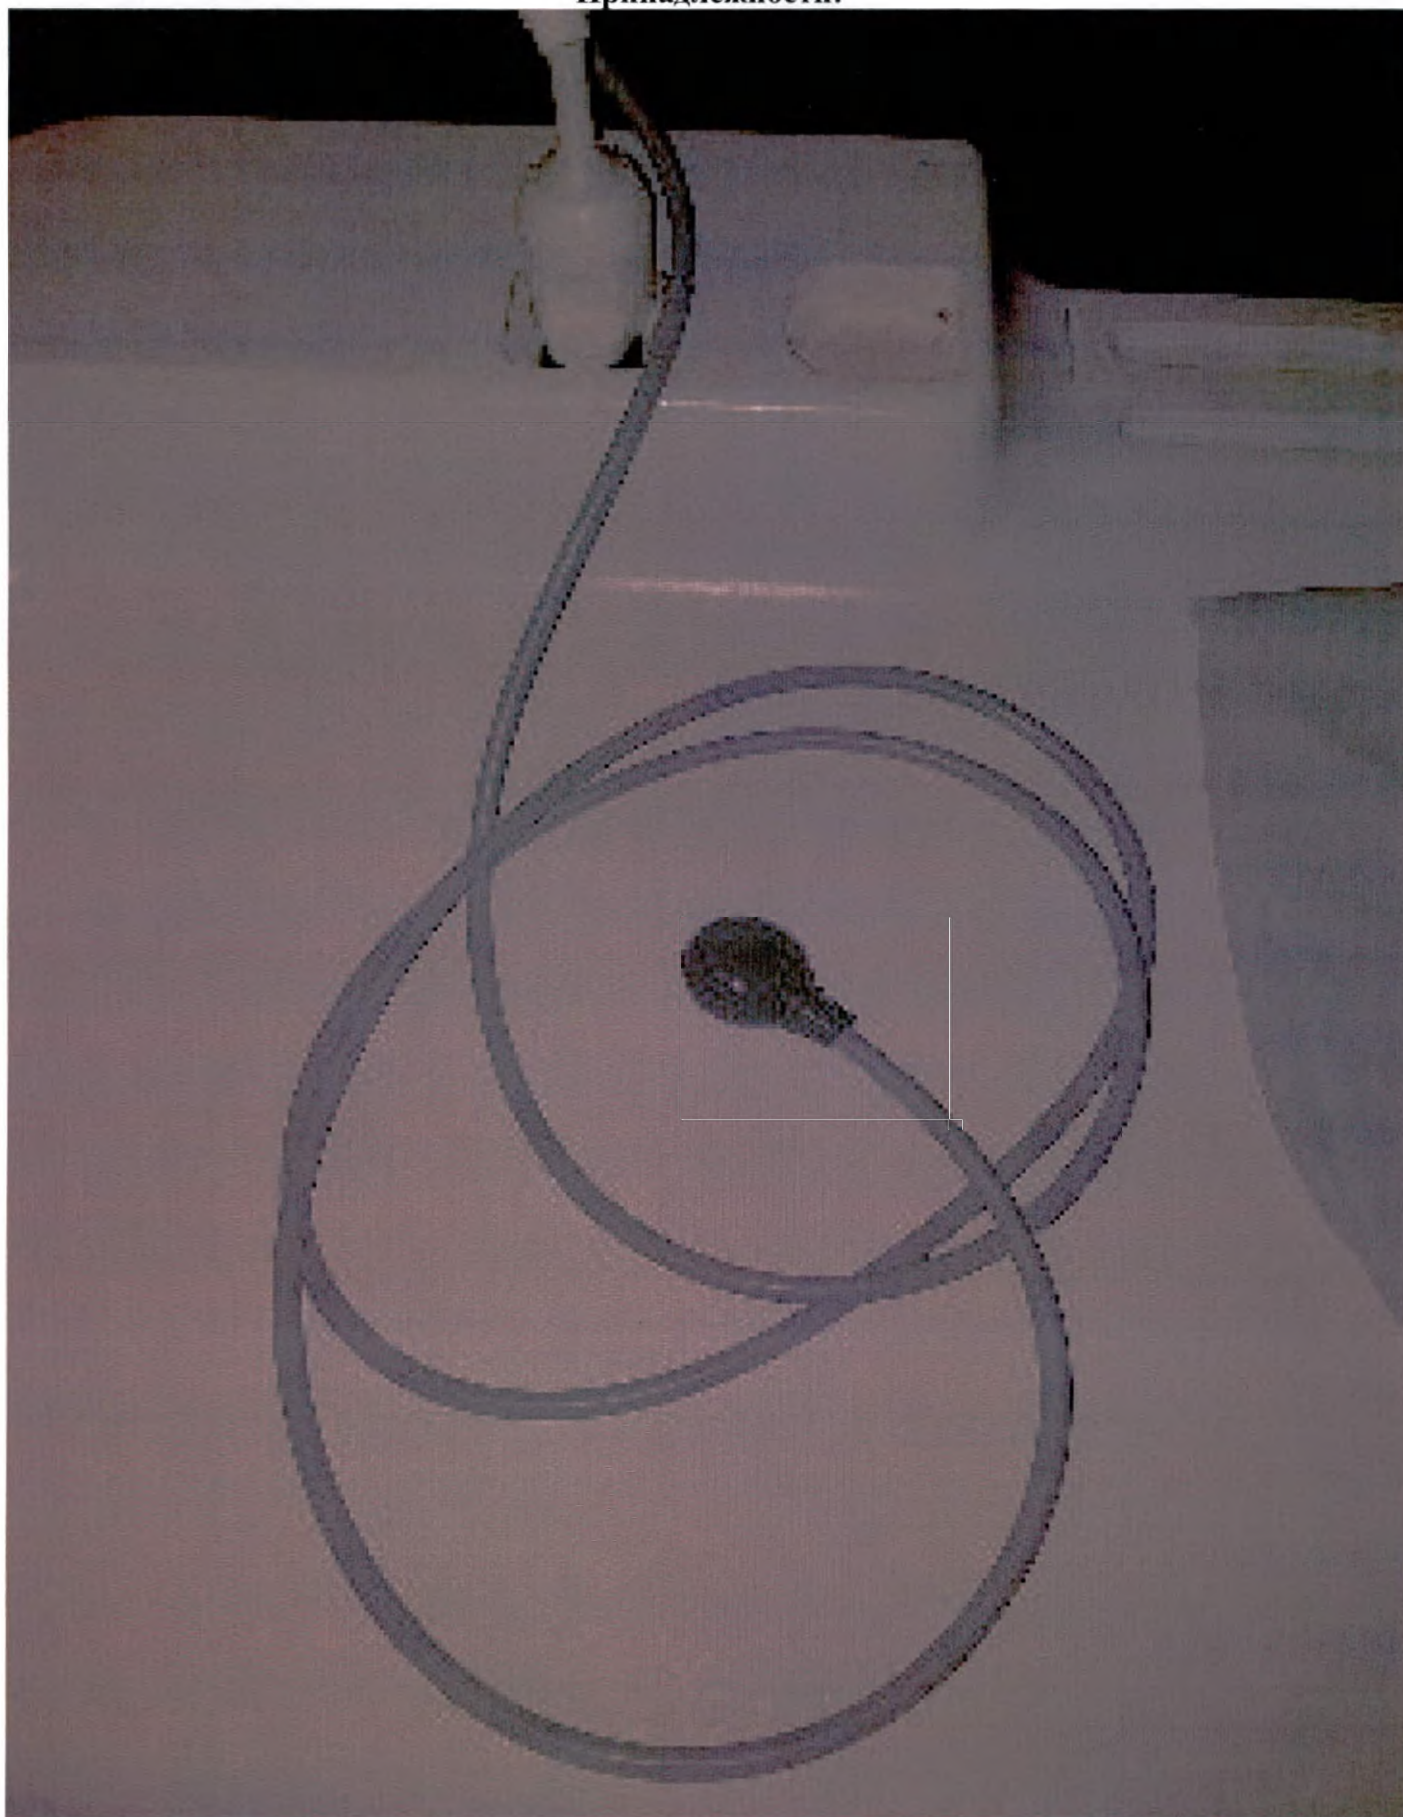

1. Кнопка вызова медсестры.



2. Пассивные наушники.



3. Устройство Caddy для катушек. Вид 1.



3. Устройство Caddy для катушек. Вид 2.




4. Шкаф для хранения катушек.




6. Фантомы, в составе:



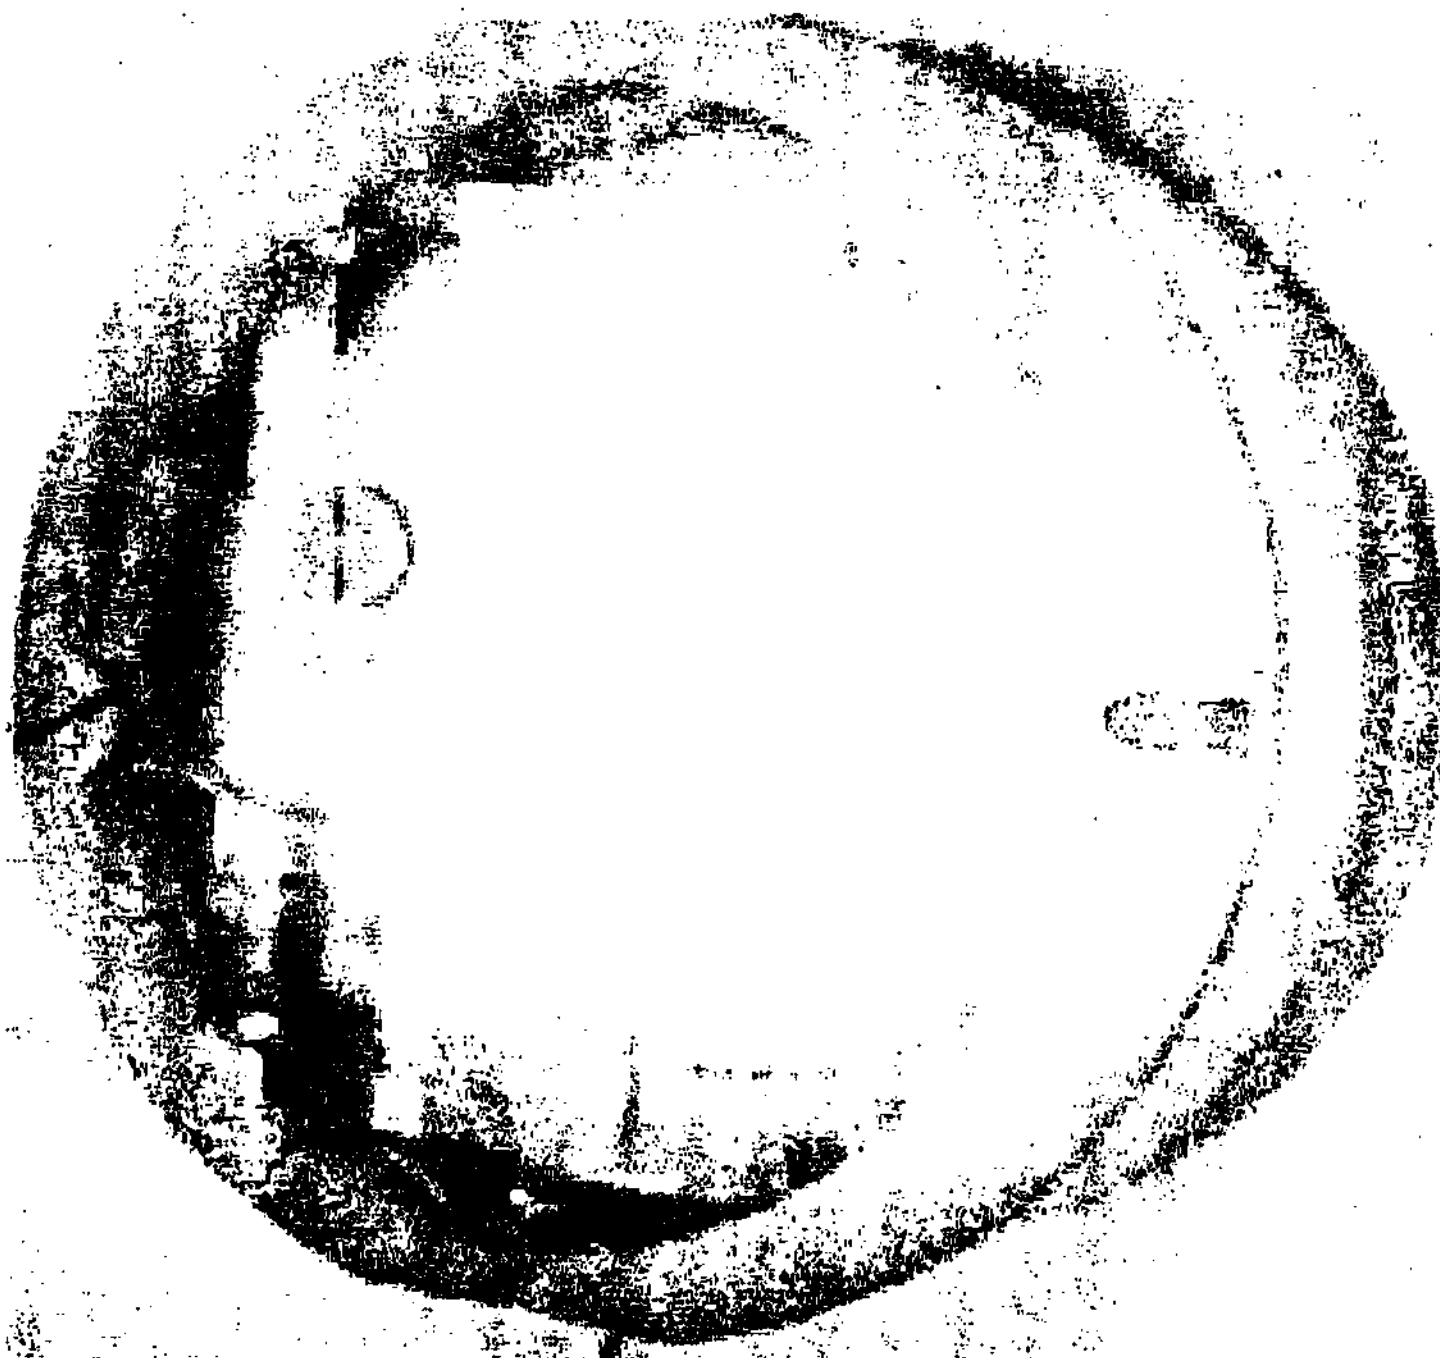




6.3. Бутылочные фантомы.

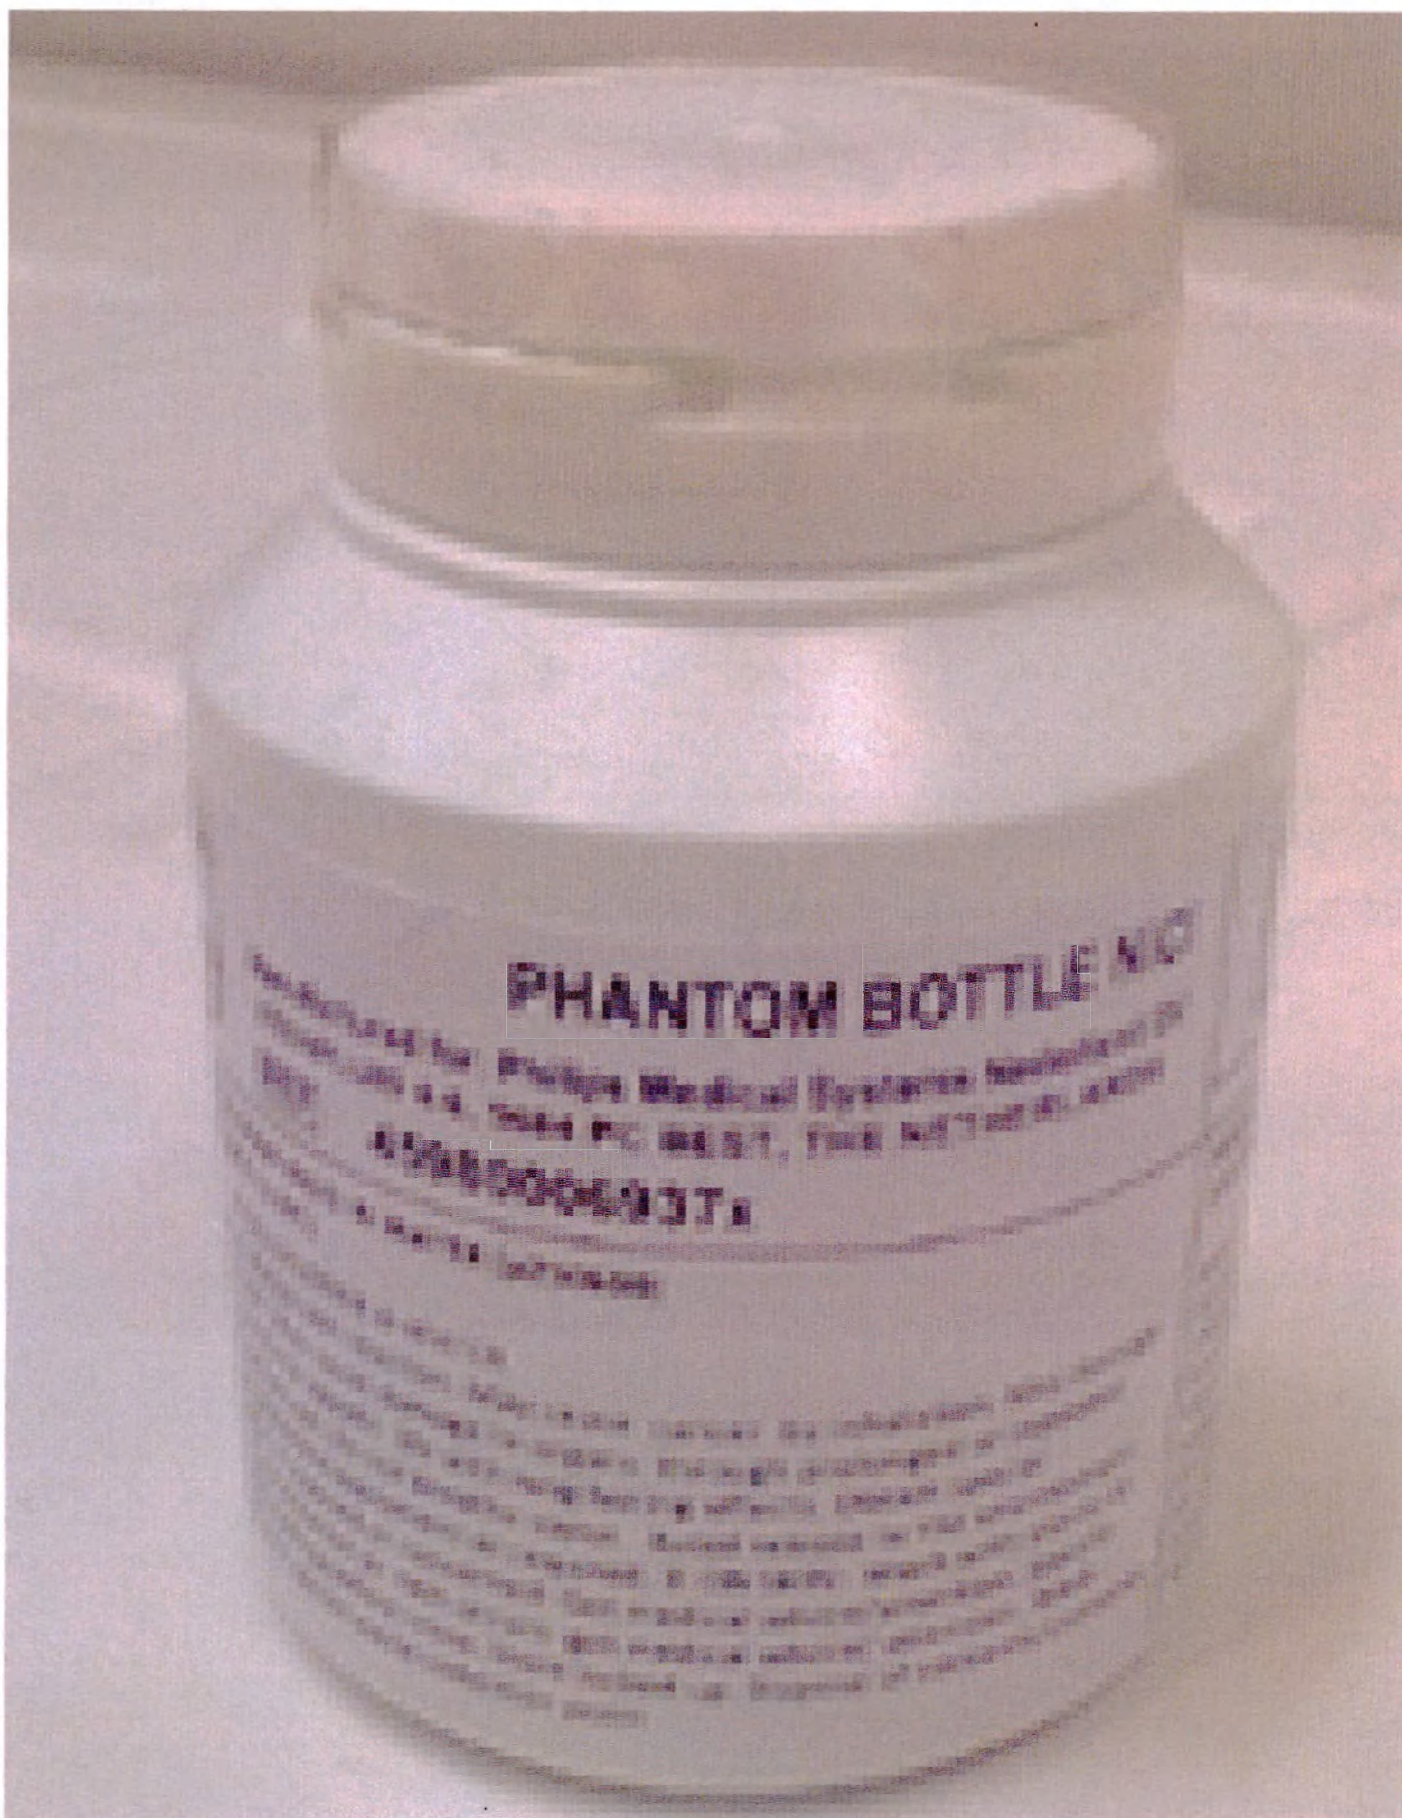


6.4. Бутылочные фантомы (АЦПК).





6.5. Протонные сферические фантомы А.

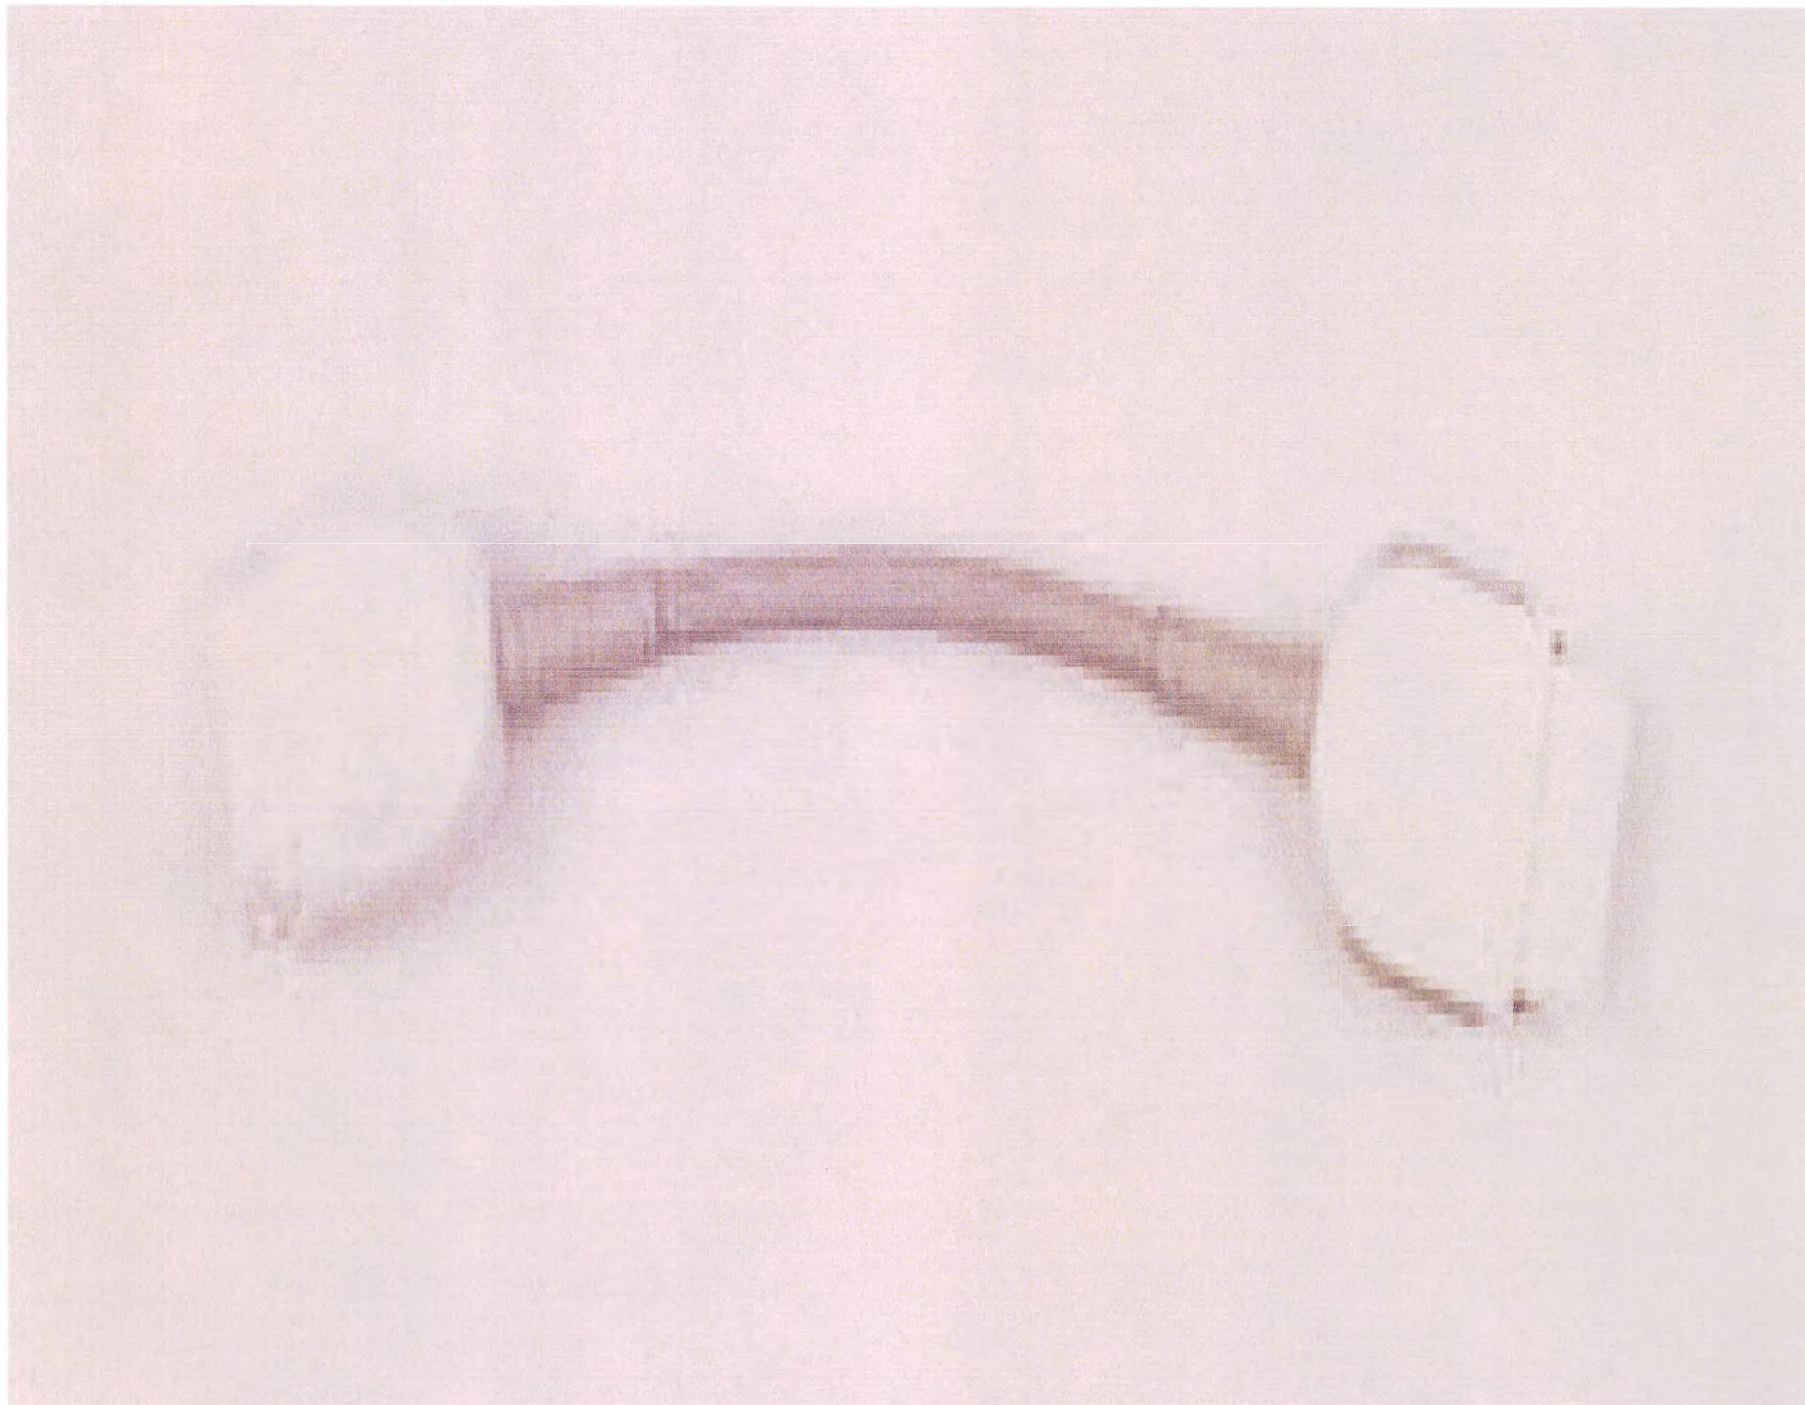



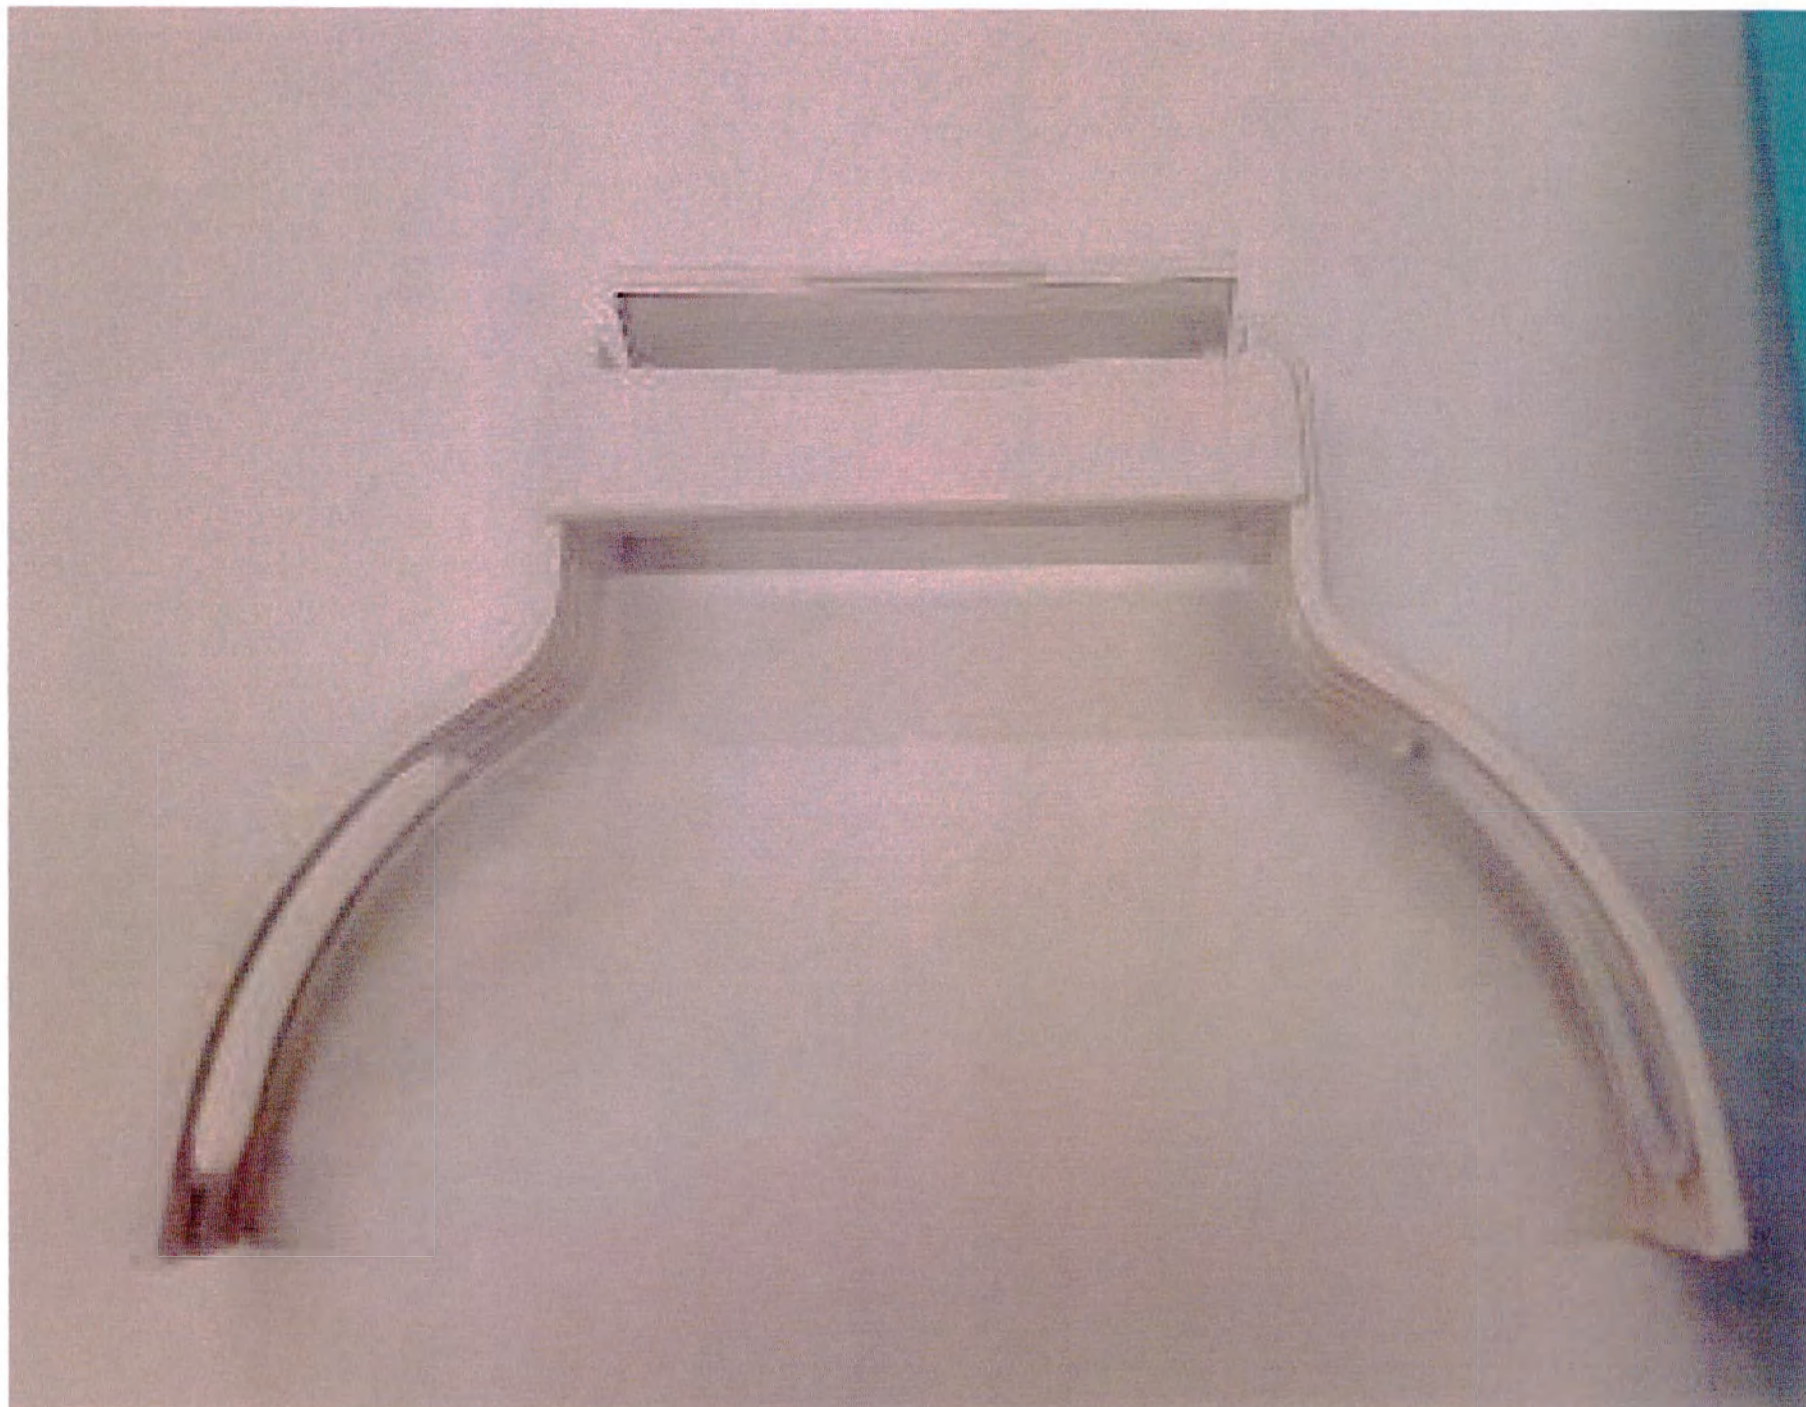

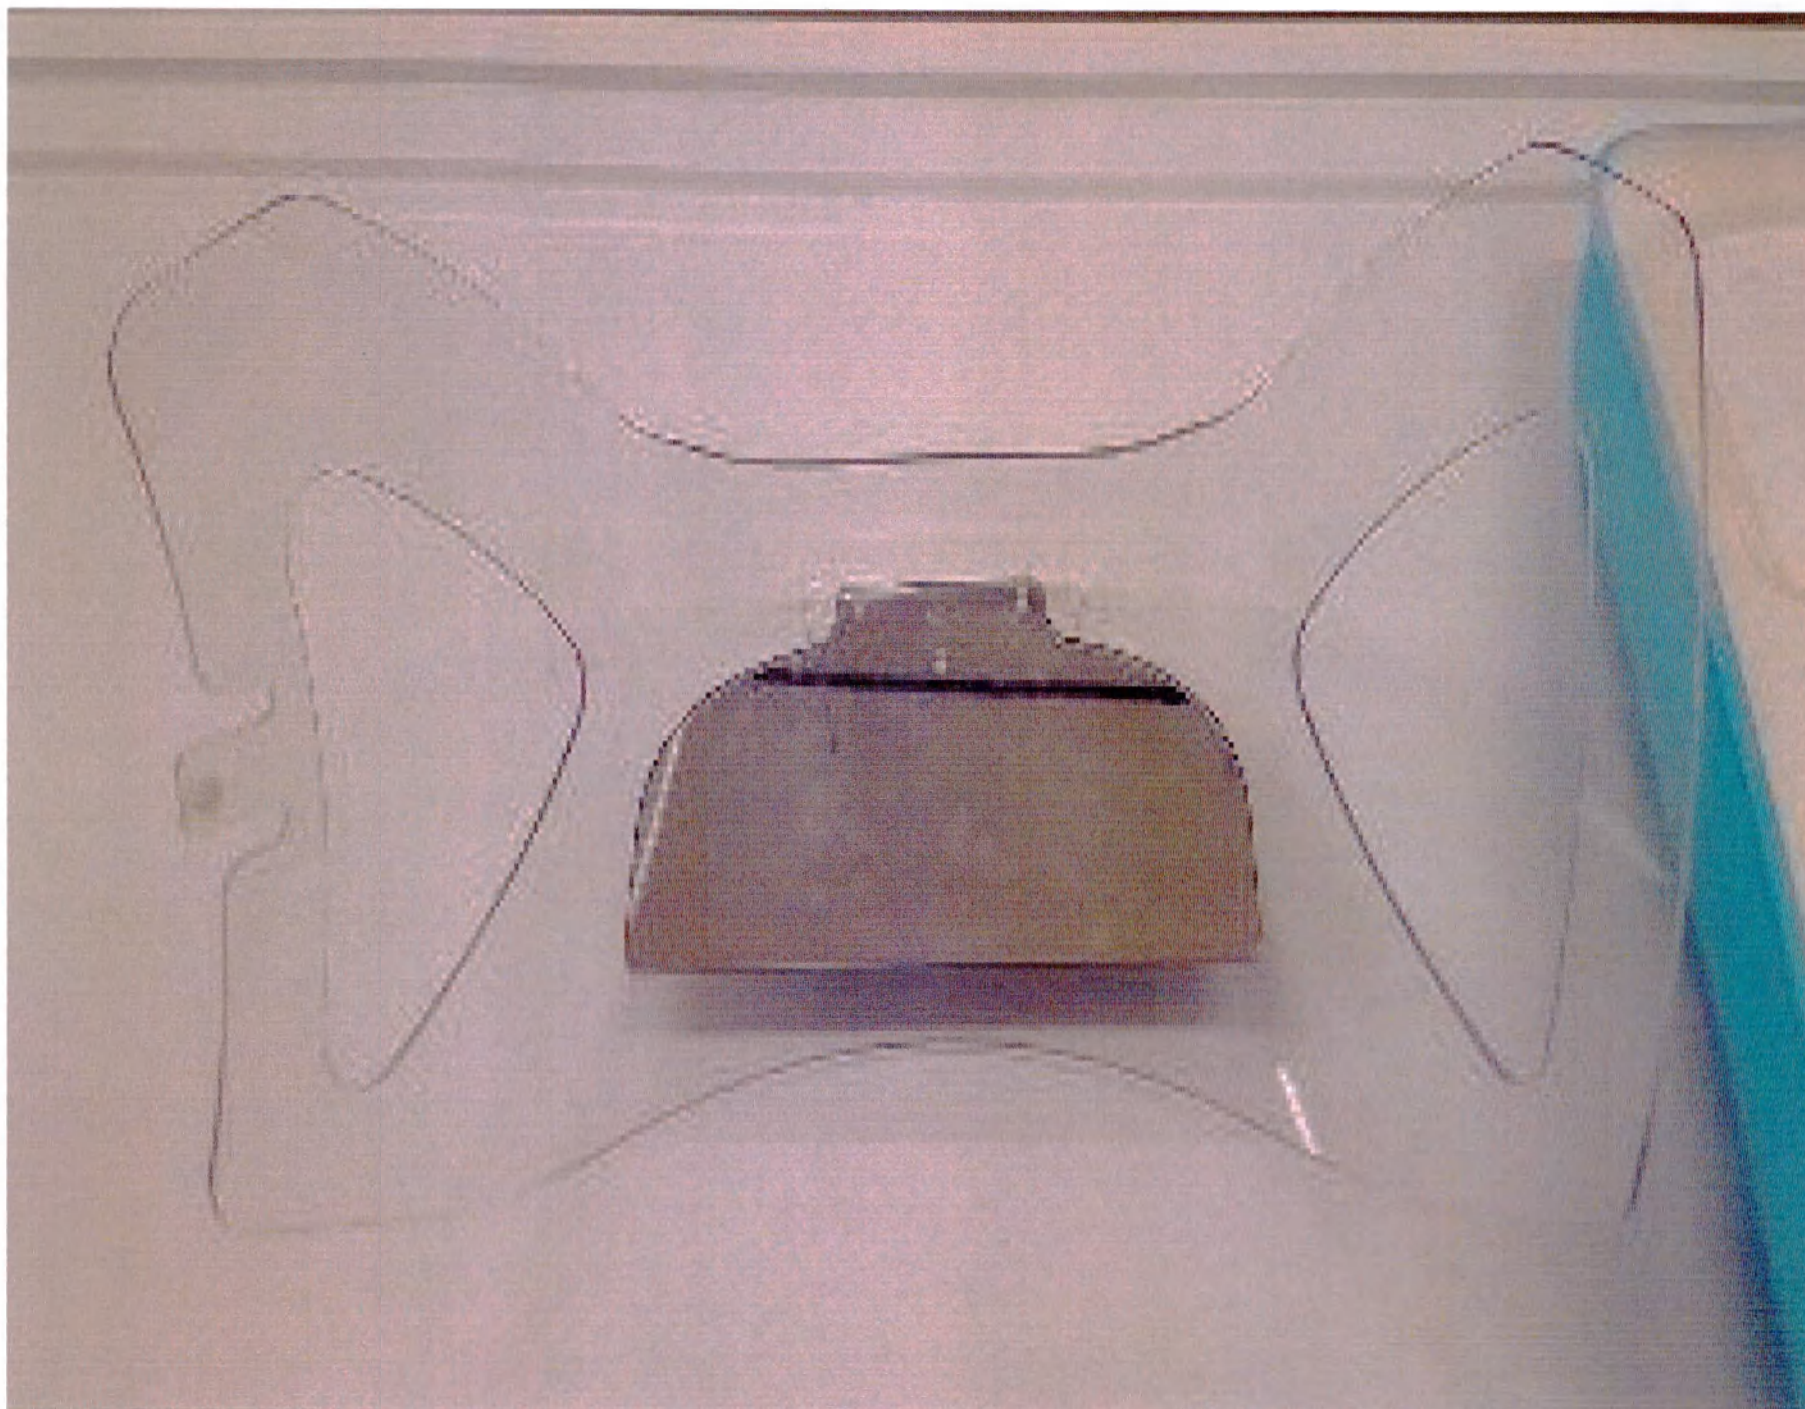

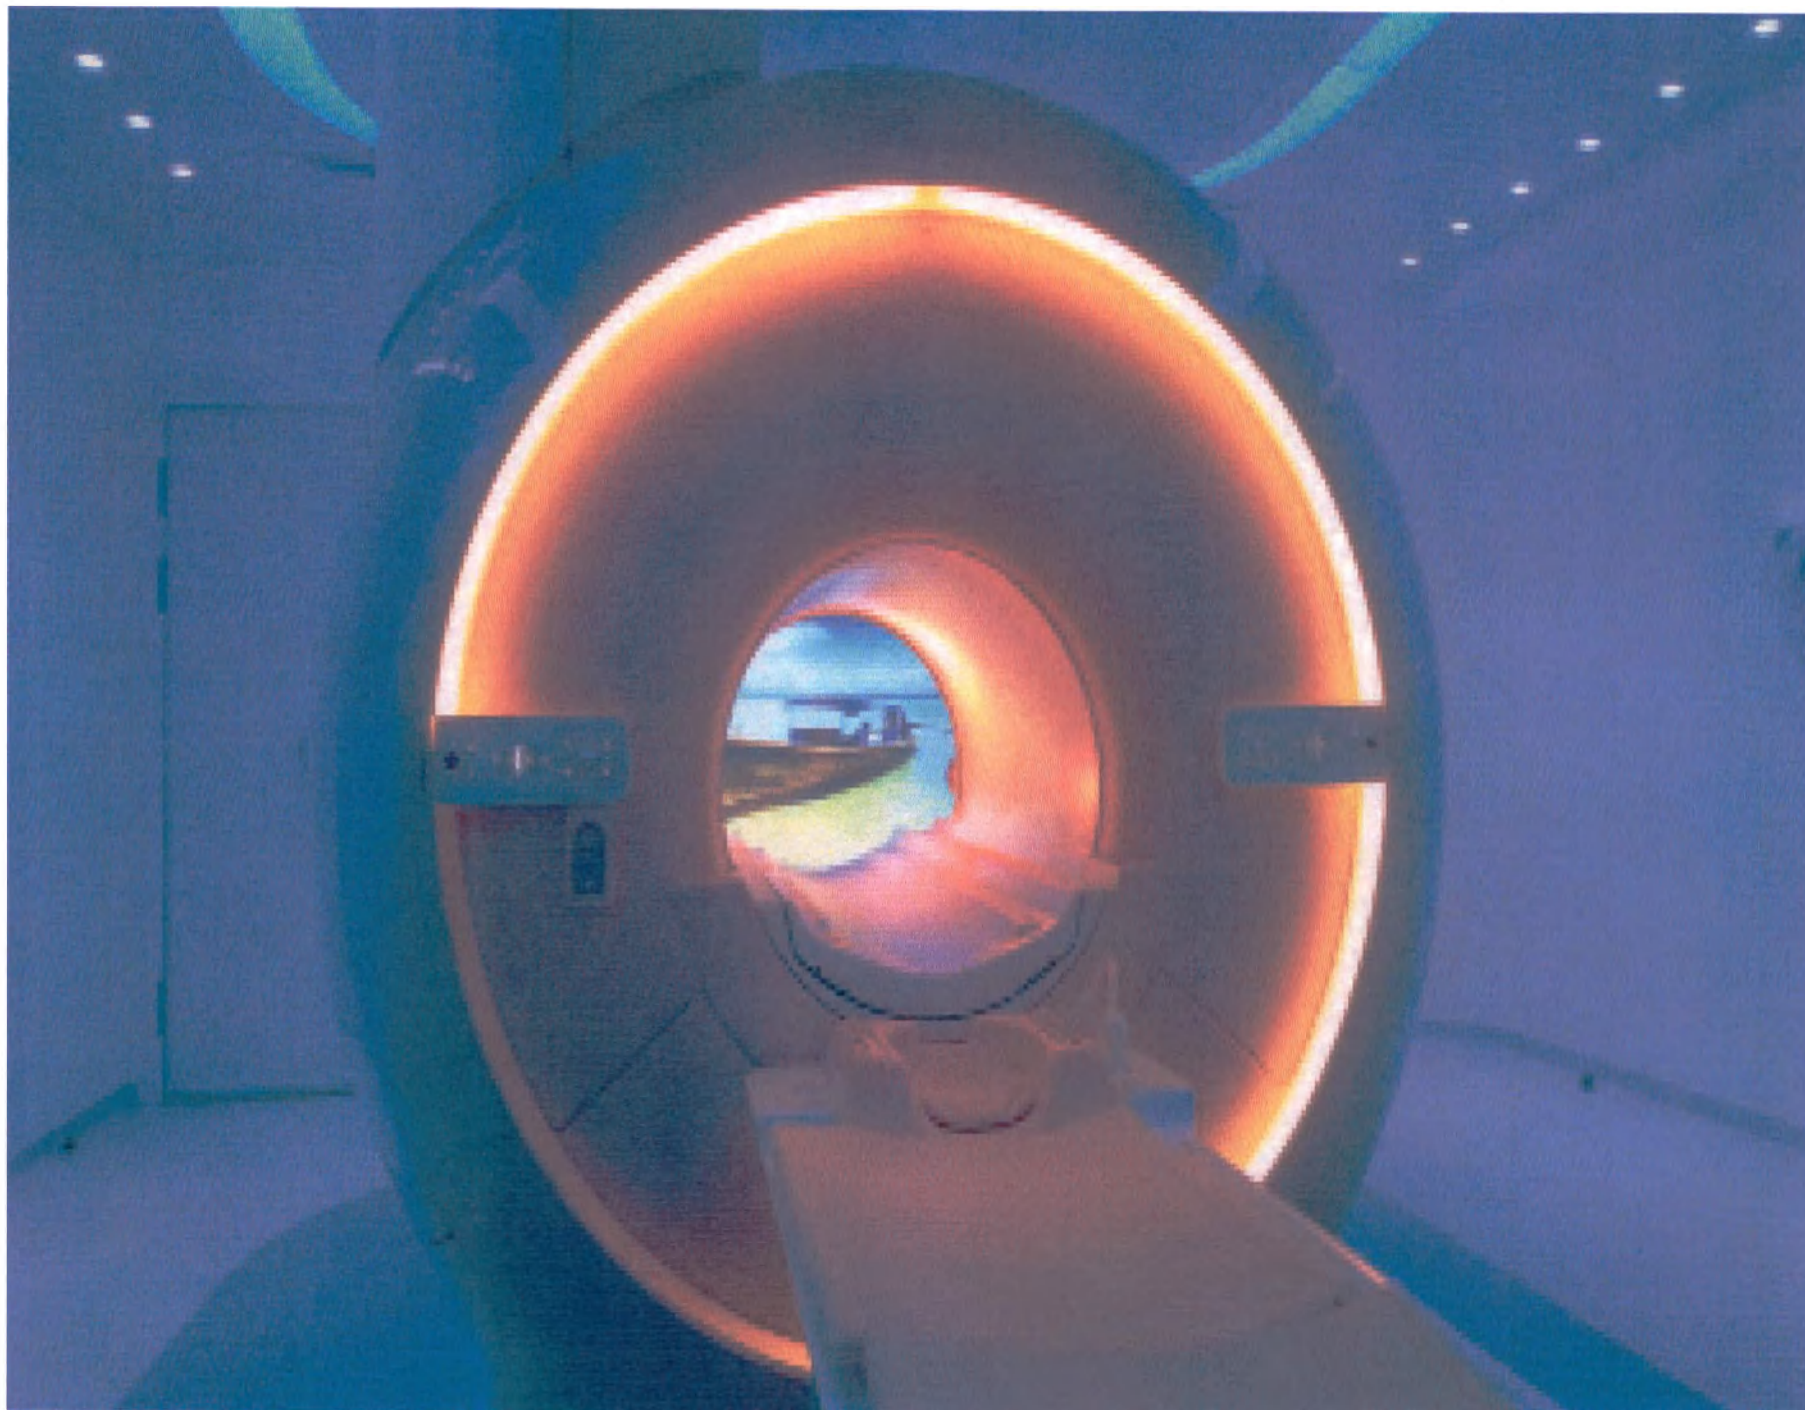




11. Специальное немагнитное противопожарное устройство.

12. Система наблюдения за пациентом, в составе:



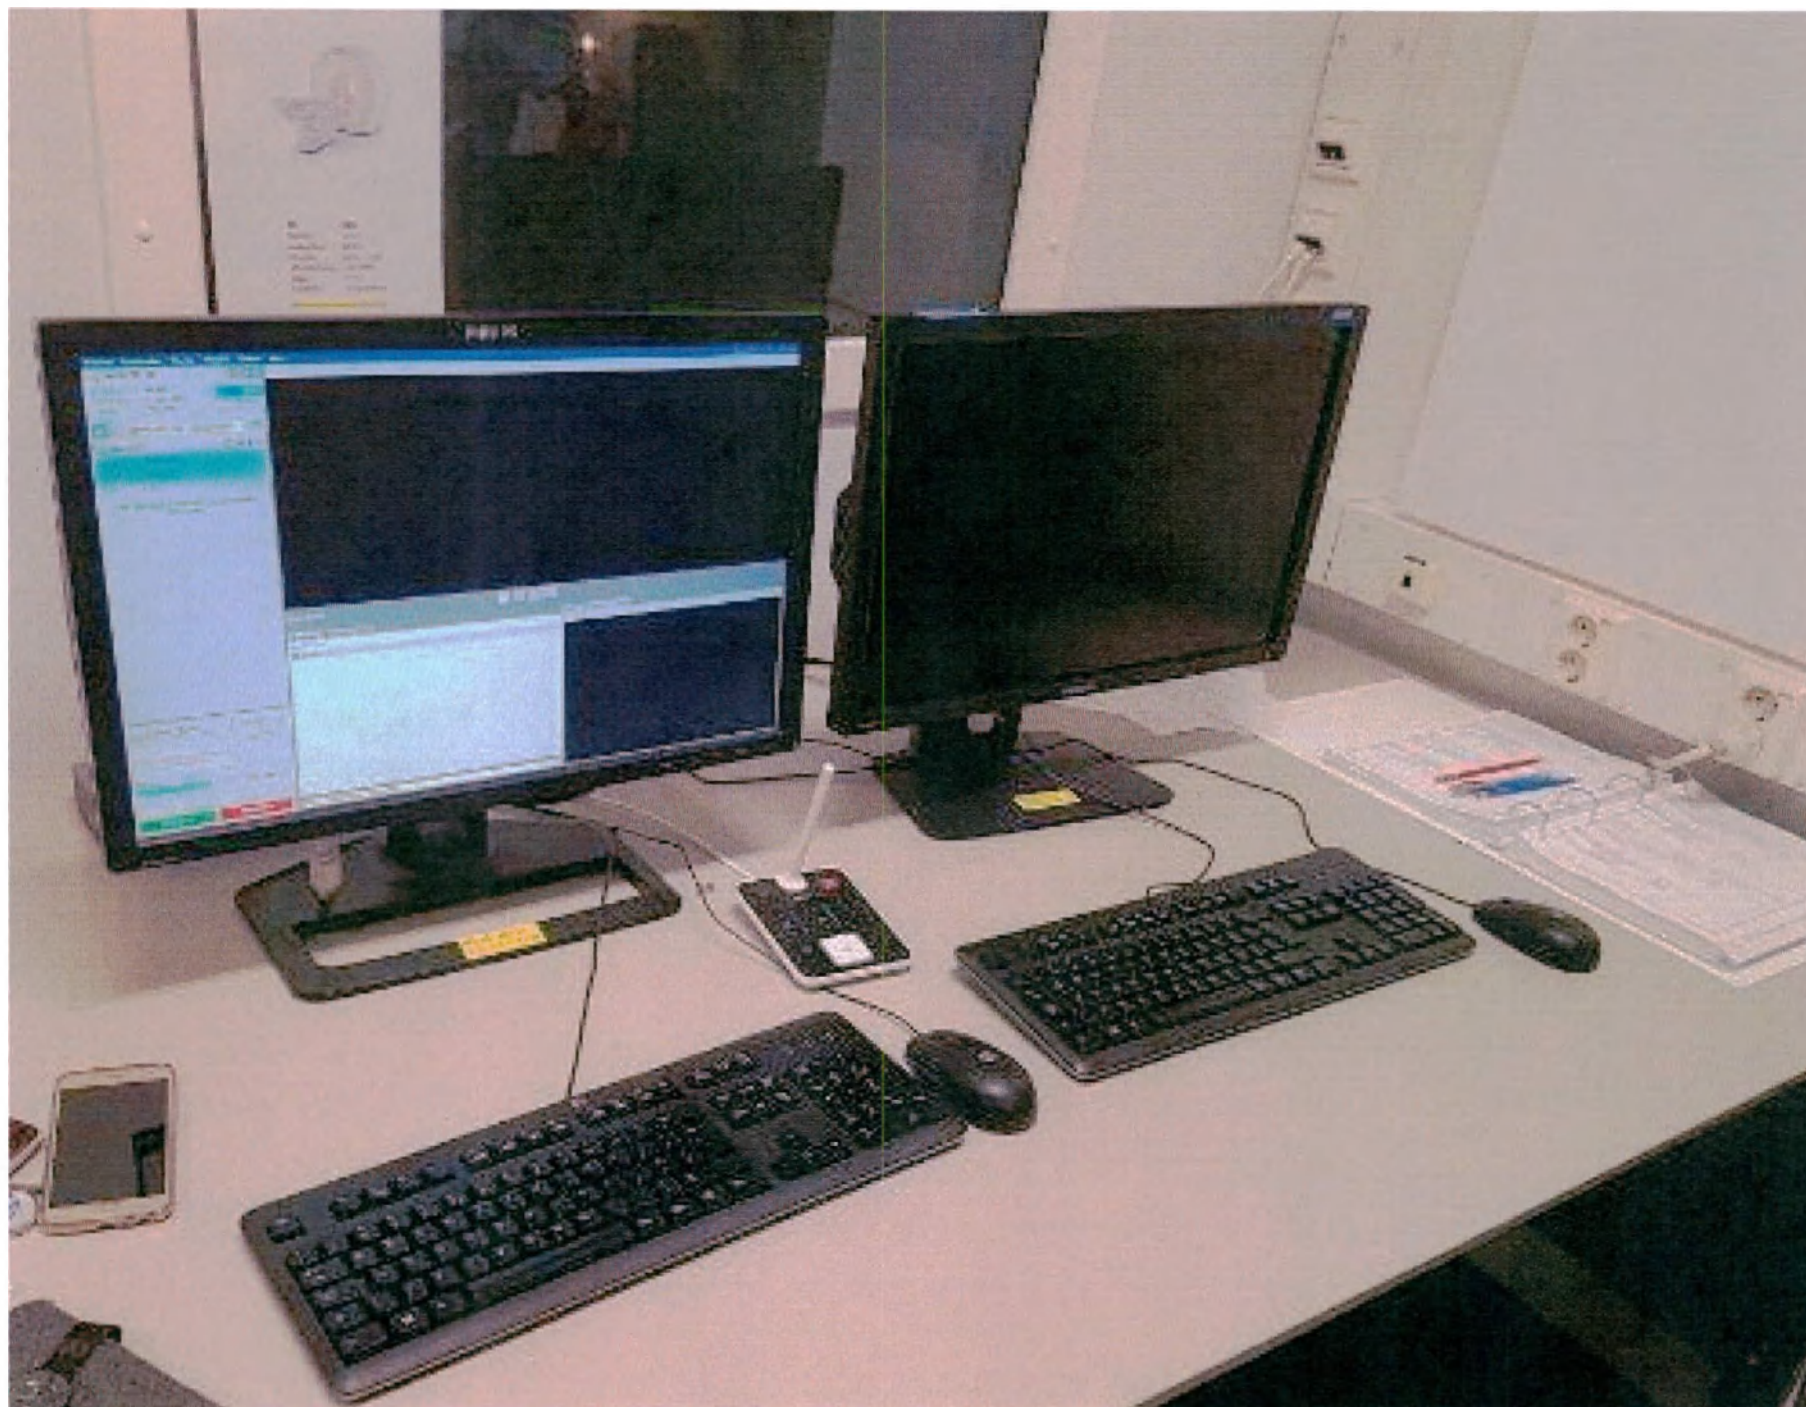



Упаковка



Упаковка магнита.



Упаковка стола пациента.



Упаковка градиентного усилителя.



Упаковка системы сбора и управления данными DACC.



Упаковка пульта оператора.



Упаковка системы охлаждения.



Упаковка системы передачи физиологических данных.



Упаковка катушек.



Philips Magnetic Resonance Equipment

MR 5300

REF 782152

SN 1




UDI (01) 00884838112841

(21) 1



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



2023-06-23

ETL CLASSIFIED



Intertek


4000488

Conforms to: ANSI / AAMI Std ES60601-1,
IEC std. 60601-1, IEC std. 60601-1-6,
IEC std. 60601-1-8, IEC std. 60601-2-33
Certified to: CAN / CSA std. C22.2 no. 60601-1

3N~ 220/380V, 50/60Hz, 60kVA

3N~ 230/400V, 50/60Hz, 60kVA

3~ 480V, 60Hz, 60kVA



0344



www.philips.com/ifu



300009418881

Маркировка системы MR 5300 производителя

Производитель: "Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.", Нидерланды,

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства медицинского изделия:

Philips Medical Systems Nederland B.V., Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Медицинское изделие: Система магнитно-резонансной томографии MR 5300 с принадлежностями

Номинальный режим работы

Серийный номер: см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Регистрационное удостоверение: № РЗН

Предупреждения и знаки опасности:



Макет русскоязычной маркировки системы MR 5300.



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 136 листа (ов)

ООО «Филипс»

