

Рf, УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству

и регуляторным вопросам

ООО «Алкон Фармацевтика»



Д.А. Николаев

29 августа 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Система офтальмологическая лазерная фемтосекундная
WaveLight FS200 с принадлежностями

Система офтальмологическая лазерная фемтосекундная WaveLight FS200 с принадлежностями:

1. Консоль лазера – 1 шт., цвета: синий (8065990714), цвет слоновой кости (8065998284), красный (8065998283), черный (8065998379), золотой (8065998381).

Синий:



Alcon

Цвет слоновой кости:

ООО «Алкон Фармацевтика»
Юридический адрес:
125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 3
Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720
ОГРН 1027739129857
ИНН 7709354370
КПП 774301001



Красный:




Черный:




Золотой:



2. Кабель питания для системы WaveLight FS200 (90635011) – 1 шт.

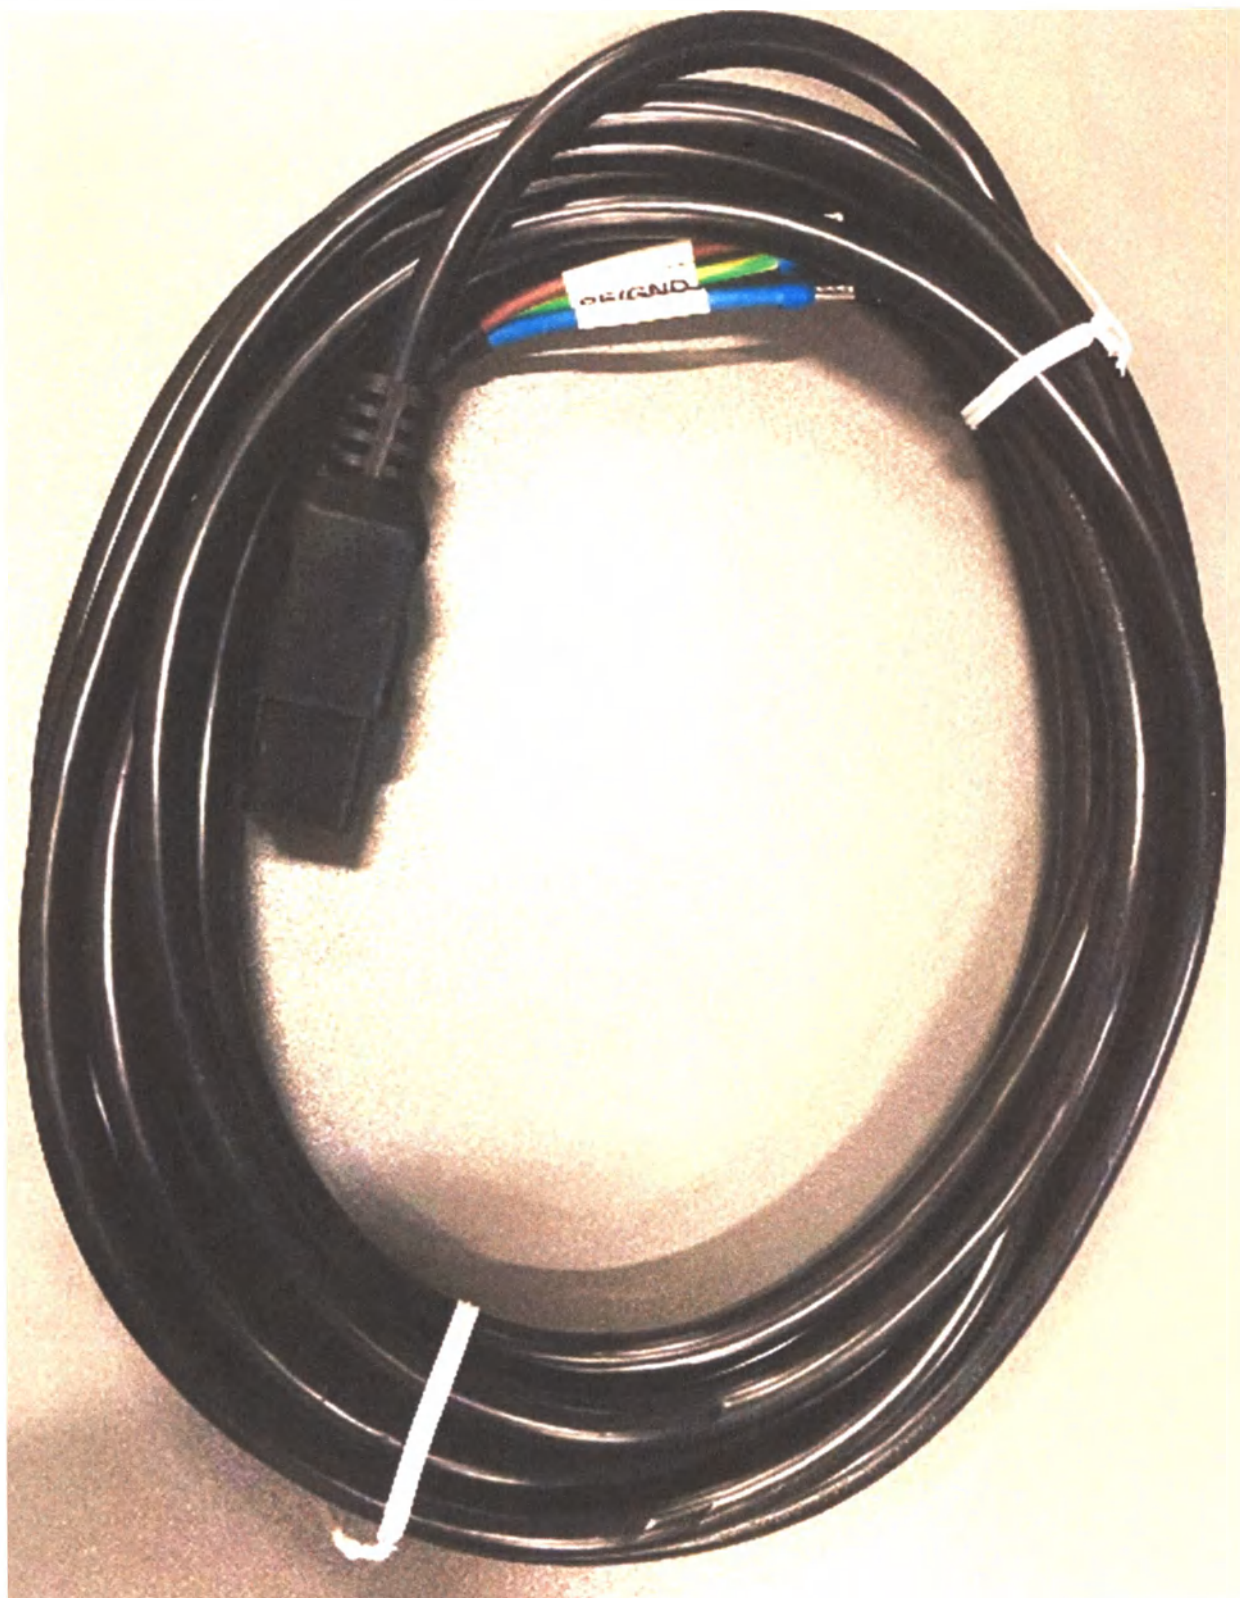


3. Кабель питания для источника бесперебойного питания NXT Power, INTEGRITY MAX, model NPTU 3200 (8065990709) (при необходимости) – 1 шт.

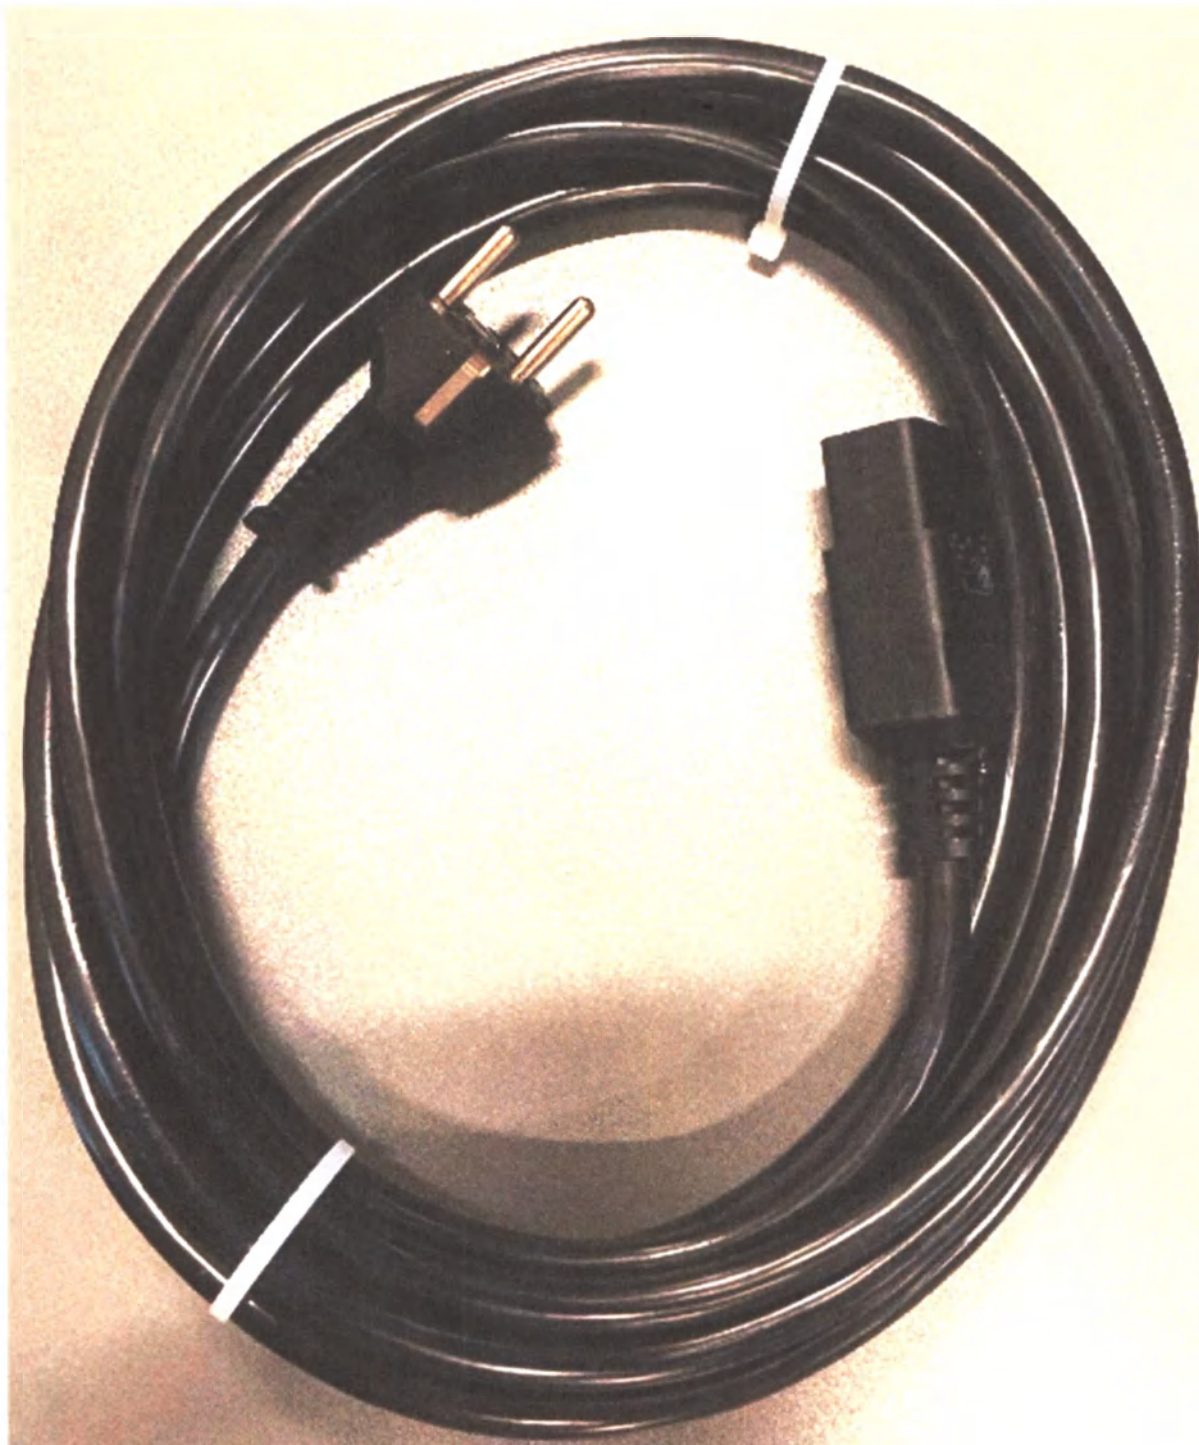

4. Кабели для операционной платформы тип 1125 (10251213) (при необходимости) – до 2 шт.



5. Тест-интерфейс (8065990803) – 1 шт.

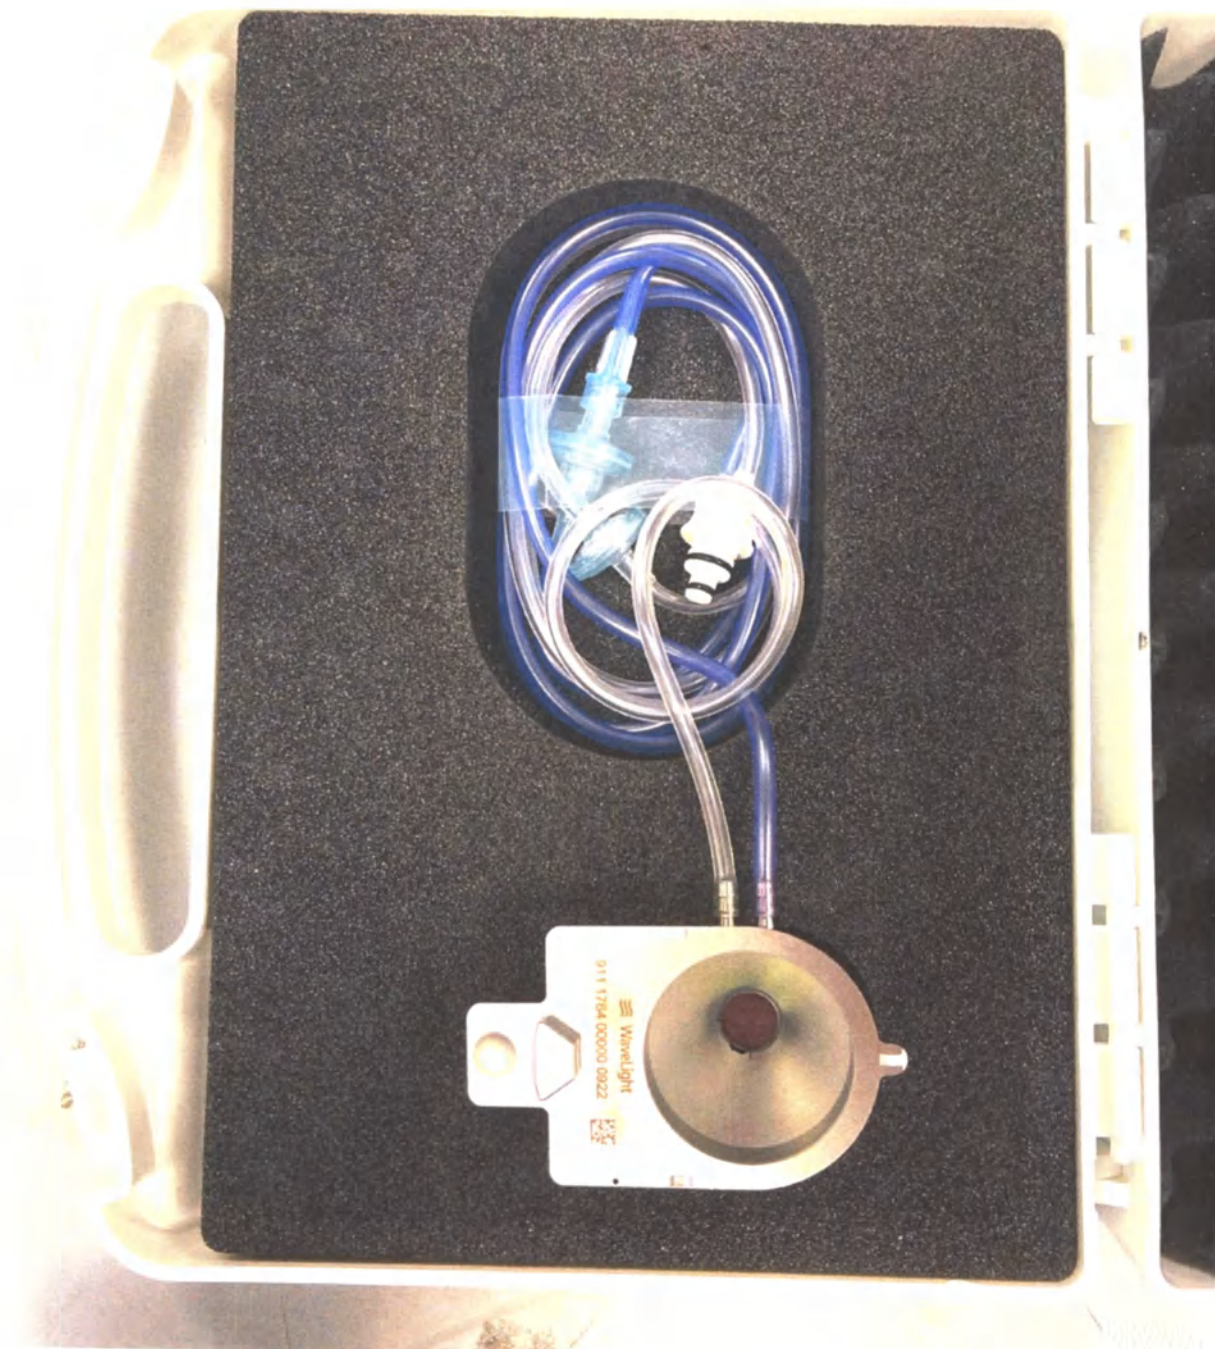

6. Набор тестовых дисков (8065990790) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- тестовые диски – 48 шт.;

- фильтр для тест-интерфейса – 1 шт.




6. Набор тестовых дисков (8065990790) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- тестовые диски – 48 шт.;


- фильтр для тест-интерфейса – 1 шт.




7. Монитор поворотный WaveLight (10161116) – 1 шт.

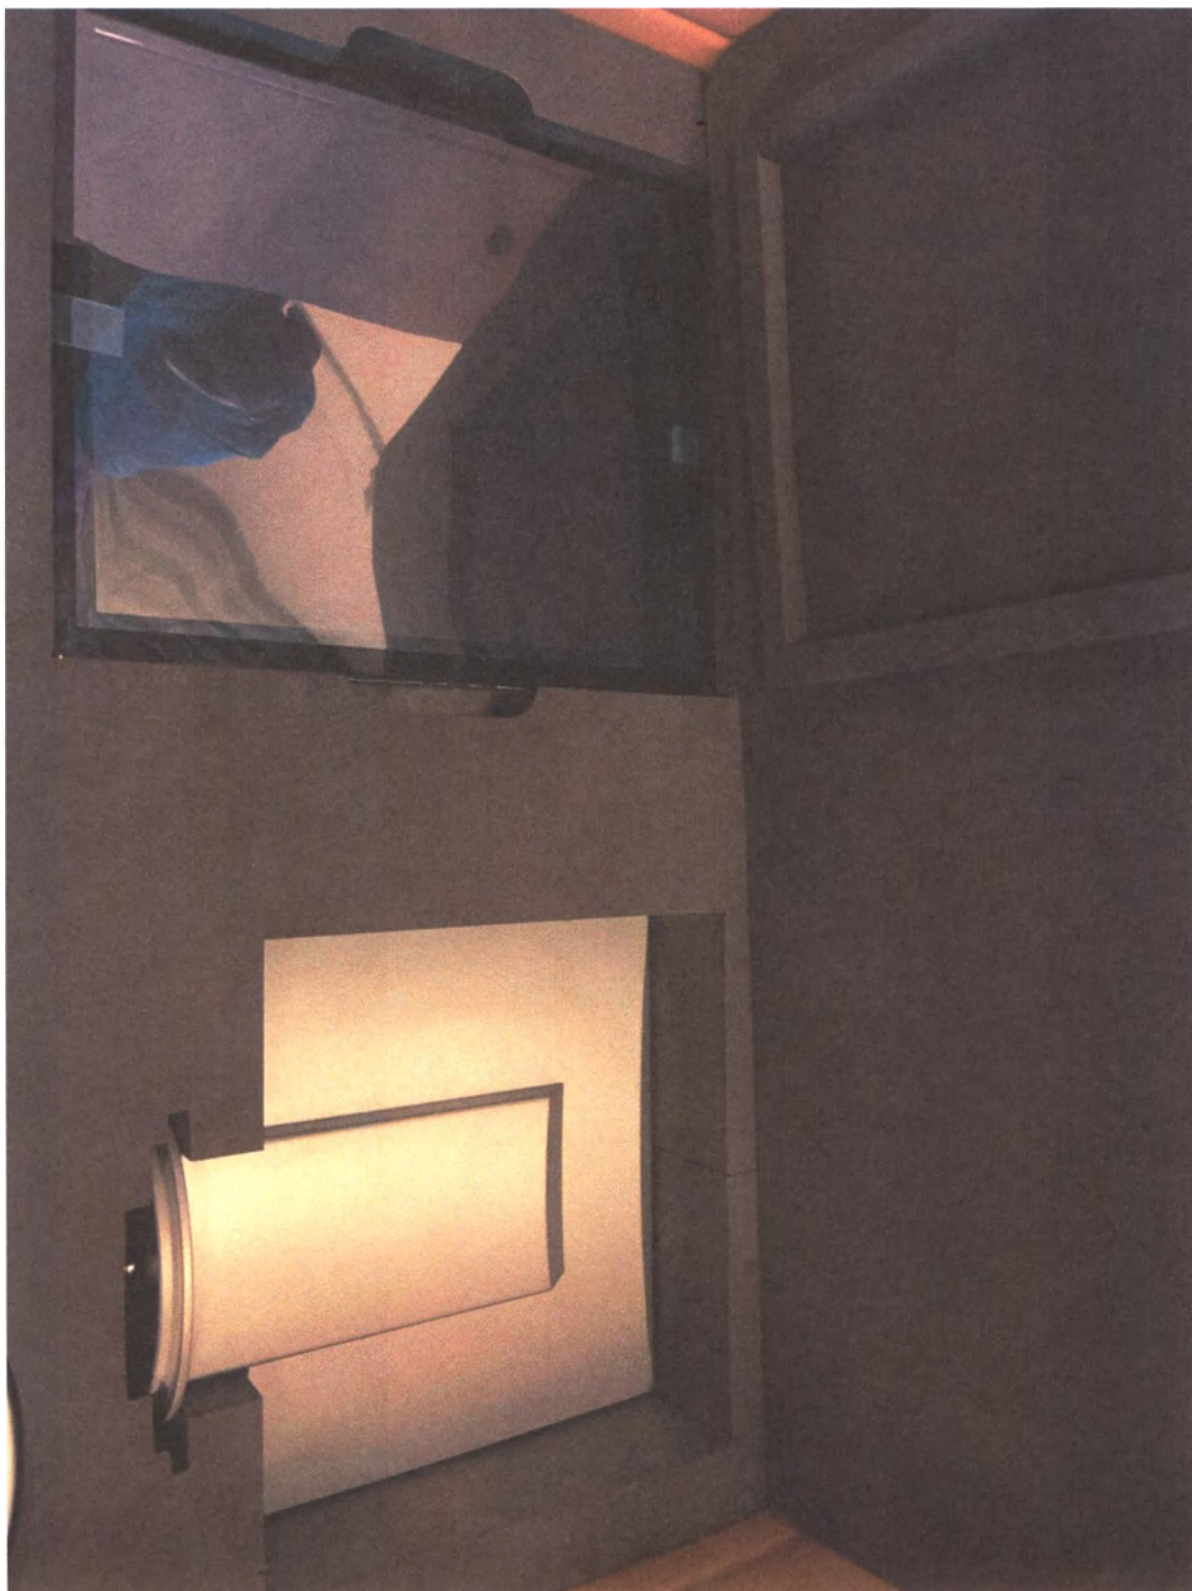

8. Педаль управления WaveLight (10161115) – 1 шт.

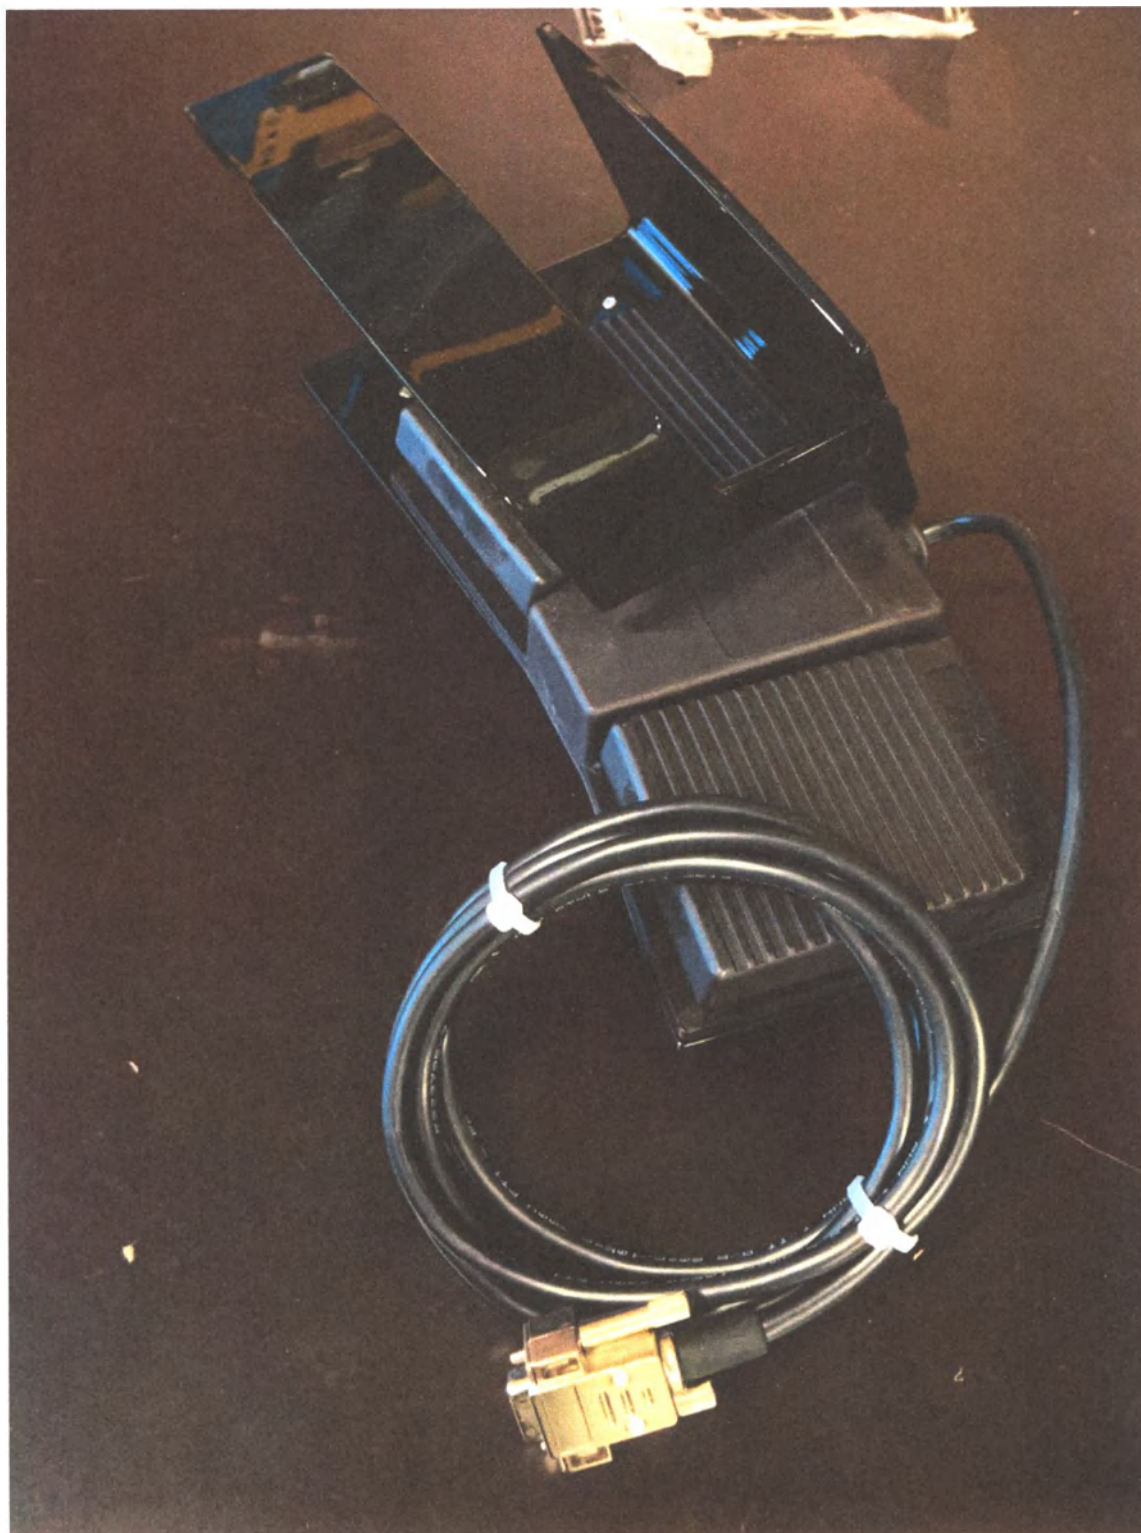

9. Джойстик WaveLight (10251107) – 1 шт.

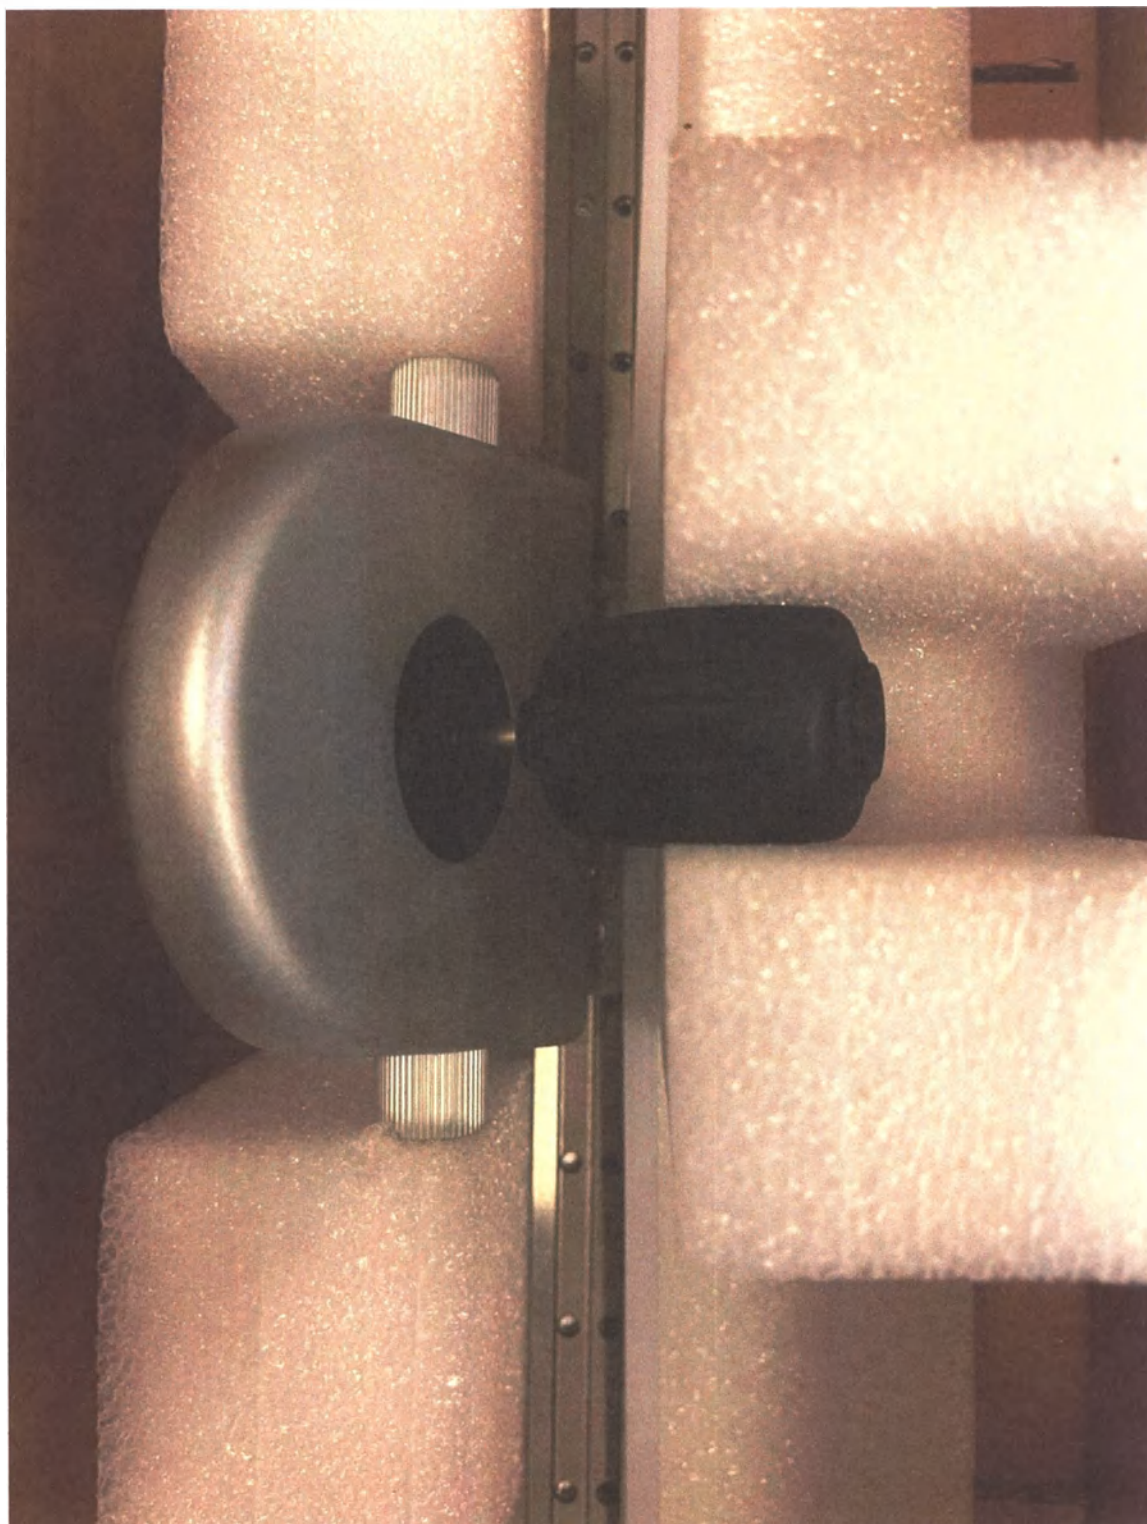

10. Операционный микроскоп ATMOS (10251591) – 1 шт.



11. Источник бесперебойного питания NXT Power, INTEGRITY MAX, model NPTU 3200 (8065990709)
(при необходимости) – 1 шт.




12. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



13. Кабель S-Video S-VHS, 5.0 м (90690034) (при необходимости) – 1 шт.



14. Подвижная система зеркал (при необходимости) – 1 шт.

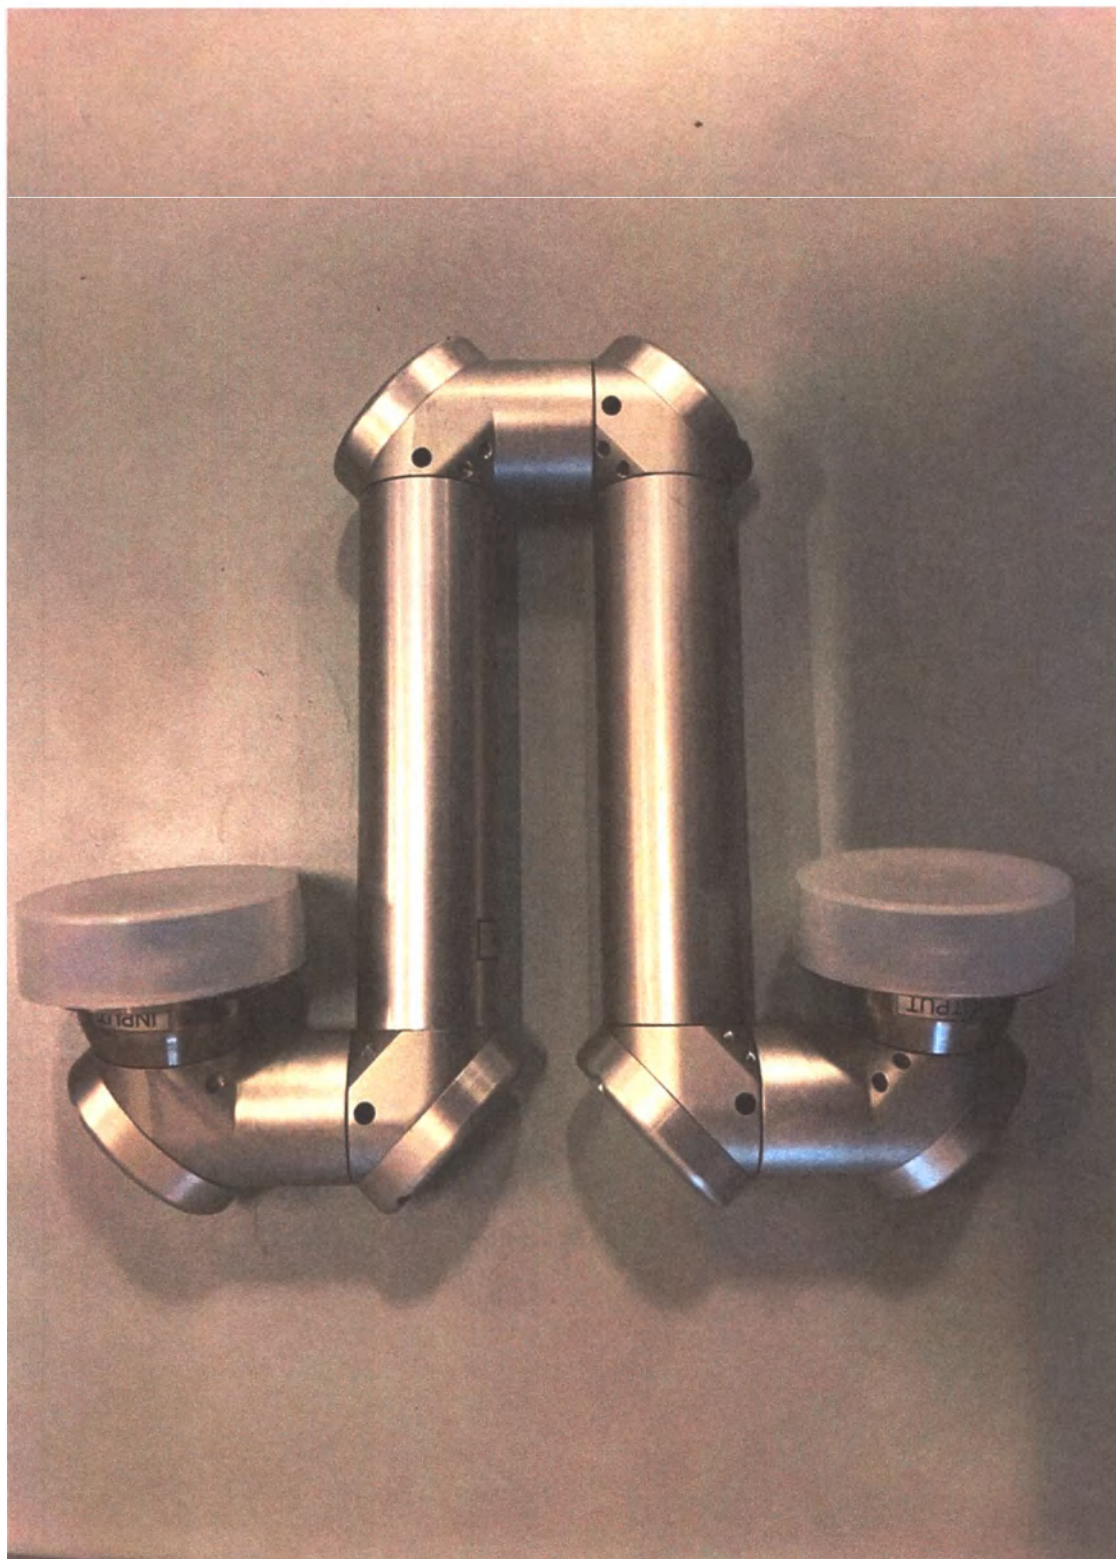


15. Резиновый колпачок для ручки регулирования операционного микроскопа ATMOS (8065000458)
(при необходимости) – до 2 шт.



16. Резиновые ножки (при необходимости) – до 8 шт.




17. Пластины (при необходимости) – до 6 шт.

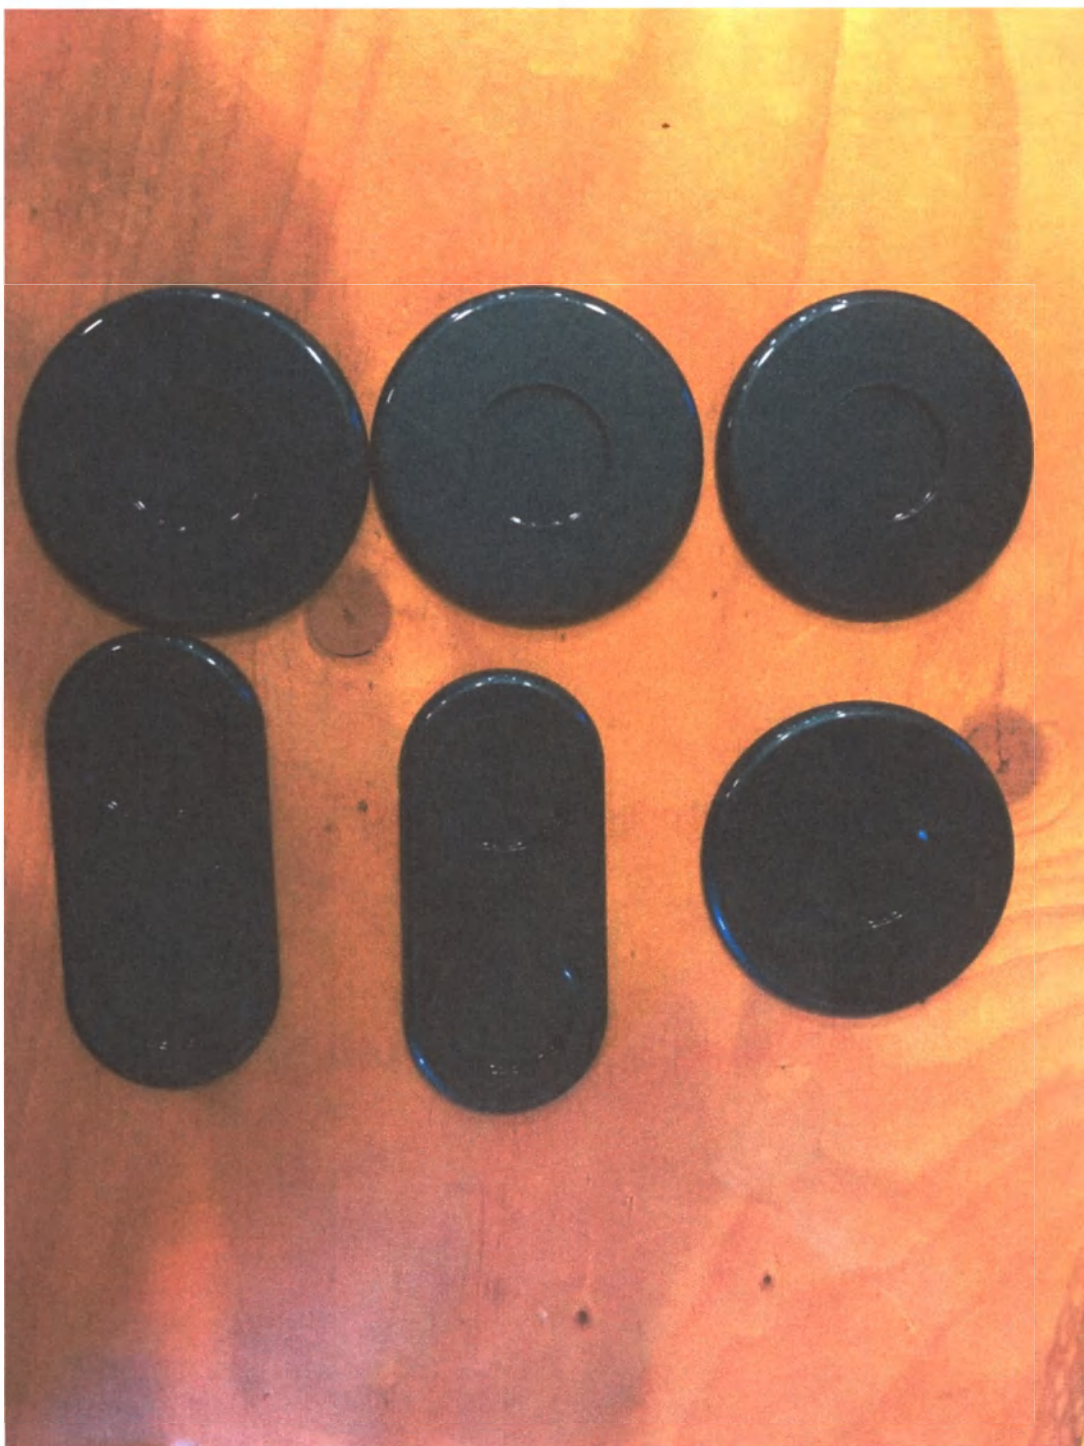


18. Операционная платформа тип 1125 (при необходимости) – 1 шт., цвета: синий (8065990896), цвет слоновой кости (8065998290), красный (8065998289), черный (8065998383), золотой (8065998384), в составе:

- операционная платформа тип 1125 – 1 шт.;
- переходник для кабеля тестового адаптера (при необходимости) – 1 шт.;
- кабель питания – 1 шт.;
- инструкция по эксплуатации – 1 шт.




Синий:

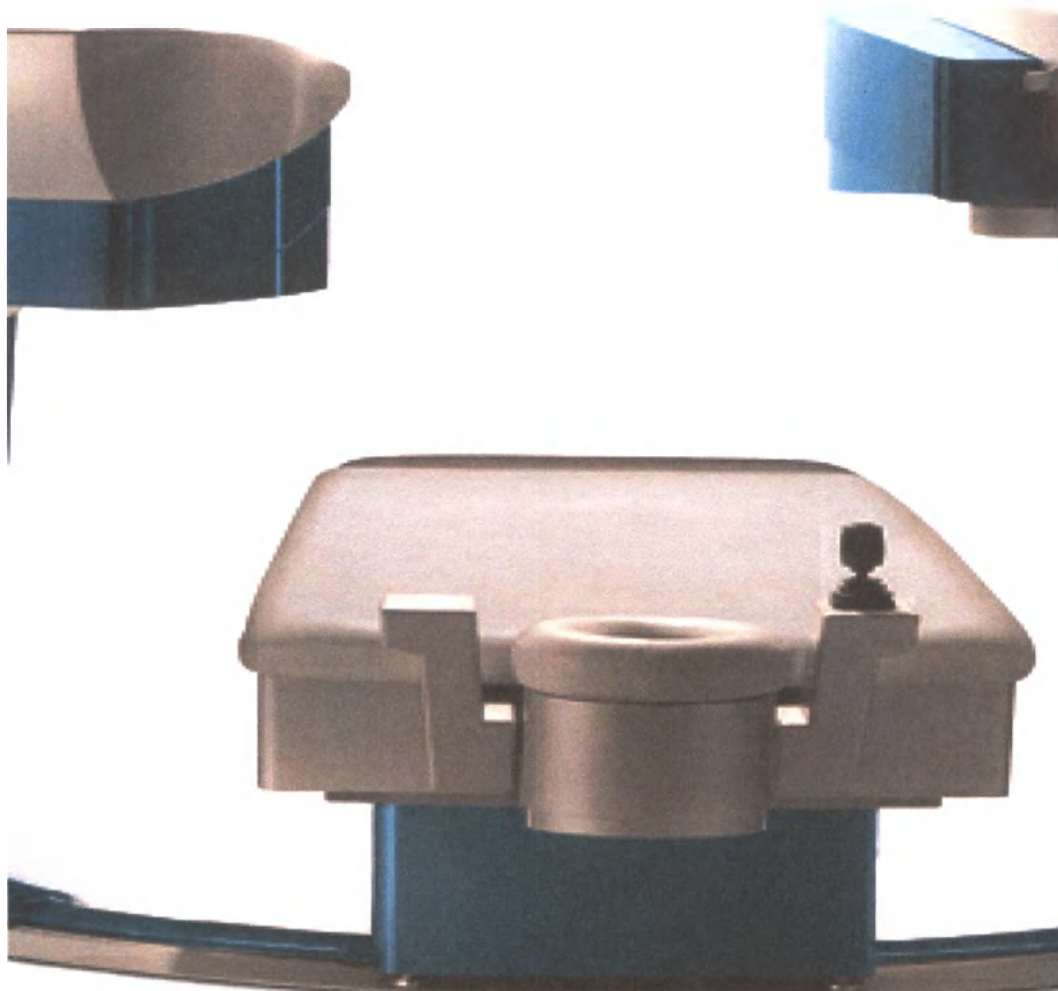


Цвет слоновой кости:

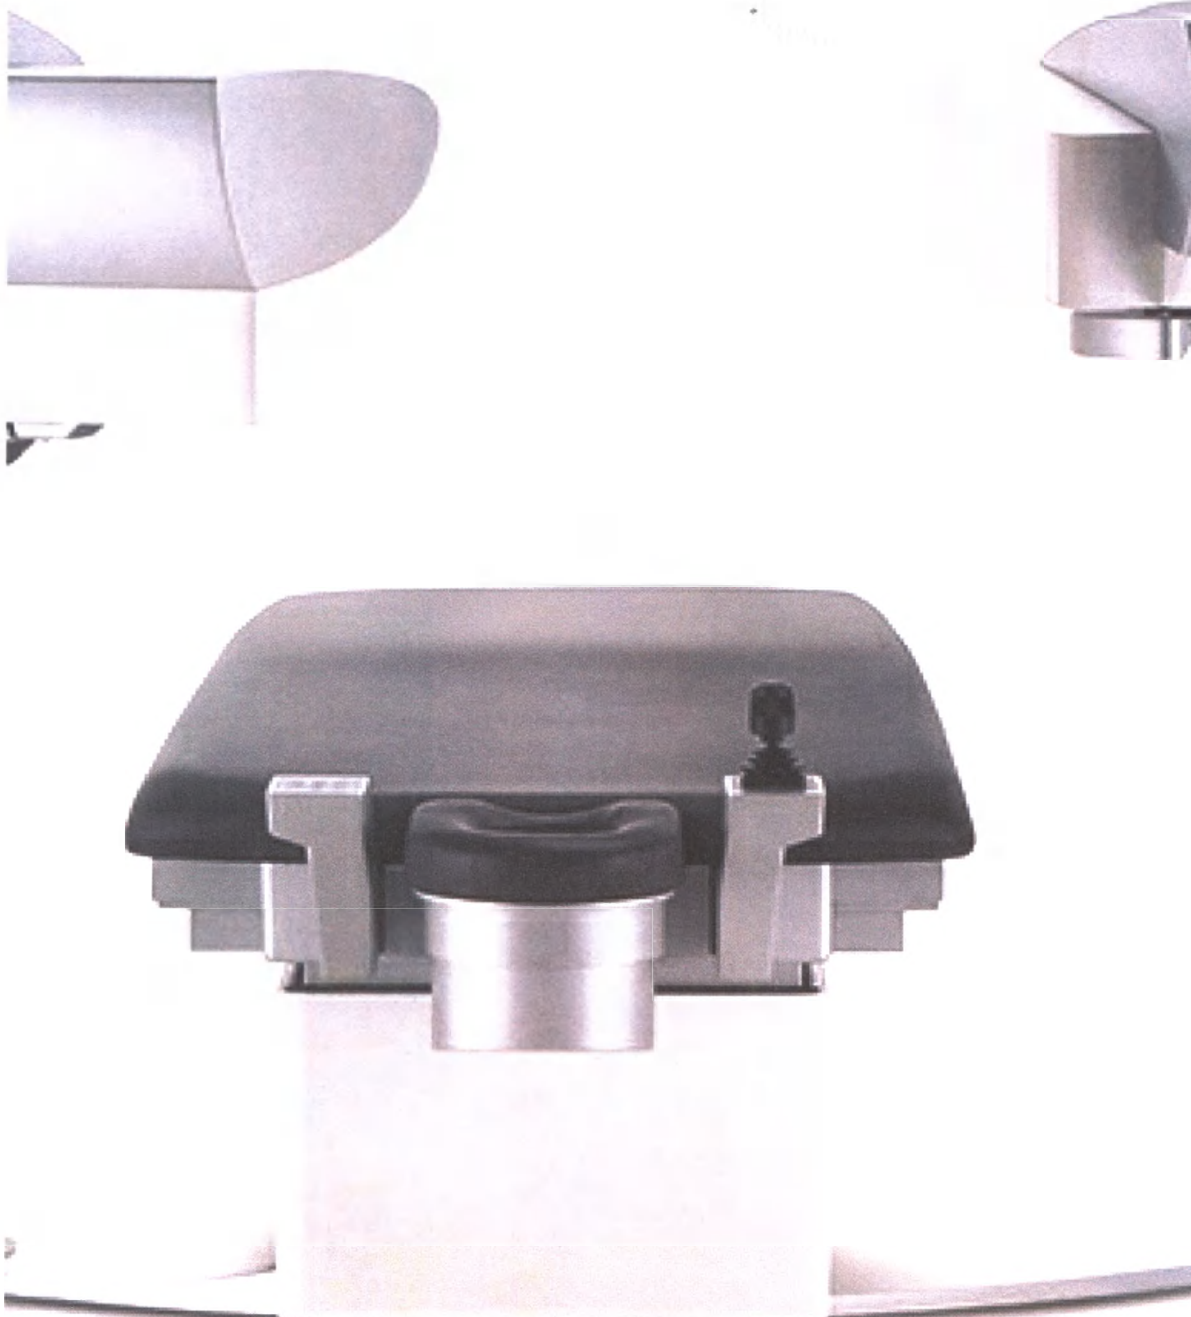


Красный:

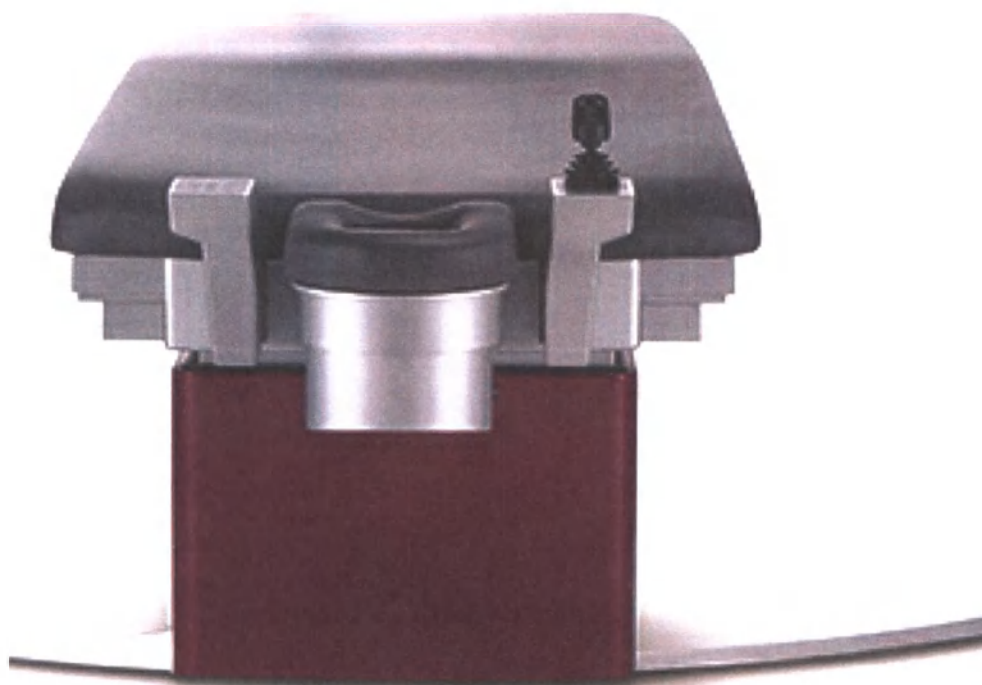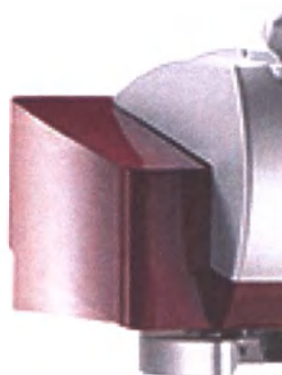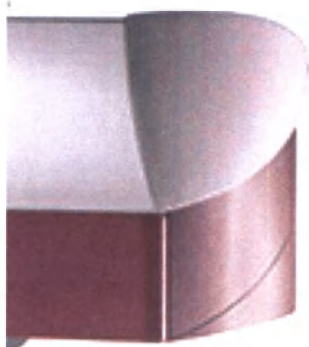

Черный:

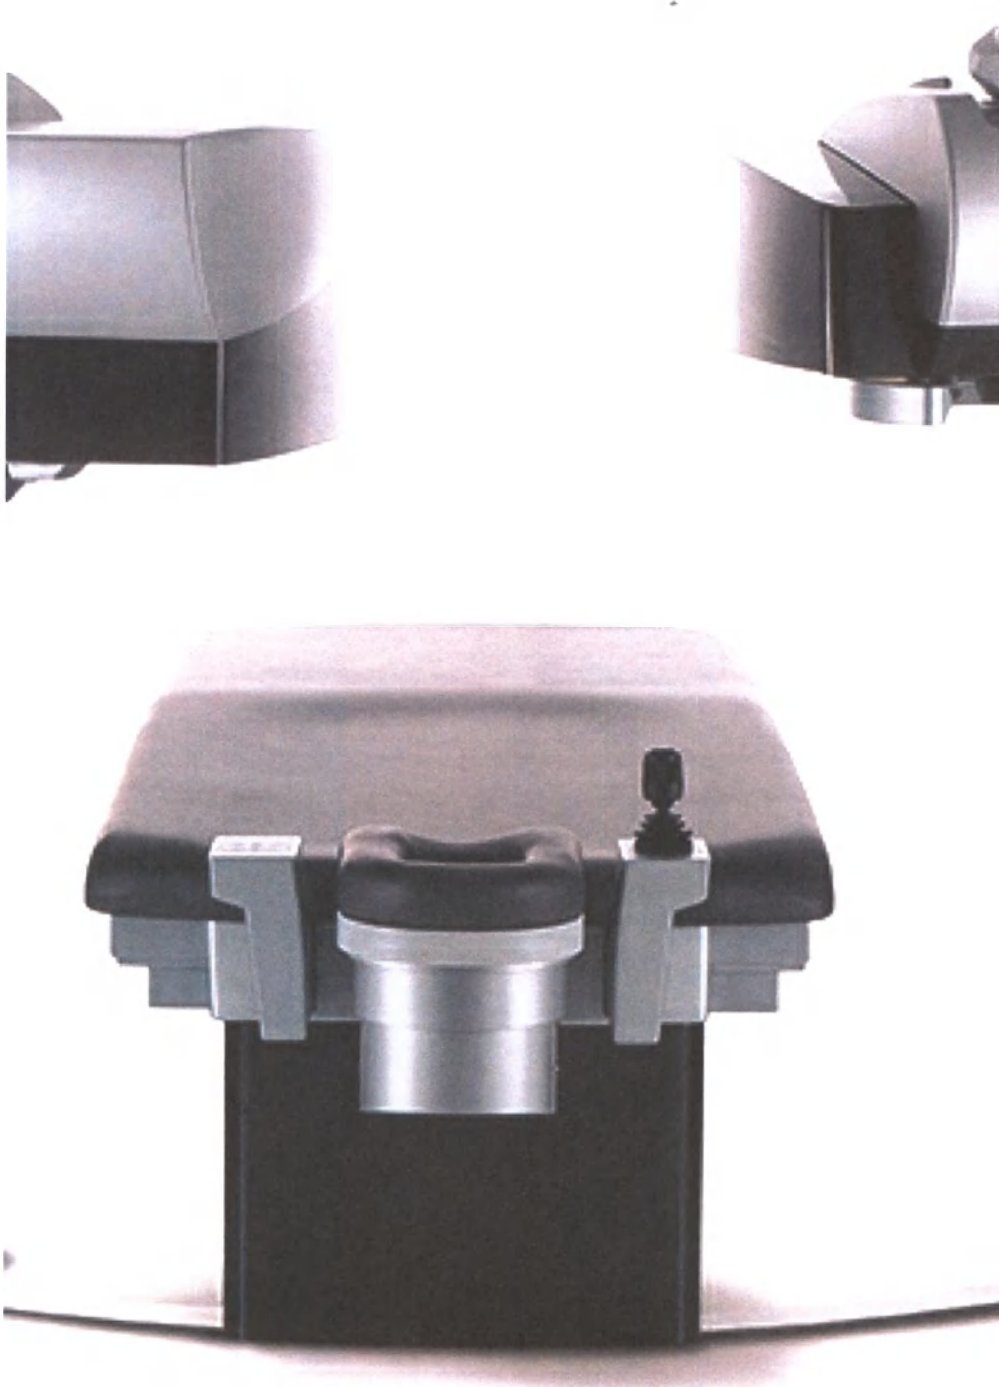


Золотой:

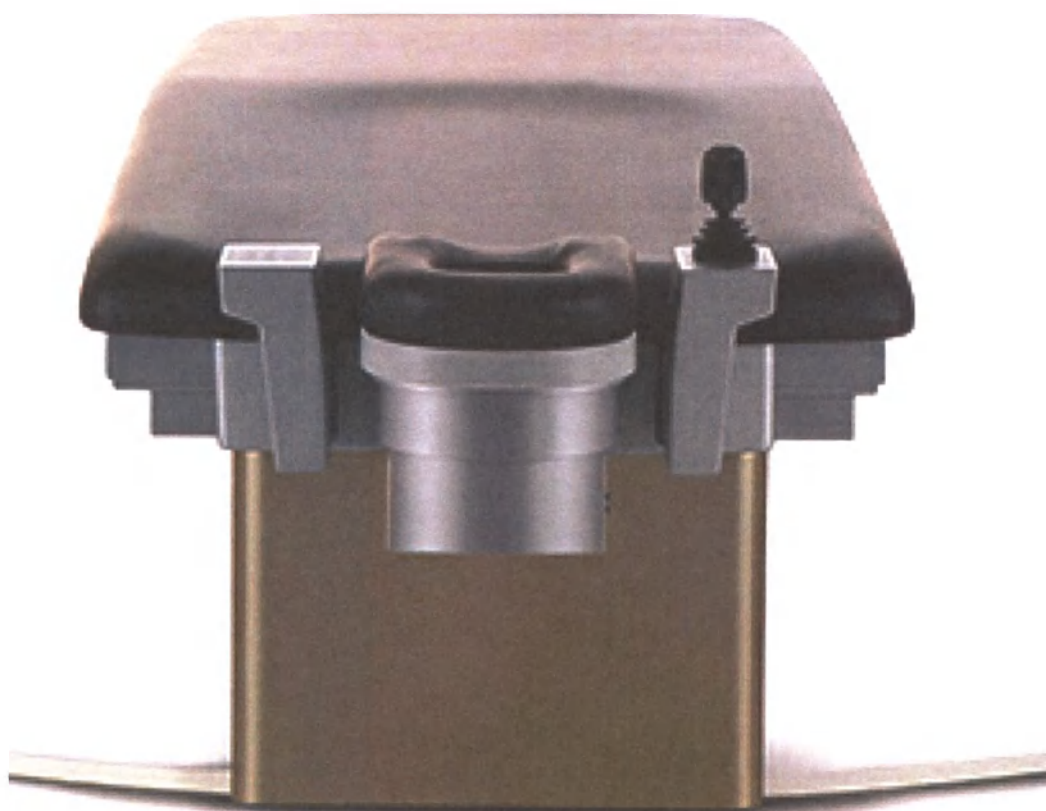

19. Направляющая для операционной платформы тип 1125 (11253039) (при необходимости) – 1 шт.



20. Пластина для позиционирования тип 1125 (11253183) (при необходимости) – 1 шт.

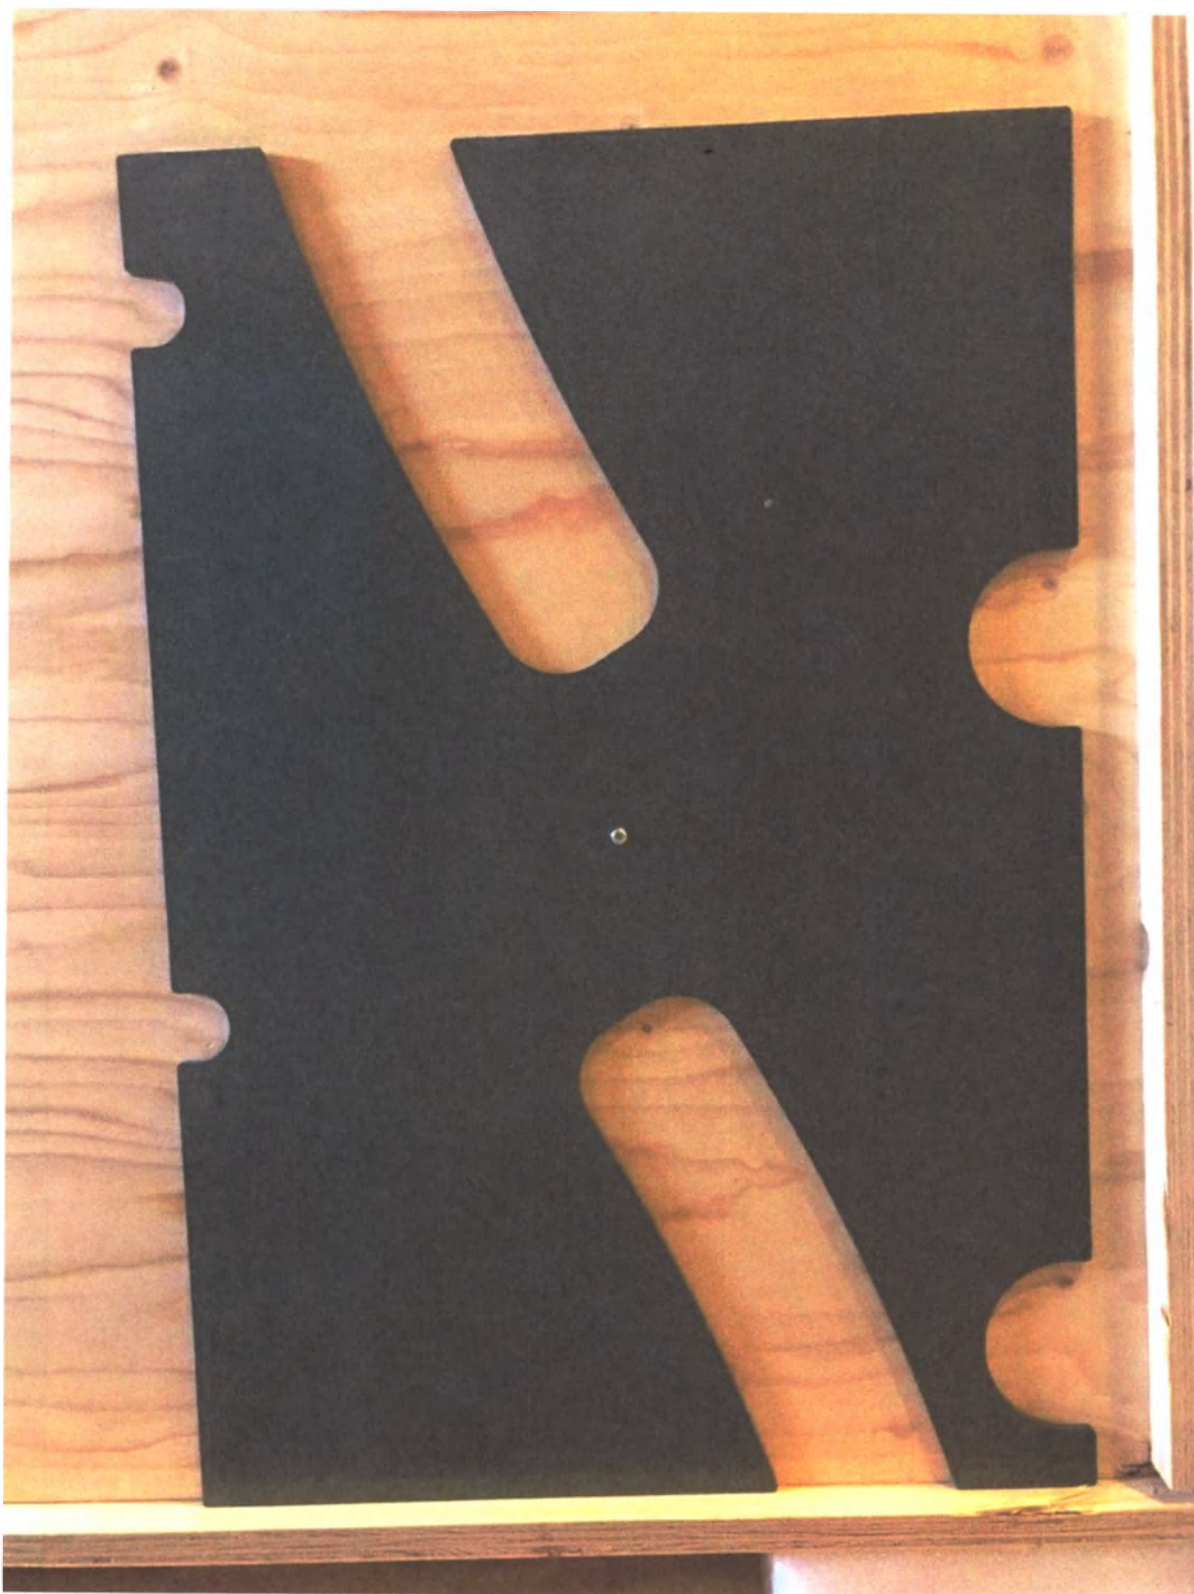

21. Набор для операционной платформы тип 1125 (8065990899) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- устройство блокировки – 1 шт.;
- кабель питания – 1 шт.;
- кабель EX – 1 шт.;
- кабель FS – 1 шт.;
- педаль с MPC3 коннектором – 2 шт.;
- винты M3×8 – до 4 шт.



22. Сетевой сервер Fujitsu, PRIMERGY TX1330 M4 (WAVENET Server 6160) (при необходимости)

- 1 шт., в составе:

· сетевой сервер Fujitsu, PRIMERGY TX1330 M4 (WAVENET Server 6160) – 1 шт.;

· документация – 1 шт.;

· сетевой кабель – до 2 шт.;

· кабель питания – до 2 шт.




22. Сетевой сервер Fujitsu, PRIMERGY TX1330 M4 (WAVENET Server 6160) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- сетевой сервер Fujitsu, PRIMERGY TX1330 M4 (WAVENET Server 6160) – 1 шт.;
- документация – 1 шт.;
- сетевой кабель – до 2 шт.;
- кабель питания – до 2 шт.



22. Сетевой сервер Fujitsu, PRIMERGY TX1330 M4 (WAVENET Server 6160) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- сетевой сервер Fujitsu, PRIMERGY TX1330 M4 (WAVENET Server 6160) – 1 шт.;
- документация – 1 шт.;
- сетевой кабель – до 2 шт.;
- кабель питания – до 2 шт.

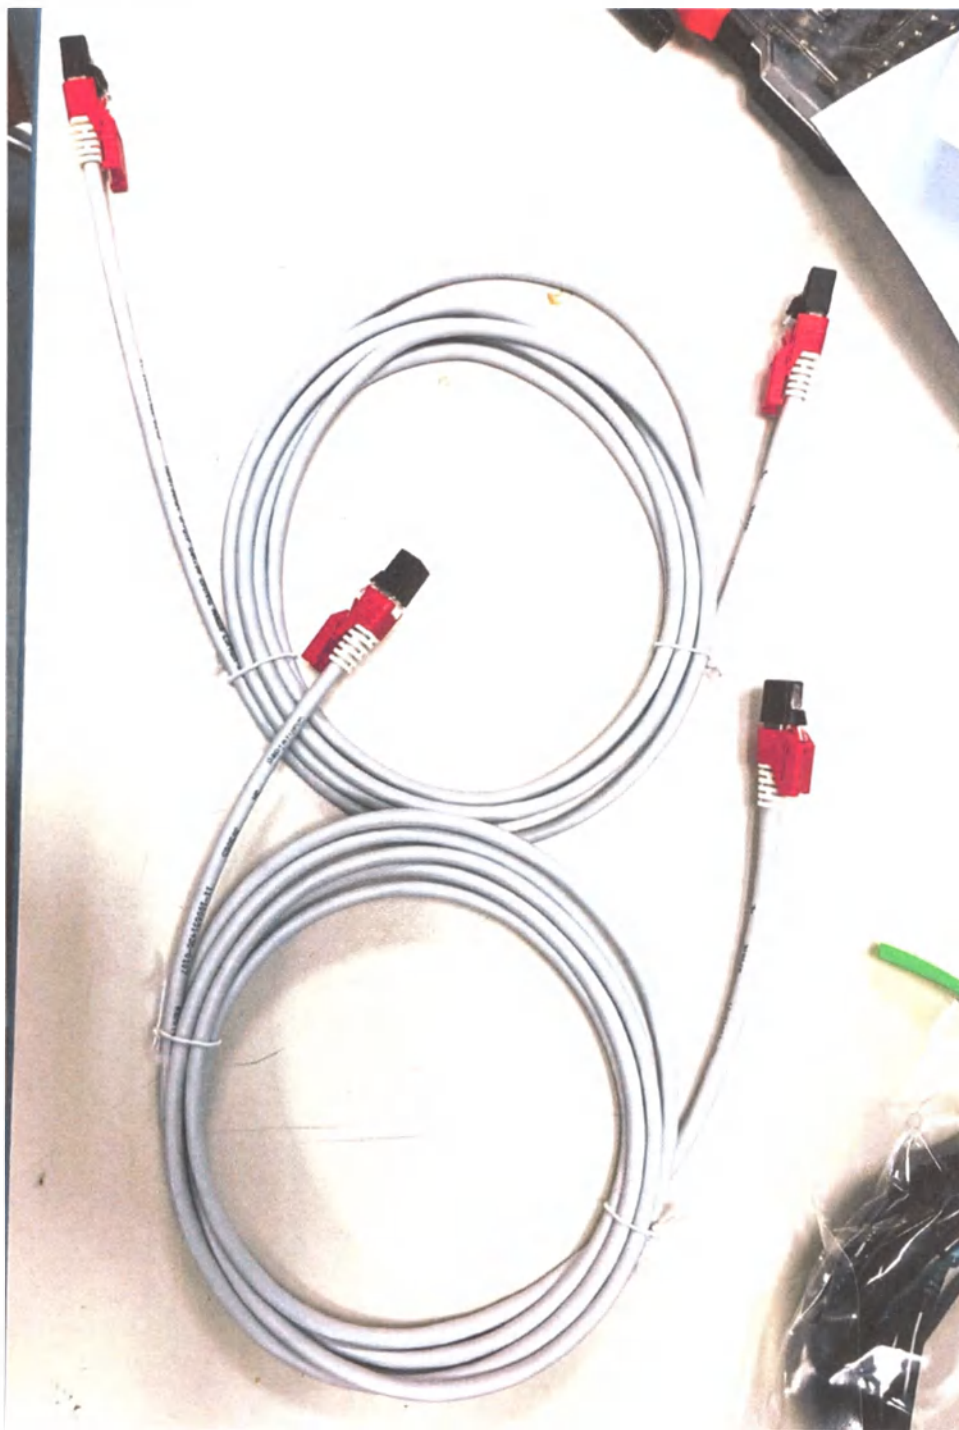

22. Сетевой сервер Fujitsu, PRIMERGY TX1330 M4 (WAVENET Server 6160) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- сетевой сервер Fujitsu, PRIMERGY TX1330 M4 (WAVENET Server 6160) – 1 шт.;
- документация – 1 шт.;
- сетевой кабель – до 2 шт.;
- кабель питания – до 2 шт.



13. Программное обеспечение WAVENET Planning Software на специальном ноутбуке (8065990816) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- специальный ноутбук для программного обеспечения WAVENET Planning Software – 1 шт.;
- документация – 1 шт.;
- сетевой кабель – 1 шт.;
- кабели питания – до 2 шт.;
- диск с программным обеспечением WAVENET Planning Software – 1 шт.



23. Программное обеспечение WAVENET Planning Software на специальном ноутбуке (8065990816) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- специальный ноутбук для программного обеспечения WAVENET Planning Software – 1 шт.;
- документация – 1 шт.;
- сетевой кабель – 1 шт.;
- кабели питания – до 2 шт.;
- диск с программным обеспечением WAVENET Planning Software – 1 шт.



24. Кресло (8065990655) (при необходимости) – 1 шт.



25. Кресло с подлокотниками (8065990648) (при необходимости) – 1 шт.




26. Набор одноразовых интерфейсов пациента WaveLight FS200 EASYPACK (8065990898) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- карта доступа FemtoCard – 1 шт.;


- интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:

- аппланационный конус – 1 шт.;
- вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

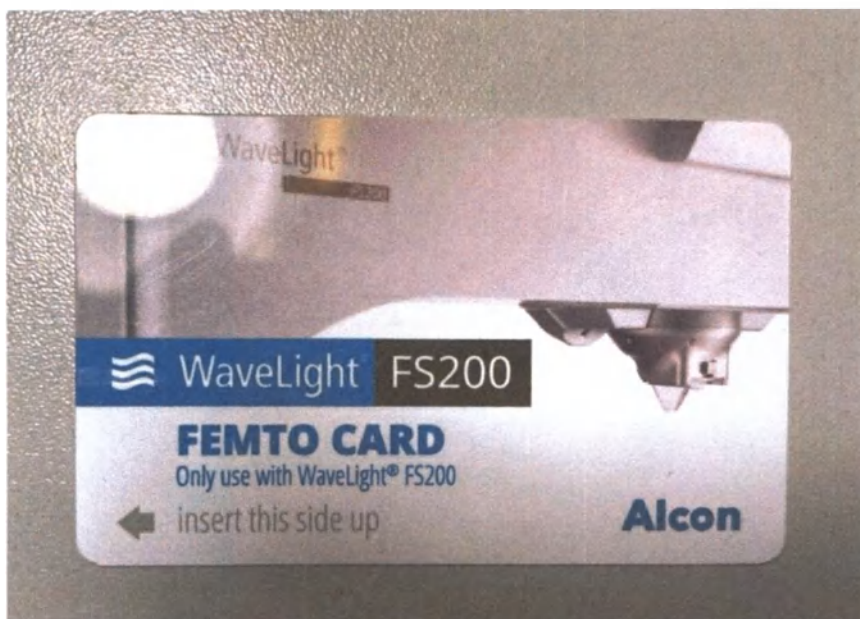

Оборотная сторона:

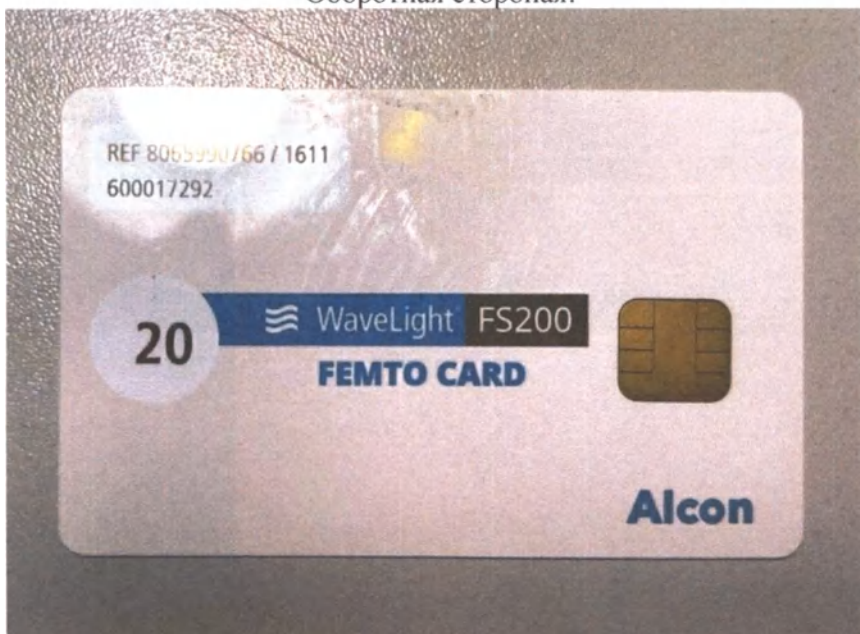

26. Набор одноразовых интерфейсов пациента WaveLight FS200 EASYPACK (8065990898) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- карта доступа FemtoCard – 1 шт.;

- интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:

- аппланационный конус – 1 шт.;
- вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.




26. Набор одноразовых интерфейсов пациента WaveLight FS200 EASYPACK (8065990898) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- карта доступа FemtoCard – 1 шт.;

- интерфейс пациента WaveLight FS200 EASYPACK – 20 шт., в составе:

- аппланационный конус – 1 шт.;
- вакуумное кольцо с двумя трубками – 1 шт.;

- инструкция по применению – 1 шт.

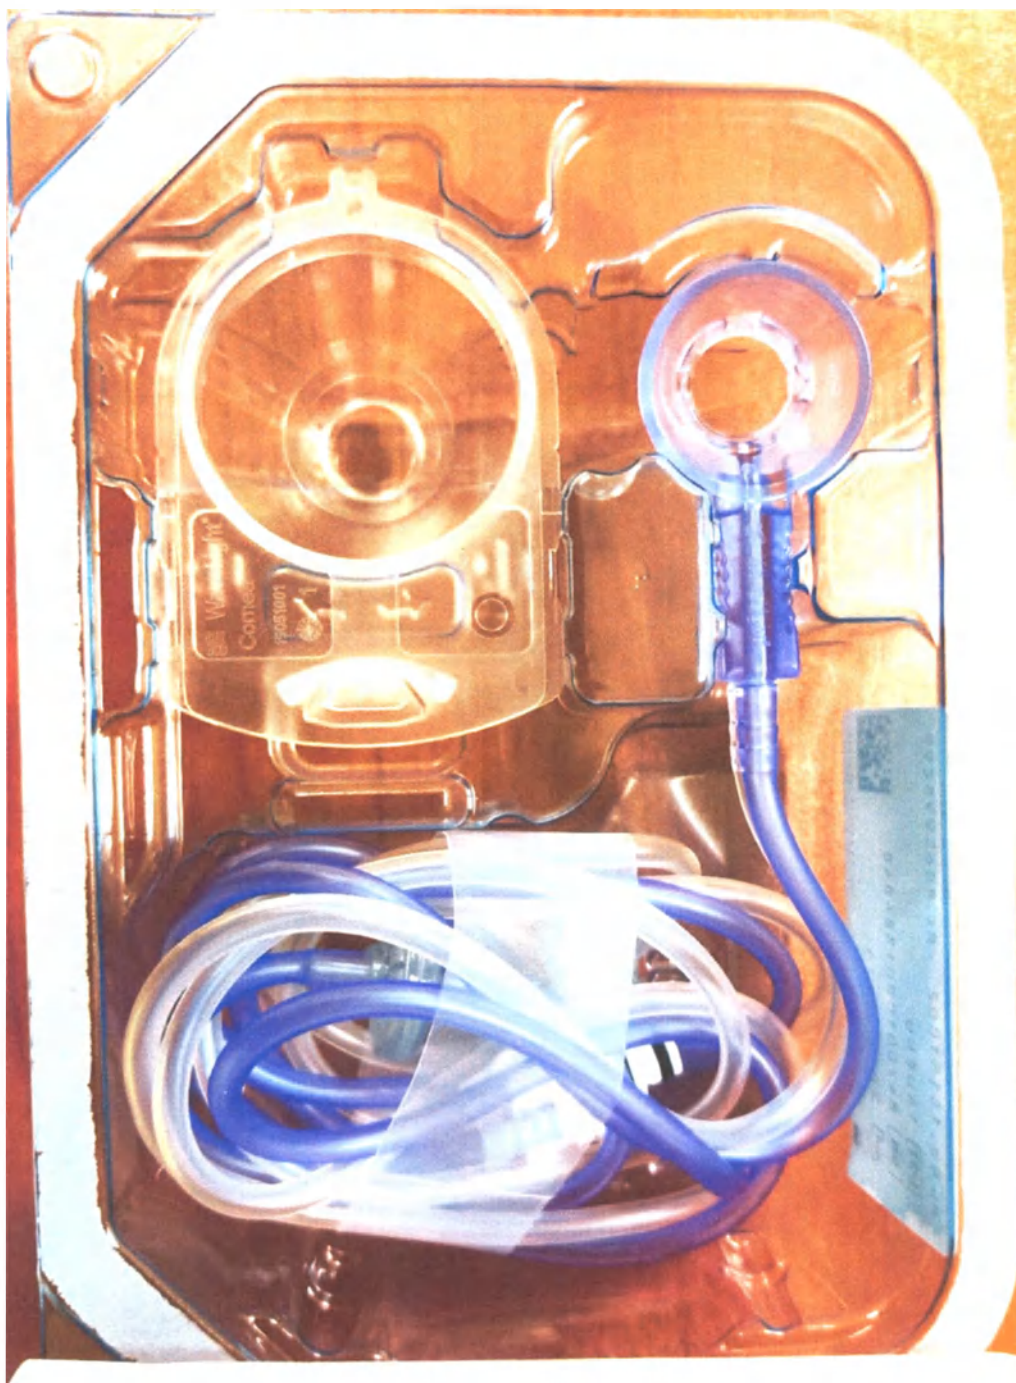

27. Набор «Система наведения при стыковке» (DGS) (8065990962) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- видеокамера – 1 шт.;
- кабель для видеокамеры – 1 шт.



28. Подставка для процедуры Lasik (8065990955) (при необходимости) – 1 шт.




29. Подставка для кератопластики (8065990951) (при необходимости) – 1 шт.



30. Набор с охлаждающей жидкостью (10251904) (при необходимости) – 1 шт., в составе:

- бутыл с охлаждающей жидкостью – 1 шт.;
- воронка – 1 шт.;
- шприц – 1 шт.;
- насадка на шприц – 1 шт.;
- трубки с коннекторами – до 2 шт.

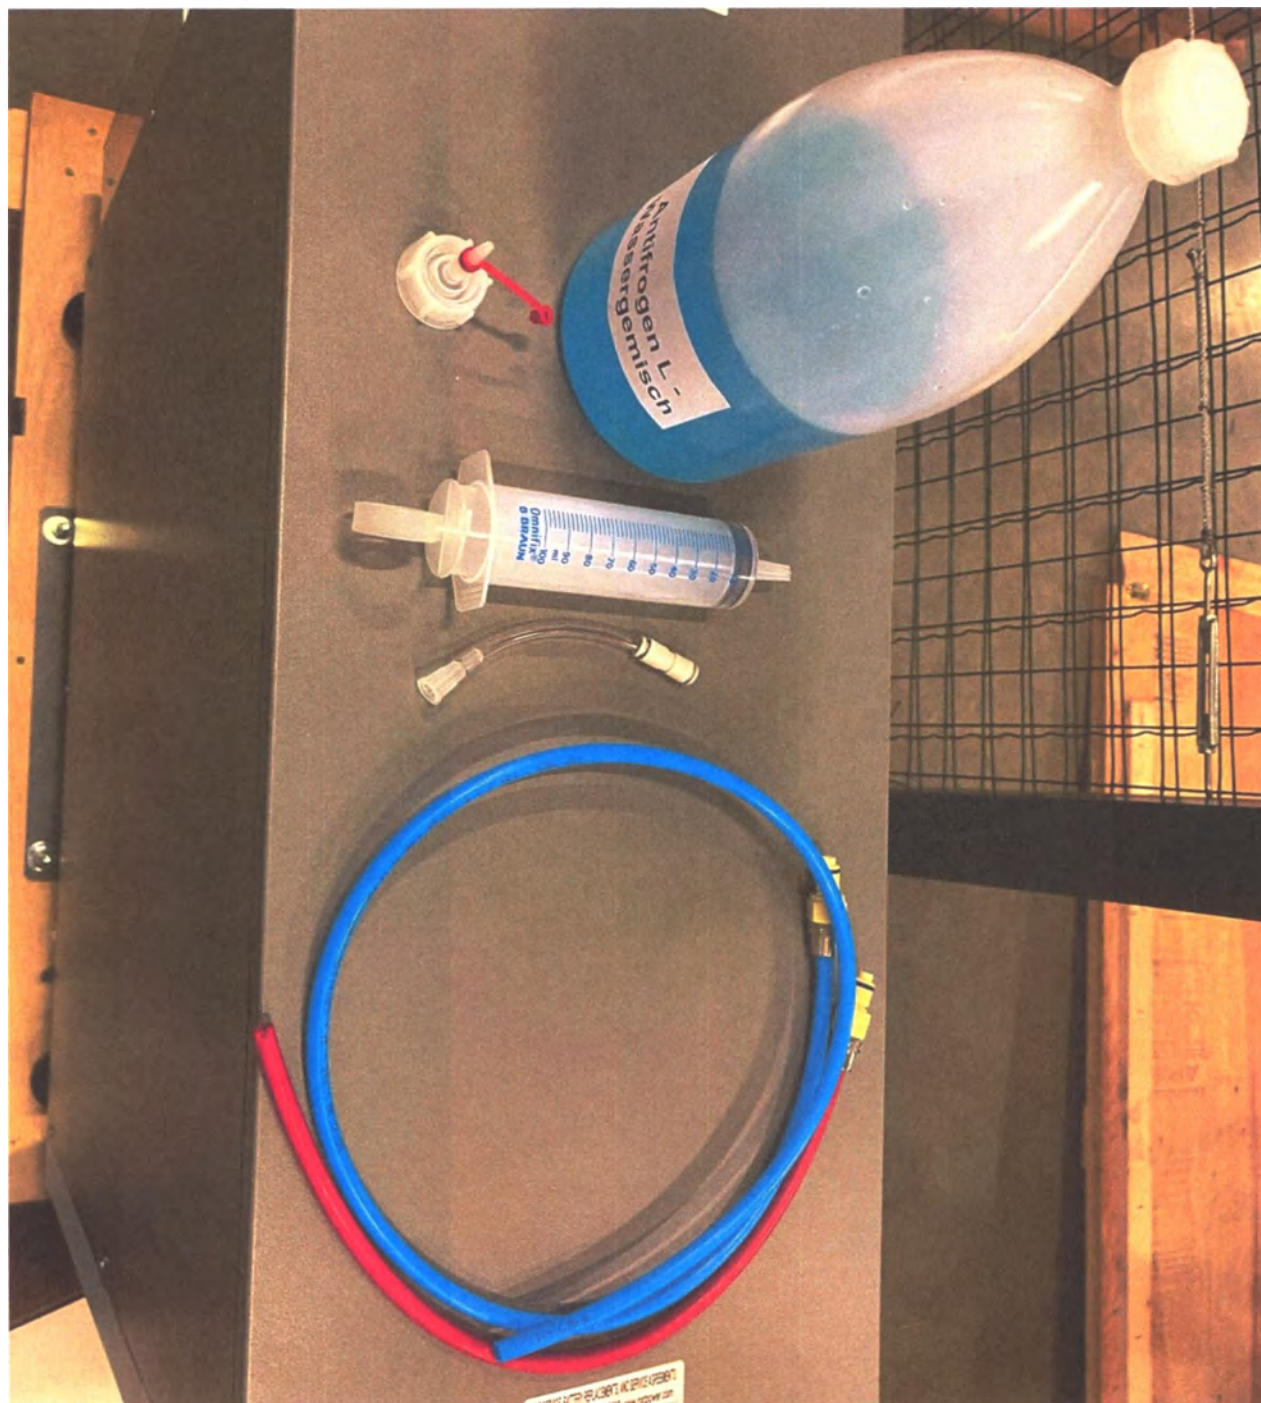

Принадлежности:


1. Сетевой кабель (61601206) – 1 шт.



2. Сервисная клавиатура CHERRY – 1 шт.



3. Сервисная клавиатура CHERRY с тачпадом (10251004) – 1 шт.

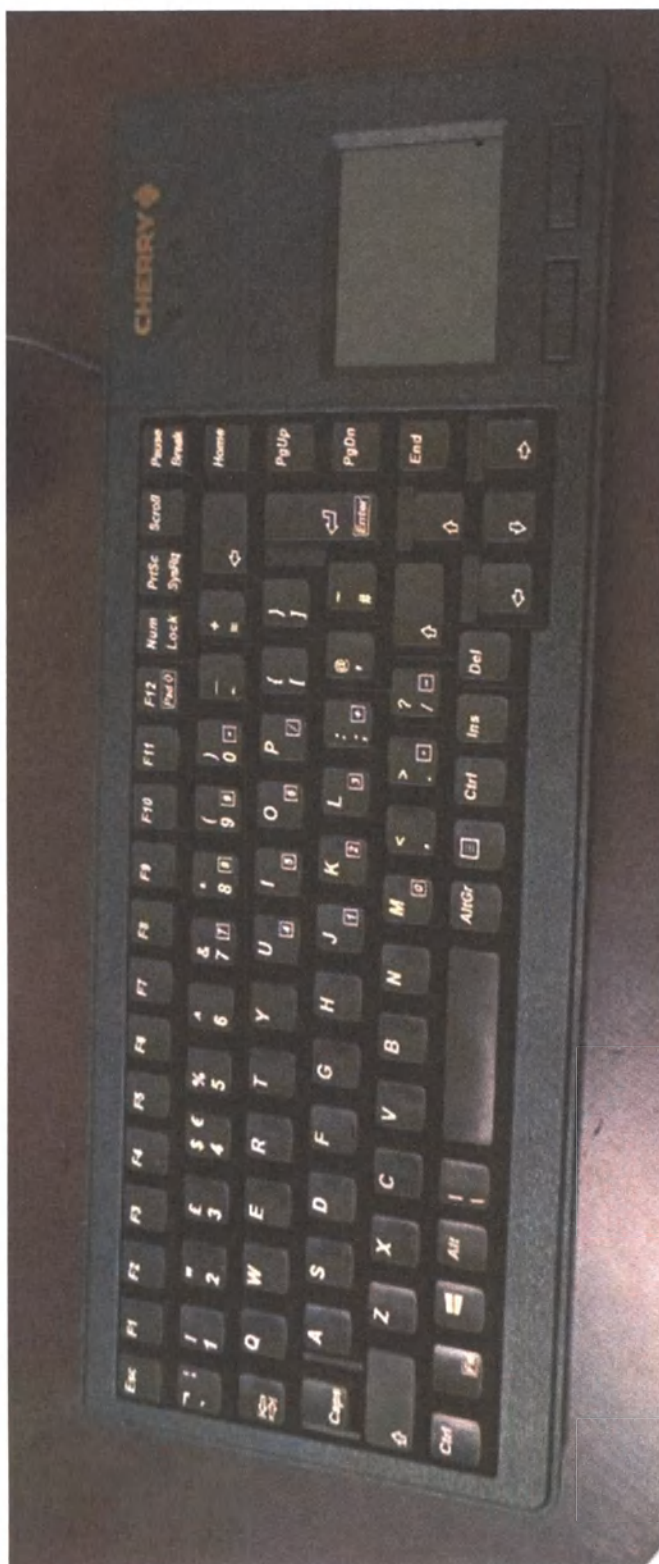

4. Кабель-адаптер для клавиатуры DIGITUS (59151018) – 1 шт.



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
50 ЛИСТА(ОВ)

Д.А. Николаев

