

Макет этикетки потребительской упаковки Набора

Вариант №1 для Короба № 1 (хранение при температуре 18 – 30 °C)



**Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов
в сухих пятнах крови человека методом тандемной масс-спектрометрии
(Neo screen 01),
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Состав набора:

1. Мобильная фаза (1000 мл) – 1 флакон;
2. Реагент для дериватизации (30 мл) – 2 флакона;
3. Восстанавливающий буфер (100 мл) – 1 флакон;
4. Промывающий раствор (1000 мл) – 1 флакон;
5. Экстрагирующий буфер (200 мл) – 1 флакон;
6. Инструкция по применению – 1 шт.

Для профессионального применения



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

Место производства:
ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44

ру

Дата регистрации

LOT



Макет этикетки потребительской упаковки Набора

Вариант № 2 для Короба № 1 (хранение при температуре 18 – 30 °С)



**Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов
в сухих пятнах крови человека методом тандемной
масс-спектрометрии (Neo screen 01)
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Состав набора:

1. Мобильная фаза (1000 мл) – 1 флакон;
2. Реагент для дериватизации (30 мл) – 2 флакона;
3. Восстанавливающий буфер (100 мл) – 1 флакон;
4. Промывающий раствор (1000 мл) – 1 флакон;
5. Экстрагирующий буфер (200 мл) – 1 флакон;
6. 96-луночный планшет – 20 шт.;
7. Защитные пленки для 96-луночных планшетов – 20 шт.;
8. Инструкция по применению – 1 шт.

Для профессионального применения



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

Место производства:
ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44

ру

Дата регистрации

LOT



Макет этикетки потребительской упаковки Набора

Вариант № 1 для Короба № 2 (хранение при температуре - 18 °С)



**Набор реагентов для анализа аминокислот
и ацилкарнитинов в сухих пятнах крови человека
методом тандемной масс-спектрометрии (Neo screen 01)
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Состав набора:

1. Внутренний стандарт (сухой) – 4 флакона;
2. Neo screen Пятна высушенной крови. Контроли для измерения аминокислот
и ацилкарнитинов уровень I - 5 пятен;
3. Neo screen Пятна высушенной крови. Контроли для измерения аминокислот
и ацилкарнитинов уровень II - 5 пятен;
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Для профессионального применения



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru


Место производства:
ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44

ру

Дата регистрации



LOT

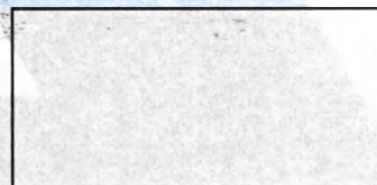

Макет этикетки потребительской упаковки Набора

Вариант № 2 для Короба № 2 (хранение при температуре - 18 °C)



**Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов
в сухих пятнах крови человека методом тандемной
масс-спектрометрии (Neo screen 01)
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Состав набора:

1. Внутренний стандарт (сухой) – 4 флакона;
2. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень I - 5 пятен;
3. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень II - 5 пятен;
4. Смесь для автонастройки (сухая) – 1 флакон;
5. Инструкция по применению – 1 шт.

Для профессионального применения



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

ру

Дата регистрации

Место производства:

ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44





Neo screen
Пятна высушенной крови.
Контроли для измерения
аминокислот и ацилкарнитинов
(Уровень II)

5 пятен

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусам
гепатита С, гепатита В отсутствуют



IVD



LOT



Смесь для автонастройки



Смесь для автонастройки
(сухая)

LOT



IVD





Neo screen
Пятна высушенной крови.
Контроли для измерения
аминокислот и ацилкарнитинов
(Уровень I)

5 пятен

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусам
гепатита С, гепатита В отсутствуют



IVD



LOT



Макеты этикеток компонентов Набора

Мобильная фаза



Внутренний стандарт (сухой)



Реагент для дериватизации



96-луночный планшет

96-ЛУНОЧНЫЙ
ПЛАНШЕТ

**CHROMOLAB**
Научно-лабораторный комплекс

96-луночный планшет
10 шт.

IVD



LOT







Защитные пленки для 96-луночных планшето

ЗАЩИТНЫЕ
ПЛЕНКИ

**CHROMOLAB**
Научно-лабораторный комплекс

**Защитные пленки
для 96-луночных планшето**
20 шт.

IVD



LOT







ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Восстанавливающий буфер



Промывающий раствор



Экстрагирующий буфер






Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.

Генеральный директор
ООО «ХромсистемсЛаб»

Глаговский П.Б.




Общее фотографическое изображение Набора

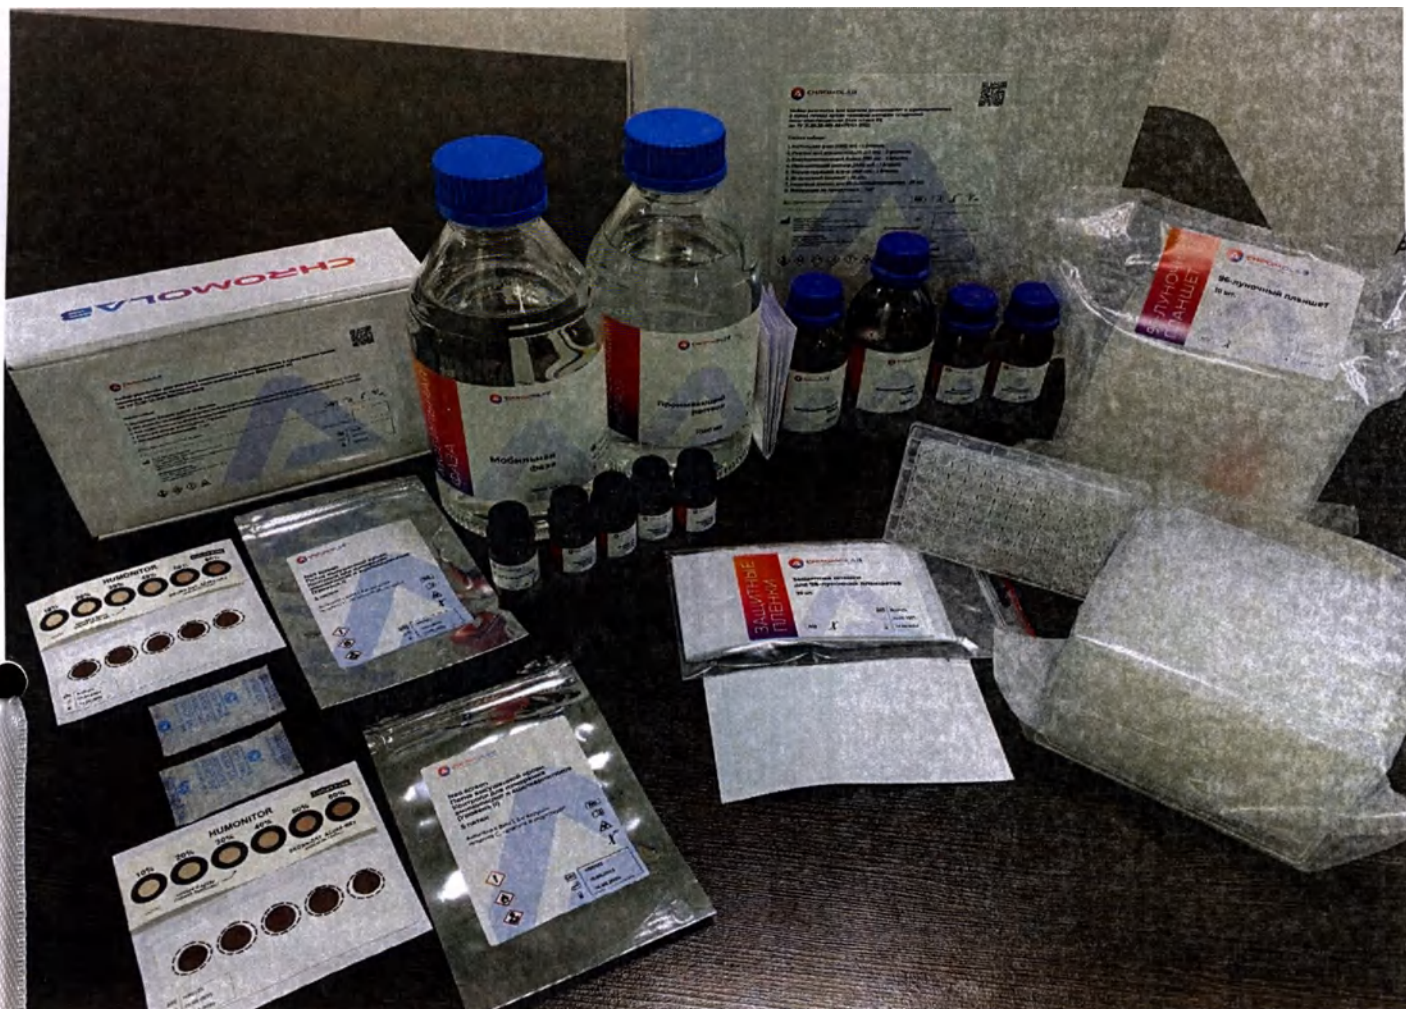

Фотографические изображения Набора для Короба №1




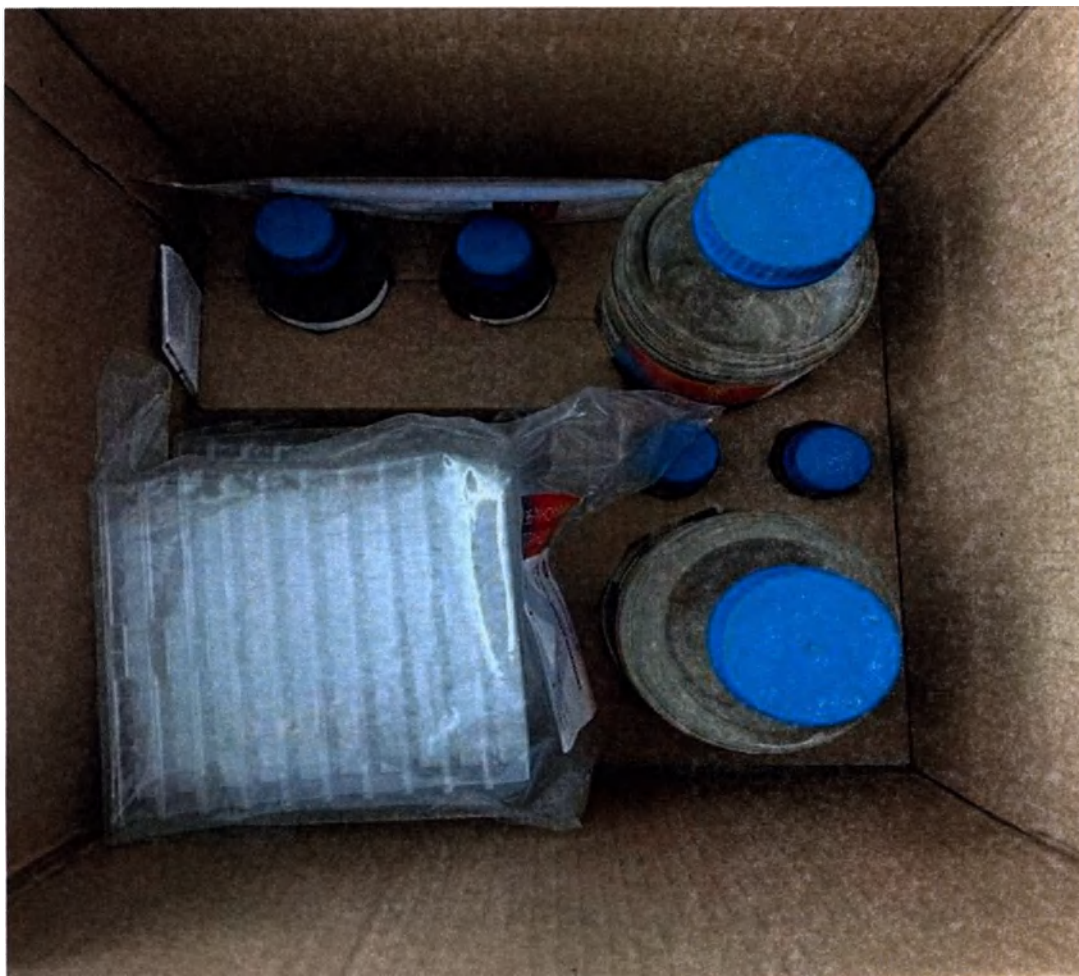

Вариант №1 (без 96-луночных планшетов и защитных пленок) для Короба № 1 (хранение при температуре 18 – 30 °С)



вариант №2 (с 96-луночными планшетами и защитными пленками) для Короба № 1 (хранение при температуре 18 – 30 °С)

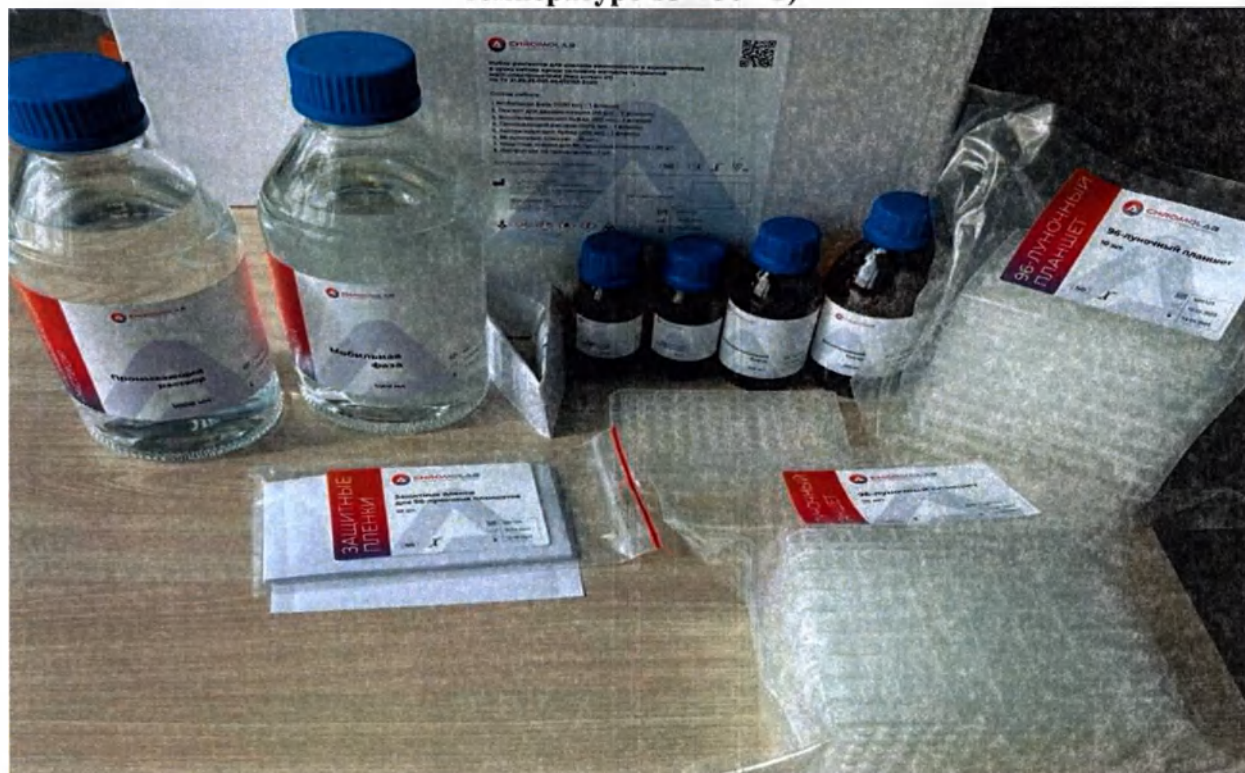


Фотографические изображения компонентов Набора в составе Короба 1


Мобильная фаза



Реагент для дериватизации

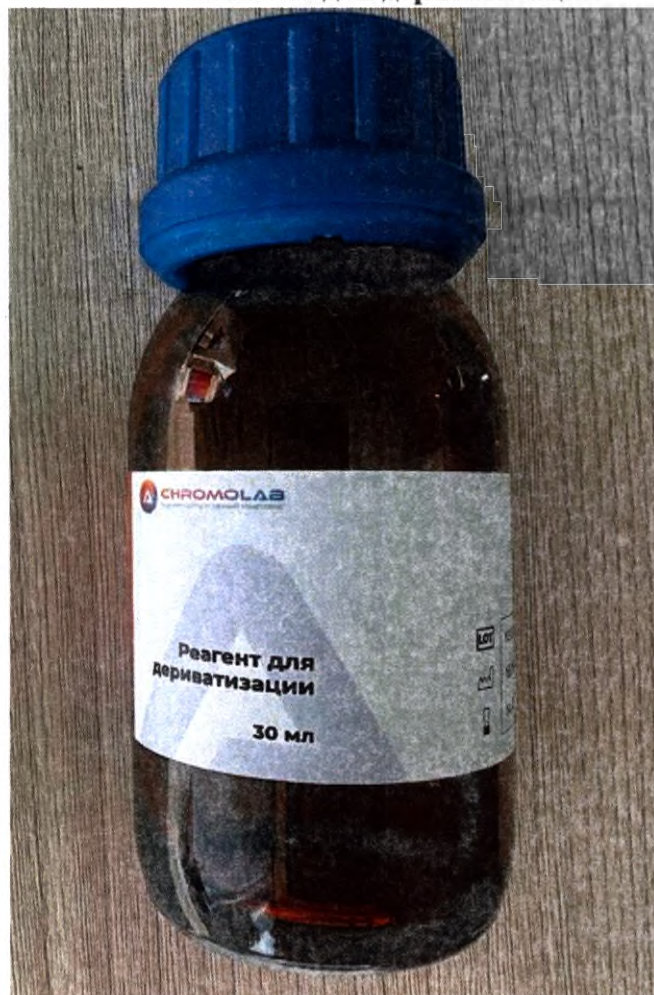

Восстанавливающий буфер

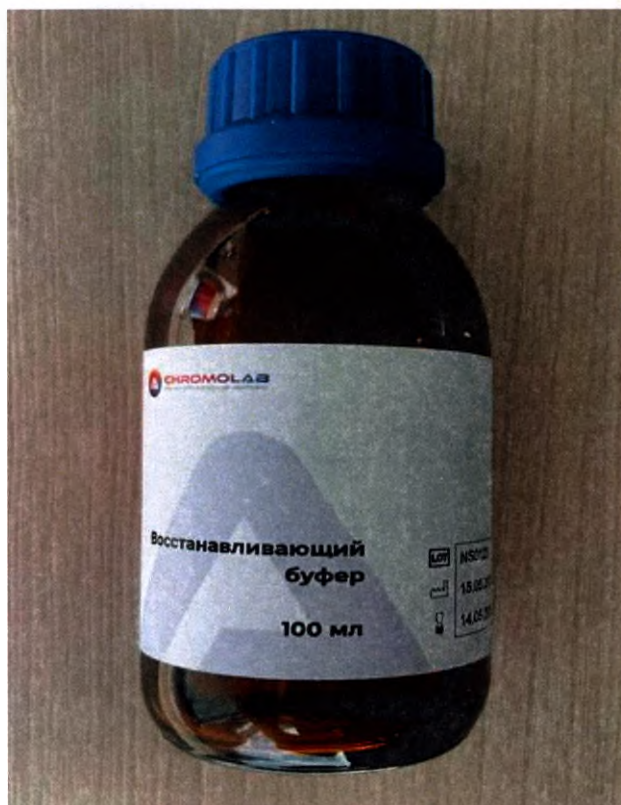


Промывающий раствор



Экстрагирующий буфер



96-луночный планшет (при необходимости)

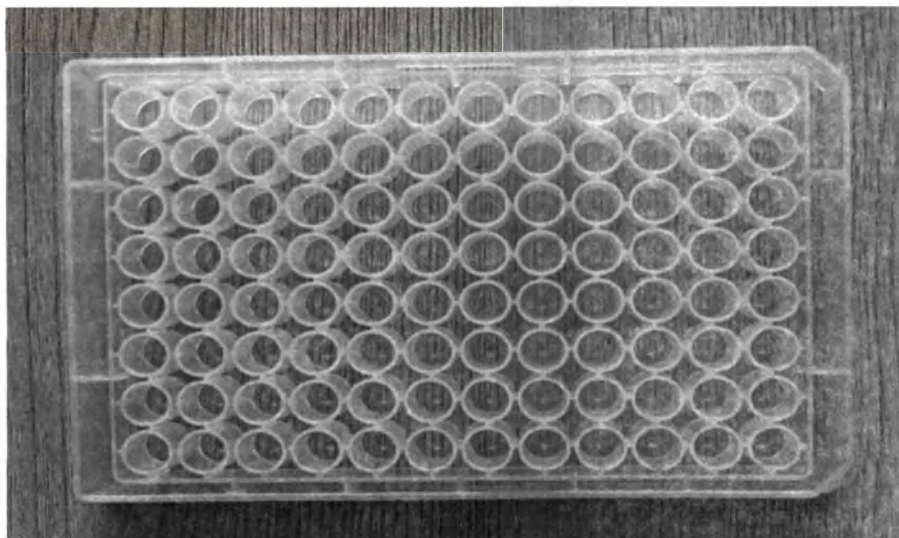

Защитные пленки для 96-луночных планшетов (при необходимости)



Фотографические изображения Набора для Короба №2



**Вариант № 1 (без смеси для автонастройки) для Короба № 2
(хранение при температуре - 18 °С)**




Вариант № 2 для Короба № 2 (хранение при температуре - 18 °С)




Фотографические изображения компонентов Набора в составе Короба 2

Внутренний стандарт (сухой)

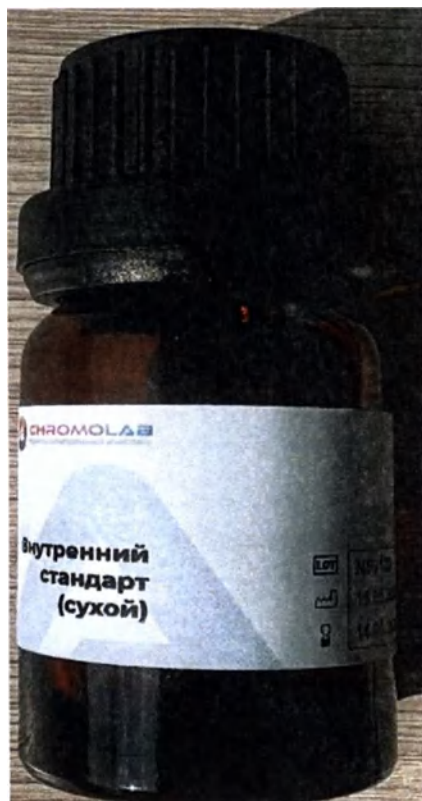

Смесь для автонастройки (сухая)
(при необходимости)

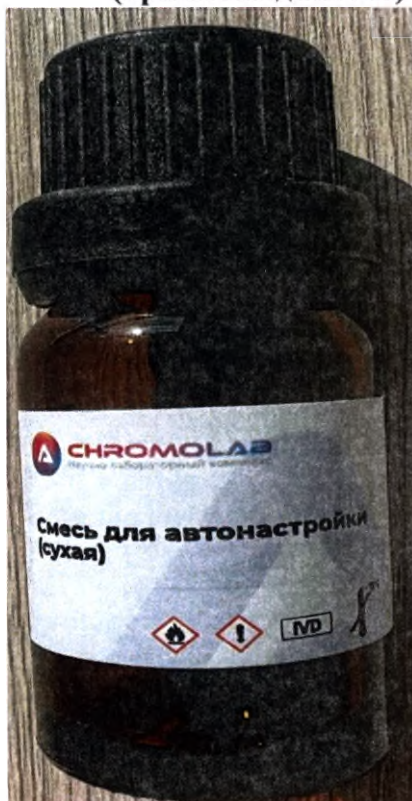

Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов
уровень I



Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень II





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.
Генеральный директор
ООО «ХромсистемсЛаб»
Глаговский П.Б.