

Вариант исполнения 1

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки Короба 1



**Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов
в сухих пятнах крови человека методом тандемной
масс-спектрометрии (Neo screen 01)
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Состав набора:

- 1. Мобильная фаза (1000 мл) – 1 флакон;**
- 2. Реагент для дериватизации (30 мл) – 2 флакона;**
- 3. Восстанавливающий буфер (100 мл) – 1 флакон;**
- 4. Промывающий раствор (1000 мл) – 1 флакон;**
- 5. Экстрагирующий буфер (200 мл) – 1 флакон;**
- 6. 96-луночный планшет (10 шт) - 2 упаковки;**
- 7. Защитные пленки для 96-луночных планшетов – 20 шт.;**
- 8. Инструкция по применению – 1 шт.**

Для профессионального применения



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

ру

Дата регистрации

Место производства:

ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44





**Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов
в сухих пятнах крови человека методом тандемной
масс-спектрометрии (Neo screen 01)
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Состав набора:

- 1. Внутренний стандарт (сухой) – 4 флакона;**
- 2. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень I - 5 пятен;**
- 3. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень II - 5 пятен;**
- 4. Смесь для автонастройки (сухая) – 1 флакон;**
- 5. Инструкция по применению – 1 шт.**

Для профессионального применения



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

Место производства:

ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44

ру

Дата регистрации

LOT






Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов в сухих пятнах крови человека методом тандемной масс-спектрометрии (Neo screen 01) по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022

Вариант исполнения 1.

1. Мобильная фаза (1000 мл) – 1 флакон;
2. Внутренний стандарт (сухой) – 4 флакона;
3. Реагент для дериватизации (30 мл) – 2 флакона;
4. Восстанавливающий буфер (100 мл) – 1 флакон;
5. Промывающий раствор (1000 мл) – 1 флакон;
6. Экстрагирующий буфер (200 мл) – 1 флакон;
7. 96-луночный планшет (10 шт) – 2 упаковки;
8. Защитные пленки для 96-луночных планшетов – 20 шт.;
9. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень I - 5 пятен;
10. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень II - 5 пятен;
11. Смесь для автонастройки (сухая) – 1 флакон;
12. Инструкция по применению – 2 шт.

Для профессионального применения



• Срок транспортировки не более 14 суток.
• После доставки Набора внешнюю упаковку необходимо незамедлительно вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом.



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

Место производства:
ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44

ру

Дата регистрации

LOT



Вариант исполнения 2

Макет этикетки вторичной (потребительской) упаковки Короба 1



**Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов
в сухих пятнах крови человека методом тандемной масс-спектрометрии
(Neo screen 01),
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Состав набора:

- 1. Мобильная фаза (1000 мл) – 1 флакон;**
- 2. Реагент для дериватизации (30 мл) – 2 флакона;**
- 3. Восстанавливающий буфер (100 мл) – 1 флакон;**
- 4. Промывающий раствор (1000 мл) – 1 флакон;**
- 5. Экстрагирующий буфер (200 мл) – 1 флакон;**
- 6. Инструкция по применению – 1 шт.**

Для профессионального применения



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д. д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

Место производства:
ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д. д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44

ру

Дата регистрации

LOT





**Набор реагентов для анализа аминокислот
и ацилкарнитинов в сухих пятнах крови человека
методом тандемной масс-спектрометрии (Neo screen 01)
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Состав набора:

1. Внутренний стандарт (сухой) – 4 флакона;
2. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень I - 5 пятен;
3. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень II - 5 пятен;
4. Инструкция по применению – 1 шт.

Для профессионального применения



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

Место производства:

ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44

ру

Дата регистрации

LOT





**Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов в сухих пятнах крови человека методом tandemной масс-спектрометрии (Neo screen 01)
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Вариант исполнения 2.

1. Мобильная фаза (1000 мл) – 1 флакон;
2. Внутренний стандарт (сухой) – 4 флакона;
3. Реагент для дериватизации (30 мл) – 2 флакона;
4. Восстанавливающий буфер (100 мл) – 1 флакон;
5. Промывающий раствор (1000 мл) – 1 флакон;
6. Экстрагирующий буфер (200 мл) – 1 флакон;
7. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень I - 5 пятен;
8. Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень II - 5 пятен;
9. Инструкция по применению – 2 шт.

Для профессионального применения



• Срок транспортировки не более 14 суток.
• После доставки Набора внешнюю упаковку необходимо незамедлительно вскрыть и поместить реагенты на хранение в соответствии с указанным на внутренней упаковке температурным режимом.



ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/22-30
Телефон: +7 (495) 369-33-09, neoscrin@chromolab.ru,
www.chromolab-production.ru

Место производства:

ООО "ХромсистемсЛаб"
117246, г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 2,
эт/пом/ком 2/1/43, 44

ру

Дата регистрации

LOT



Макеты этикеток компонентов Наборов

Мобильная фаза



Внутренний стандарт (сухой)



Реагент для дериватизации



Восстанавливающий буфер



Промывающий раствор



Экстрагирующий буфер



Смесь для автонастройки (только для варианта исполнения 1)


 **CHROMOLAB**
Научно-лабораторный комплекс

Смесь для автонастройки
(сухая)

LOT

IVD

18°C 30°C



96-луночный планшет (только для варианта исполнения 1)

**96-ЛУНОЧНЫЙ
ПЛАНШЕТ**

 **CHROMOLAB**
Научно-лабораторный комплекс

96-луночный планшет
10 шт.

LOT

IVD

18°C 30°C



Защитные пленки для 96-луночных планшетов (только для варианта исполнения 1)

**ЗАЩИТНЫЕ
ПЛЕНКИ**

 **CHROMOLAB**
Научно-лабораторный комплекс

Защитные пленки
для 96-луночных планшетов
20 шт.

LOT

IVD

18°C 30°C





Neo screen
Пятна высушенной крови.
Контроли для измерения
аминокислот и ацилкарнитинов
(Уровень I)

5 пятен


Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусам
гепатита С, гепатита В отсутствуют



IVD



LOT

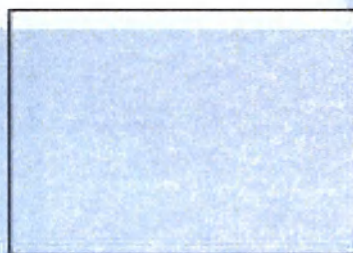



**Neo screen
Пятна высушенной крови.
Контроли для измерения
аминокислот и ацилкарнитинов
(Уровень II)**

5 пятен


Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусам
гепатита С, гепатита В отсутствуют



IVD



LOT

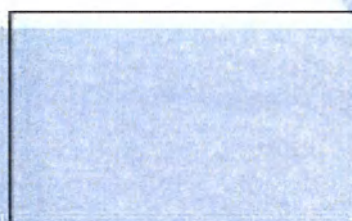

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11 листов.


Генеральный директор
ООО «ХромсистемсЛаб»

Глаговский П.Б.



**Набор реагентов для анализа аминокислот и ацилкарнитинов в сухих пятнах крови человека методом тандемной масс-спектрометрии (Neo screen 01),
по ТУ 21.20.23-001-66475153-2022**

Фотографические изображения транспортной упаковки (на примере Варианта исполнения 1)

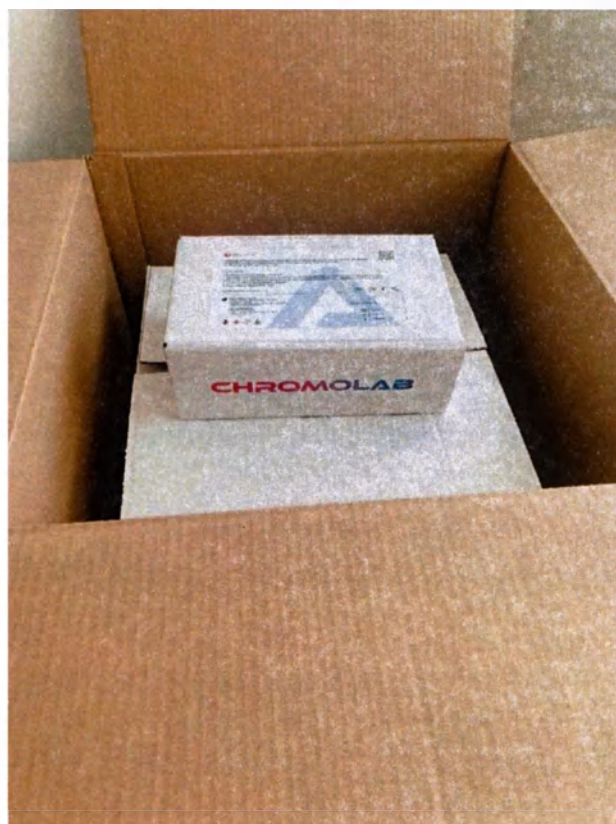


Вариант исполнения 1

Общее фотографическое изображение Набора



Фотографические изображения вторичной упаковки Короб 1 и компонентов Короба 1 (хранение при температуре 18 – 30 °С)

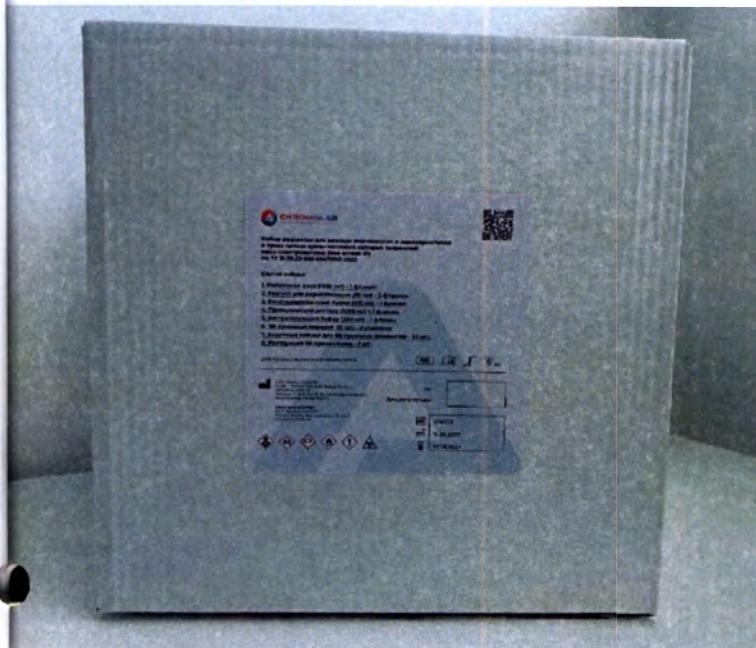

Фотографические изображения вторичной упаковки Короб 2 и компонентов Короба 2 (хранение при температуре - 18 °C)



Вариант исполнения 2

Общее фотографическое изображение Набора



Фотографические изображения компонентов Короба 1 (хранение при температуре 18 – 30 °С)



Фотографические изображения компонентов Короба 2 (хранение при температуре - 18 °C)




Фотографические изображения компонентов Набора

Мобильная фаза



Реагент для дериватизации

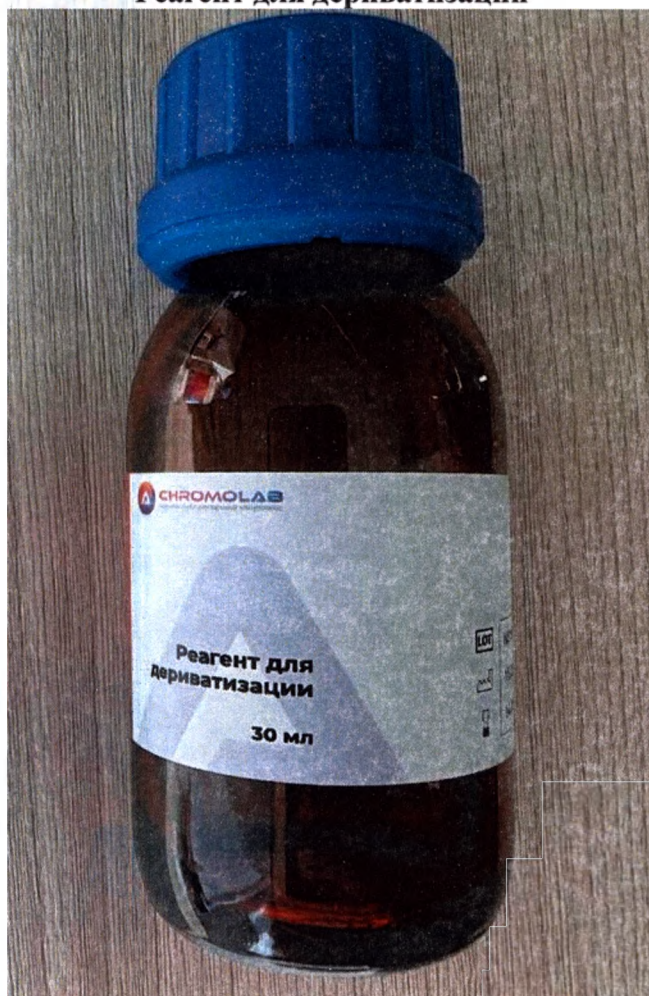


Восстанавливающий буфер




Промывающий раствор



Экстрагирующий буфер

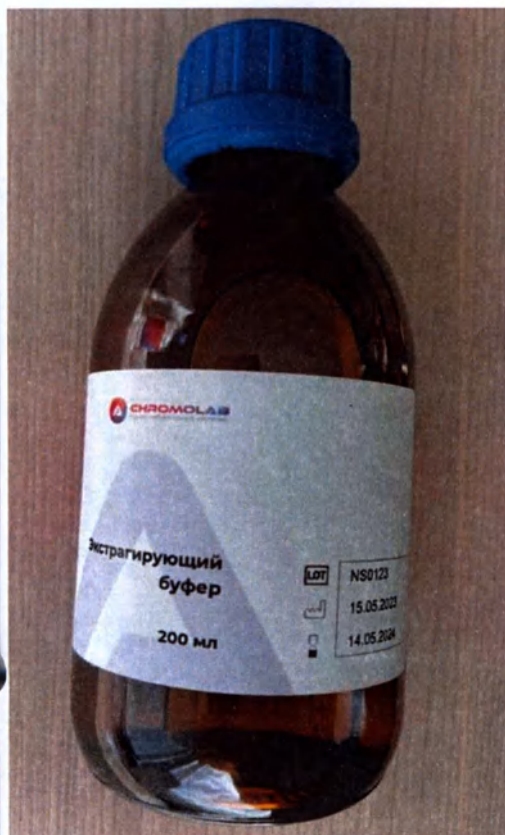


Внутренний стандарт (сухой)

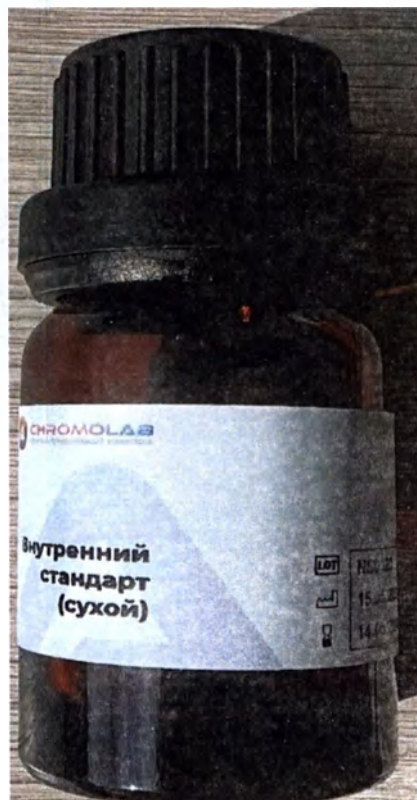

Смесь для автонастройки (сухая)
(только для Варианта исполнения 1)



96-луночный планшет (только для Варианта исполнения 1)

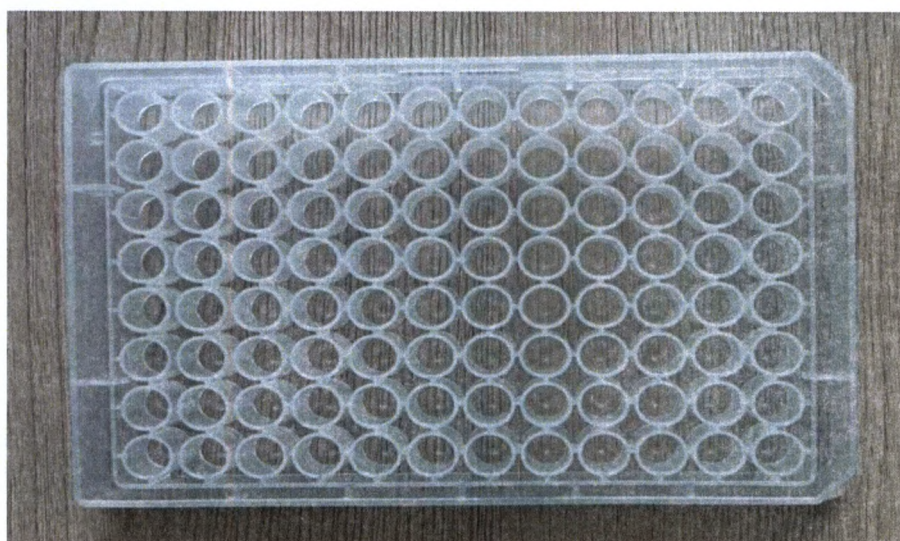


Защитные пленки для 96-луночных планшетоов (только для Варианта исполнения 1)



Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень I



Neo screen Пятна высушенной крови, Контроли для измерения аминокислот и ацилкарнитинов уровень II

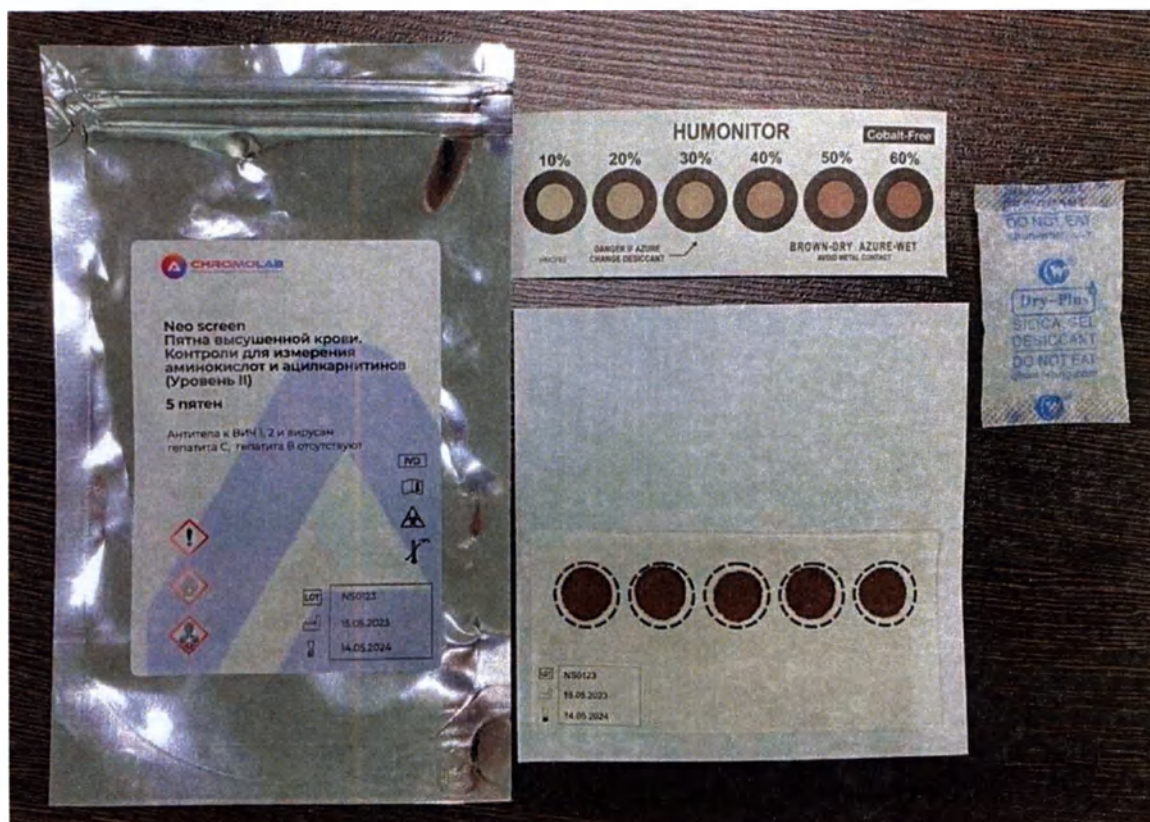

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.

Генеральный директор
ООО «ХромсистемсЛаб»
Глаговский П.Б.

