



Имплантат стоматологический XPEED AnyRidge с внутренним соединением (XPEED AnyRidge Internal Fixture): FANIHX3507C.



плекте с фиксирующим винтом (Temporary Abutment): AANTAN5012T; Абатмент EZ Post в комплекте с фиксирующим винтом (EZ Post Abutment): AEPN4025L; Абатмент ССМ в комплекте с фиксирующим винтом (ССМ Abutment): AANCAN4012L; Абатмент Multi-unit в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Abutment): AANSAL4024; Абатмент Multi-unit угловой в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Angled Abutment): AANMUH50317L.

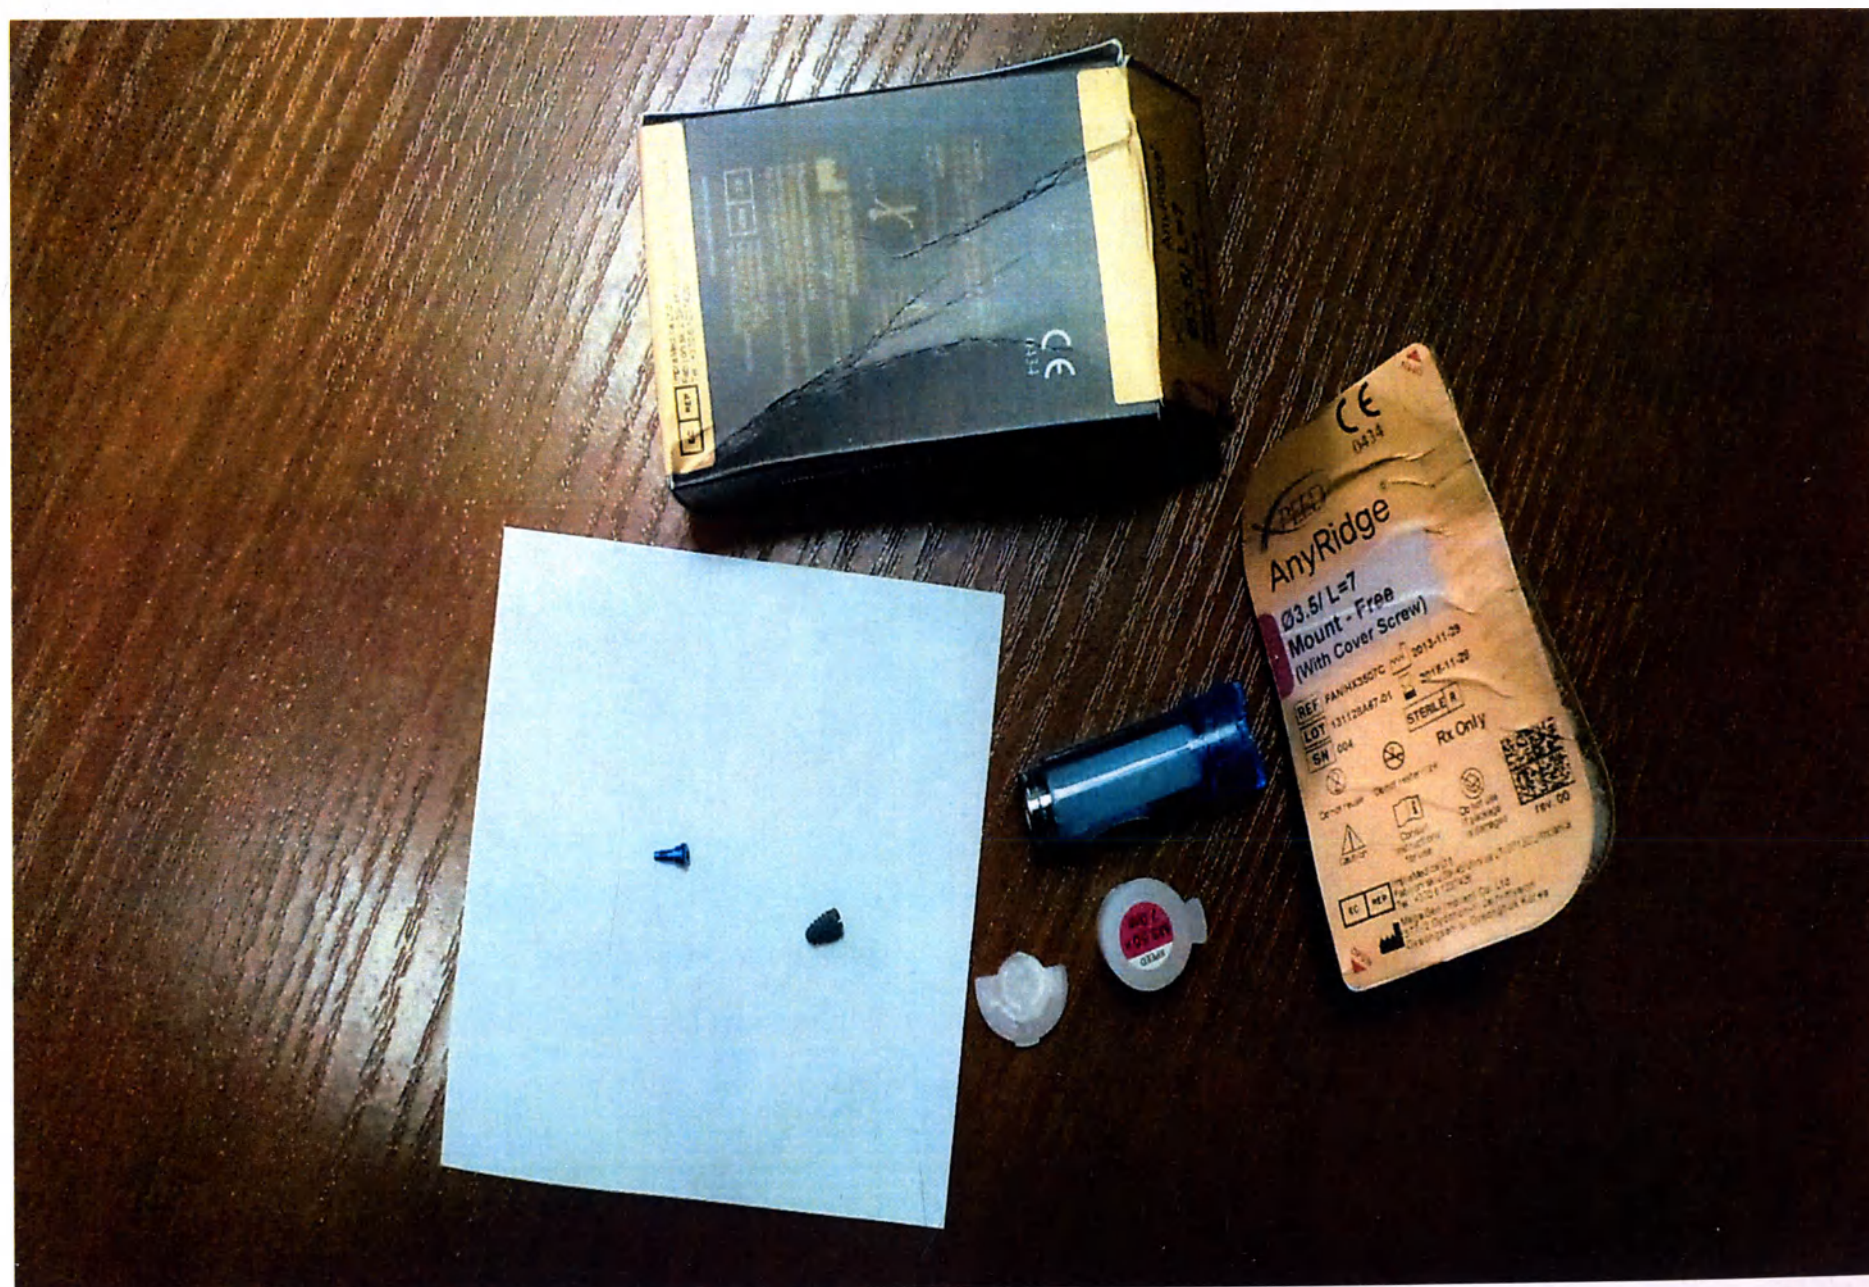

Абатмент золотой в комплекте с фиксирующим винтом (Gold Abutment): AANGAH4012L.

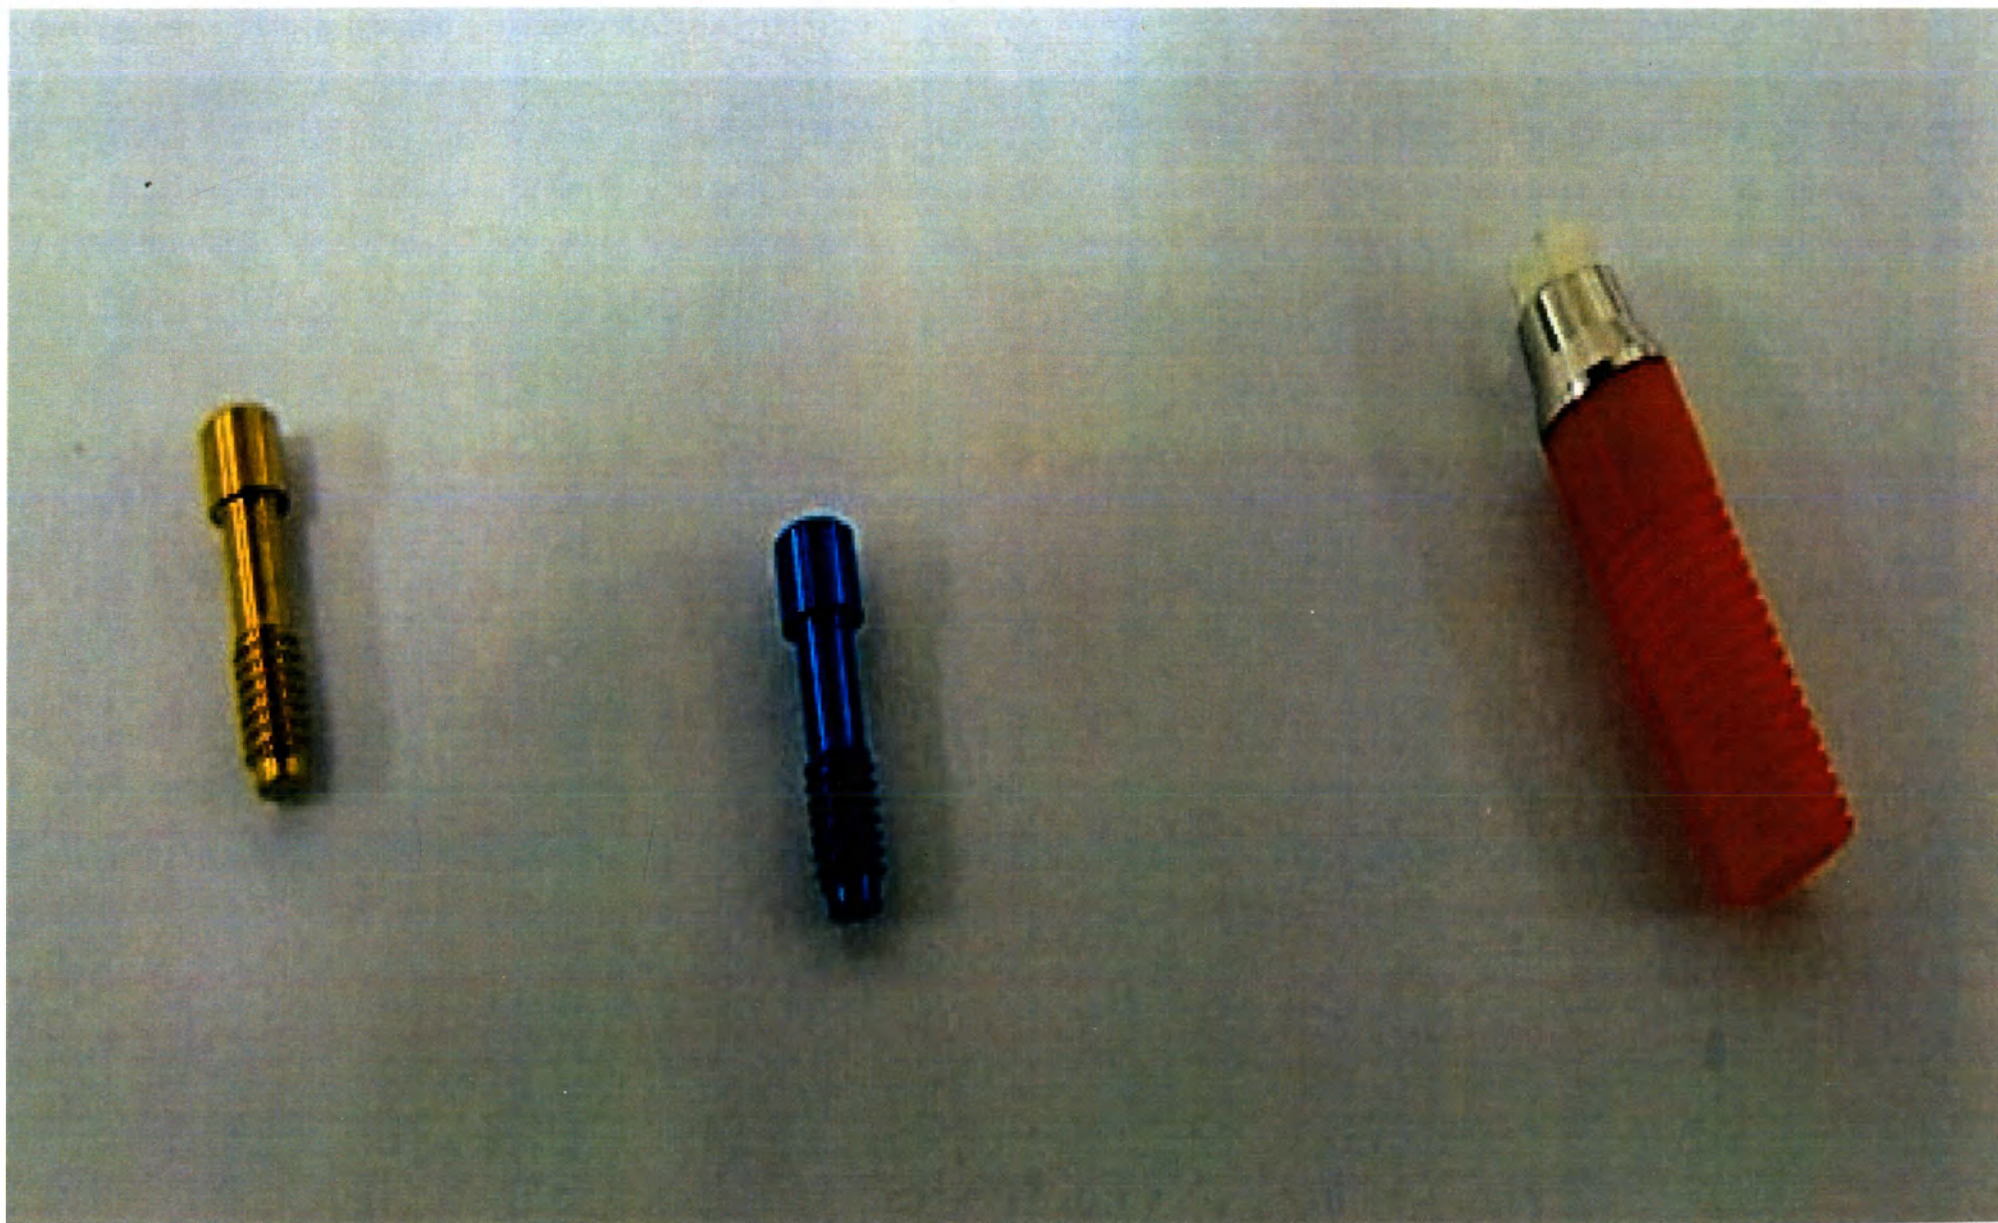


аемый в комплекте с фиксирующим винтом (Milling Abutment): AANMAH4029L; Абатмент
OAF4010; Абатмент плоский (Flat Abutment): AANFAL3510; Абатмент пластиковый (Plastic
раняющий в комплекте с фиксирующим винтом и заглушкой (Fuse Abutment): AFAA5315P; Абатмент
винтом (Angled Abutment): AANAAN4215L.



комплекте с фиксирующим винтом (Zirconia Abutment): AANZAH4012L; Аналог лабораторный (Lab. /
торный для плоского абатмента (Flat Lab Analog): FLA3512; Винт-заглушка (CoverScrew): AANCSF3508
мента (Flat Cover Screw): FCS3510; Колпачок защитный (Comfort Cap): AANCCF440.




Комплекты с фиксирующим винтом (Healing Cap): AANOHC4000T; Колпачок металлический слепочный (Snap Impression Coping): AANSIF440; Комплект из 2-х (Steel Housing): 141CAE; Комплект из 4-х колпачков ретенционных (4 Retentive Caps): 140CEV.

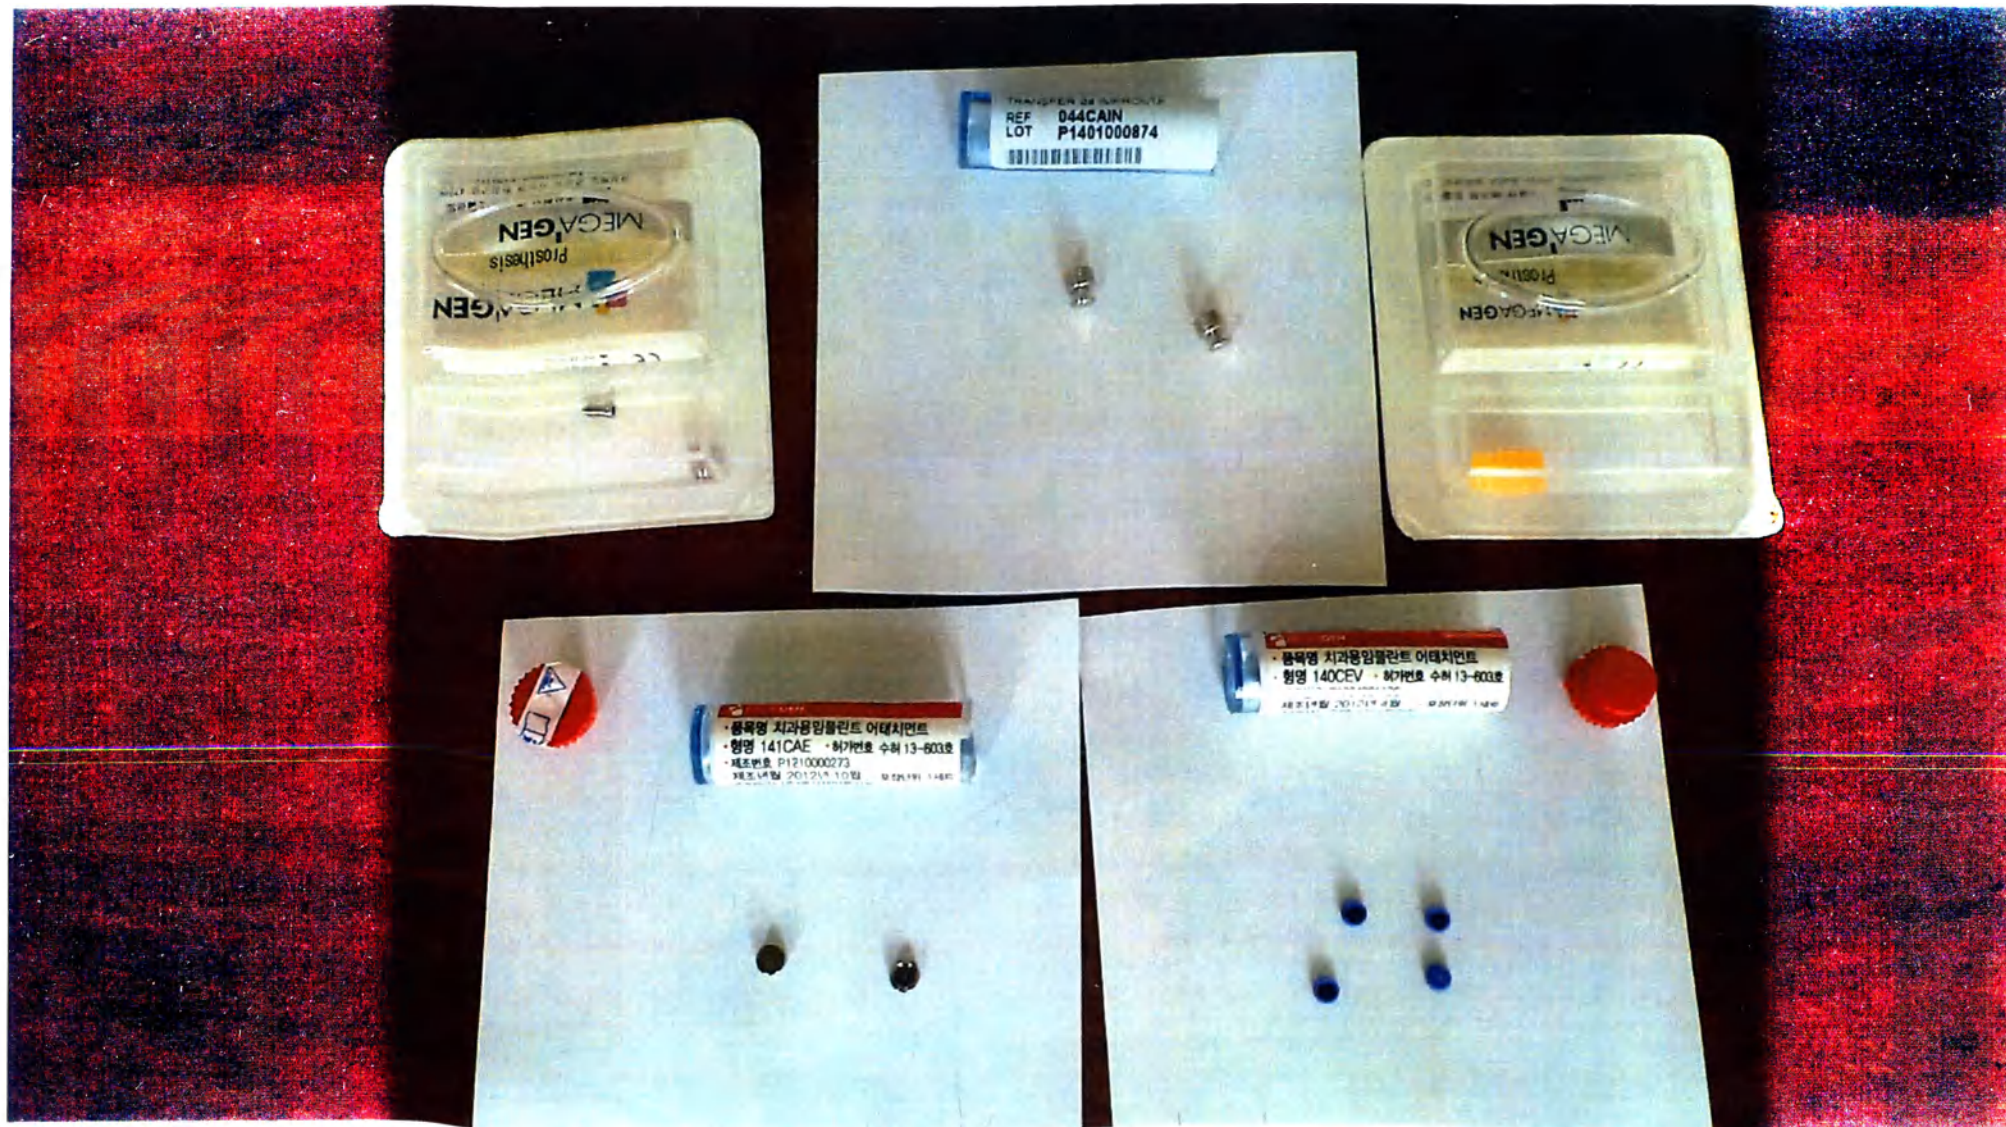

Локатор Meg-Rhein: ADR06.



Мембрана титановая i-Gen: IG1W5510.

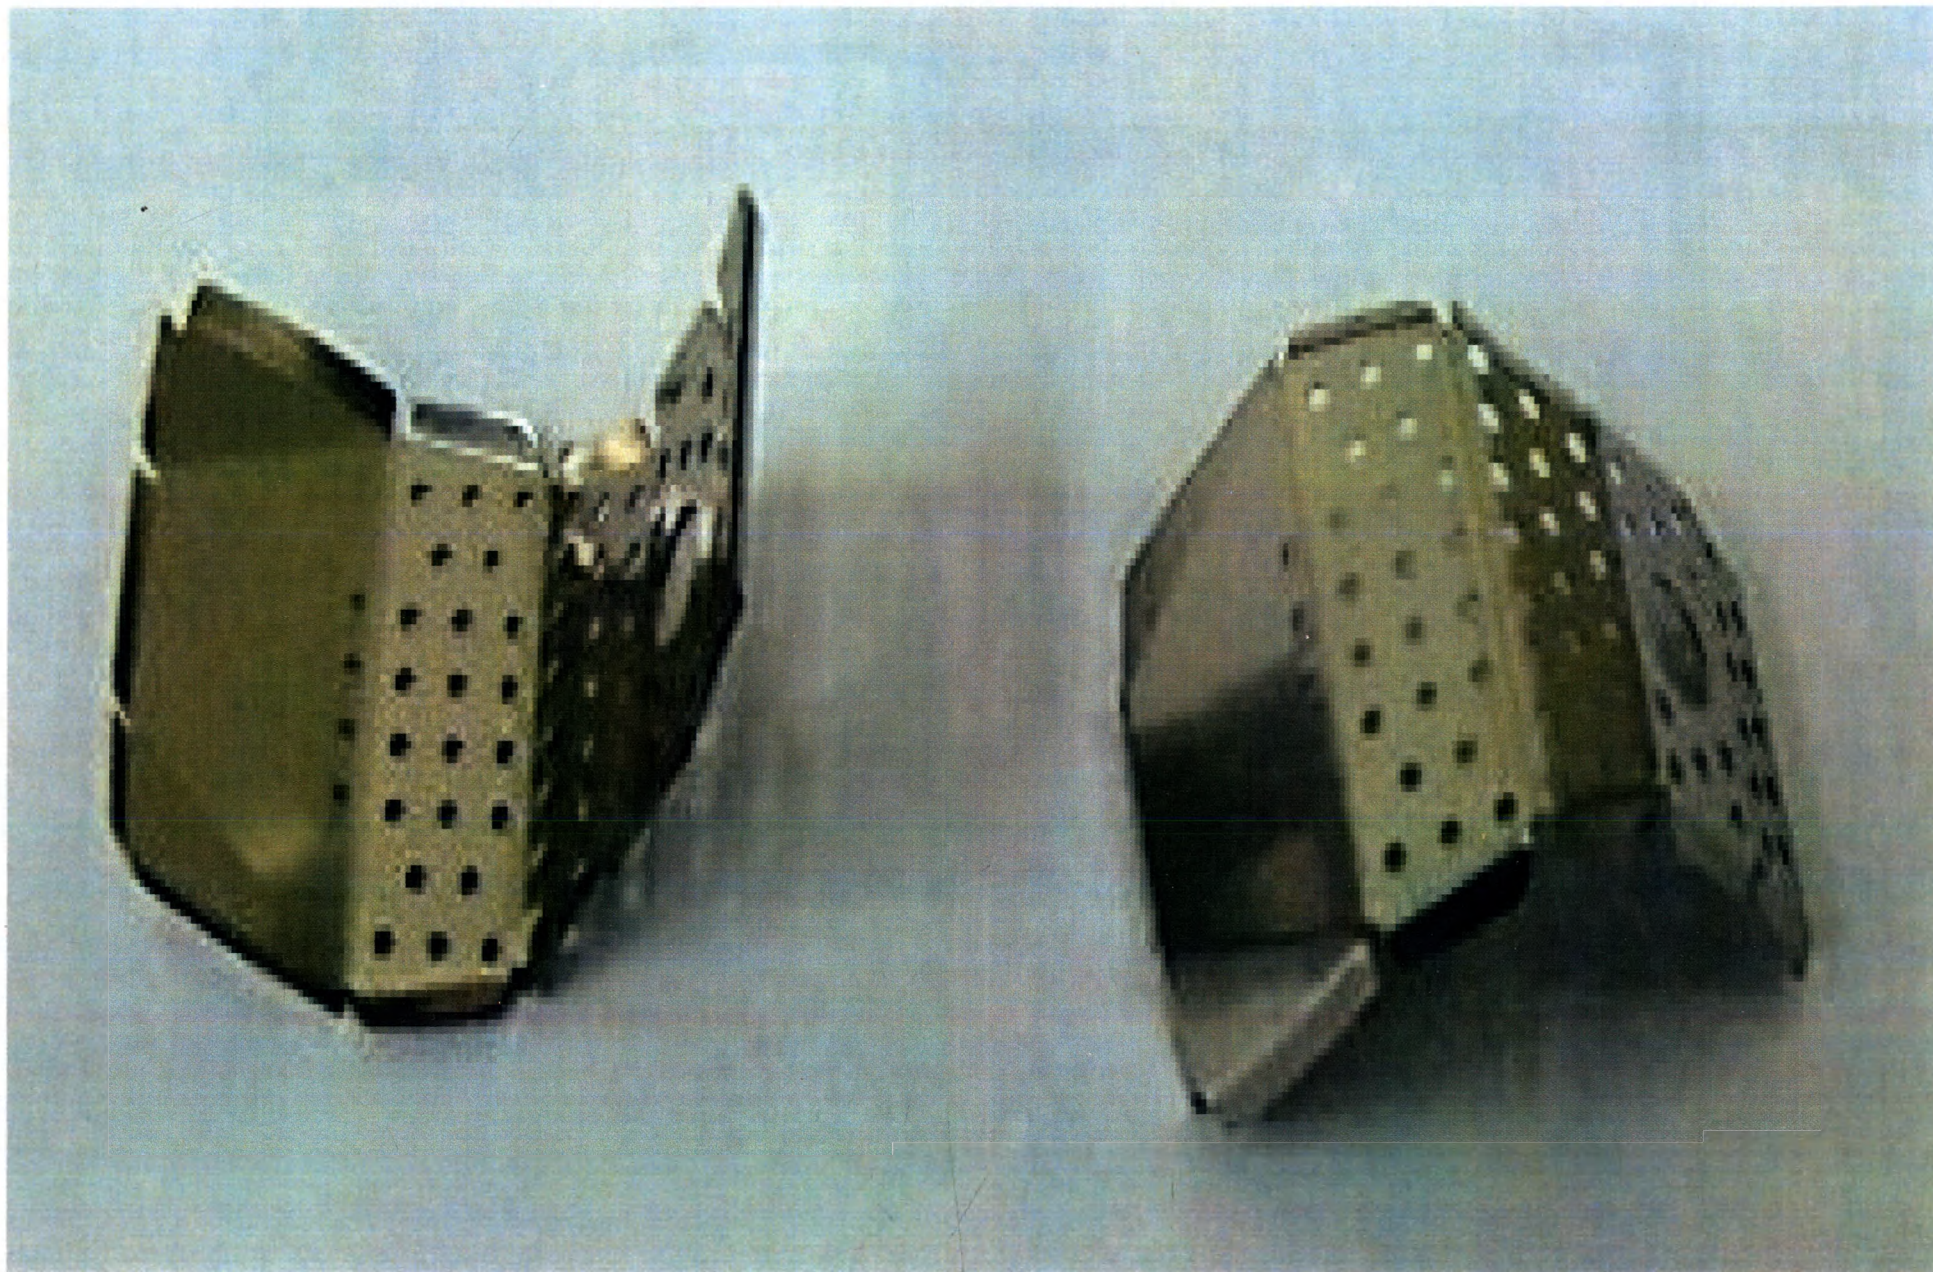

Набор примерочных абатментов AnyRidge (AnyRidge Abutment Selection Guide Kit Case): KANASG3000.



Набор для запечатывания шахты абатмента (EZ Seal Plus Case): EZSP21K.




Трансфер слепочный в комплекте с фиксирующим винтом для закрытой ложки (Impression Coping Transfer type): AAOITN6012T; Трансфер слепочный в комплекте с фиксирующим винтом для открытой ложки (Impression Coping Pick-up type): RIEH480T; Трансфер слепочный для плоского абатмента в комплекте с пином направления: (Flat Impression Coping): FIT4012T; Формирователь десны (Healing Abutment): AANNAF0403; Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment): FHA402; Цилиндр временный для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat Temporary Cylinder): FTC4012T.



Цилиндр временный в комплекте с фиксирующим винтом (Temporary Cylinder): AANOTCO4010T; Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder): AANBCB470; Цилиндр золотой в комплекте с фиксирующим винтом (Gold Cylinder): AANGCO4000T; Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder): RCA800T; Цилиндр Flat EZ Post для плоского абатмента (Flat EZ Post Cylinder): FEC4005T; Цилиндр CCM в комплекте с фиксирующим винтом (CCM Cylinder): AANCCO4000T.



Цилиндр золотой для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat Gold Cylinder): FGC4012T

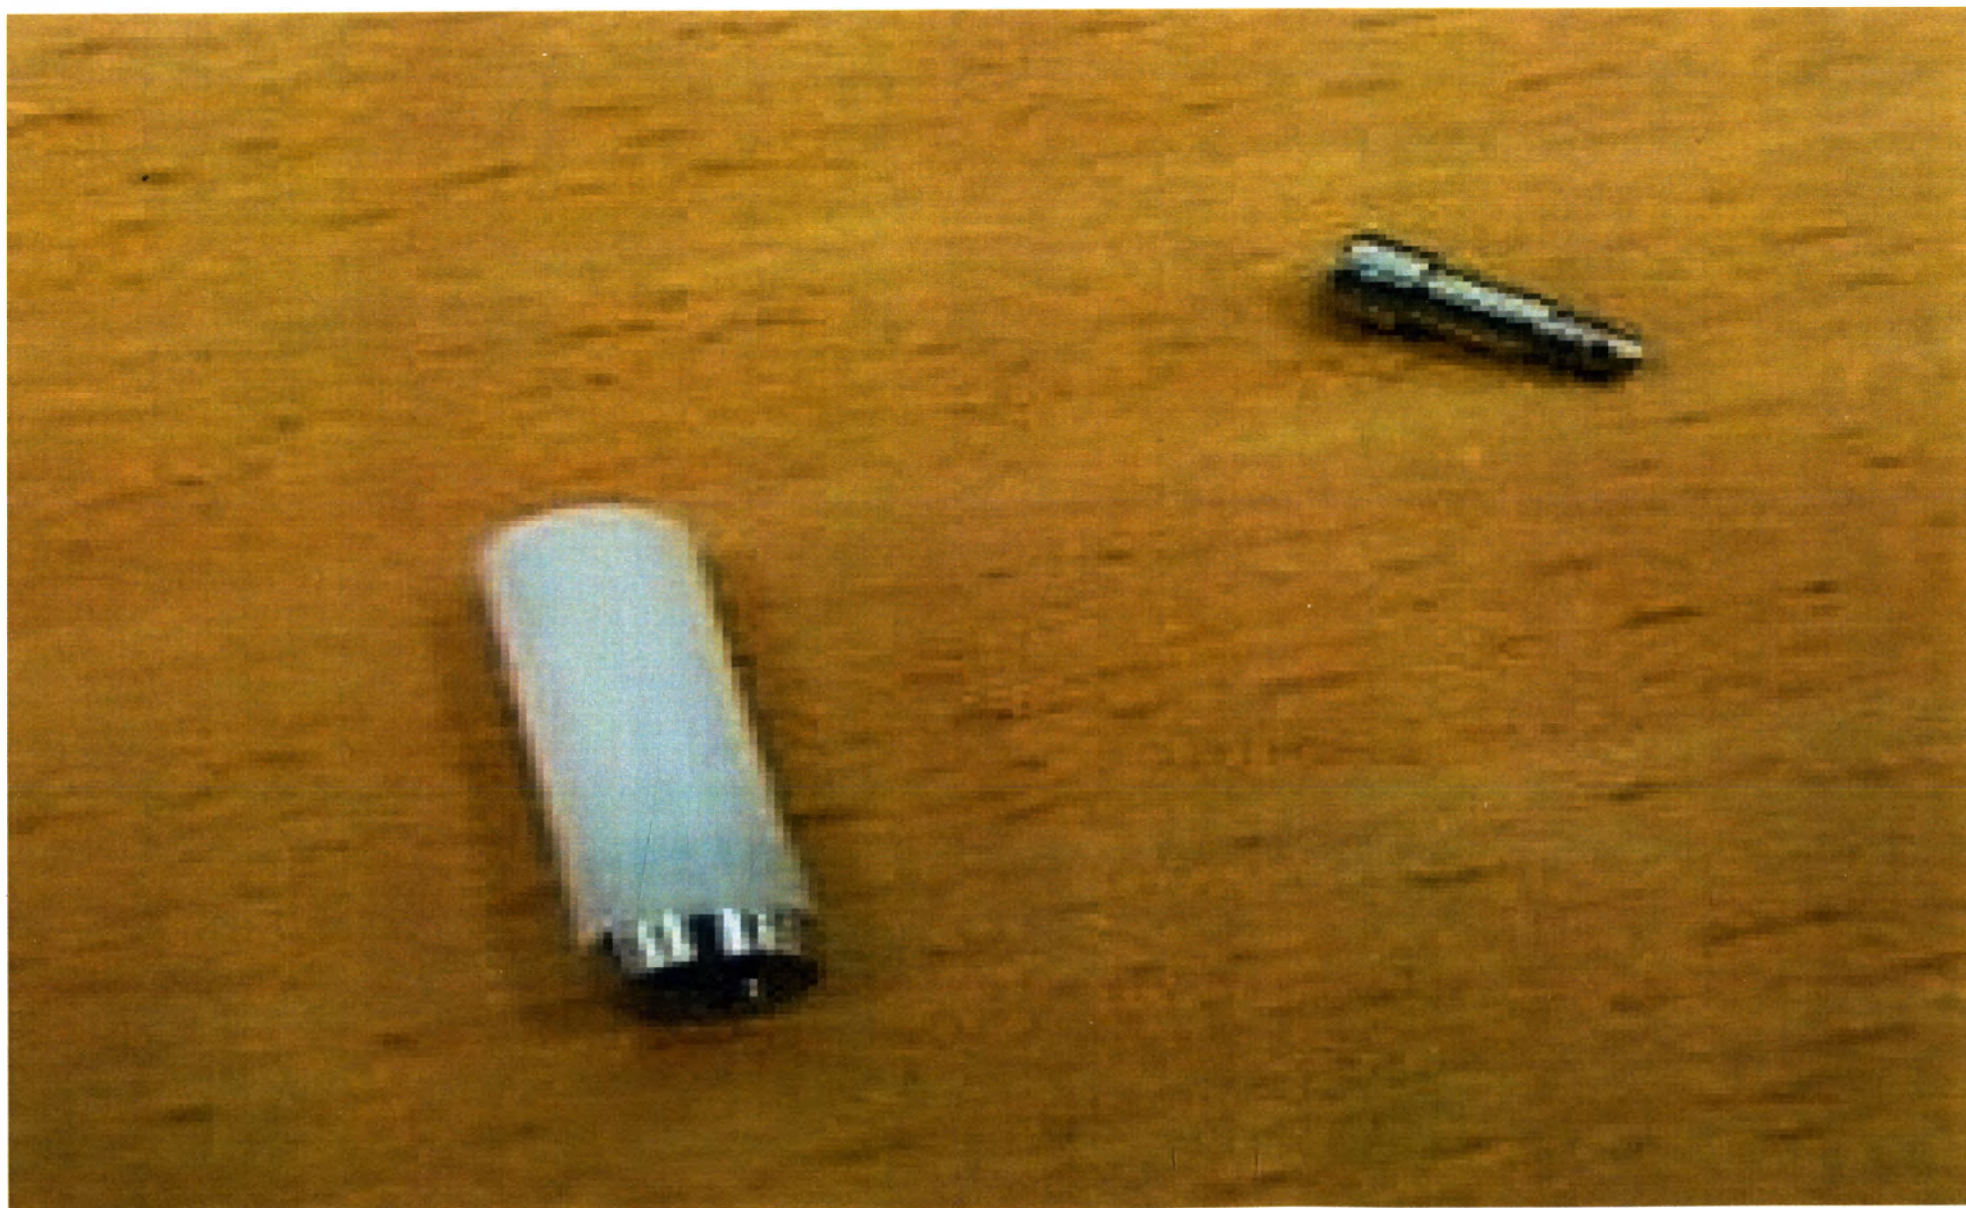

Цилиндр ССМ для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat CCM Cylinder): FCC4010T; Цилиндр пластиковый в комплекте с фиксирующим винтом (Plastic Cylinder): AAOTCO4010T; Цилиндр пластиковый для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat Plastic Cylinder): FPC4012T.



Генеральный директор,
ООО "Имплант Гуру"
Рудакова Е. В.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
14 (четырнадцать) листов

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Имплант Гуру»

Е. В. Рудакова

«02» марта 2015 г.



ДОПОЛНЕНИЕ

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

С МАРКИРОВКОЙ УПАКОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Имплантаты и ортопедические конструкции стоматологические с принадлежностями

MegaGen Implant Co., Ltd. (МегаДжен Имплант Ко., Лтд.), Корея

Маркировка упаковки с информацией на русском языке.

Данная маркировка распространяется на весь состав (Ассортимент) медицинского изделия «Имплантаты и ортопедические конструкции стоматологические с принадлежностями», производства MegaGen Implant Co., Ltd. (МегаДжен Имплант Ко., Лтд.), Корея.

MEGAGEN


CE
0434

Абатмент временный (Temporary Abatment)
с фиксирующим винтом
Ø5/без шестигранника
REF AANTAN5012T
LOT 130813A32-01
SN 098

 2013-08-13

 Внимание	 Обратитесь к инструкции по применению	 Не используйте, если упаковка повреждена
 Не использовать повторно	 Не стерильно	 15°C - 30°C

 МегаДжен Имплант Ко., Лтд., Корея.
472, Hanjanggun-ro, Jain-myeon, Gyeongsan-si,
Gyeongsangbuk-do, Korea

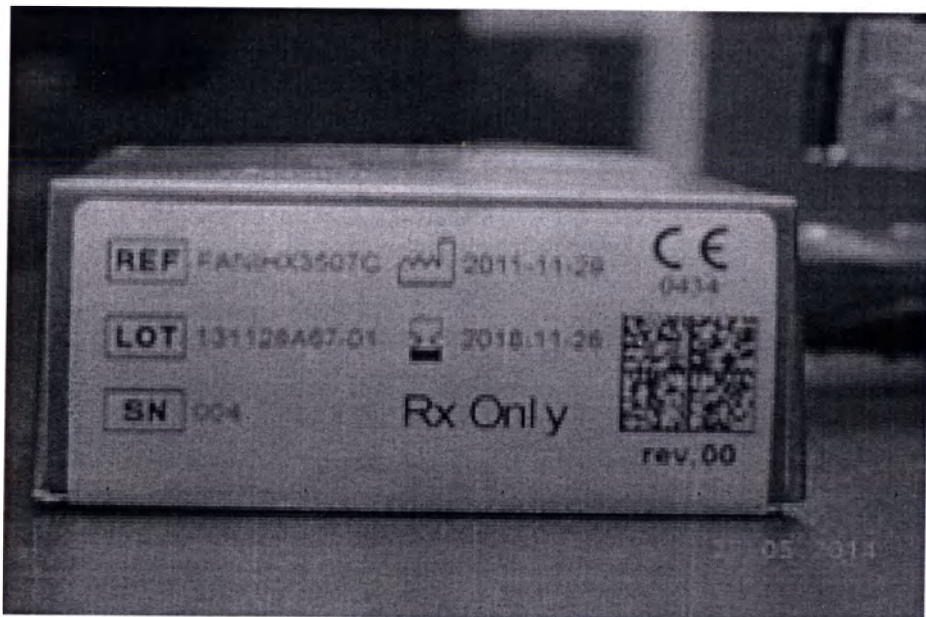

Знак соответствия международному стандарту CE



Фирменное наименование изделия

Размер

Номер по каталогу (артикул)



Код партии



Порядковый номер



Дата изготовления



Дата окончания срока годности



Не использовать повторно



Стерильно



Не стерильно



Не используйте, если упаковка повреждена



Обратитесь к инструкции по применению



Ограничение температуры



Название и адрес компании-производителя

Штрих-код



Внимание!



Мембрана i-Gen титановая Тип С

CE
0434

REF IG3W1328

2014-05-20

LOT 140520A0451-02

2019-05-19

SN 022

STERILE R Rx Only



Do not reuse



Do not resterilize




Caution



Consult
Instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426



MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852



rev. 01



MEGA'GEN IMPLANT

PEEL HERE

PEEL HERE

Абатмент временный в комплекте с фиксирующим винтом (Temporary Abutment): AANTAN5012T. Абатмент EZ Post в комплекте с фиксирующим винтом: AANEPN4025L. Абатмент CCM в комплекте с фиксирующим винтом (CCM Abutment): RCA5013HT. Абатмент Multi-unit в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Abutment): AANMUH5020T.

MEGA'GEN CE 0434

Temporary Abutment [AR]
Ø5 / Non-hex

REF AANTAN5012T 2013-08-13
LOT 130813A32-01
SN 098

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REF ImplaMedica Ltd. Fabijorsku 39-45 Vircus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 377-2 Gyecheon-ro Jain-myeon Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент временный (Temporary Abutment) с фиксирующим винтом [AR]
Ø5 / без шестигранника

CE 0434

REF AANTAN5012T 2013-08-13
LOT 130813A32-01
SN 094

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REF ImplaMedica Ltd. Fabijorsku 39-45 Vircus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 377-2 Gyecheon-ro Jain-myeon Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент EZ Post с фиксирующим винтом
Ø4 / C=2 / P=5.5 / без шестигранника

CE 0434

REF AANEPN4025L 2013-11-22
LOT 131122A00-01
SN 026

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REF ImplaMedica Ltd. Fabijorsku 39-45 Vircus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 377-2 Gyecheon-ro Jain-myeon Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

MEGA'GEN CE 0434

Абатмент CCM (CCM Abutment) с фиксирующим винтом
Ø5 / L=13 / шестигранник

REF RCA5013HT 2013-11-21
LOT 131121A15-01
SN 007

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REF ImplaMedica Ltd. Fabijorsku 39-45 Vircus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 377-2 Gyecheon-ro Jain-myeon Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment) с фиксирующим винтом [AR]
Ø5 / C=2 / шестигранник

CE 0434

REF AANMUH5020T 2014-03-10
LOT 140310A0610-01
SN 049

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REF ImplaMedica Ltd. Fabijorsku 39-45 Vircus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 472 Hwanggun-ro Jain-myeon Gyeongsan-si Gyeongbuk-do Korea Republic of 712-852

Temperature limitation

With Concept Implant System **MEGA¹GEN** **CE** 0434

CCM Abutment [AR]
Ø4/ L=12/ Non-Hex

REF AANCAN4012L  2014-03-03
LOT 140303A0070-01
SN 005

 Do not reuse  Non-sterile **Rx Only**

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

 rev.00

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

With Concept **MEGA¹GEN** **CE**

Абатмент CCM (CCM Abutment)
с фиксирующим винтом
Ø4 / L=12 / без шестигранника

REF AANCAN4012L  2014-03-03
LOT 140303A0070-01
SN 006

 Do not reuse  Non-sterile **Only**

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

 rev.00

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

With Concept
Implant System

MEGA'GEN

CE
0434

Solid Abutment [AR]

Ø4 / C=2 / P=4

REF AANSAL4024

2013-12-16

LOT 131216A15-01

SN 116



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
Instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



rev.01

EC REP

ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426



MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea



Temperature
limitation

Rx Only

With Concept
Implant System

MEGA'GEN

CE
0434

Абатмент монолитный
(Solid Abutment)
Ø4 / C=2 / P=4

REF AANSAL4024

2013-12-16

LOT 131216A15-01

SN 160



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
Instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



rev.01

EC REP

ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426



MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea



Temperature
limitation

Rx Only



With Concept Implant System **MEGA¹GEN** **CE** 0434

Milling Abutment [AR]
Ø4 / C=2 / P=9 / Hex


REF AANMAH4029L  2013-09-17
LOT 130917A21-01
SN 005

 Do not reuse  Non-sterile **Rx Only**  rev.01

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

 MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

 Temperature limitation

With Concept **Абатмент обрабатываемый (Milling Abutment) с фиксирующим винтом Ø4 / C=12 / P=9 / шестигранник** **CE** 0434


REF AANMAH4029L  2013-09-17
LOT 130917A21-01
SN 030

 Do not reuse  Non-sterile **Rx Only**  rev.01

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

 MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

 Temperature limitation

Абатмент Multi-unit угловой в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Angled Abutment): AANMUH50317L. Абатмент Окта винтовой (Octa Abutment): AANOAF4010. Абатмент плоский (Flat Abutment): AANFAL3510. Абатмент пластиковый (Plastic Abutment): RPEN100T.

Абатмент Multi-unit угловой в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Angled Abutment): AANMUH50317L. Абатмент Окта винтовой (Octa Abutment): AANOAF4010. Абатмент плоский (Flat Abutment): AANFAL3510. Абатмент пластиковый (Plastic Abutment): RPEN100T.

With Concept Implant System **MEGA GEN** CE 0434

Multi-unit angled abutment [AR]

Ø5/ C=3.5/ 17°/ Hex

REF AANMUH50317L 2013-12-20

LOT 131220A31-01

SN 030

Do not reuse Non-sterile Rx Only

Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REP ImplaMedica Ltd Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd 472 Hwangguk-ro, Jangmyeon Gyeongju-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment) с фиксирующим винтом Ø5 / C=3.5 / 17° / шестигранный [AR]

REF AANMUH50317L 2013-12-20

LOT 131220A31-01

SN 016

Do not reuse Non-sterile Rx Only

Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REP ImplaMedica Ltd Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd 472 Hwangguk-ro, Jangmyeon Gyeongju-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент Окта винтовой (Octa Abutment) CE 0434

C=1

REF AANOAF4010 2014-03-06

LOT 140306A0380-01

SN 027

Do not reuse Non-sterile Rx Only

Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REP ImplaMedica Ltd Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd 472 Hwangguk-ro, Jangmyeon Gyeongju-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент плоский (Flat Abutment) CE 0434

Ø3.5/ C=1

REF AANFAL3510 2014-02-10

LOT 140208A0070-01

SN 186

Do not reuse Non-sterile Rx Only

Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REP ImplaMedica Ltd Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd 472 Hwangguk-ro, Jangmyeon Gyeongju-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент пластиковый (Plastic Abutment) без шестигранника CE 0434

REF RPEN100T 2007-12-14

LOT 070570005-01

SN 205

Do not reuse Non-sterile Rx Only

Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

EC REP ImplaMedica Ltd Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd 472 Hwangguk-ro, Jangmyeon Gyeongju-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

With Concept
Invisant System

MEGAⁱGEN

Zirconia Abutment [AR]
Ø4.3/ Hex

REF AANZAH4012L 2013-11-13
LOT 131113A02-01
SN 010

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

rev.01

Temperature limitation

ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškių 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

With Concept

**Абатмент циркониевый
(Zirconia Abutment)
с фиксирующим винтом
Ø4.3 / шестигранник**

REF AANZAH4012L 2013-11-13
LOT 131113A02-01
SN 034

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

rev.01

Temperature limitation

ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškių 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

Абатмент предохраняющий в комплекте с фиксирующим винтом и заглушкой (Fuse Abutment): AFAA5315P. Абатмент угловой в комплекте с фиксирующим винтом (Angled Abutment): AANA4215L. Винт-заглушка для плоского абатмента (Flat Cover Screw): FCS3510. Колпачок защитный (Comfort Cap): AANCCF440.



With Concept Implant System **MEGA¹GEN** **CE** 0434

Cover Screw [AR]
Ø3.5 / H=0.8

REF AANCSF3508  2013-09-12
LOT 130912A17-01  2018-09-11
SN 047 **STERILE R**

 Do not reuse  Do not re sterilize
 Caution  Consult instructions for use
 Do not use if package is damaged

Rx Only  rev.00

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoni skiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea


With Concept Implant System **MEGA¹GEN** **CE** 0434

Винт-заглушка
(Cover Screw)
Ø3.5 / H=0.8

REF AANCSF3508  2013-09-12
LOT 130912A17-01  2018-09-11
SN 045 **STERILE R**

 Do not reuse  Do not re sterilize
 Caution  Consult instructions for use
 Do not use if package is damaged

Rx Only  rev.00

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoni skiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea





With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE** 0434

Flat Healing Abutment [AO]
Ø4 / H=1.5

REF FHA402  2013-06-12

LOT 130612A50-01

SN 020

 Do not reuse

 Non-sterile

Rx Only

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.00

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškių 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

With Concept **MEGA'GEN** **CE** 0434

Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment) Ø4 / H=1.5

REF FHA402  2013-06-12

LOT 130612A50-01

SN 021

 Do not reuse

 Non-sterile


Rx Only

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.00

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškių 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

**Цилиндр временный
(Temporary Cylinder)
с фиксирующим винтом
Ø3.8 / восьмигранник**

CE 0434

REF AANOTCO4010T 2013-10-29

LOT 131029A10-01

SN 053

Rx Only

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

rev.00

Temperature limitation

EC REP

ImplaMedica Ltd
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

With Concept Implant System **MEGA¹GEN** CE 0434

**Temporary Cylinder [AR]
Ø3.8/ Octa**

REF AANOTCO4010T 2013-10-29

LOT 131029A10-01

SN 046

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

rev.00

Temperature limitation

EC REP

ImplaMedica Ltd
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426


MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

Цилиндр временный для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat Temporary Cylinder): FTC4012T. Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder): AANBCB470. Цилиндр золотой в комплекте с фиксирующим винтом (Gold Cylinder): AANGCO4000T. Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder): AAOECO4005T.



Цилиндр Flat EZ Post для плоского абатмента (Flat EZ Post Cylinder): FEC4005T.

Цилиндр CCM для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat CCM Cylinder): FCC4010T.

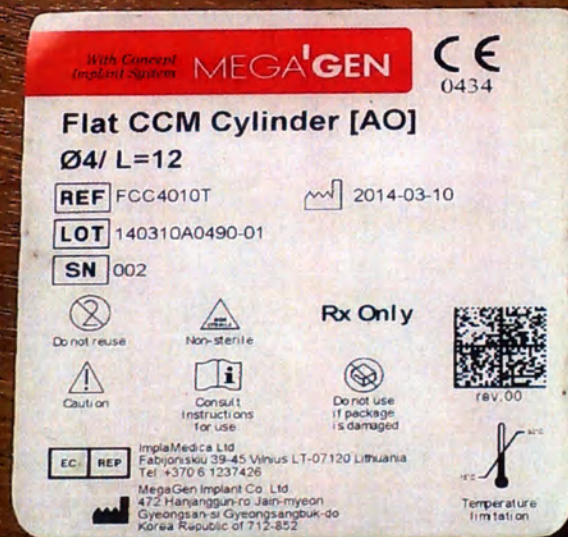

Цилиндр пластиковый в комплекте с фиксирующим винтом (Plastic Cylinder): AAOTCO4010T.

Цилиндр пластиковый для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat Plastic Cylinder): FPC4012T.

MEGA GEN CE 0434

Plastic Cylinder [AR]
Ø3.8 / Octa

REF AAOTCO4010T 2014-02-20
LOT 140220A0030-01
SN 054

Do not reuse Non-sterile Rx Only
Caution Consult Instructions for use Do not use if package is damaged rev.00

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

Temperature limitation

Цилиндр пластиковый (Plastic Cylinder) с фиксирующим винтом
Ø3.8 / восьмигранник

REF AAOTCO4010T 2014-02-20
LOT 140220A0030-01
SN 056

Do not reuse Non-sterile Rx Only
Caution Consult Instructions for use Do not use if package is damaged rev.00

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

Temperature limitation

Цилиндр пластиковый для плоского абатмента (Flat Plastic Cylinder) с фиксирующим винтом
Ø4 / L=12

REF FPC4012T 2014-03-10
LOT 140310A0530-01
SN 001

Do not reuse Non-sterile Rx Only
Caution Consult Instructions for use Do not use if package is damaged rev.00

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

Temperature limitation

With Concept
Implant System **MEGA'GEN** **CE**
0434

Lab Analog [AR]
Ø3.5 / L=12

REF AANLAF35  2013-09-05

LOT 130905A07-01

SN 098

Rx Only

 Do not reuse

 Non-sterile

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.00

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

With Concept
Implant System **MEGA'GEN** **CE**
0434

Аналог лабораторный
(Lab Analog)
Ø3.5 / L=12

REF AANLAF35  2013-09-05

LOT 130905A07-01

SN 088

Rx Only

 Do not reuse

 Non-sterile

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged


 rev.00


 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea



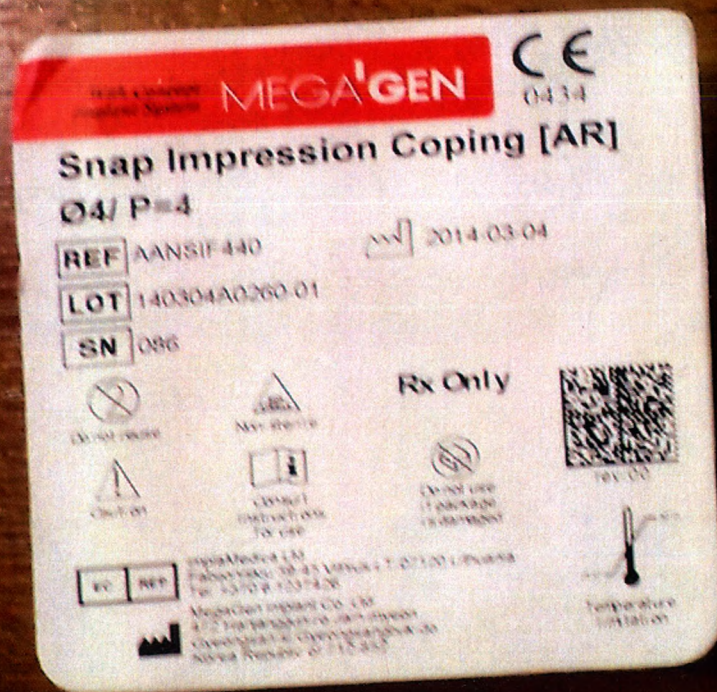

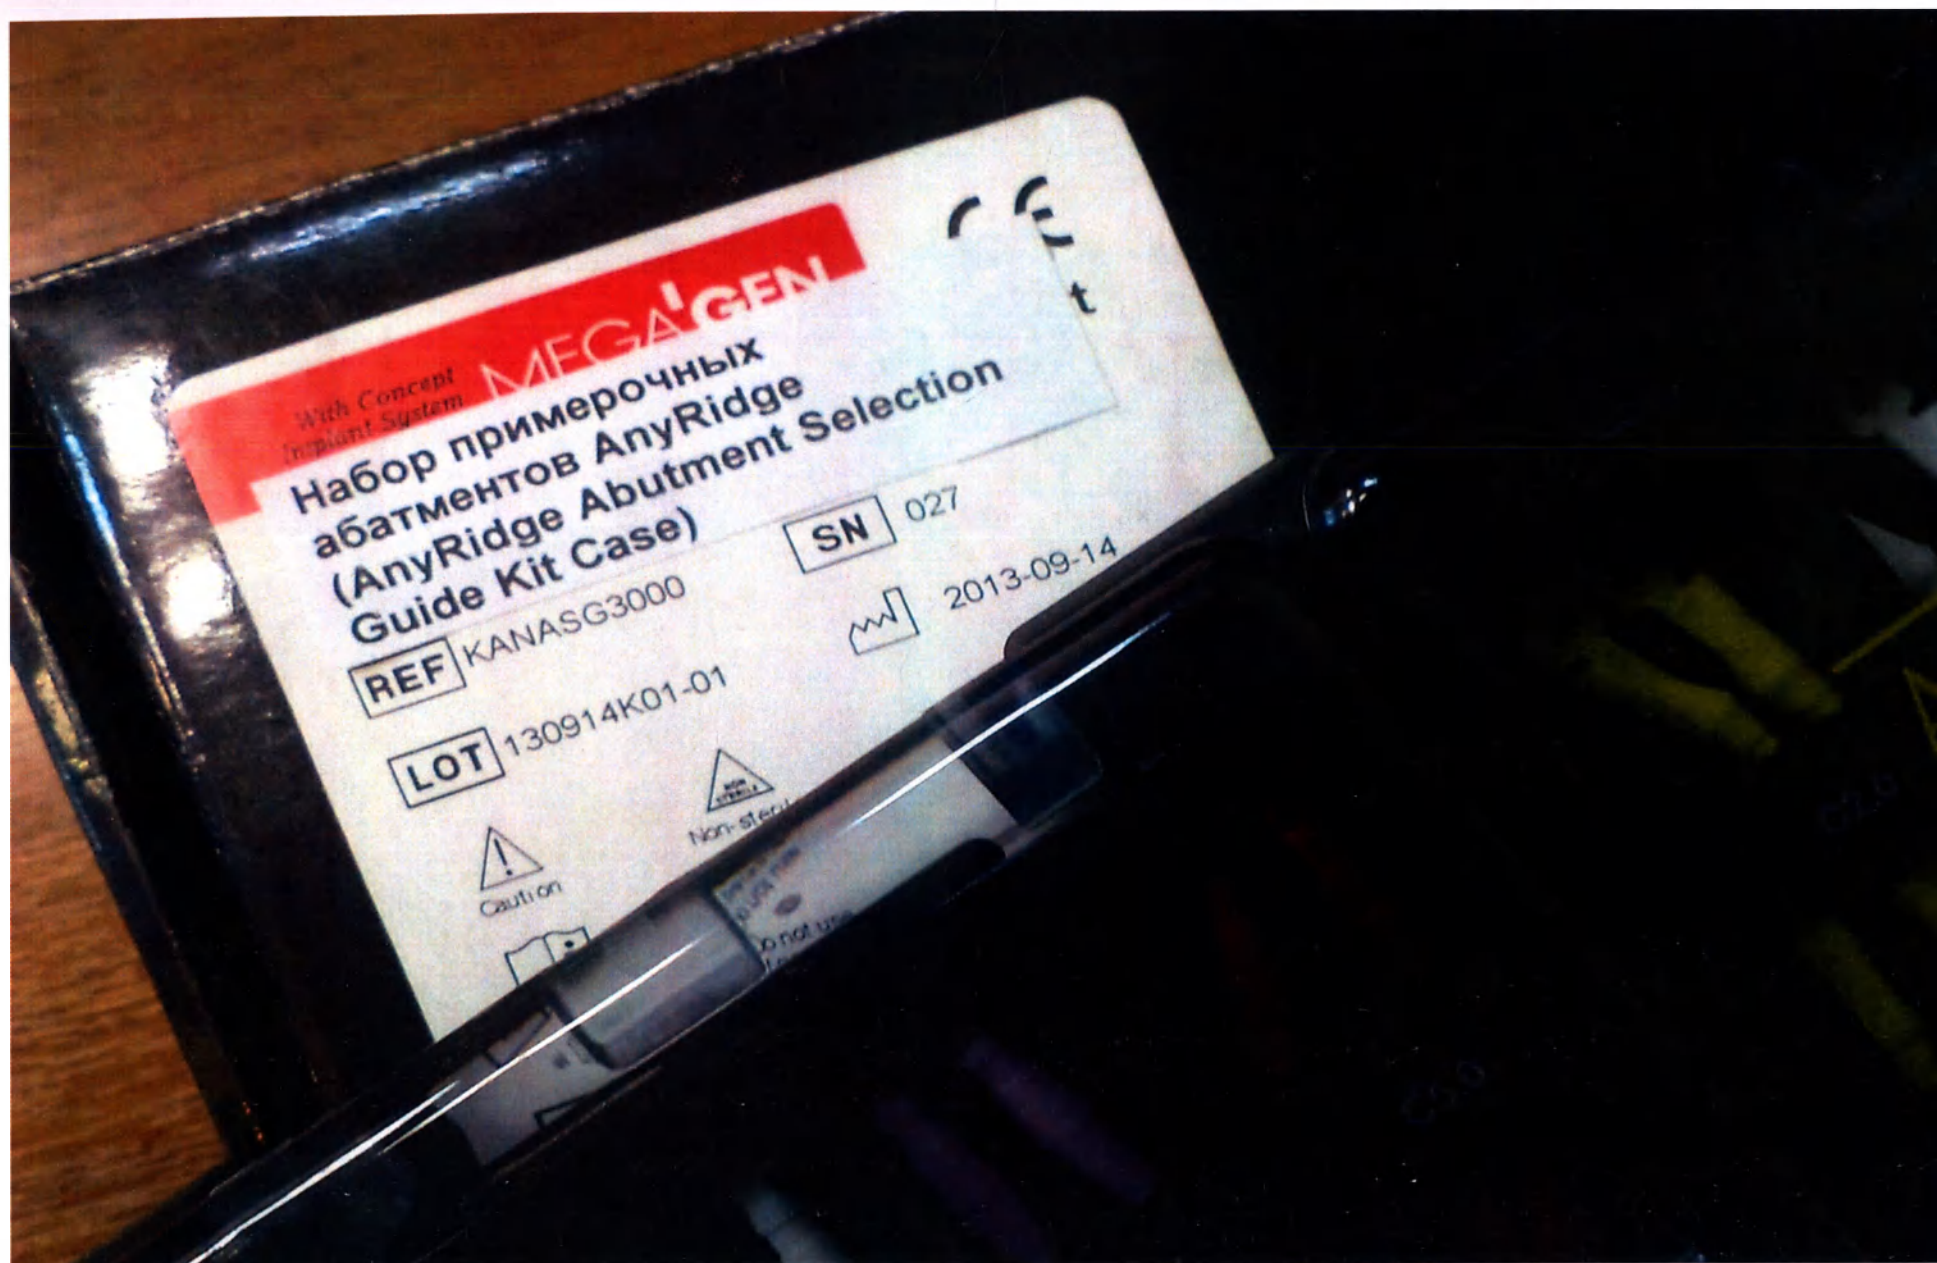

Набор примерочных абатментов AnyRidge (AnyRidge Abutment Selection Guide Kit Case): KANASG30.



Трансфер слепочный в комплекте с фиксирующим винтом для закрытой ложки (Impression Coping Transfer type): AANITN4012, RITE
AAOITN6012T.

Трансфер слепочный с
фиксирующим винтом для закрытой
ложки
(Impression Coping Transfer type)
Ø4 / L=12

REF AANITN4012
LOT 131031A56-01
SN 078

2013-10-31



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
instructions
for use



Do not use
if package
is damaged

Rx Only



160.01

EC REF

ImplaMedica Ltd
Fabryńska 29-45, Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyeongsan-ro, Jinju-myeon
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
Korea



Temperature
limitation

Трансфер слепочный с
фиксирующим винтом для закрытой
ложки
(Impression Coping Transfer type)
Ø4.8 / L=8

REF RITE480
LOT 140227A0041-01
SN 011

2014-02-28



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
instructions
for use



Do not use
if package
is damaged

Rx Only



160.01

EC REF

ImplaMedica Ltd
Fabryńska 29-45, Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyeongsan-ro, Jinju-myeon
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-802



Temperature
limitation

Трансфер слепочный с
фиксирующим винтом для закрытой
ложки
(Impression Coping Transfer type)
Ø5.8 / L=12 / без восьмигранника

REF AAOITN6012T
LOT 130605A04-01
SN 017

2013-08-05



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
instructions
for use



Do not use
if package
is damaged

Rx Only



160.01

EC REF

ImplaMedica Ltd
Fabryńska 29-45, Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyeongsan-ro, Jinju-myeon
Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do
Korea



Temperature
limitation

Трансфер слепочный с
фиксирующим винтом для открытой
ложки
(Impression Coping Pick-up type)
Ø4.8 / L=9 / шестигранник

REF RIEH480T

2014-02-06

LOT 140206A024

SN 002



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



rev. 01

EC REP

ImplaMedica Ltd
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea



Temperature
limitation

Rx Only



Трансфер слепочный с
фиксирующим винтом для открытой
ложки
(Impression Coping Pick-up type)
Ø4 / L=12 / шестигранник

REF AANIPH4012T

2014-02-27

LOT 140226A0031-01

SN 260



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



rev. 01

EC REP


ImplaMedica Ltd
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanyanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852



Temperature
limitation

Rx Only



With Concept
Impressure System

MEGA^IGEN

CE 0434

Flat Impression coping [AO]
Ø4/ L=12/ Transfer

REF FIT4012T 2014-03-10

LOT 140310A0510-01

SN 001

Do not reuse

Non-sterile

Rx Only

Caution

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

rev.00

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

Temperature limitation

Трансфер слепочный для
плоского абатмента с пином
направления
(Flat Impression Coping)

CE 0434
[AO]

Ø4 / L=12

REF FIT4012T 2014-03-10

LOT 140310A0510-01

SN 002

Do not reuse

Non-sterile

Rx Only

Caution

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

rev.00

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

Temperature limitation



With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE** 0434

Solid Abutment [AR]
Ø4/ C=2/ P=4

REF AANSAL4024  2013-12-16

LOT 131216A15-01

SN 116

 Do not reuse  Non-sterile **Rx Only**

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

 rev.01

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE** 0434

Абатмент монолитный (Solid Abutment)
Ø4 / C=2 / P=4

REF AANSAL4024  2013-12-16

LOT 131216A15-01

SN 160

 Do not reuse  Non-sterile **Rx Only**

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

 rev.01

 Temperature limitation

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

With Concept
Implant System

MEGA¹GEN

CE
0434

Milling Abutment [AR]
Ø4/ C=2/ P=9/ Hex

REF AANMAH4029L  2013-09-17

LOT 130917A21-01

SN 005

 Do not reuse

 Non-sterile

Rx Only

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.01

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

 MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

 Temperature limitation

With Concept

**Абатмент обтачиваемый
(Milling Abutment)
с фиксирующим винтом
Ø4 / C=12 / P=9 / шестигранник**

CE
0434

REF AANMAH4029L  2013-09-17

LOT 130917A21-01

SN 030

 Do not reuse

 Non-sterile

Rx Only

 Caution


 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.01

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

 MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

 Temperature limitation

With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE** 0434

CCM Abutment [AR]
Ø4 / L=12 / Non-Hex

REF AANCAN4012L  2014-03-03
LOT 140303A0070-01
SN 005

 Do not reuse  Non-sterile **Rx Only** 
 Caution  Consult Instructions for use  Do not use if package is damaged
 ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanyanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852
 Temperature limitation

With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE**

Абатмент ССМ (CCM Abutment)
с фиксирующим винтом
Ø4 / L=12 / без шестигранника

REF AANCAN4012L  2014-03-03
LOT 140303A0070-01
SN 006

 Do not reuse  Non-sterile **Only** 
 Caution  Consult Instructions for use  Do not use if package is damaged
 ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanyanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852
 Temperature limitation

With Concept Implant System **MEGA¹GEN**

Zirconia Abutment [AR]
Ø4.3/ Hex

REF AANZAH4012L  2013-11-13

LOT 131113A02-01

SN 010

 Do not reuse

 Non-sterile


Rx Only

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.01

 Temperature limitation

EC **REP** Implamedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

With Concept Implant System **MEGA¹GEN**

**Абатмент циркониевый
(Zirconia Abutment)
с фиксирующим винтом
Ø4.3 / шестигранный**

REF AANZAH4012L  2013-11-13

LOT 131113A02-01

SN 034

 Do not reuse

 Non-sterile


Rx Only

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.01

 Temperature limitation

EC **REP** Implamedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea



With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE** 0434

Lab Analog [AR]
Ø3.5 / L=12

REF AANLAF35  2013-09-05

LOT 130905A07-01

SN 098

Rx Only

 Do not reuse

 Non-sterile

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.00

 Temperature limitation

EC **REP**  ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

 MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE** 0434

Аналог лабораторный (Lab Analog)
Ø3.5 / L=12

REF AANLAF35  2013-09-05

LOT 130905A07-01

SN 088

Rx Only


 Do not reuse

 Non-sterile

 Caution

 Consult instructions for use

 Do not use if package is damaged

 rev.00

 Temperature limitation

EC **REP**  ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

 MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE** 0434


Cover Screw [AR]
Ø3.5 / H=0.8

REF AANCSF3508  2013-09-12
LOT 130912A17-01  2018-09-11
SN 047 **STERILE R**

 Do not reuse  Do not re-sterilize **Rx Only**

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

 rev.00

 **EC REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

 MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

 Temperature limitation

With Concept Implant System **MEGA'GEN** **CE** 0434


Винт-заглушка
(Cover Screw)
Ø3.5 / H=0.8

REF AANCSF3508  2013-09-12
LOT 130912A17-01  2018-09-11
SN 045 **STERILE R**

 Do not reuse  Do not re-sterilize **Rx Only**

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

 rev.00

 **EC REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

 MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

 Temperature limitation

Абатмент временный в комплекте с фиксирующим винтом (Temporary Abutment): AANTAN5012T. Абатмент EZ Post в комплекте с фиксирующим винтом (CCM Abutment): RCA5013HT. Абатмент CCM в комплекте с фиксирующим винтом (CCM Abutment): RCA5013HT. Абатмент Multi-unit в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Abutment): AANMUH5020T.

MEGA GEN CE 0434

Temporary Abutment [AR]
Ø5 / Non-hex

REF: AANTAN5012T 2013-08-13
LOT: 130813A32-01
SN: 098

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged rev. 04

ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Miestas LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 377-2 Gyecheon-ro Jain-myeon Gyeongseon-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент временный (Temporary Abutment) с фиксирующим винтом [AR]
Ø5 / без шестигранника

REF: AANTAN5012T 2013-08-13
LOT: 130813A32-01
SN: 094

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged rev. 03

ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Miestas LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 377-2 Gyecheon-ro Jain-myeon Gyeongseon-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент EZ Post с фиксирующим винтом
Ø4 / C=2 / P=5.5 / без шестигранника

REF: AANEPN4025L 2013-11-22
LOT: 131122A00-01
SN: 026

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged rev. 01

ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Miestas LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 377-2 Gyecheon-ro Jain-myeon Gyeongseon-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

MEGA GEN CE 0434

Абатмент CCM (CCM Abutment) с фиксирующим винтом
Ø5 / L=13 / шестигранник

REF: RCA5013HT 2013-11-21
LOT: 131121A15-01
SN: 007

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged rev. 00

ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Miestas LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 377-2 Gyecheon-ro Jain-myeon Gyeongseon-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

Абатмент Multi-unit (Multi-unit Abutment) с фиксирующим винтом [AR]
Ø5 / C=2 / шестигранник

REF: AANMUH5020T 2014-03-10
LOT: 140310A0610-01
SN: 049

Rx Only

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged rev. 00

ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Miestas LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd. 472 Hanjagun-ro Jain-myeon Gyeongseon-si Gyeongbuk Korea Korea Republic of 712-852

Temperature limitation

Абатмент Multi-unit угловой в комплекте с фиксирующим винтом (Multi-unit Angled Abutment): AA MUH50317L. Абатмент Окта винтовой (Octa Abutment): AANOAF4010. Абатмент пластиковый (Plastic Abutment): RPEN100T.

With Concept Implant System **MEGA GEN** **CE** 0434

Multi-unit angled abutment [AR]
 $\varnothing 5 / C=3.5 / 17^\circ / \text{Hex}$

REF AANMUH50317L 2013-12-20
 LOT 131220A31-01
 SN 030

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

Rx Only

rev. 01

EC REP ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Minus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd. 47-2 Haejeong-gu Incheon Gyeonggi-do Korea Republic of 715-862

Temperature limitation

Абатмент Multi-unit угловой (Multi-unit Angled Abutment) с фиксирующим винтом $\varnothing 5 / C=3.5 / 17^\circ / \text{шестигранник}$ [AR]

REF AANMUH50317L 2013-12-20
 LOT 131220A31-01
 SN 016

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

rev. 01

EC REP ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Minus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd. 47-2 Haejeong-gu Incheon Gyeonggi-do Korea Republic of 715-862

Temperature limitation

Абатмент Окта винтовой (Octa Abutment) **CE** 0434

C=1

REF AANOAF4010 2014-03-06
 LOT 140306A0380-01
 SN 027

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

Rx Only

rev. 00

EC REP ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Minus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd. 47-2 Haejeong-gu Incheon Gyeonggi-do Korea Republic of 715-862

Temperature limitation

Абатмент плоский (Flat Abutment) **MEGA GEN** **CE** 0434

$\varnothing 3.5 / C=1$

REF AANFAL3510 2014-02-10
 LOT 140208A0070-01
 SN 186

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

Rx Only

rev. 00

EC REP ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Minus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd. 47-2 Haejeong-gu Incheon Gyeonggi-do Korea Republic of 715-862

Temperature limitation

Абатмент пластиковый (Plastic Abutment) без шестигранника **CE** 0434

REF RPEN100T 2007-12-14
 LOT 070570005-01
 SN 205

Do not reuse Non-sterile Caution Consult instructions for use Do not use if package is damaged

Rx Only

rev. 01





EC REP ImplaMedica Ltd. Fabijoniskiu 39-45 Minus LT-07120 Lithuania Tel: +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd. 47-2 Haejeong-gu Incheon Gyeonggi-do Korea Republic of 715-862

Temperature limitation

Абатмент предохраняющий в комплекте с фиксирующим винтом и заглушкой (Fuse Abutment): AF5315P. Абатмент угловой в комплекте с фиксирующим винтом (Angled Abutment): AANA4215L. Винт-заглушка для плоского абатмента (Flat Cover Screw): FCS3510. Колпачок защитный (Comfort Cap): AANCCF440. Колпачок защитный (Comfort Cap): AANCCF440.




Цилиндр временный для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat Temporary Cylinder): FTC4012T. Цилиндр выжигаемый (Burn-out Cylinder): AANBCB470. Цилиндр золотой в комплекте с фиксирующим винтом (Gold Cylinder): AANGCO4000T. Цилиндр EZ Post (EZ Post Cylinder): AAOECO4006T.

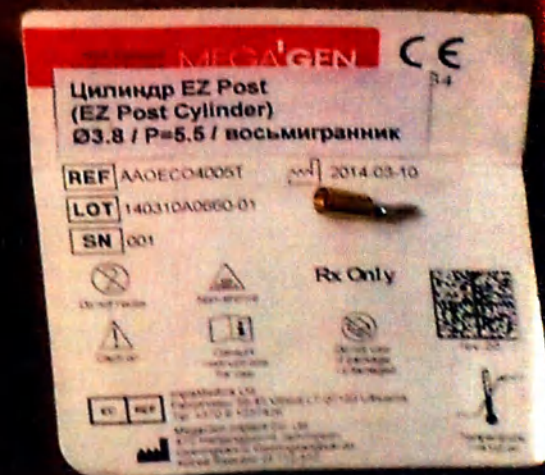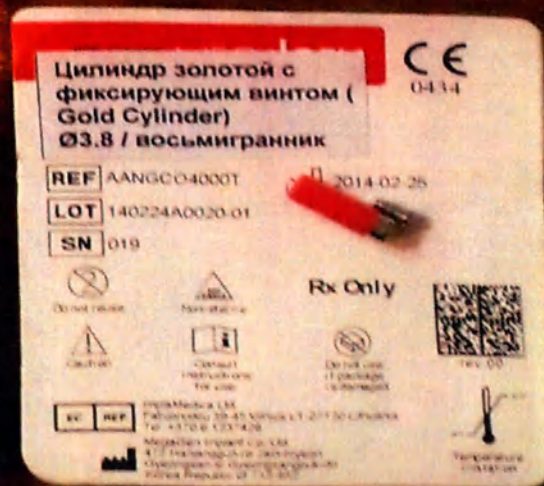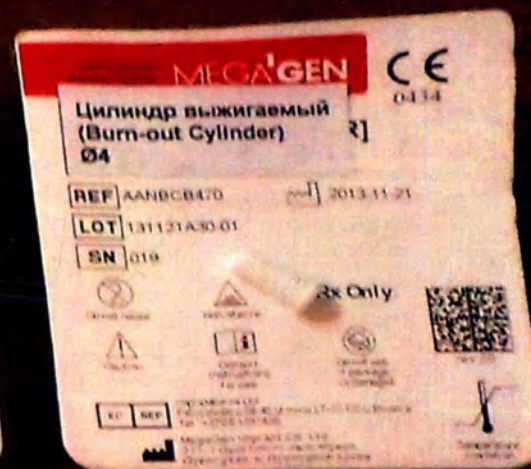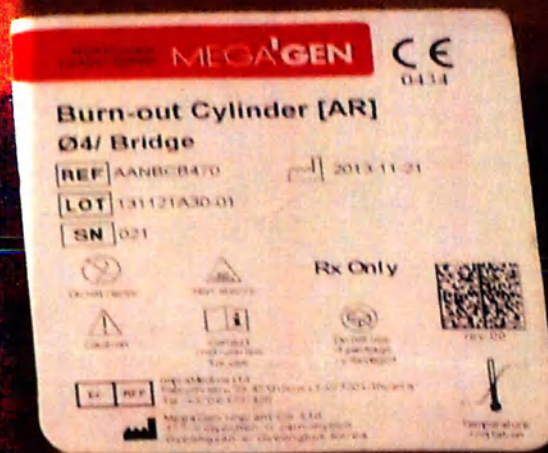


Цилиндр Flat EZ Post для плоского абатмента (Flat EZ Post Cylinder): FEC4005T.

Цилиндр CCM для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat CCM Cylinder): FCC4010T.

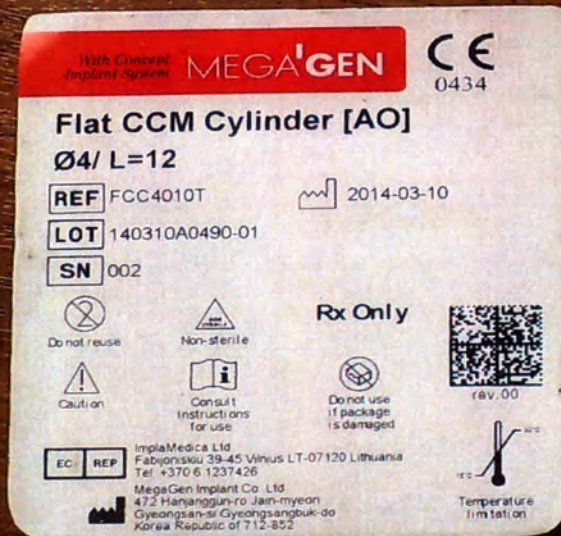


Цилиндр пластиковый в комплекте с фиксирующим винтом (Plastic Cylinder): AAOTCO4010T.

Цилиндр пластиковый для плоского абатмента в комплекте с фиксирующим винтом (Flat Plastic Cylinder): FPC4012T.

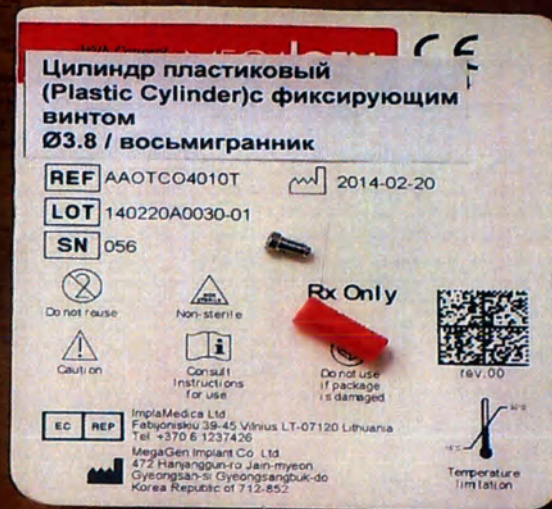

Трансфер слепочный в комплекте с фиксирующим винтом для закрытой ложки (Impression Coping Transfer type): AANITN4012, RITE480, AAOITN6012T.

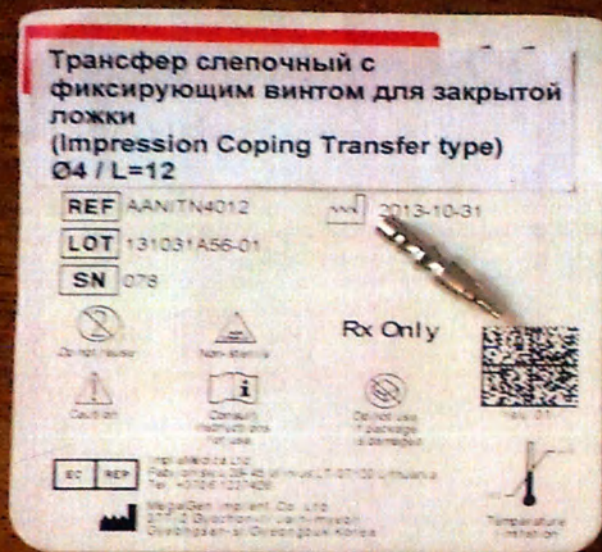


 0434

Snap Impression Coping [AR]

Q4 / P=4

REF AANSIF 440
 LOT 140304A0260-01
 SN 086

2014-03-04

 Do not reuse
 Non-sterile
 Caution
 Consult instruction for use
 Do not use if package is damaged

Rx Only

 rev. 00
 Temperature limitation

InpaMedica Ltd.
 Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
 Tel. +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd.
 47-2 Hwangginsiro, Jamsil-yeon
 Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
 Korea Republic of 712-852


 0434


Колпачок пластиковый слепочный (Snap Impression Coping)

Q4 / P=4

REF AANSIF 440
 LOT 140304A0260-01
 SN 085

2014-03-04

 Do not reuse
 Non-sterile
 Caution
 Consult instruction for use
 Do not use if package is damaged


 rev. 00
 Temperature limitation

InpaMedica Ltd.
 Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
 Tel. +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd.
 47-2 Hwangginsiro, Jamsil-yeon
 Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
 Korea Republic of 712-852

Колпачок защитный в комплекте с фиксирующим винтом (Healing Cap): IHC400T.

With Concept Implant System **MEGA¹GEN** CE 0434

Healing Cap [EX]

Ø5

REF IHC400T 2013-08-09

LOT 130809A52-01

SN 121

Rx Only

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Consult Instructions for use

Do not use if package is damaged

rev.01

EC REP

ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation

With Concept Implant System **MEGA¹GEN** CE

**Колпачок защитный (Healing Cap)
с фиксирующим винтом**

Ø5

REF IHC400T 2013-08-09

LOT 130809A52-01

SN 122

Rx Only

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Consult Instructions for use

Do not use if package is damaged

rev.01


EC REP

ImplaMedica Ltd.
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea

Temperature limitation



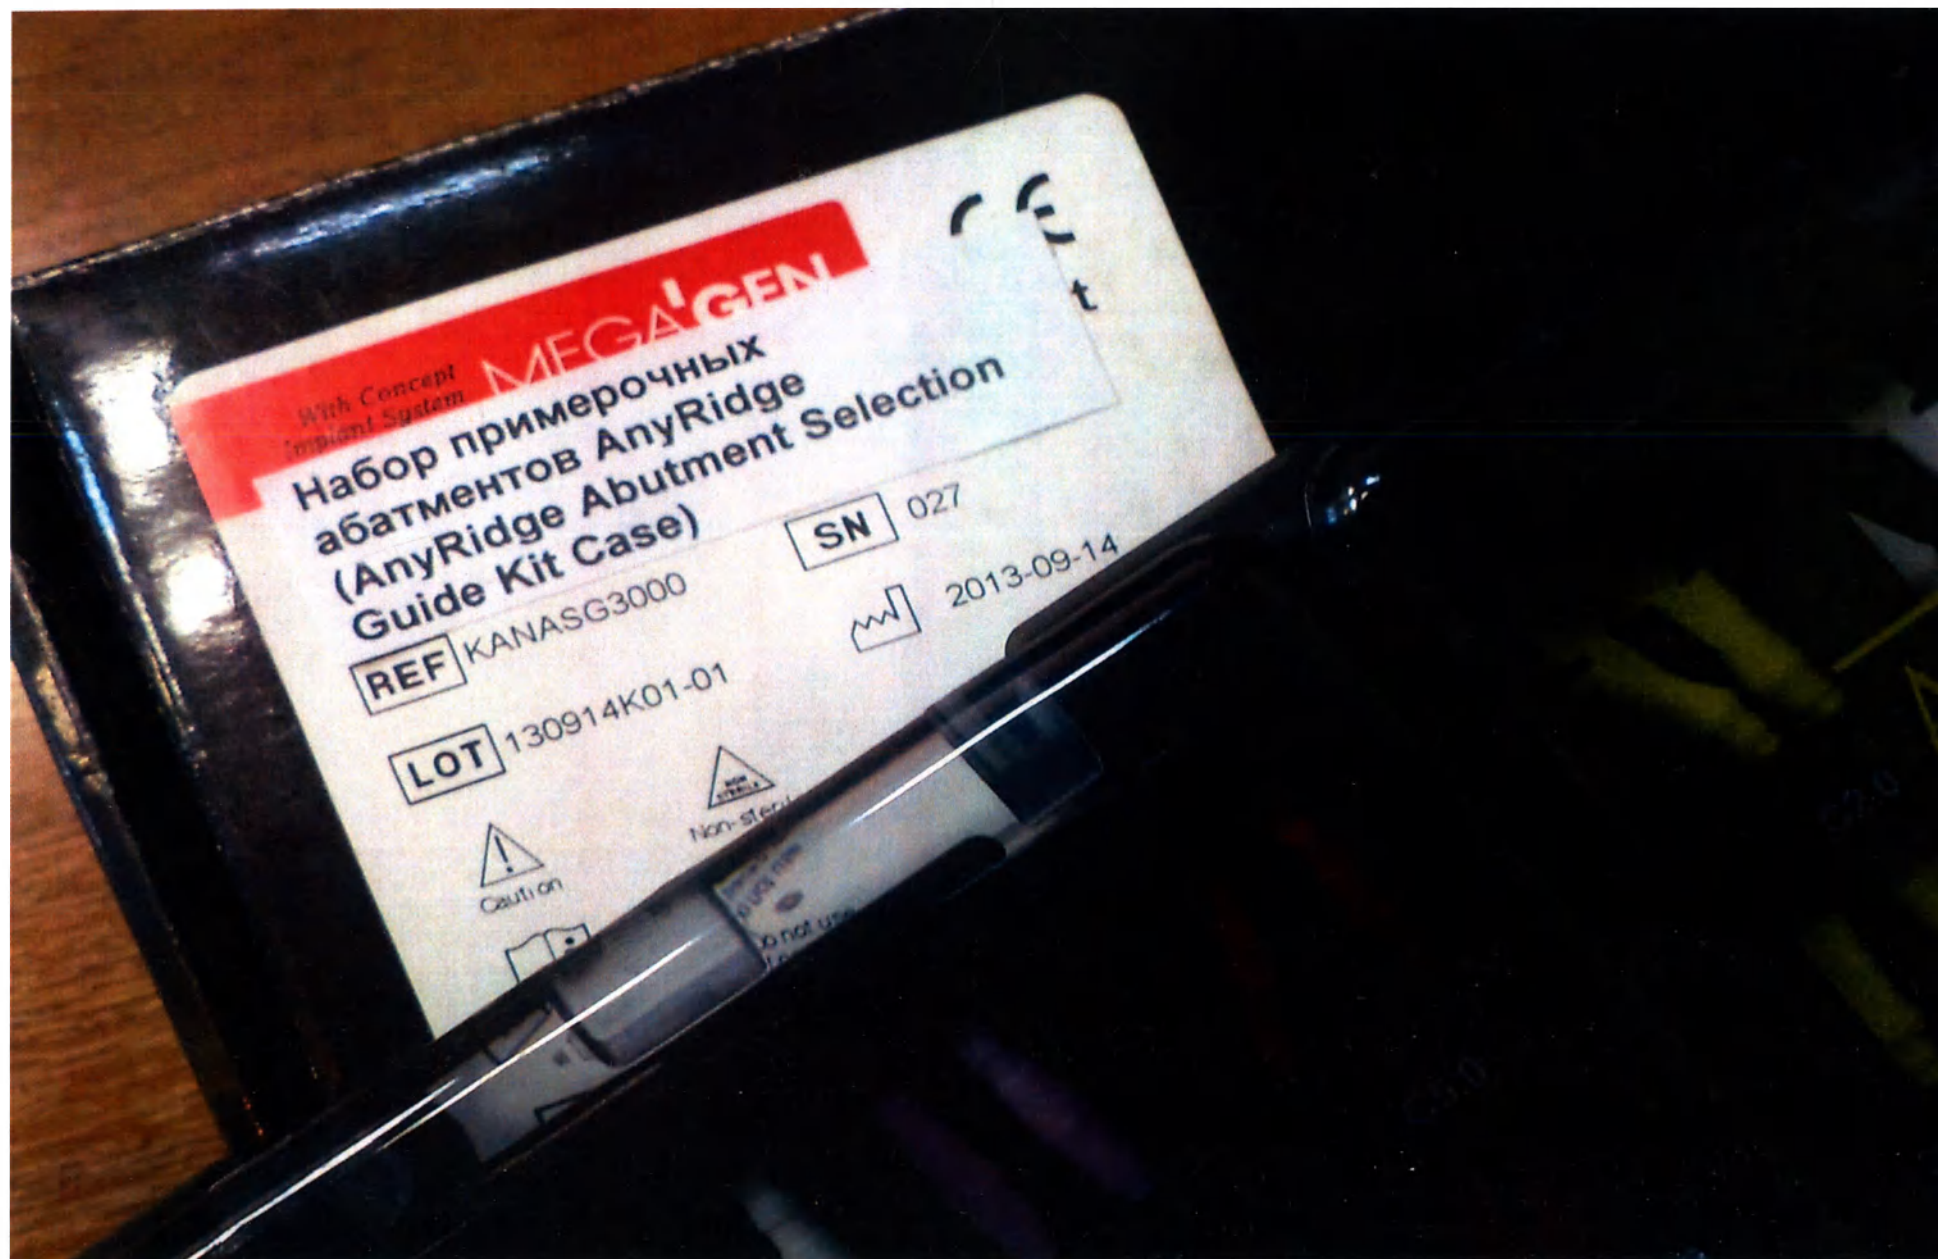

Трансфер слепочный для плоского абатмента в комплекте с пином направления (Flat Impression Coping): FIT4012T.

With Gemalign Implant System **MEGA¹GEN** **CE** 0434

Flat Impression coping [AO]
Ø4/ L=12/ Transfer

REF FIT4012T  2014-03-10
LOT 140310A0510-01
SN 001

 Do not reuse
 Non-sterile
Rx Only
 Caution
 Consult instructions for use
 Do not use if package is damaged
 rev.00
 Temperature limitation

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanyanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

Трансфер слепочный для плоского абатмента с пином направления (Flat Impression Coping) [AO] **CE** 0434

Ø4 / L=12

REF FIT4012T  2014-03-10
LOT 140310A0510-01
SN 002

 Do not reuse
 Non-sterile
Rx Only
 Caution
 Consult instructions for use
 Do not use if package is damaged
 rev.00
 Temperature limitation

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanyanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

Трансфер слепочный в комплекте с фиксирующим винтом для закрытой ложки (Impression Coping Transfer type): AANITN4012, RITE
AAOITN6012T.

Трансфер слепочный с фиксирующим винтом для закрытой ложки (Impression Coping Transfer type) Ø4 / L=12

REF AANITN4012 2013-10-31

LOT 131031A56-01

SN 078

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyecheon-ro Jangji-myeon
Gyeonggi-do Gyeonggi-do Korea

Temperature limitation

Трансфер слепочный с фиксирующим винтом для закрытой ложки (Impression Coping Transfer type) Ø4.8 / L=8

REF RITE480 2014-02-28

LOT 140227A0041-01

SN 011

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyecheon-ro Jangji-myeon
Gyeonggi-do Gyeonggi-do Korea
Tel: +3706 1237426

Temperature limitation

Трансфер слепочный с фиксирующим винтом для закрытой ложки (Impression Coping Transfer type) Ø5.8 / L=12 / без восьмигранника

REF AAOITN6012T 2013-08-05

LOT 130805A04-01

SN 017

Rx Only

Do not reuse
Non-sterile
Caution
Consult instructions for use
Do not use if package is damaged

EC REP ImplaMedica Ltd
Fabrynska 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyecheon-ro Jangji-myeon
Gyeonggi-do Gyeonggi-do Korea

Temperature limitation

Трансфер слепочный с
фиксирующим винтом для открытой
ложки
(Impression Coping Pick-up type)
Ø4.8 / L=9 / шестигранник

REF RIEH480T

2014-02-06

LOT 140206A0241

SN 002



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
Instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



rev. 01

EC REP

ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426



MegaGen Implant Co. Ltd
377-2 Gyochon-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongbuk Korea



Temperature
limitation

Rx Only

Трансфер слепочный с
фиксирующим винтом для открытой
ложки
(Impression Coping Pick-up type)
Ø4 / L=12 / шестигранник

REF AANIPH4012T

2014-02-27

LOT 140226A0031-01

SN 260



Do not reuse



Non-sterile



Caution



Consult
Instructions
for use



Do not use
if package
is damaged



rev. 01

EC REP

ImplaMedica Ltd
Fabijoniskiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +370 6 1237426



MegaGen Implant Co. Ltd
472 Hanyanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852



Temperature
limitation

Rx Only

With Concept Implant System **MEGA¹GEN** **CE** 0434

Flat Healing Abutment [AO]
Ø4/ H=1.5

REF FHA402  2013-06-12

LOT 130612A50-01

SN 020

 Do not reuse  Non-sterile **Rx Only**  rev.00

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoni skiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel. +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

 Temperature limitation

With Concept Implant System **MEGA¹GEN** **CE** 0434

Формирователь десны для плоского абатмента (Flat Healing Abutment) [AO]
Ø4 / H=1.5

REF FHA402  2013-06-12

LOT 130612A50-01

SN 021

 Do not reuse  Non-sterile **Rx Only**  rev.00

 Caution  Consult instructions for use  Do not use if package is damaged

EC **REP** ImplaMedica Ltd.
Fabijoni skiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel. +370 6 1237426
MegaGen Implant Co. Ltd.
472 Hanjangu-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Republic of 712-852

 Temperature limitation

Цилиндр временный в комплекте с фиксирующим винтом (Temporary Cylinder): AANOTCO4010T.

**Цилиндр временный
(Temporary Cylinder)
с фиксирующим винтом
Ø3.8 / восьмигранник**

CE 0434

REF AANOTCO4010T 2013-10-29

LOT 131029A10-01

SN 053

Rx Only

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

rev.00

Temperature limitation

EC REP

ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
GyeongSan-si Gyeongbuk Korea

With Concept Implant System **MEGA'GEN** CE 0434

**Temporary Cylinder [AR]
Ø3.8/ Octa**

REF AANOTCO4010T 2013-10-29

LOT 131029A10-01

SN 046

Do not reuse

Non-sterile

Caution

Consult instructions for use

Do not use if package is damaged

rev.00


Temperature limitation

EC REP

ImplaMedica Ltd.
Fabijoniškiu 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
Tel: +3706 1237426

MegaGen Implant Co. Ltd.
377-2 Gyochon-ri Jain-myeon
GyeongSan-si Gyeongbuk Korea

Трансфер слепочный в комплекте с фиксирующим винтом для закрытой ложки (Impression Coping Transfer type): AANITN4012, RITE480, AAOITN6012T.

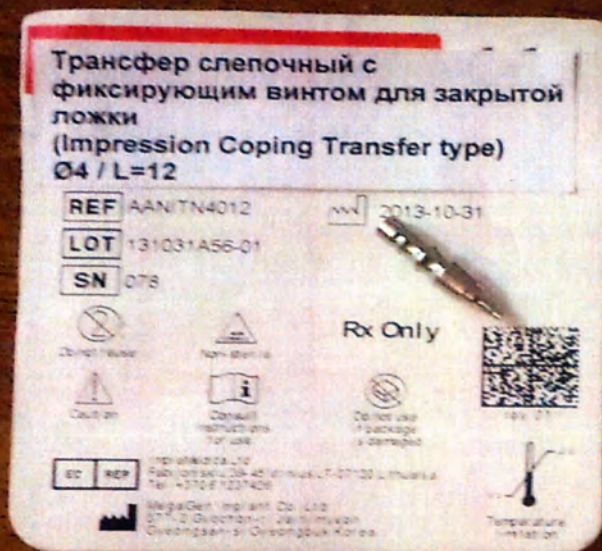




Snap Impression Coping [AR]
 04 / P=4

REF AANSIF440
 LOT 140304A0260-01
 SN 086

2014-03-04

Rx Only








rev. 00



impaMedica Ltd.
 Faborynko 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
 Tel: +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd.
 472 Hanyangju-ro Jangmyeon
 Gyeonggi-do Gyeonggi-do
 Korea Republic of 115-852




Колпачок пластиковый слепочный
 (Snap Impression Coping)
 04 / P=4

REF AANSIF440
 LOT 140304A0260-01
 SN 085

2014-03-04








rev. 00




impaMedica Ltd.
 Faborynko 39-45 Vilnius LT-07120 Lithuania
 Tel: +370 6 1237426
 MegaGen Implant Co. Ltd.
 472 Hanyangju-ro Jangmyeon
 Gyeonggi-do Gyeonggi-do
 Korea Republic of 115-852

Прошнуровано и пронумеровано

кол-во листов: 55

Генеральный директор

ООО "Имплант Гуру"


(Е.В.Рудакова)

дата: _____

