

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО НПО «ДЕОСТ»

Е.Л. Паклин

«01» марта 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Катетер баллонный для чрескожной транслюминальной коронарной
ангиопластики Fluydo

2024

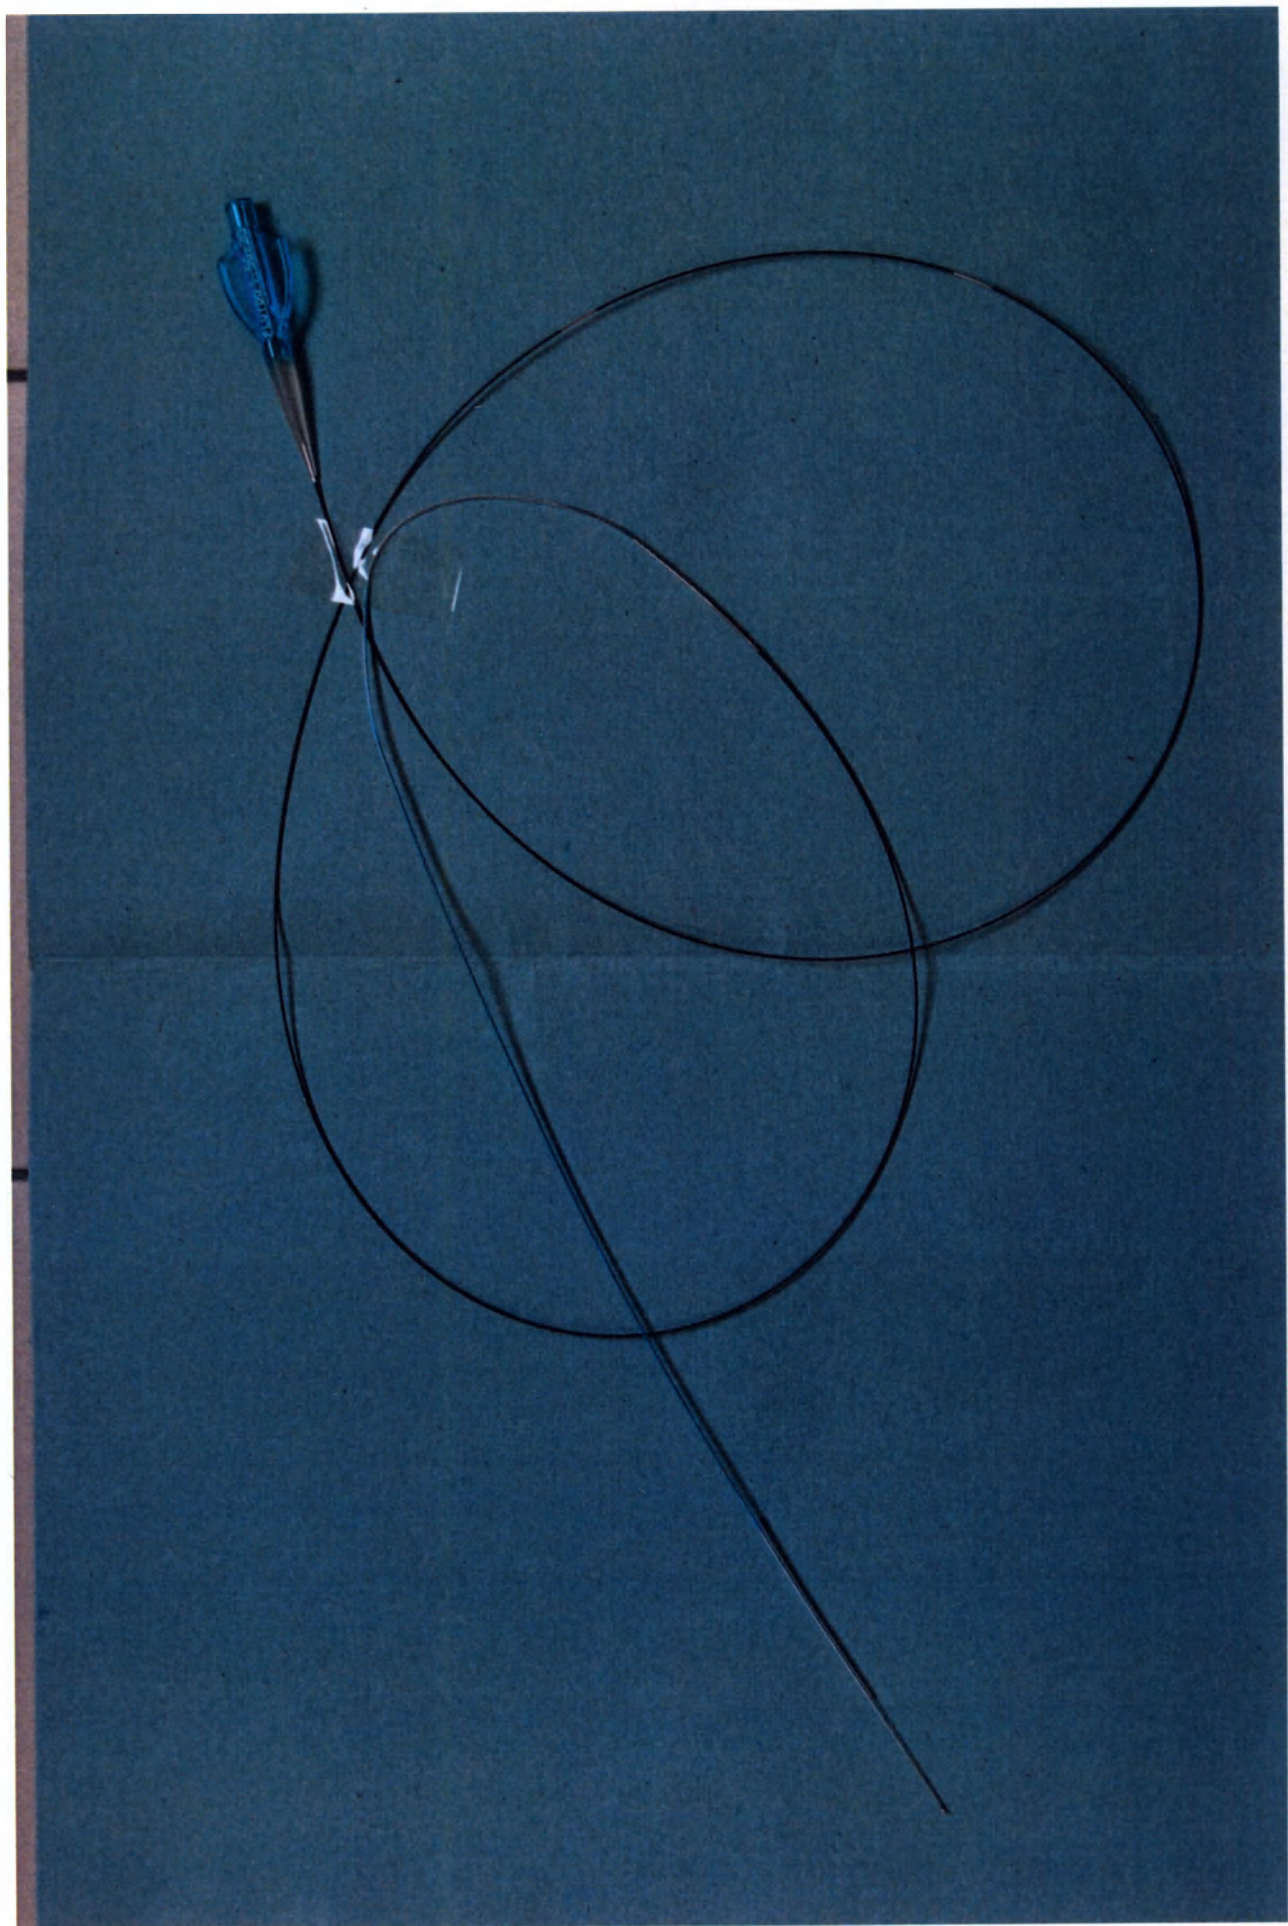


Фото 1. Внешний вид катетера.
Внешний вид катетеров с различными размерами баллонов идентичен приведенному.

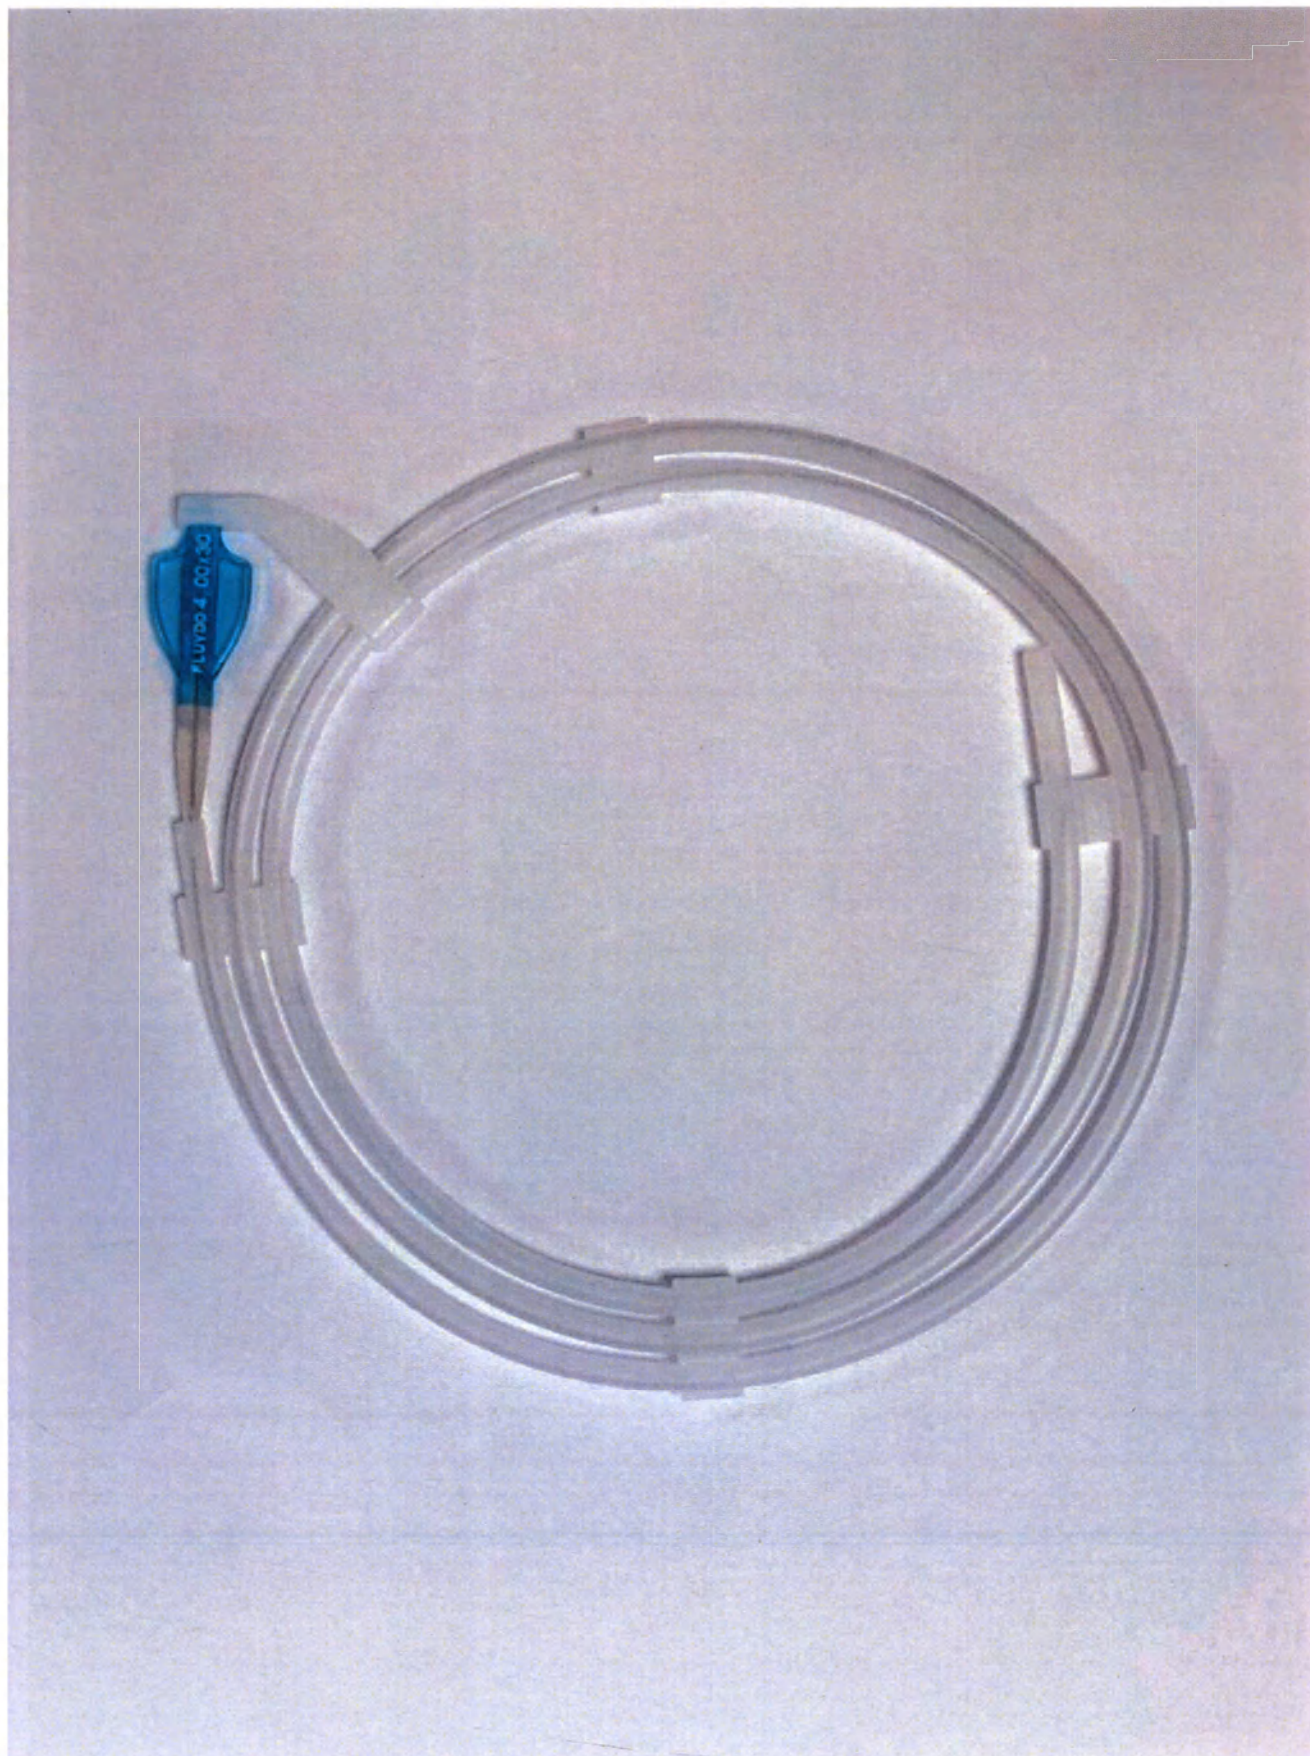


Фото 2. Внешний вид катетера в защитной трубке.
Внешний вид катетеров в защитной трубке, зафиксированной клипсами, с различными размерами баллонов идентичен приведенному.

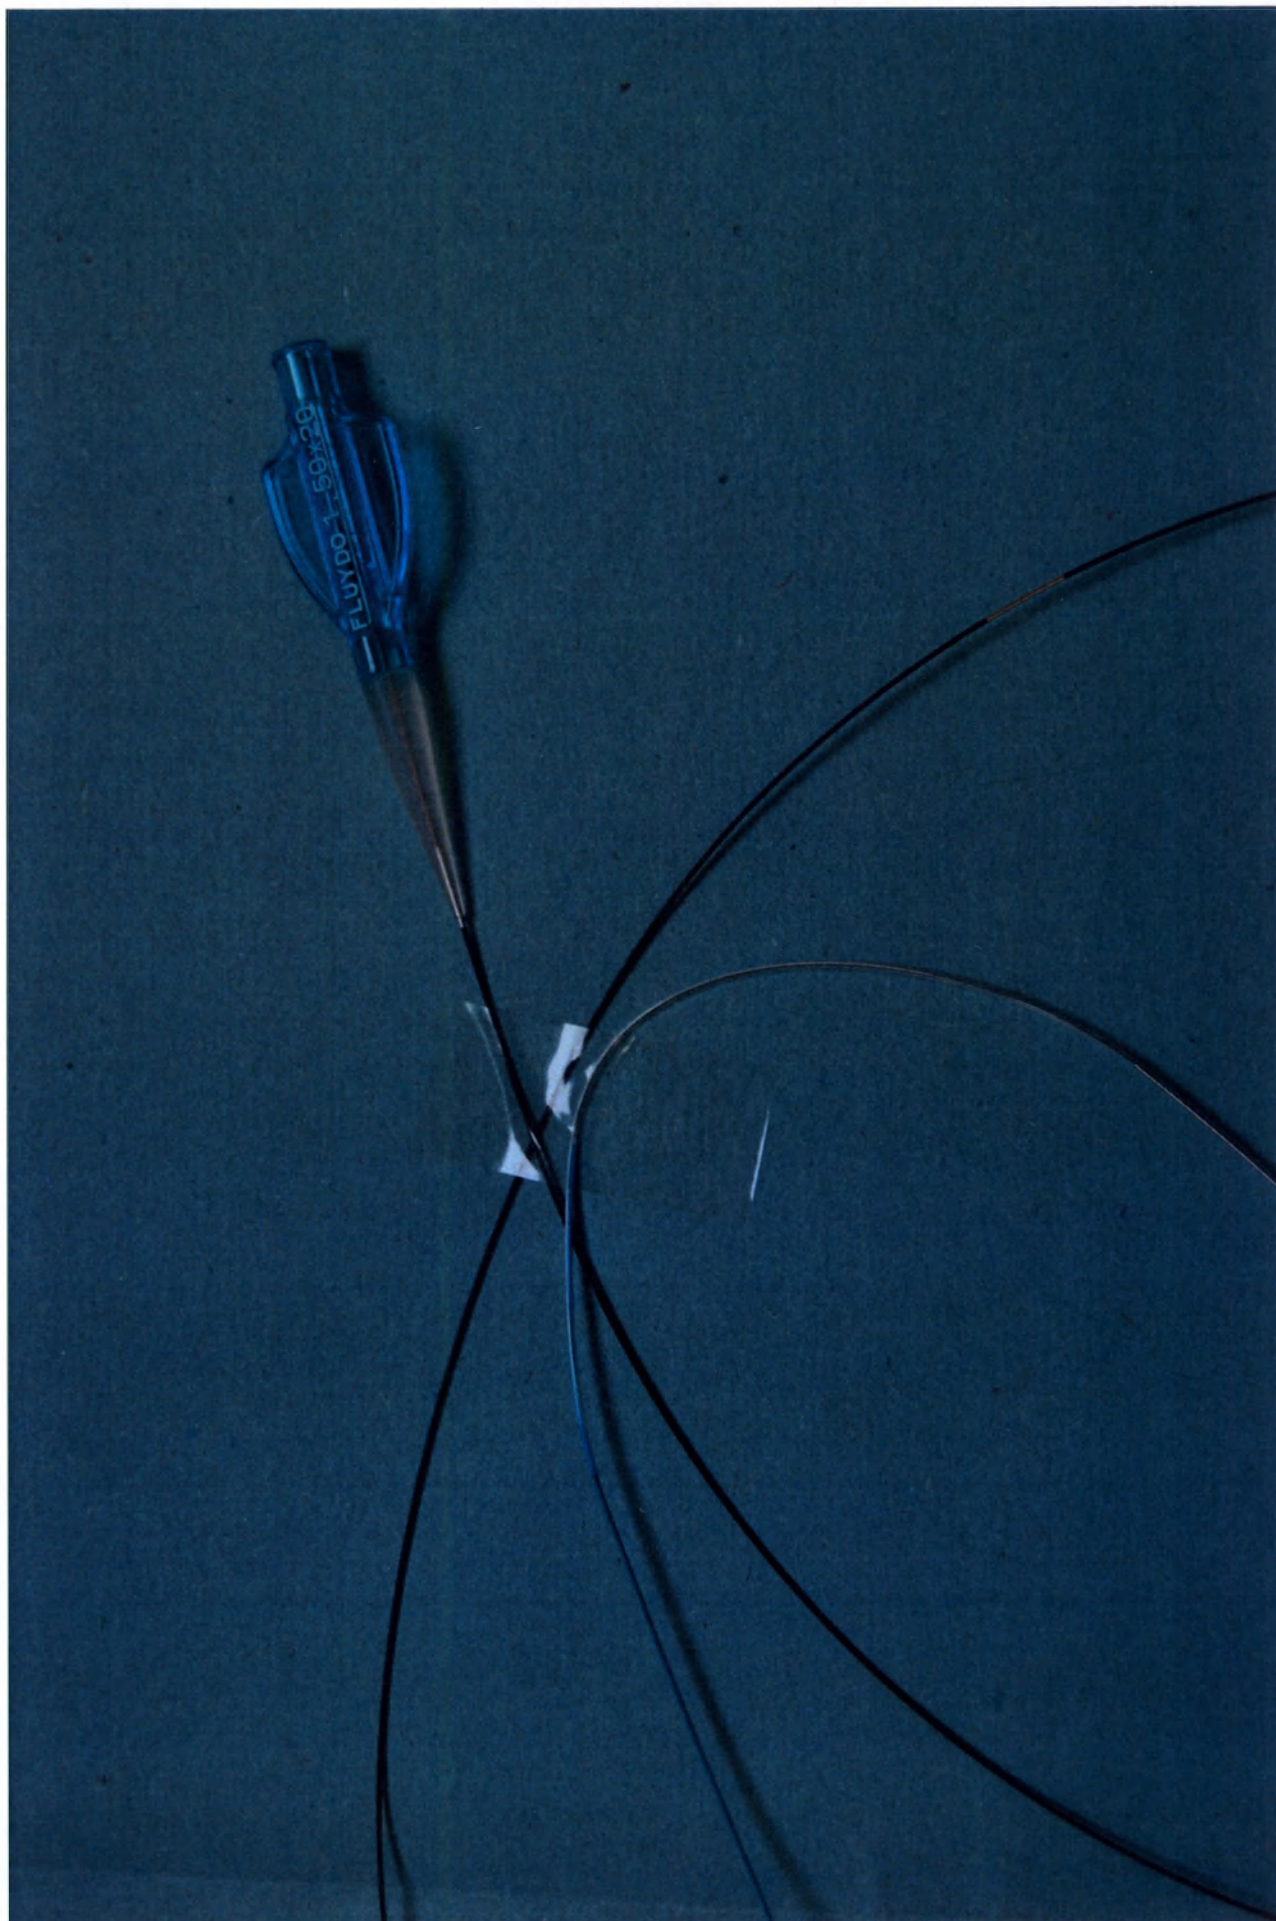


Фото 3. Маркировка порта Луер катетера. Пример.



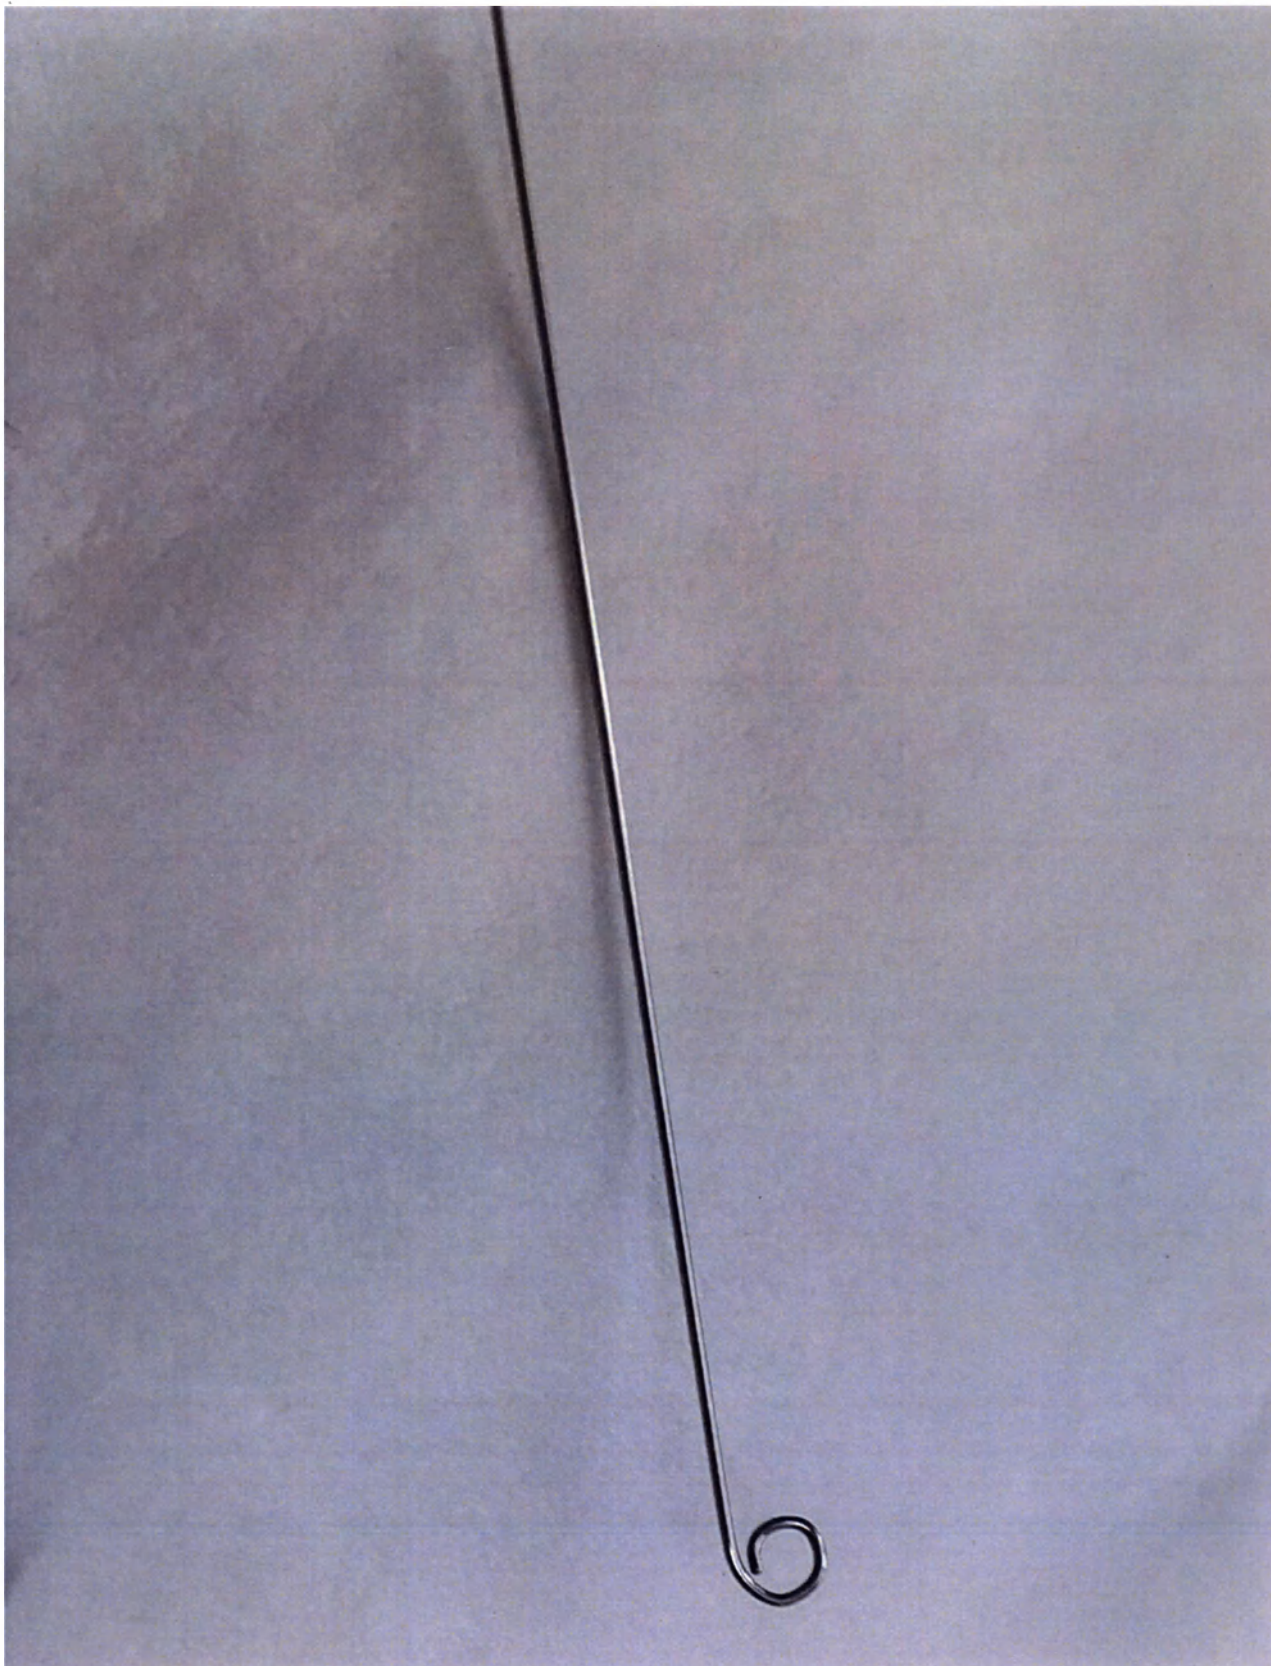


Фото 4. Внешний вид стилета.

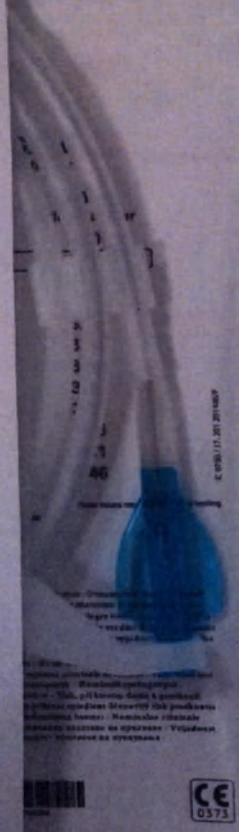

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

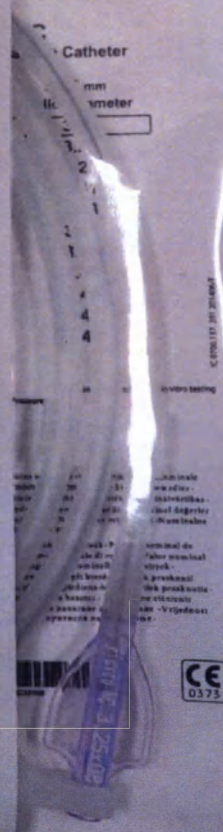

2



Фото 7. Внешний вид упаковочной коробки моделей Fluido Pegaso. Пример.



Фото 8. Внешний вид упаковочной коробки моделей Fluydo NC. Пример.



Фото 9. Внешний вид транспортной коробки. Пример.

RX **Fluido**

SIZE





2026/12

3.00x15 mm

REF ICV8384

LOT 5211220012


Contents: one PTCA catheter. Contenu: un cathéter pour PTCA. Inhalt: ein PTCA-Katheter. Contenuto: un catetere per PTCA. Contenido: un catéter PTCA. Indhold: en PTCA kateter. **Contento**: um cateter para PTCA. Inhoud: een PTCA katheter. Innehåll: ett kateter för PTCA. Sisältö: 1 PTCA katetri. Περιεχόμενα: ένα καθετήρα για PTCA. İçindekiler: PTCA için 1 kateter. Obsah: jeden katetr PTCA. Sisaldus: üks PTCA kateter. Tartalom: egy PTCA katéter. Turinys: vienas vienas kateteris. Saturs: viens PTCA katetrs. Innhold: en PTCA kateter. Obsah: jeden PTCA kateter. Vsebina: en PTCA kateter. Сadržina: jedan PTCA kateter. Sadržaj: jedan PTCA kateter. Sadržina: jedan PTCA kateter. Conținut: un cateter PTCA. Zawiera: jeden PTCA cewnik. Съдържание: един катетър за PTCA. Сadržajmo: один катетер для ЧТКА. Вміст: один катетер для ЧТКА. 包装内容: 一 根 PTCA 导管。 Deftar Isi: 1 kateter per PTCA



3.00 mm

NP

6 atm



15 mm

MGCS

5 F
(1.47 mm)

RBP

14 atm

MGD

0.014 inch

atm	mm
4	2.80
6	3.00
7	3.06
8	3.11
10	3.20
12	3.28
13	3.32
14	3.36

STERILE EO



2021/12

Model - Modèle - Modell - Modello - Modelo
Malli - Μοντέλο - Модел - Modelis - Модель
型号



(01)08033897683492(240)ICV8384



(17)261200(10)5211220012

ICV8384 11220012

Model **3.00x15 mm**

REF

ICV8384

LOT

5211220012



2026/12

CiD **Fluido** CE 0373

SIZE **3.00x15 mm**
REF **ICV8384**
LOT **5211220012**

CiD **Fluido** CE 0373

SIZE **3.00x15 mm**
REF **ICV8384**
LOT **5211220012**

CiD **Fluido** CE 0373

SIZE **3.00x15 mm**
REF **ICV8384**
LOT **5211220012**

CE 0373

CiD S.p.A.
Strada per Crescentino, sn
13040 Saluggia (VC) Italy
www.alvimedica.com

Made
in
Turkey

CiD

Member of

Alvimedica Group

Фото 10. Маркировка стерилизационной упаковки моделей Fluido Regaso. Пример.

RX

Fluידo NC
NON COMPLIANT BALLOON CATHETER

2026/12

SIZE

3.25 x 8




mm

REF ICNC32508

LOT

5211217032

Contents: 1 PTCA Non-Compliant Balloon Catheter. Contenu: 1 cathéter non-compliant pour ACTP. Inhalt: 1 Noncompliant-Katheter für PTCA. Contenuto: 1 catetere Non Compliant per PTCA. Contenido: 1 catéter no distensible para PTCA. Indhold: Non-compliant kateter til PTCA. Contento: 1 cateter não complacente para PTCA. Inhoud: 1 niet-compliance kateter voor PTCA. Innehåll: En ej tänjbar kateter för PTCA. Sisältö: 1 mukautumaton katetri PTCA : ta varten. Περιεχόμενα: 1 μη συμμορφούμενος καθετήρας για PTCA. İçindekiler: PTCA için 1 uyumlu olmayan kateter. Obsah: 1 nepoddajný katétyr pro PTCA. Sisu: 1 PTCA-ks sobimatu kateteter. Tartalom: PTCA noncompliant ballonkatéter. Saturs: 1 augsta spiedina PTCA katetrs. Turinys: 1 kateteris, neskirtas PTCA. Innhold: 1 kateter med ballong som ikke vokser ved fylling for PTCA. Obsah: 1 nepoddajný katéter na PTCA. Vsečina: 1 nekomplančni kateter za PTCA. Sadržaj: 1 kateter za PTCA sa nerastegljivim balonom. Sadržaj: 1 kateter za PTCA sa nerastegljivim balonom. Continut: 1 cateter necompliant pentru PTCA. Zawartość: 1 niepodatny cewnik PTCA. Сadržани: 1 нерастегливатель за ПТКА. Сadržани: 1 катетер для ЧТКА с нерастяжимым баллоном. Вміст упаковки: 1 нероздушний катетер для ЧТКА. 包裝內容: 1 个用于 PTCA 的膨胀后无号管

**3.25 mm****8 mm**

NP

12 atm

RBP

22 atm

MGCS

**5F
(1.47 mm)**

MGD

0.014 inch

atm	mm
10	3.22
12	NP 3.25
14	3.29
16	3.33
18	3.38
20	3.42
22	RBP 3.46

STERILE




2021/12

Model - Modèle - Modell - Modello - Modelo

Mall - Μοντέλο - Модел - Modelis - Модель

型号

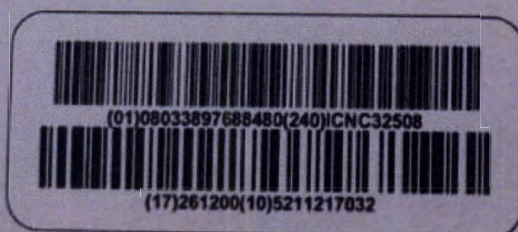Model **3.25x8 mm**

REF

ICNC32508

LOT

5211217032



2026/12

CiD **Fluידo NC** CE 0373

SIZE **3.25x8 mm**
REF **ICNC32508**
LOT **5211217032**

CiD **Fluידo NC** CE 0373

SIZE **3.25x8 mm**
REF **ICNC32508**
LOT **5211217032**

CiD **Fluידo NC** CE 0373

SIZE **3.25x8 mm**
REF **ICNC32508**
LOT **5211217032**

CE 0373



CiD S.p.A.
Strada per Crescentino, sn
13040 Saluggia (VC) Italy
www.alvimedica.com

Made
in
Turkey


CiD

Member of

Alvimedica Group

Фото 11. Маркировка стерилизационной упаковки моделей Fluידo NC. Пример.

Contents: one PTCA catheter. Contenu: un cathéter pour PTCA. Inhalt: ein PTCA-Katheter. Contenuto: un catetere per PTCA. Contenido: un catéter PTCA. Innhold: en PTCA kateter. Contentido: um cateter para PTCA. Inhoud: een PTCA katheter. Innehåll: ett kateter för PTCA. Sisälsä: 1 PTCA katetri. Прыпрыгыва: yno katetrop yon PTCA. İçindekiler: PTCA için 1 kateter. Obsah: jeden kateter PTCA. Sisältös: üks PTCA kateter. Tartalom: egy PTCA katéter. Turiny: vienas vienas kateteris. Saturs: viens PTCA katērs. Innhold: en PTCA-kateter. Obsah: jeden PTCA kateter. Vsebina: en PTCA kateter. Содержание: один катетер за PTCA. Сadržanie: jeden kateer. Sadržaj: jedan PTCA kateter. Sadržina: jedan PTCA kateter. Conținut: un cateter PTCA. Zawiera: jeden PTCA cewnik. Содержание: один катетер за PTCA. Сadržanie: один катетер для ЧТКА. Вміст: один катетер для ЧТКА. 包裝內容: 一組 PTCA 导管。 Daftar Isi: 1 kateter per PTCA.



3.00 mm NP 6 atm

10 mm MGCS 5F (1.47 mm)

RBP 14 atm MGD 0.014 inch

atm	mm
4	2.80
6	3.00
7	3.06
8	3.11
10	3.20
12	3.28
13	3.32
14	3.36

Distributed by



2021/09

Model - Modèle - Modell - Modello - Modelo

Malli - Modello - Mogen - Modelis - Modelen

型号



Model 3.00x10 mm

REF ICV8378

LOT 5210907023

2026/09



CE 0373 CID S.p.A. Strada per Crescentino, 13 13040 Saluggia (VC) Italy www.alvimedica.com

Made in Turkey

CID Member of

Alvimedica Group

Катетер баллонный для чрескожной транскатетеральной коронарной ангиопластики Fluydo Regaso, с рабочей длиной 142 см и баллоном (диаметр x длина). (размер указан на упаковке)

Артикул: указан на упаковке

Дата изготовления: указана на упаковке. Использовать до: указано на упаковке

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение «Деост» (ООО НПО «Деост»)

Юридический адрес уполномоченного представителя производителя на территории РФ: Россия, 142290, Московская область, город Пушкино, проспект Неужин, дом 3, помещение 4, комната 22, этаж 4

ИНН: 5039003073 КПП: 503901001 Телефон: 8 (495) 540-40-04 E-mail: deost@deost.ru

Условия хранения:

+10°C -40°C Относительная влажность воздуха не более 80 %

Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

Беречь от влаги и прямого воздействия солнечного света.

РУ № _____ от _____ г.

Фото 12. Маркировка упаковочной коробки моделей Fluydo Regaso. Пример.

14



Фото 14. Маркировка транспортной коробки. Пример.

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 15 (17.85.1428422) листов
Генеральный директор
ООО НПО «Деост»



Паклин Е. Л.