

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Здоровье»



В.А. Курбатов

«23» апреля 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ BISICO PROVI TEMP К ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВ


производства компании Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ&Ко.КГ (Bisico
Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co.KG), Германия

2024

⑤ Provi Temp K

Temporäres Kronen- und Brückenmaterial
auf BIS-Acrylat-Basis

Farbe



A1

Inhalt:
1 Kartusche 1:4:1 50 ml
+ 15 Mischer heilblau



②



①



③

Инструкция по применению **RUS**

Provi Temp K

смешиваемый материал для изготовления врем.

Provi Temp K - это автоматический смешивающий материал на основе многофункциональных светлосиних временных коронок и мостов, в полости пациента. Благодаря высокой конечной твердости подходит для изготовления мостов большой протяжности.

Provi Temp K не содержит металламатериалов. Тем. После изготовления временный протез застывает, принимает форму прикуса. Затвердевший временный протез устойчив к истиранию, малой усадке при Кроне. Кроме того, он отличается хорошей эстетической стабильностью и флуоресценцией.

Временные протезы из Provi Temp K легко ремонтировать. Материал химически соединяется со светлосиними композиционными материалами. Практически не подвергается коррозии/окислению. Система на основе металлов приклеивается из толстых краев коронок. Поэтому имеет большую протяженность.

Применение

④




1. Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок A1, в картридже 50 мл.
2. Наконечник для смешивания светлосиним.
3. Инструкция краткая по применению.
4. Пистолет-дозатор Bisico Dispenser 4/10.
5. Потребительская упаковка.

Материал стоматологический Bisico Provi Temp K для изготовления временных коронок и мостов.

Вариант исполнения Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок A1. Общий вид с инструкцией краткой по применению и потребительской упаковкой

Материал стоматологический Bisico Provi Temp K для изготовления временных коронок и мостов. Вариант исполнения Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок A2. Общий вид с инструкцией краткой по применению и потребительской упаковкой.

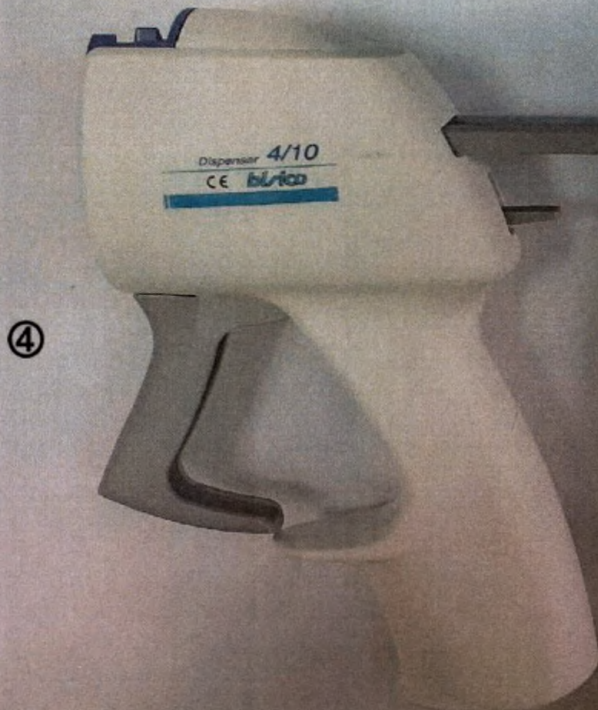


1. Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок A2, в картридже 50 мл.
2. Наконечник для смешивания светло-голубой.
3. Инструкция краткая по применению.
4. Пистолет-дозатор Bisico Dispenser 4/10.
5. Потребительская упаковка.

Материал стоматологический Bisico Provi Temp K для изготовления временных коронок и мостов. Вариант исполнения Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок А3. Общий вид с инструкцией краткой и потребительской упаковкой.

Provi Temp K

Temporäres Kronen- und Brückenmaterial auf BIS-Acrylat-Basis

Farbe



A3

Inhalt:
1 Kartusche 1 4:1 50 ml
+ 15 Mischer hellblau

bisico

③

Инструкция по применению **RUS**

Provi Temp K
смешиваемый материал для изготовления протезов

Provi Temp K – это автоматический смешивающий картридж на основе многофункционального метакрилатного временного коронок и мостов, который подходит для изготовления мостов большой протяженности.

Provi Temp K не содержит метилметакрилата. После изготовления временных протезов материал принимает форму прикуса. Затвердевший материал устойчив к истиранию, малой усадке при усадке. Кроме того, он отличается хорошими внешними характеристиками и флуоресценцией.

Временные протезы из Provi Temp K легко ремонтировать. Материал химически соединяется со смешиваемыми композиционными материалами. Практически все порошковые/жидкостные системы на основе метакрилатов проявляются на тонких краях коронок. Поэтому материал имеет большую протяженность.

Полимеризация

1. Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок А3, в картридже 50 мл.
2. Наконечник для смешивания светло-голубой.
3. Инструкция краткая по применению.
4. Пистолет-дозатор Bisico Dispenser 4/10.
5. Потребительская упаковка.


④




②



①

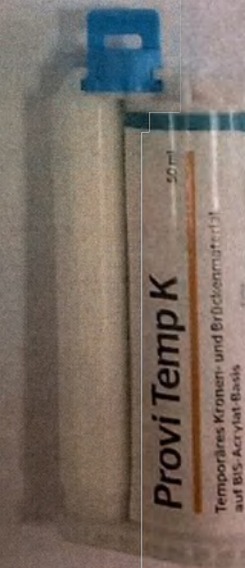

Материал
стоматологический
Bisico Provi Temp K для
изготовления временных
коронки и мостов.
Вариант исполнения
Материал
стоматологический
Bisico Provi Temp K, 4:1,
оттенок максимально
белый. Общий вид с
инструкцией краткой по
применению и
потребительской
упаковкой.

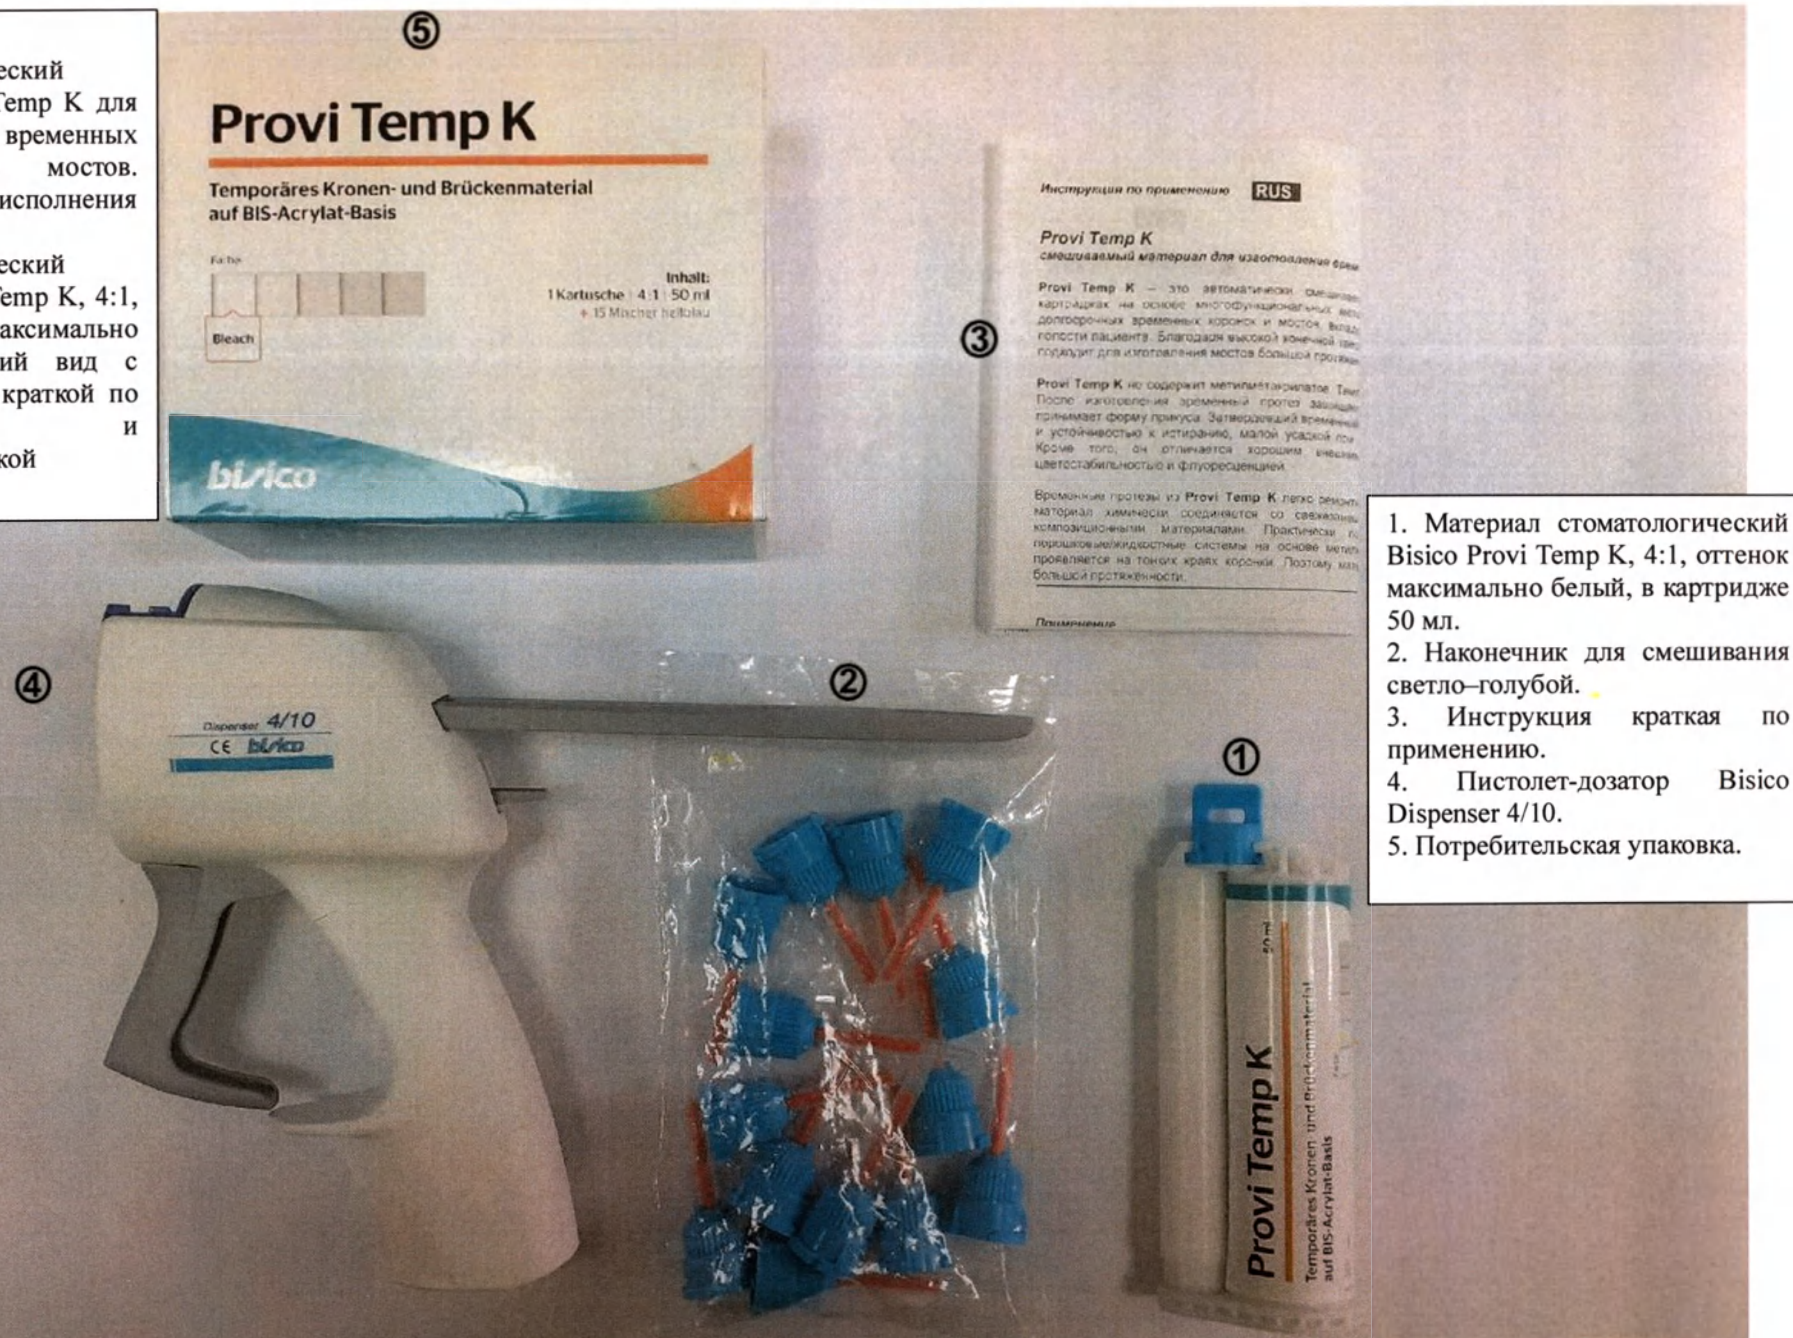


1. Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок максимально белый, в картридже 50 мл.
2. Наконечник для смешивания светло-голубой.
3. Инструкция краткая по применению.
4. Пистолет-дозатор Bisico Dispenser 4/10.
5. Потребительская упаковка.

Provi Temp K

Temporäres Kronen- und Brückenmaterial
auf BIS-Acrylat-Basis

Farbe:



Bleach

Inhalt:
1 Kartusche 4:1 50 ml
+ 15 Mischer hellblau

bisico

Инструкция по применению **RUS**

Provi Temp K
смешиваемый материал для изготовления бр.

Provi Temp K — это автоматический смешивающий картридж на основе многофункционального свето-дополняющего временного коронки и мостов. Благодаря высокой эстетической ценности и легкой обработке для изготовления мостов большой прочности.

Provi Temp K не содержит метилметакрилатов. После изготовления временный протез застывает, принимает форму прикуса. Застывший временный и устойчивостью к истиранию, малой усадкой после Кроне того, он отличается хорошей внешней цветостойкостью и флуоресценцией.

Временные протезы из Provi Temp K легко ремонтировать. Материал химически соединяется со свежими композиционными материалами. Пространство между композиционными системами на основе метилметакрилатов не проявляется на тонких краях коронки. Поэтому материал обладает большой прочностью.

Потребительская упаковка

Dispenser 4/10
CE bisico

Provi Temp K

Temporäres Kronen- und Brückenmaterial
auf BIS-Acrylat-Basis

Материал стоматологический Bisico Provi Temp K для изготовления временных коронок и мостов.
Картридж с материалом и наконечники для смешивания светло-голубые



The image displays two cartridges of Bisico Provi Temp K dental temporary crown and bridge material. The left cartridge is labeled 'Provi Temp K' and 'Temporäres Kronen- und Brückenmaterial auf BIS-Acrylat-Basis'. The right cartridge shows the 'bisico' logo and 'Made in Germany'.

Материал стоматологический Bisico Provi Temp К для изготовления временных коронок и мостов. Маркировка потребительской упаковки

Provi Temp K

Temporäres Kronen- und Brückenmaterial
auf BIS-Acrylat-Basis

Farbe



A1

Inhalt:
1 Kartusche | 4:1 | 50 ml
+ 15 Mischer hellblau

bisico

HIBC



+EBIB735601/SS1
1252119032

UDI

REF 73560

LOT 211903



11.2025



Made in Germany

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dentist.

LOT



See Sticker

Bisico Bielefelder Dentsillicone GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße 3
D-33611 Bielefeld

REF 73560

- GB Special material for temporary crowns and bridges.
- F Matériau à base de résine bis-acrylique pour couronnes et bridges provisoires
- I Materiale autopolimerizzabile per corone e ponti provvisori
- NL Speciaal materiaal voor tijdelijke kronen en bruggen.
- PL Specjalny materiał do wykonywania koron i mostów jako uzupełnienie prowizorycznych.
- PRT Temporária Coroa e Ponte de materiais em BIS-acrílico
- RUS Специальный материал для изготовления временных коронок и мостов
- CN 临时冠桥材料。适用制作临时冠桥。
- AR مواد التيجان والجسور المؤقتة اونوميكس

56820-08 2020

Материал стоматологический Bisico Provi Temp К для изготовления временных коронок и мостов. Макет транспортной упаковки с маркировкой



bisico®

Chargenstempel

Product Name

REF

Inhalt:

Bruttogewicht:

CE Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co.KG
Johanneswerkstr. 3, D- 33611 Bielefeld

**Макет маркировочной этикетки на русском языке в комплектации
с пистолетом дозатором Bisico Dispenser 4/10**

**Материал стоматологический
Bisico Provi Temp К для изготовления
временных коронок и мостов**

Оттенок цвета: максимально белый

Самотвердеющий материал

Комплектность:

Материал стоматологический Bisico Provi Temp К, 4:1, оттенок максимально белый, в составе:

- Материал стоматологический Bisico Provi Temp К, 4:1, оттенок максимально белый, в картридже 50 мл – X шт.

- Наконечник для смешивания светло-голубой – XX шт.

- Инструкция краткая по применению материала стоматологического Bisico Provi Temp К для изготовления временных коронок и мостов – X шт.

- Пистолет-дозатор Bisico Dispenser 4/10 – X шт., в составе:

Пистолет-дозатор Bisico Dispenser 4/10 – 1 шт.

Инструкция краткая по применению пистолета-дозатора Bisico Dispenser 4/10 – 1 шт.

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Примечание: См. инструкцию по применению

Годеи до: См. на упаковке

Производитель:

«Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ» (Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

Макет маркировочной этикетки на русском языке при поставке материала,
не укомплектованного пистолетом-дозатором Bisico Dispenser 4/10

**Материал стоматологический
Bisico Provi Temp K для изготовления
временных коронок и мостов**

Оттенок цвета: максимально белый

Самотвердеющий материал

Комплектность:

Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок максимально белый, в составе:

- Материал стоматологический Bisico Provi Temp K, 4:1, оттенок максимально белый, в картридже 50 мл – X шт.
- Наконечник для смешивания светло-голубой – XX шт.
- Инструкция краткая по применению материала стоматологического Bisico Provi Temp K для изготовления временных коронок и мостов – X шт.

ПУ № _____ от « ____ » _____ г.

Примечание: См. инструкцию по применению

Годен до: См. на упаковке

Производитель:

«Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ» (Bisico Bielefelder
Dentalsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью:

11 (срок карантина) листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Здоровье» В.А. Курбатов

