

Фотографические изображения медицинского изделия
Контейнер термозоляционный
с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов
КТ-СП-6-«Медпром»
по ТУ 32.50.50-010-50063260-2019
производитель ООО «Медпром», Россия



Фотография 1. Общий вид. Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов КТ-СП-6-«Медпром» по ТУ 32.50.50-010-50063260-2019



Фотография 2. Вид сзади. Карман крышки расстегнут.



Фотография 3. Общий вид. Крышка контейнера открыта



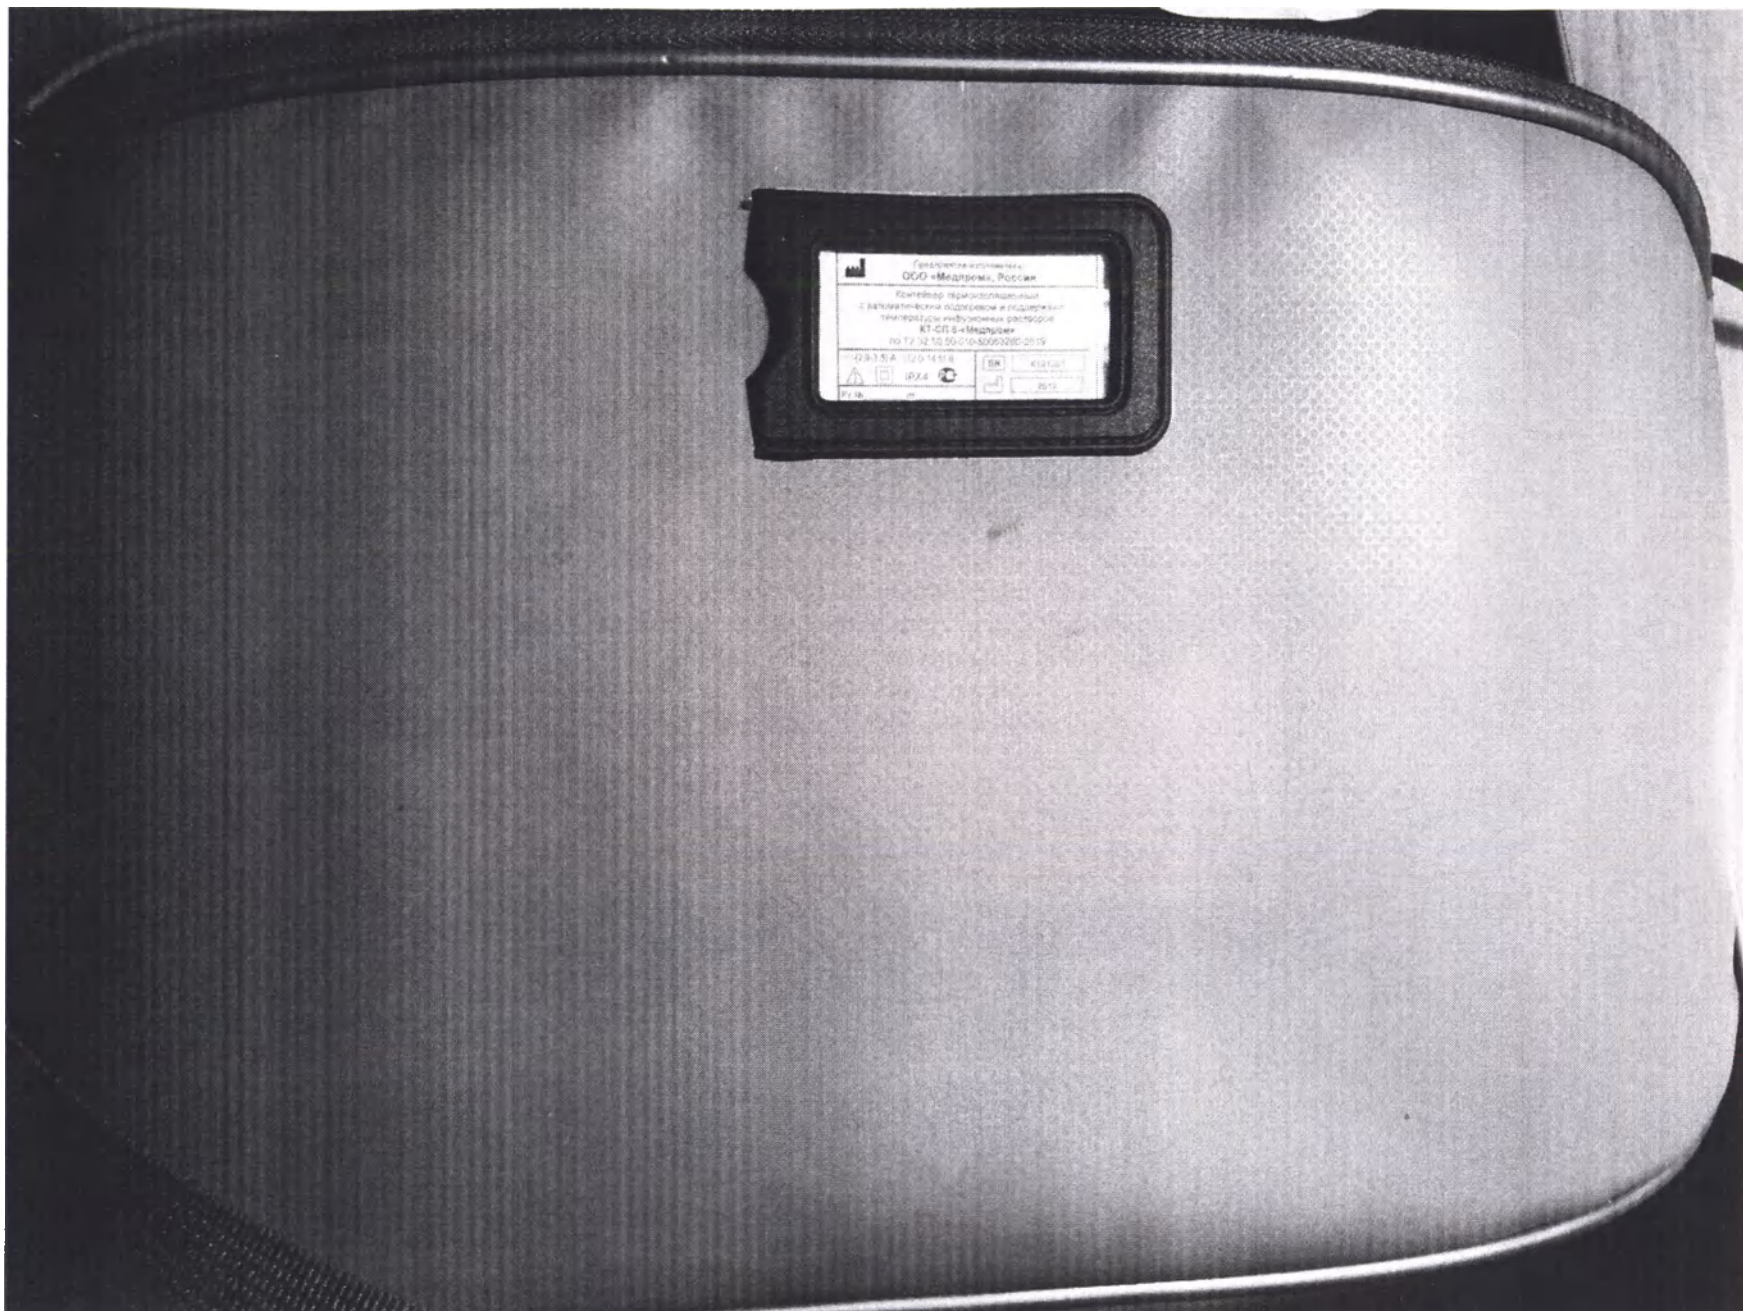
Фотография 4. Вид сверху (крышка открыта)



Фотография 5. Общий вид. Место расположения термостата (устройство управления) и несъемного кабеля питания. Карман расстегнут.



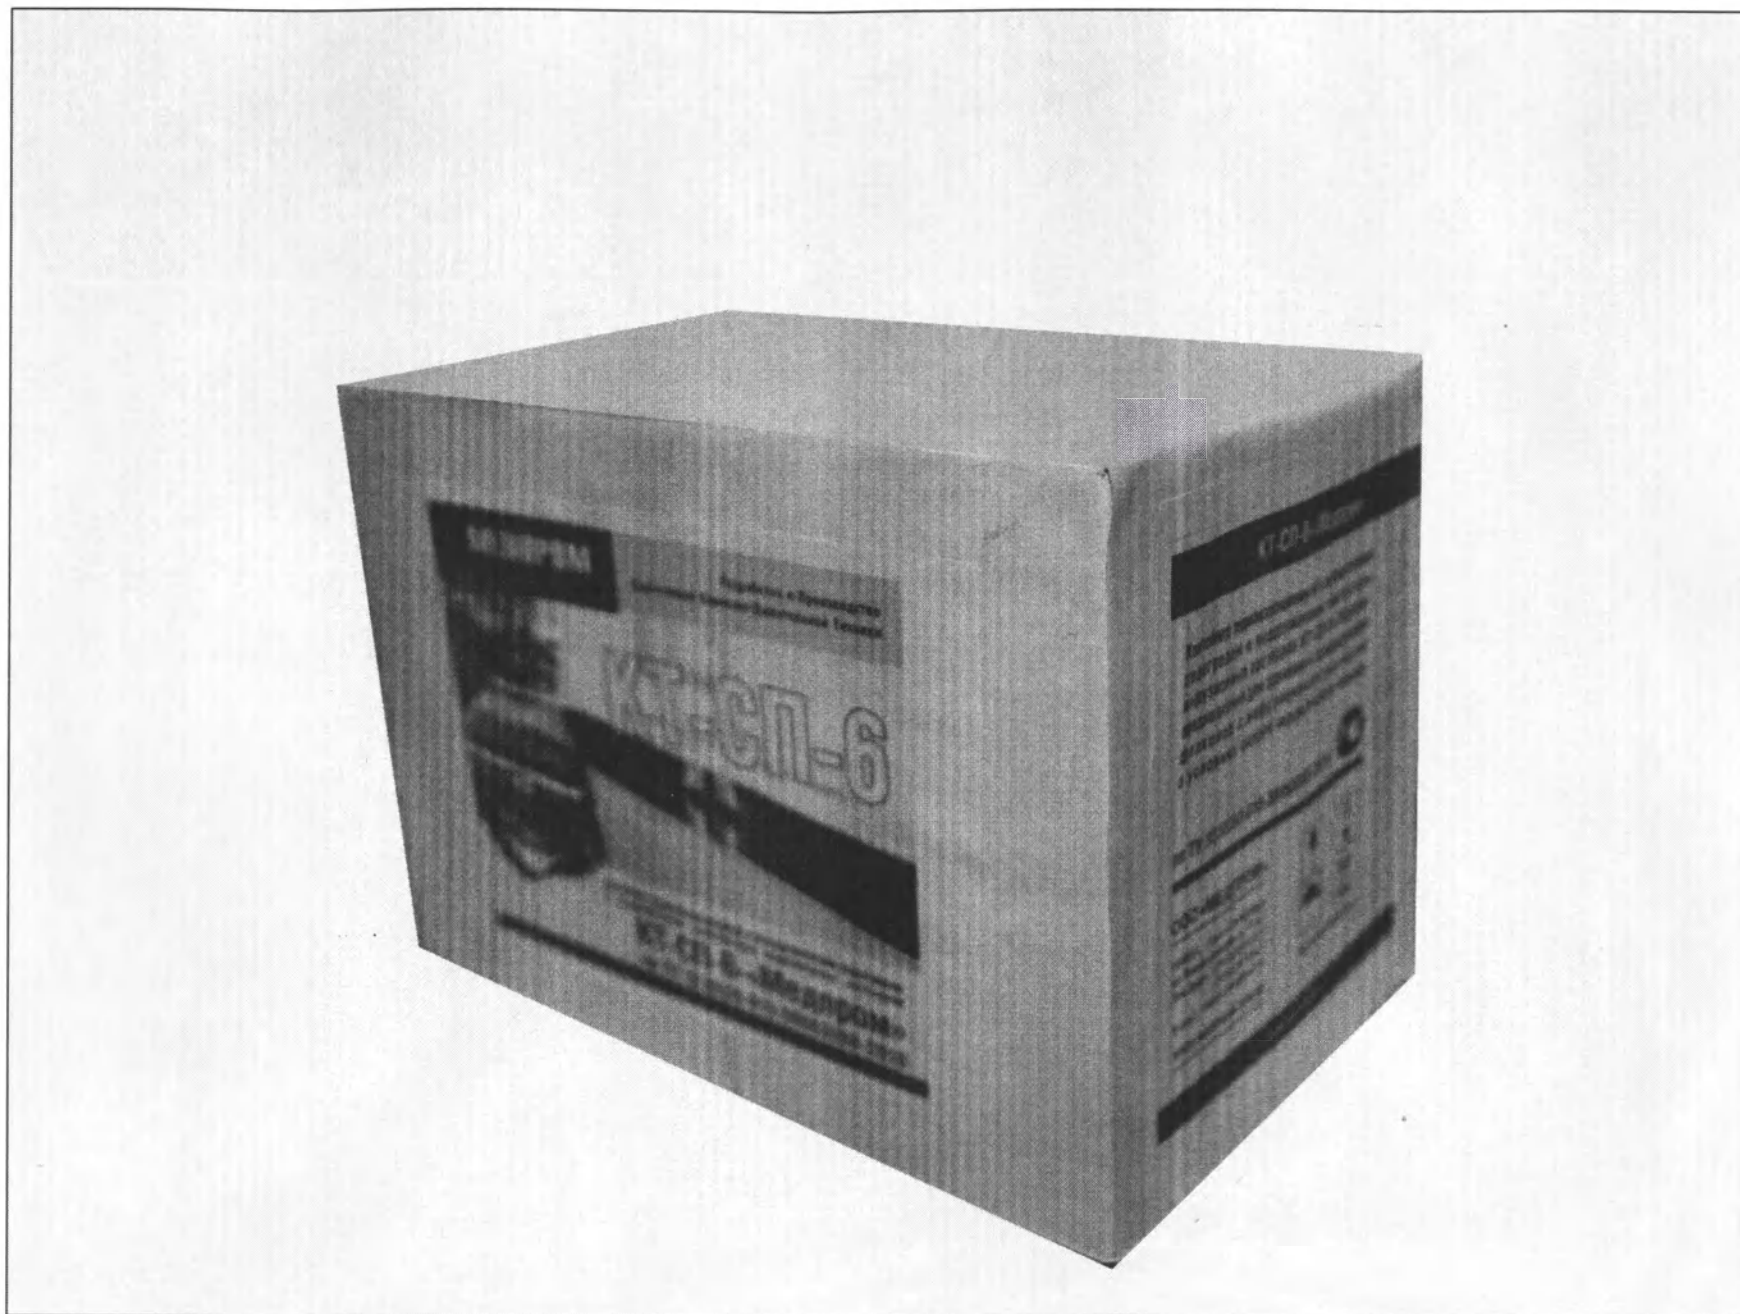
Фотография 6. Общий вид. Контейнер с открытой крышкой и вынутым из кармана несъемным кабелем питания.




Фотография 7. Вид сверху. Расположение маркировки изделия (шильда)



Фотография 8. Маркировка изделия (шильда)




Фотография 9. Упаковка (транспортная упаковка)

 Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17 корп.3	
Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов КТ-СП-6-«Медпром» по ТУ 32.50.50-010-50063260-2019	
---(2,9-3,5) A (12,0-14,5) B   IPX4 	 2019  SN K191001 Упаковано: 2019.02 (год, месяц)  Штмп: ОТК
Масса: брутто 3,5 кг, нетто 2,8 кг	РУ № _____ от _____
Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°C... 50°C  	
Условия хранения - 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°C... 50°C  	
   	

Фотография 10. Маркировка на упаковке (транспортная упаковка)

Генеральный директор ООО «Медпром»

Вазин Д.А. 

Всего прошито и пронумеровано 11

() лист об

ООО «МЕДПРОМ»

Макеты маркировки медицинского изделия

**Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и
поддержанием температуры инфузионных растворов
КТ-СП-6-«Медпром» по ТУ 32.50.50-010-50063260-2019,
производства ООО «Медпром», Россия**


Маркировка медицинского изделия

Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов
КТ-СП-6-«Медпром» по ТУ 32.50.50-010-50063260-2019,
производства ООО «Медпром», Россия

	
Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия	
Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов КТ-СП-6-«Медпром» по ТУ 32.50.50-010-50063260-2019	
---(2,9-3,5) А (12,0-14,5) В	
	 IPX4 
ПУ № _____	от _____
 SN	
	

Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия

Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов
КТ-СП-6-«Медпром» по ТУ 32.50.50-010-50063260-2019,
производства ООО «Медпром», Россия

 Предприятие-изготовитель: ООО «Медпром», Россия Россия, 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 17 корп.3	
Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов КТ-СП-6-«Медпром» по ТУ 32.50.50-010-50063260-2019	
=== (2,9-3,5) A (12,0-14,5) B   IPX4 	   Упаковано: _____ (год, месяц)
Масса: брутто 3,5 кг, нетто 2,8 кг	РУ № _____ от _____.
Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150-69: - температура от минус 50°C до плюс 50°C; - относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°C. - 50°C  + 50°C  100%	
Условия хранения - 2 по ГОСТ 15150-69: - при температуре от минус 50°C до плюс 40°C; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°C. - 50°C  + 40°C  98 %	
   	

Генеральный директор ООО «Медпром»

Вазин Д.А.

Всего прошито и пронумеровано 3

() лист 2