

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭМС»

Галынин А.И.



Дефибриллятор-монитор Deficor-DM

по ЛТБВ.941135.001 ТУ

Альбом фотографий

Общий вид



Рисунок 1 — Общий вид изделия со всеми составными частями и принадлежностями

Составные части



Рисунок 2 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-06, панель управления)



Рисунок 3 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-06, левая панель)



Рисунок 4 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-06, правая панель)



Рисунок 5 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-06, задняя крышка)



Рисунок 6 — Электроды дефибрилляции многоразовые для взрослых и детей
(ЛТБВ.943132.001, вид сверху)



Рисунок 7 — Электроды дефибриляции многоразовые для взрослых и детей
(ЛТБВ.943132.001, контактные площадки)



Рисунок 8 — Электроды дефибриляции, мониторинга и стимуляции
 одноразовые для взрослых (ЛТБВ.943.132.002, в упаковке)

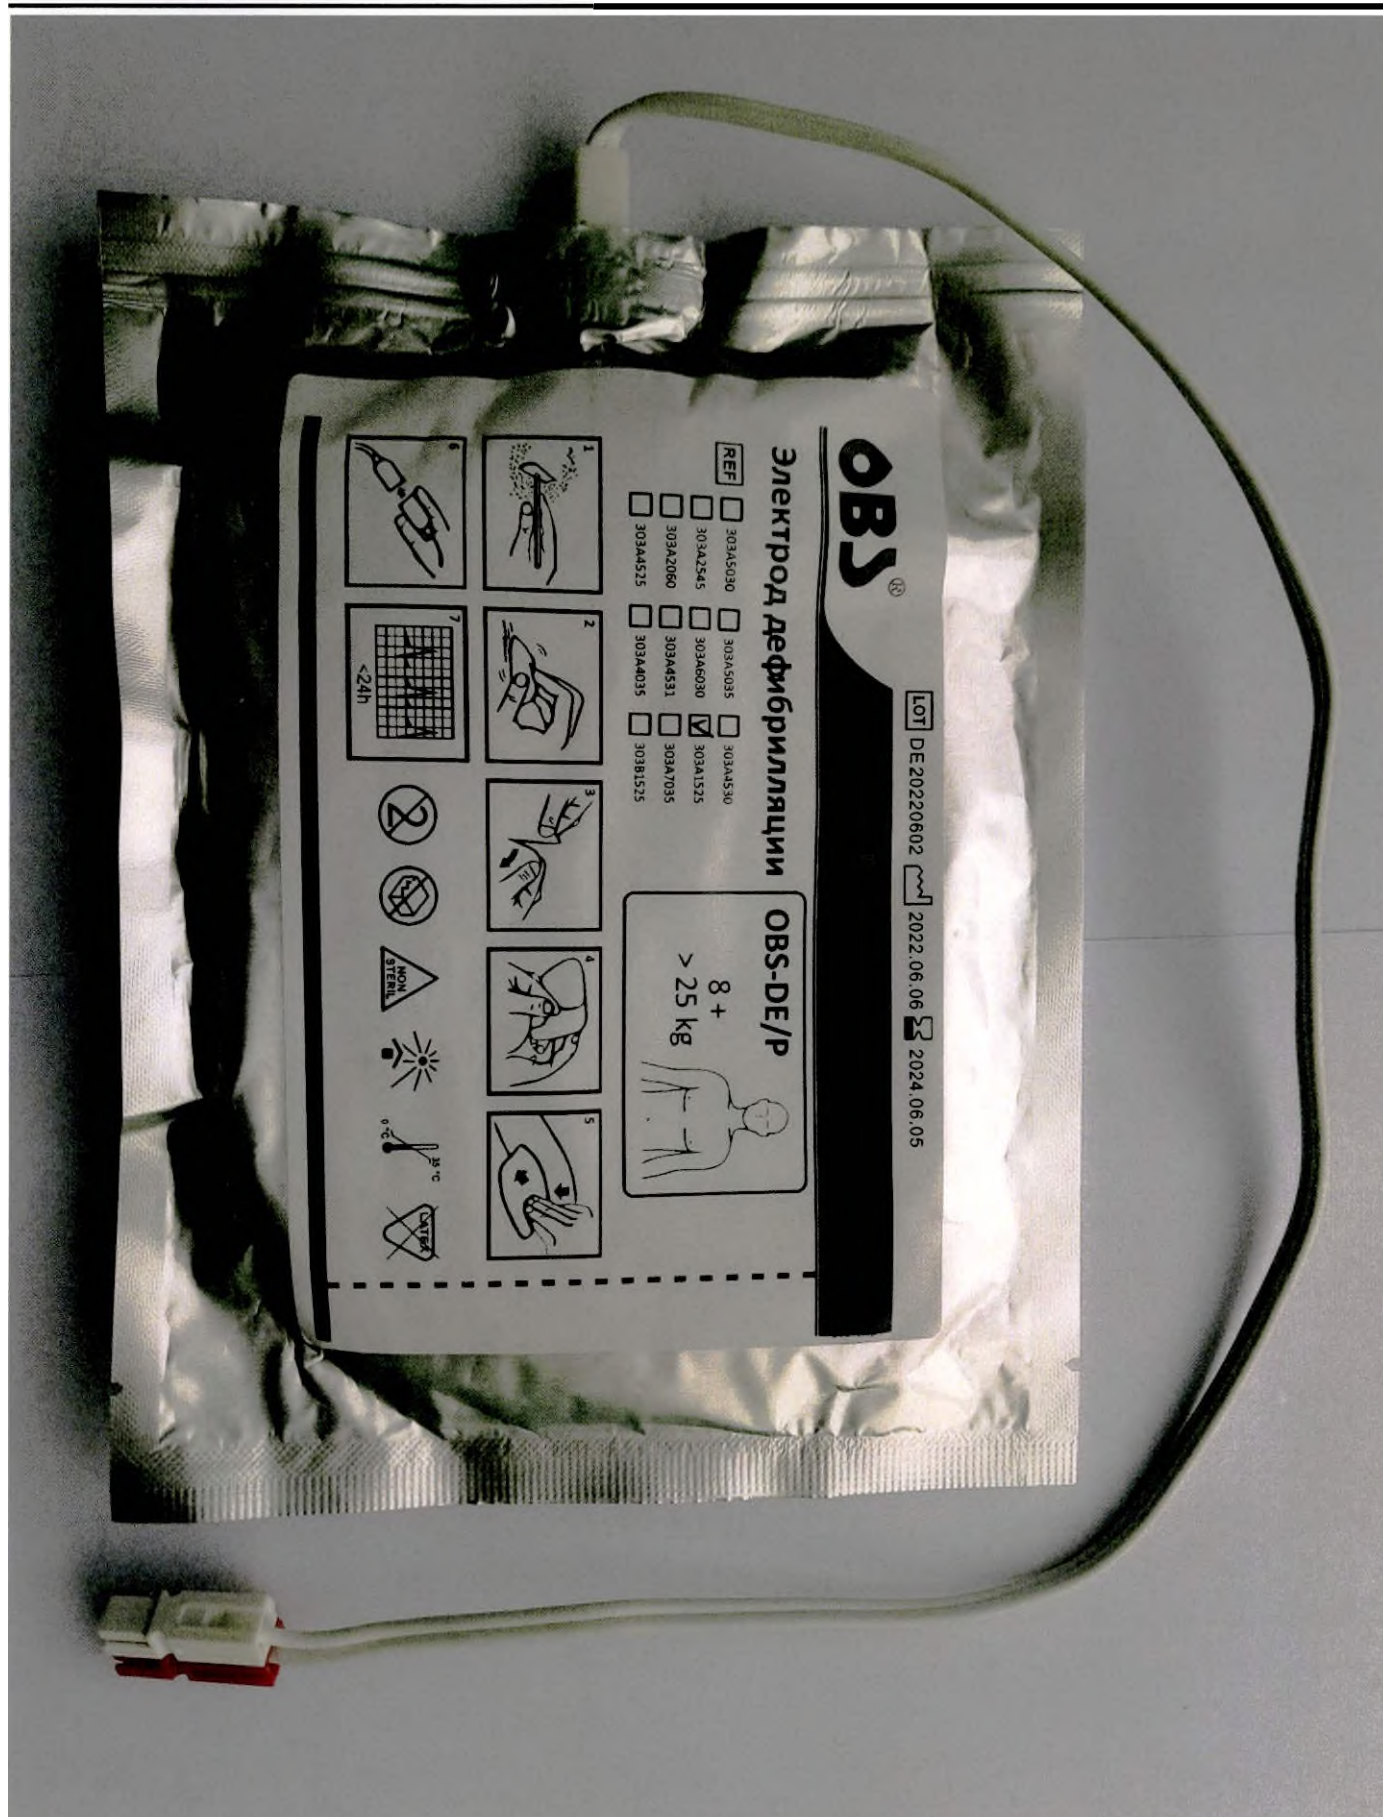


Рисунок 9 — Электрод дефибрилляции OBS-DE/P (303A1525, в упаковке)



Рисунок 10 — Одноразовые многофункциональные электроды для наружной дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ Lessa Defi-Pad (99.835.102, в упаковке)



Рисунок 11 — Электроды дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовые для детей (ЛТБВ.943.132.003, в упаковке)

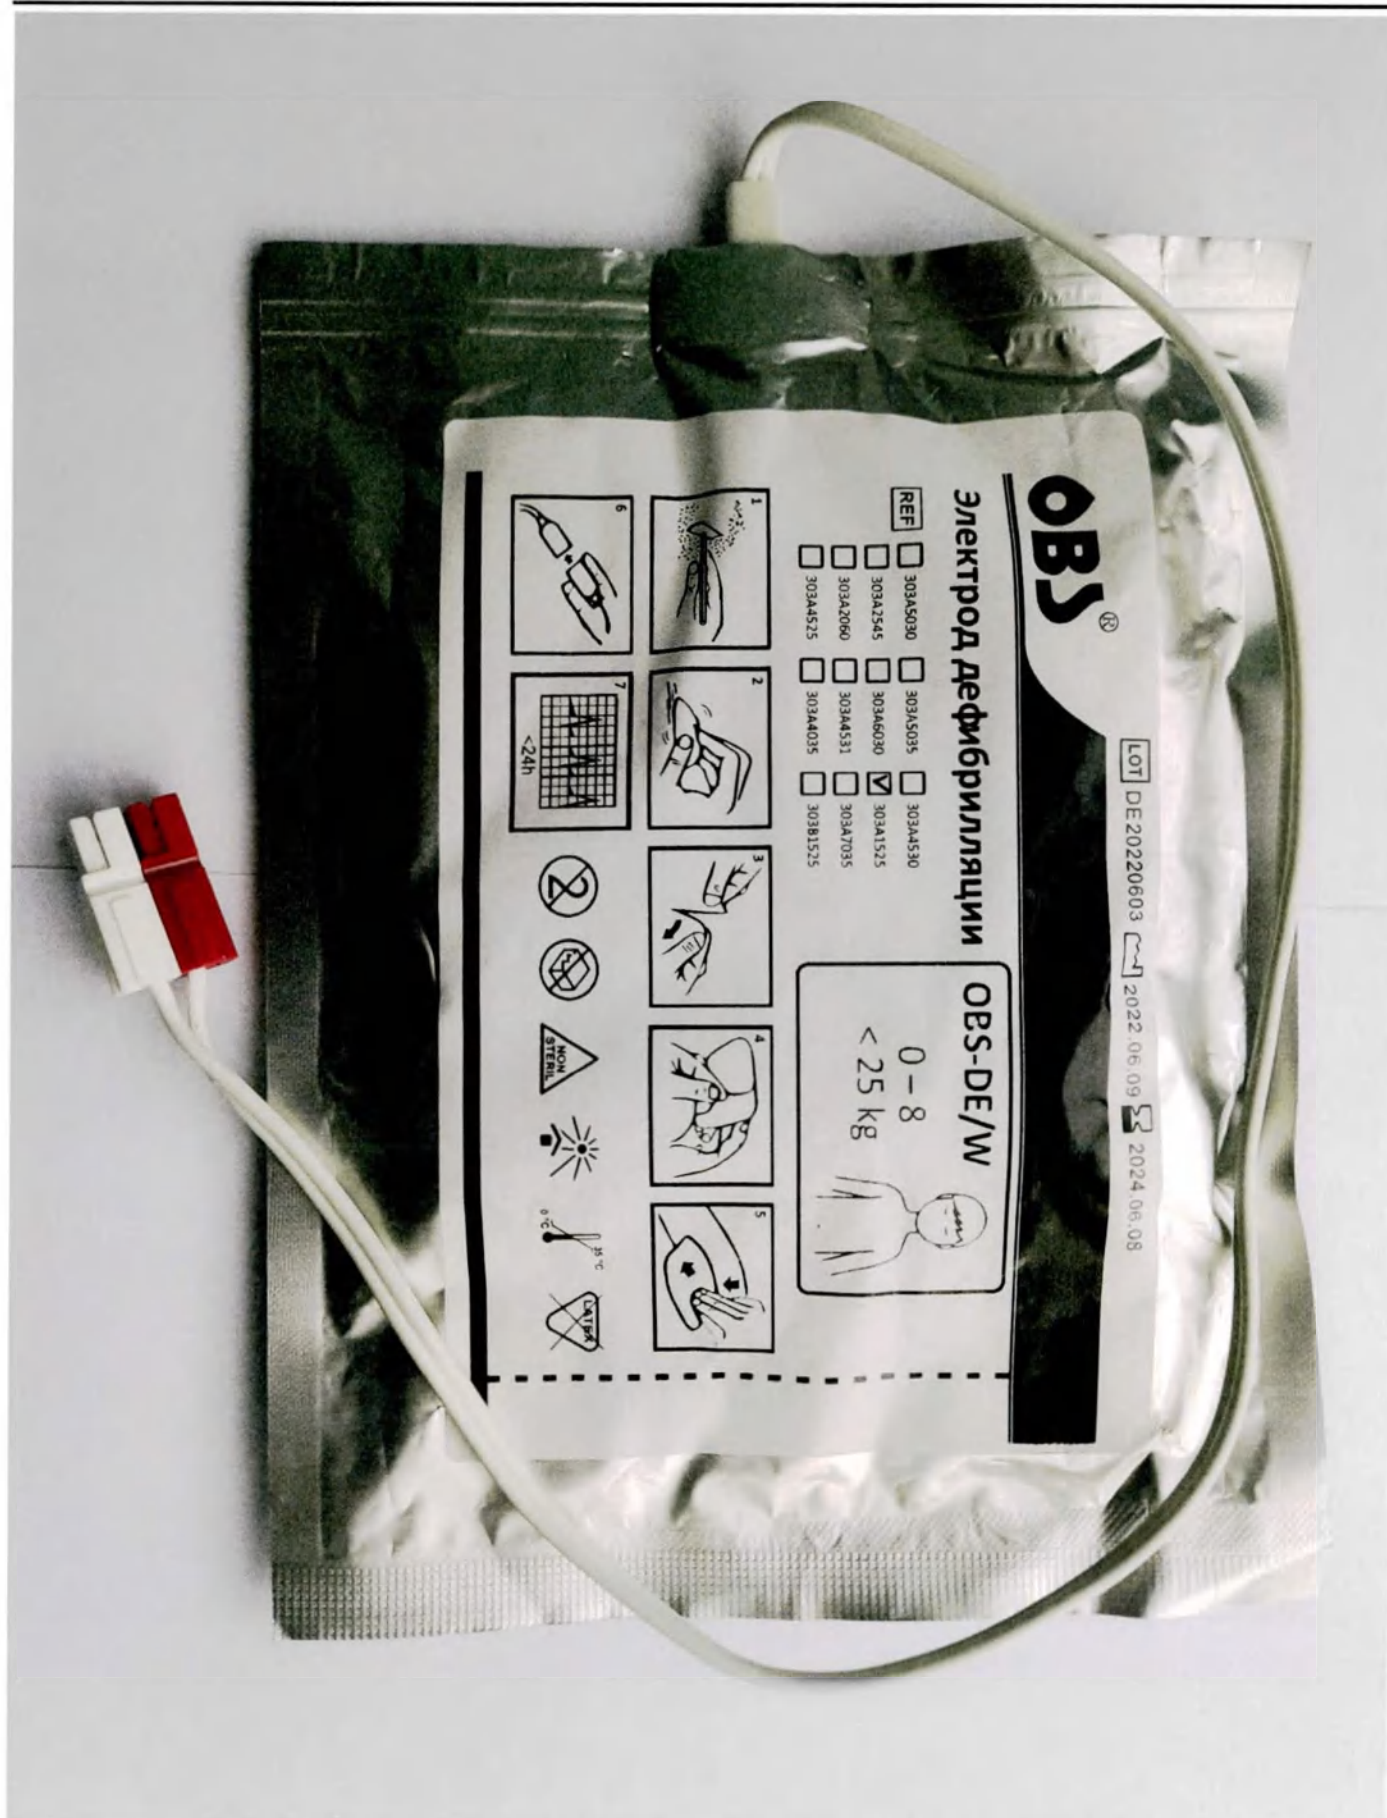


Рисунок 12 — Электрод дефибрилляции OBS-DE/W (303A1525, в упаковке)



Рисунок 13 — Одноразовые многофункциональные электроды для наружной дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ Lessa Defi-Pad (99.835.103, в упаковке)



Рисунок 14 — Аккумуляторная батарея (ЛТБВ.943129.001)



Рисунок 15 — Неperезаряжаемая батарея (ЛТБВ.943129.002)



Рисунок 16 — Сетевой преобразователь 220/13 В (ЛТБВ.943129.003)

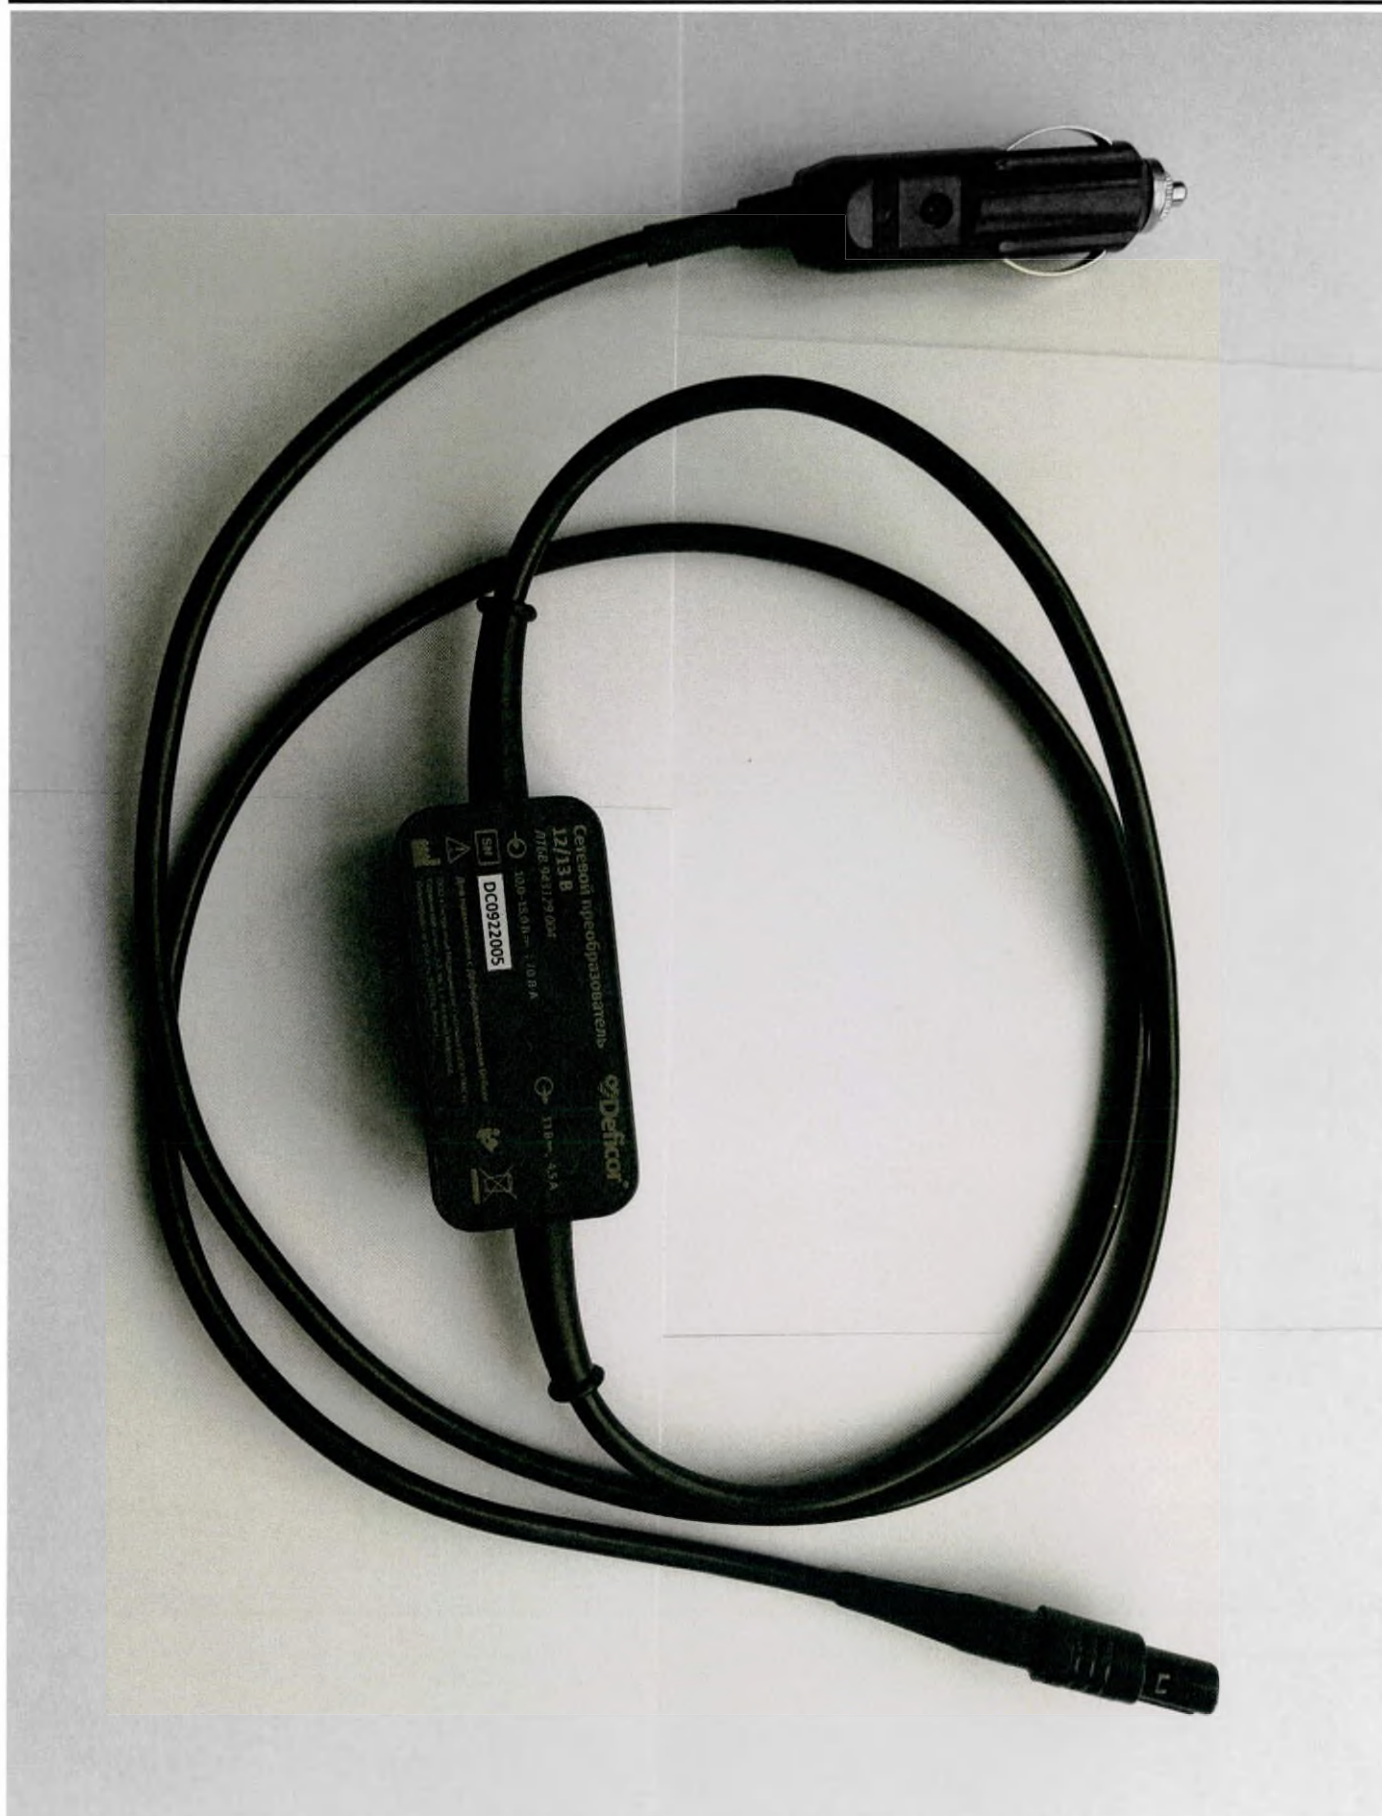


Рисунок 17 — Сетевой преобразователь 12/13 В (ЛТБВ.943129.004)

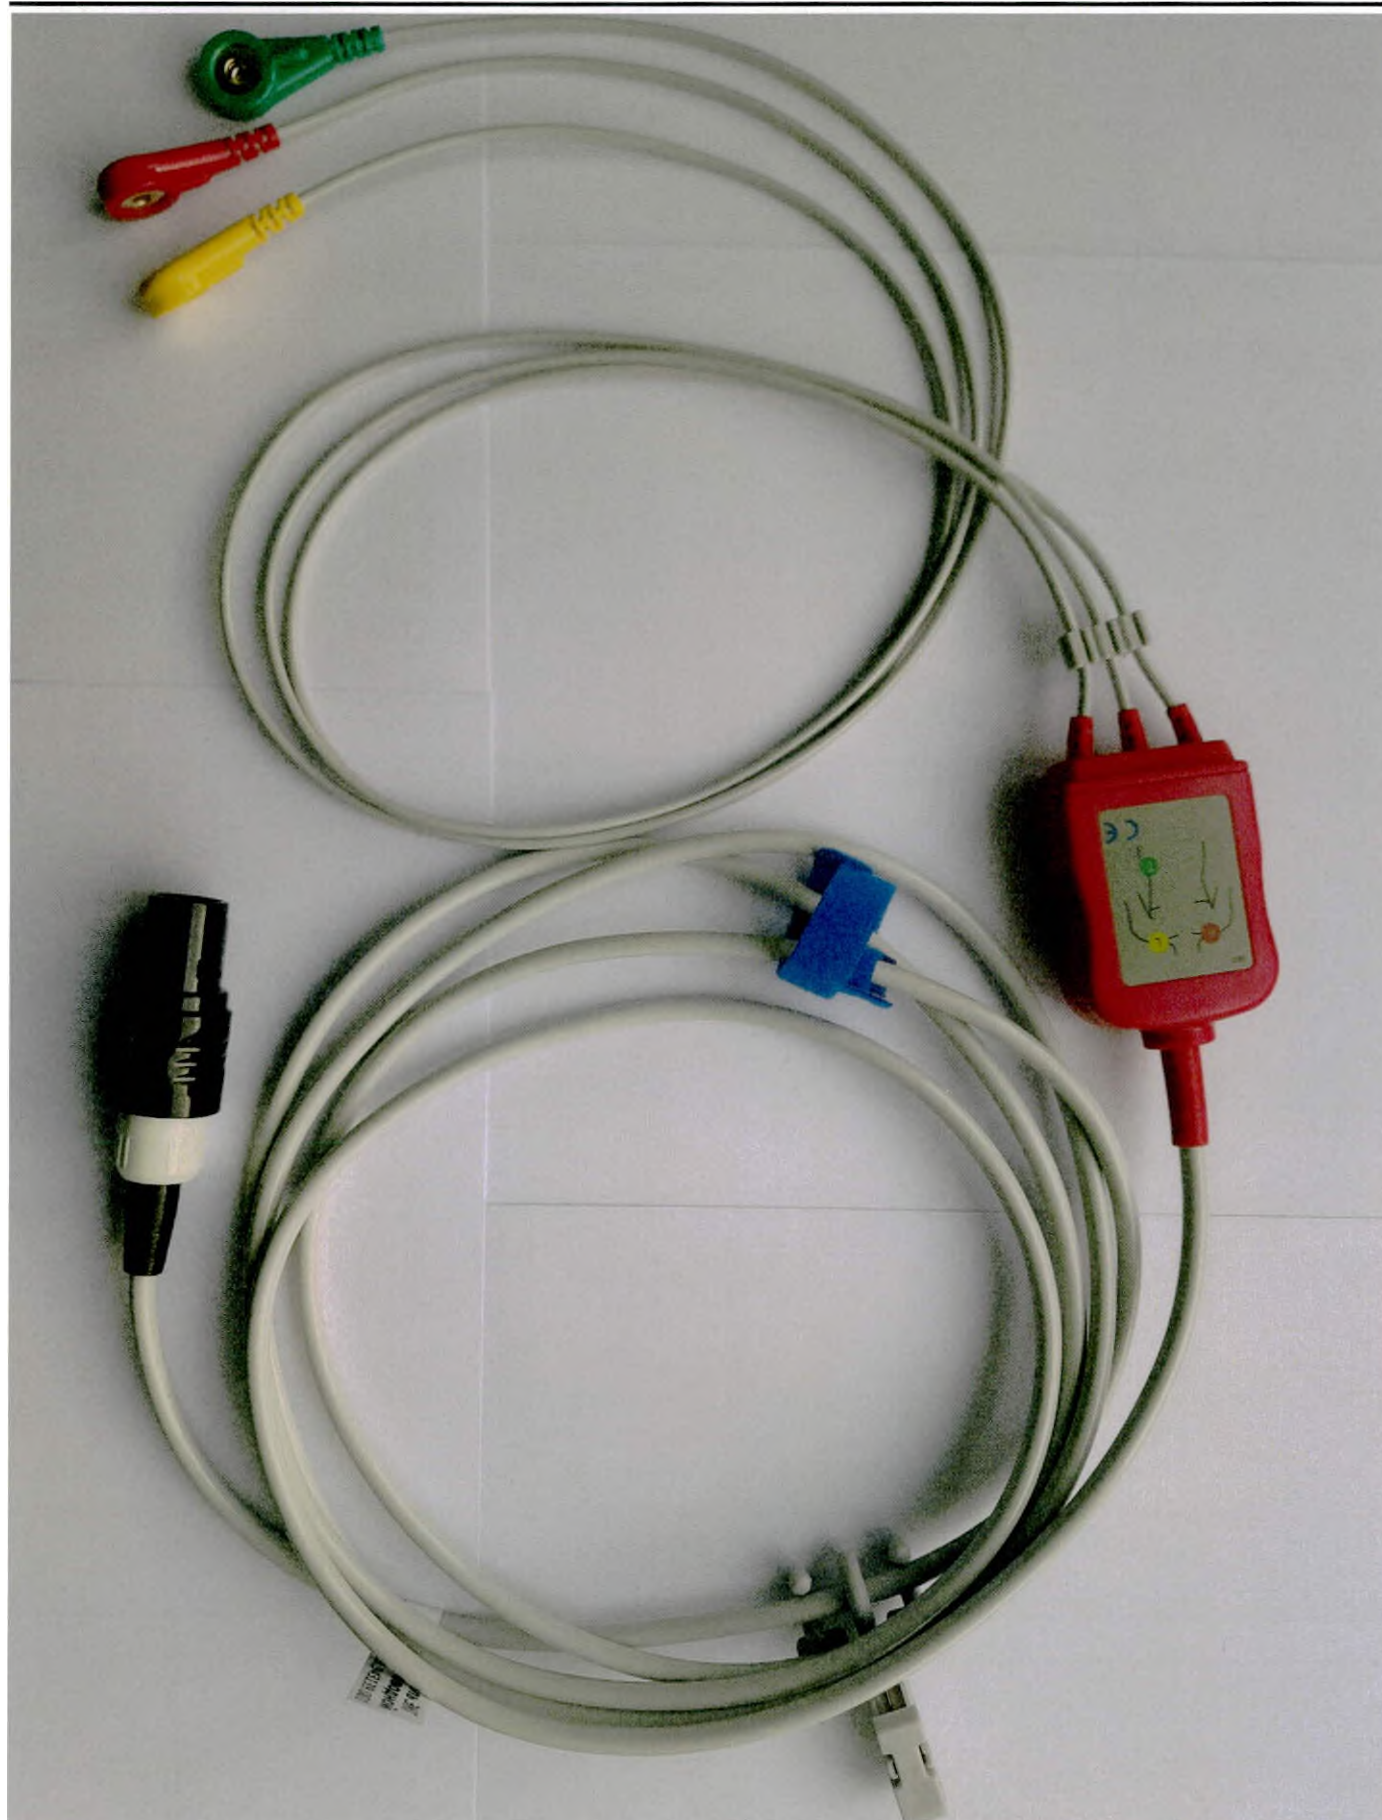


Рисунок 18 — Кабель ЭКГ 3-проводной (ЛТБВ.943139.001)

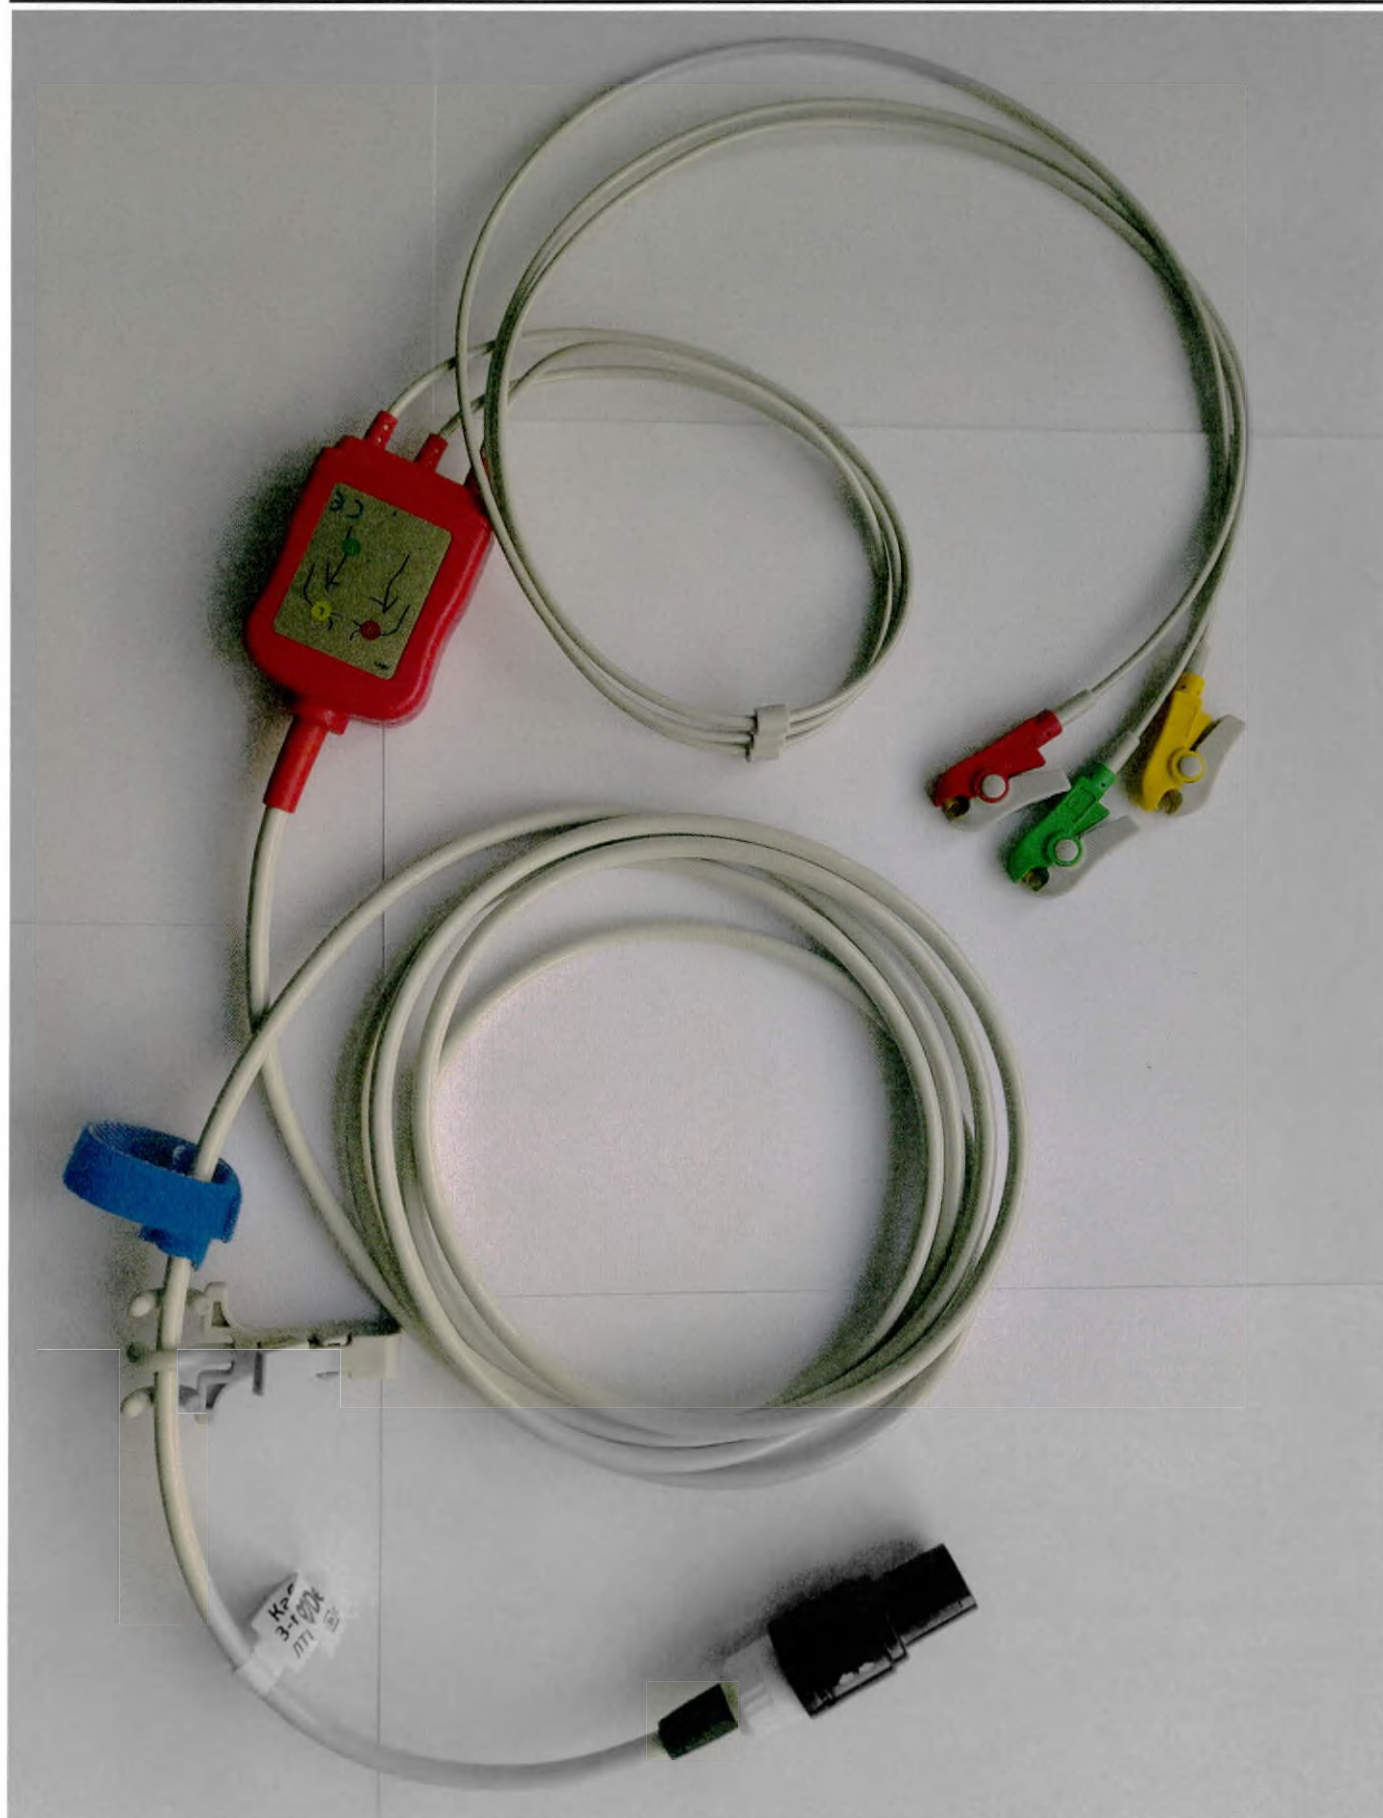


Рисунок 19 — Кабель ЭКГ 3-проводной (ЛТБВ.943139.004)

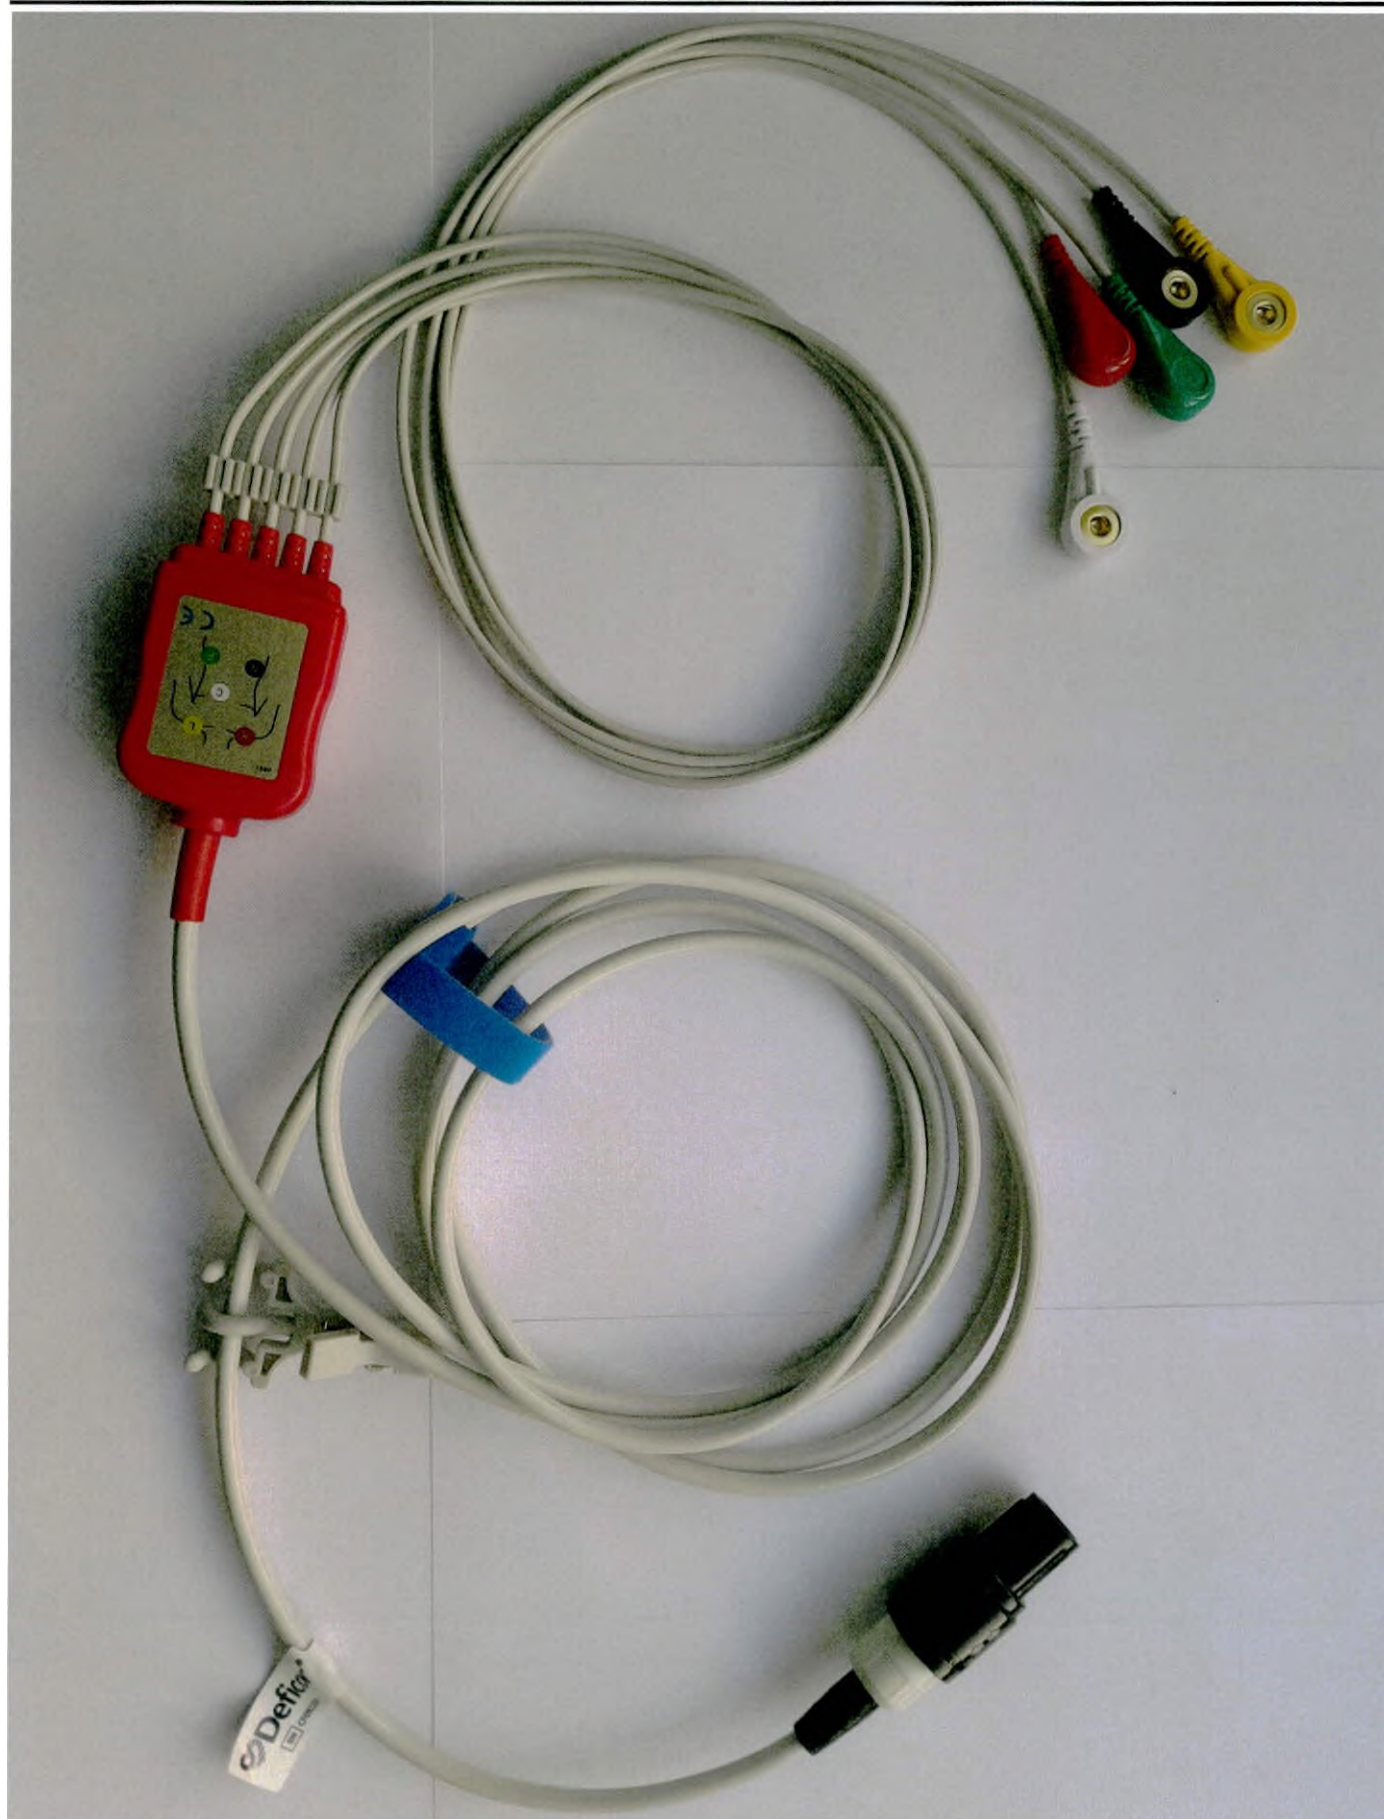


Рисунок 20 — Кабель ЭКГ 5-проводной (ЛТБВ.943139.002)

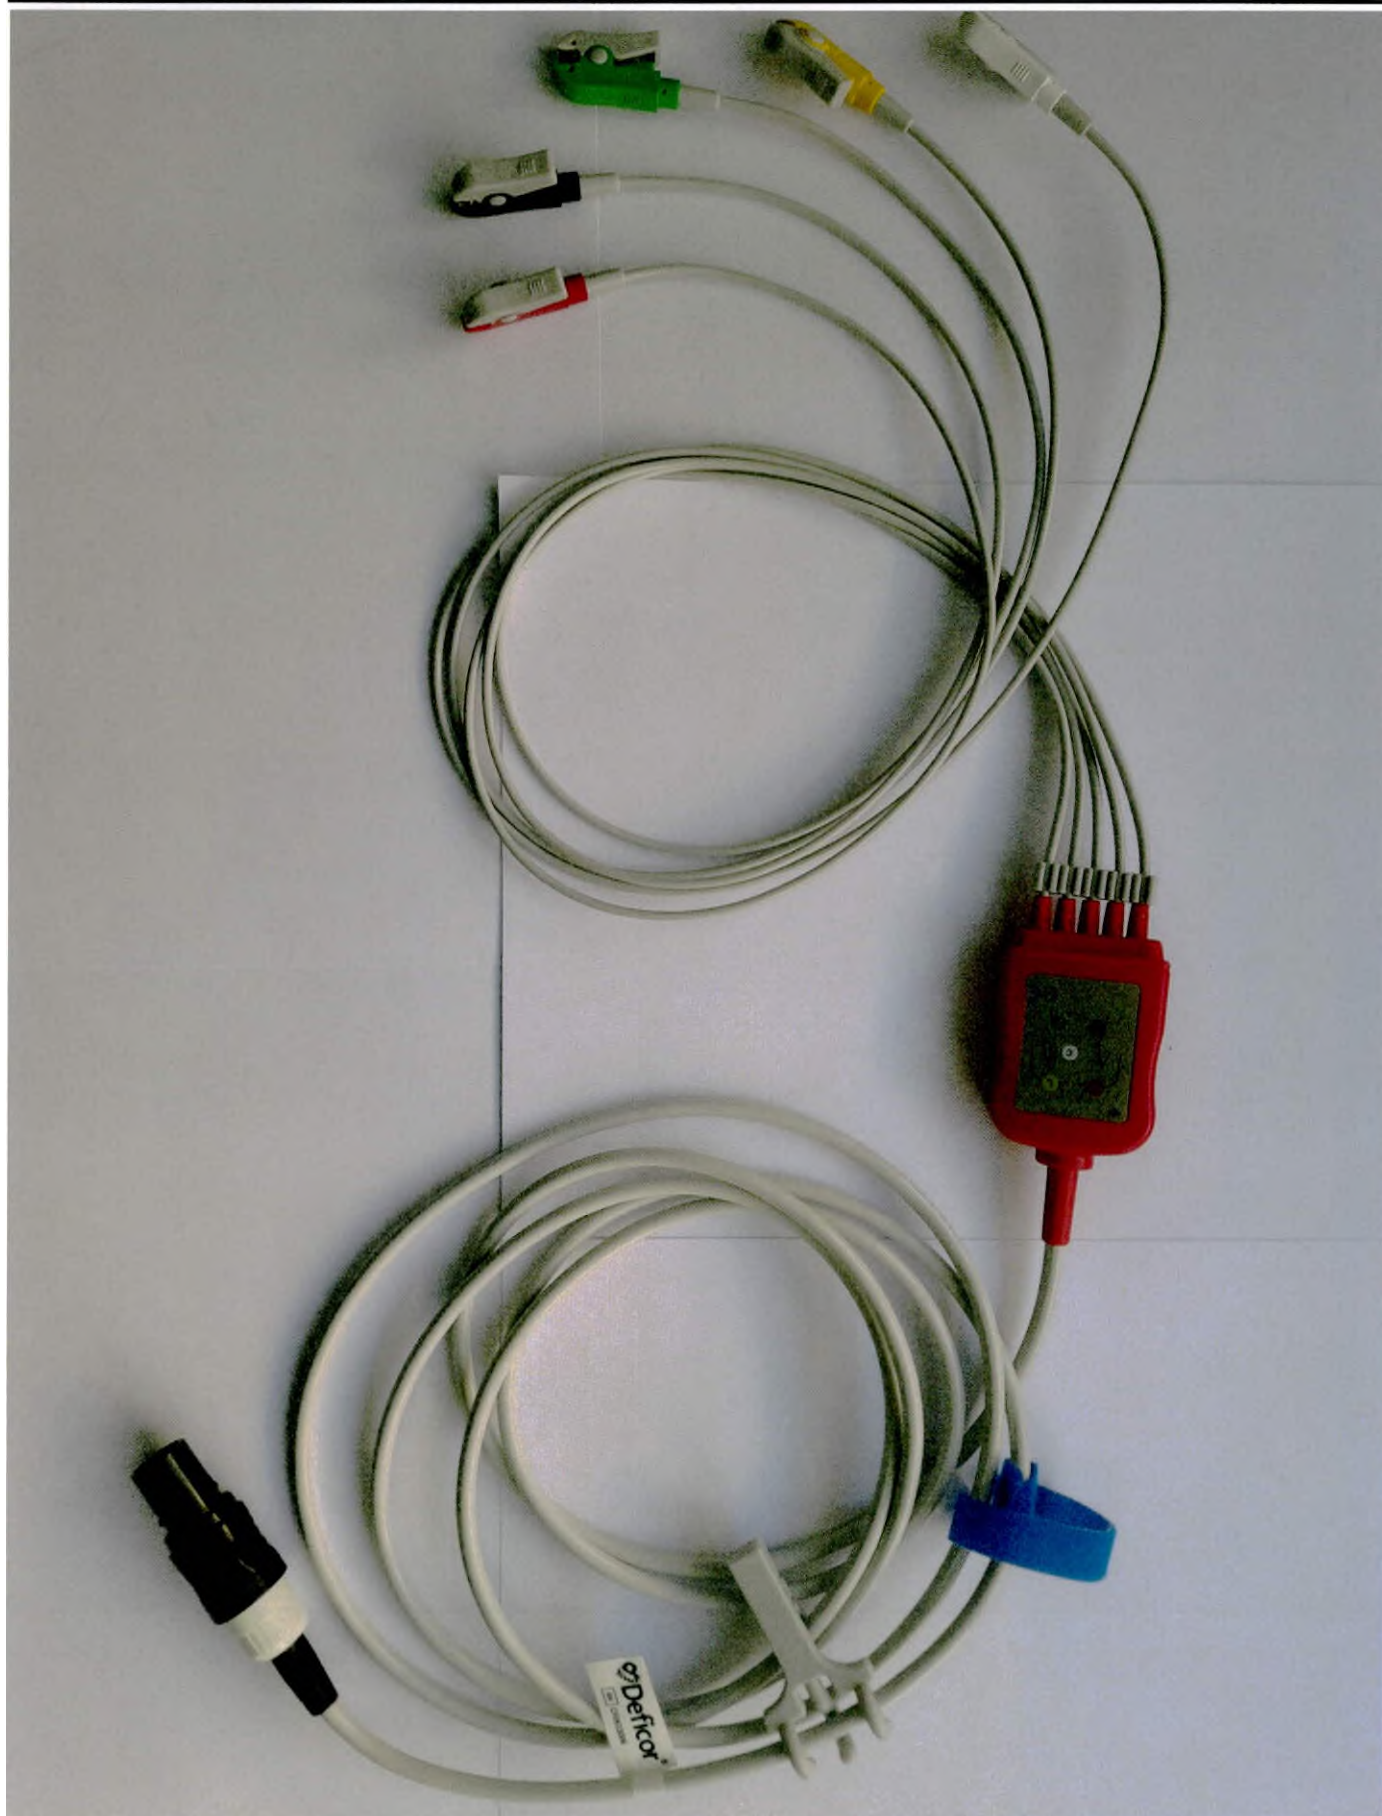


Рисунок 21 — Кабель ЭКГ 5-проводной (ЛТБВ.943139.005)

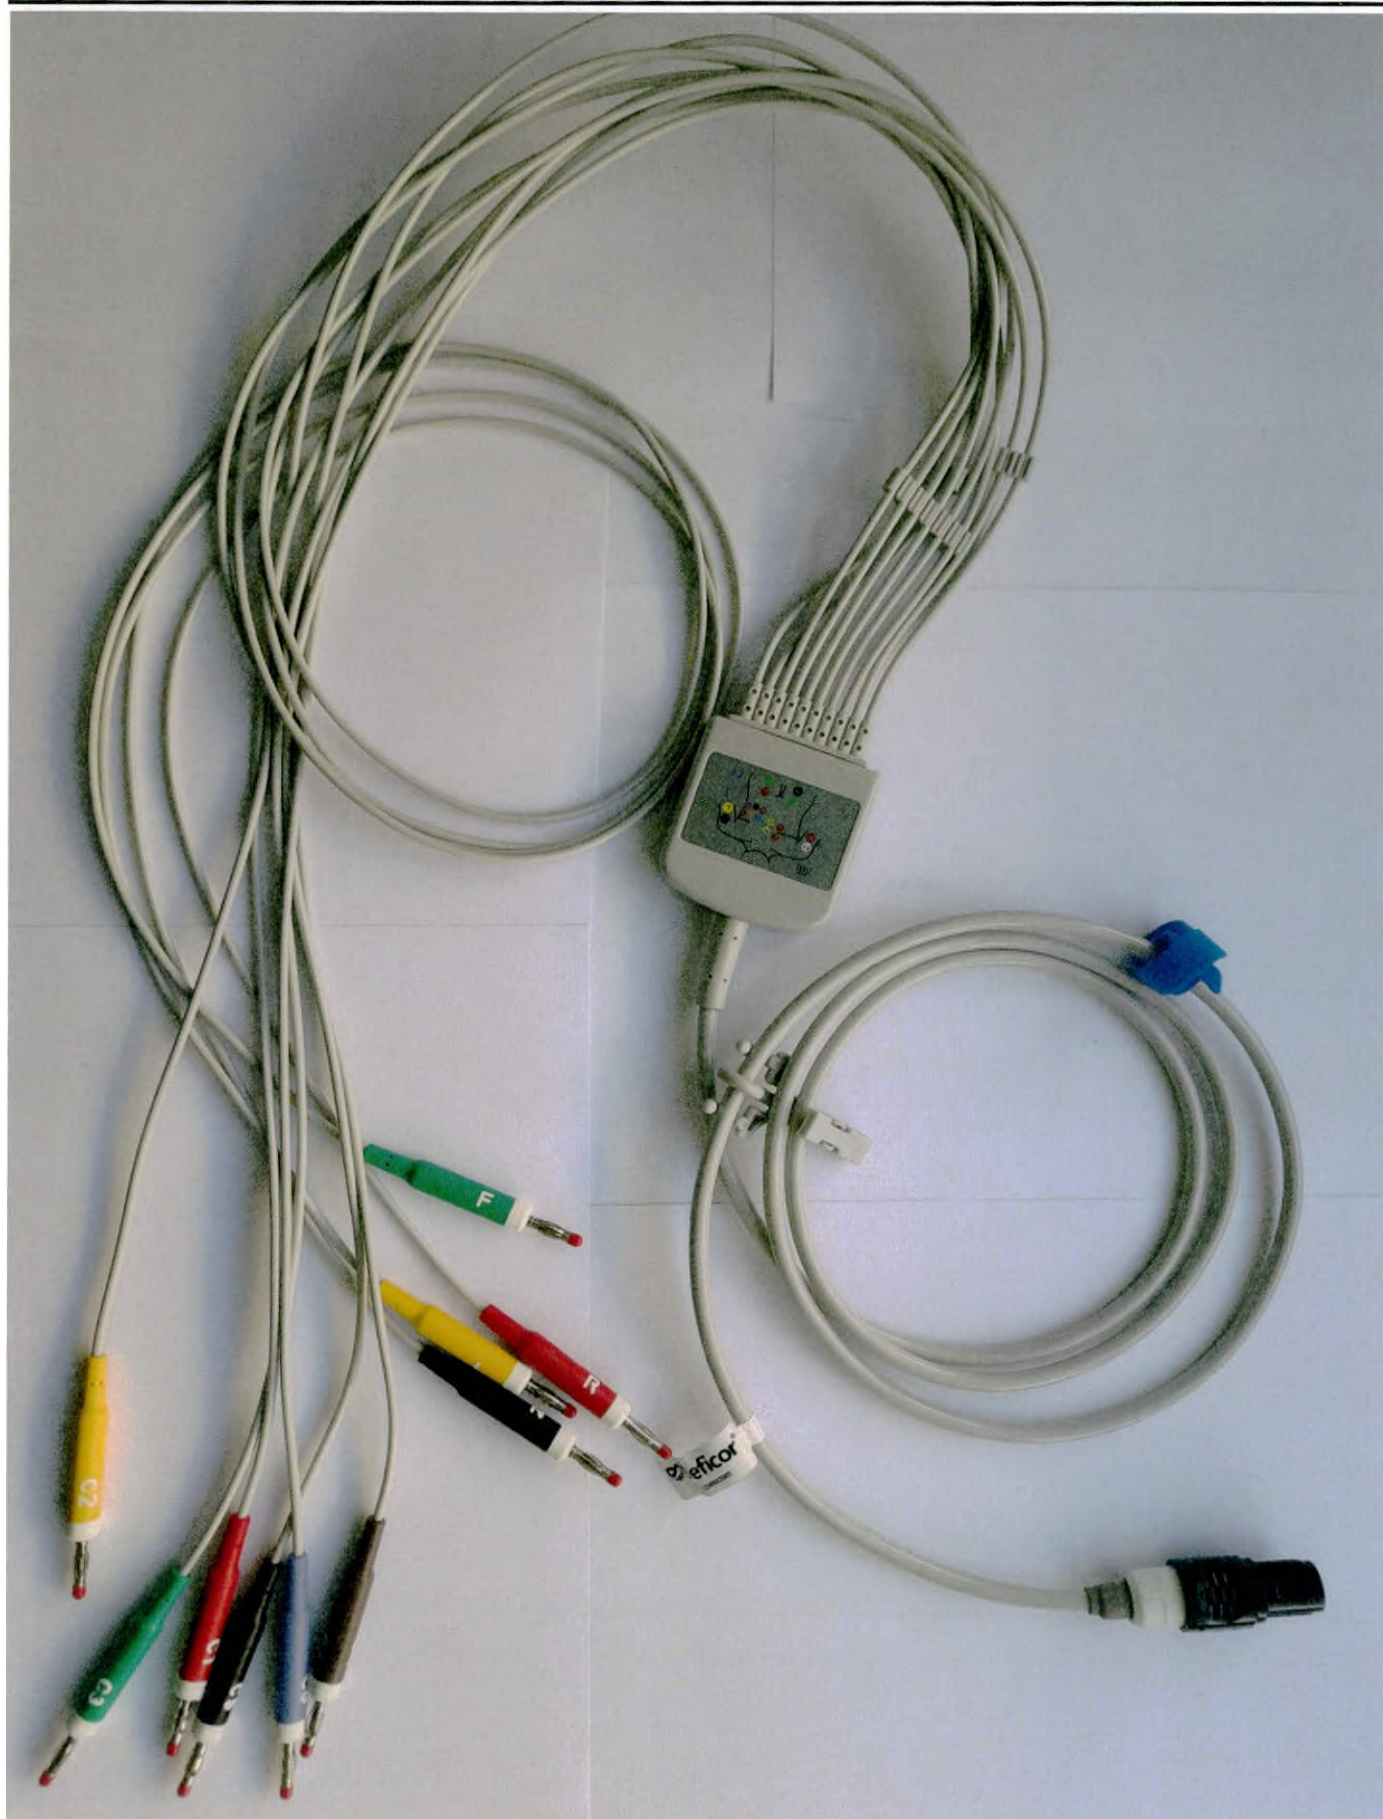


Рисунок 22 — Кабель ЭКГ 10-проводной (ЛТБВ.943139.003)



Рисунок 23 — Комплект электродов ЭКГ многоразовых грудных для взрослых (Lessa 99.111.12)



Рисунок 24 — Комплект электродов ЭКГ многоцветных на конечности для взрослых (Lessa 99.100.00)



Рисунок 25 — Комплект электродов ЭКГ многоразовых грудных для детей (Lessa 99.111.10)



Рисунок 26 — Комплект электродов ЭКГ многоразовых на конечности для детей (Lessa 99.100.10)



Рисунок 27 — Электроды ЭКГ одноразовые для взрослых (Lessa 99.830.28, в упаковке)



Рисунок 28 — Электроды ЭКГ одноразовые для детей (Lessa 99.830.12, в упаковке)



Рисунок 29 — Датчик SpO₂ «манжета» для взрослых (ЛТБВ.943119.001)

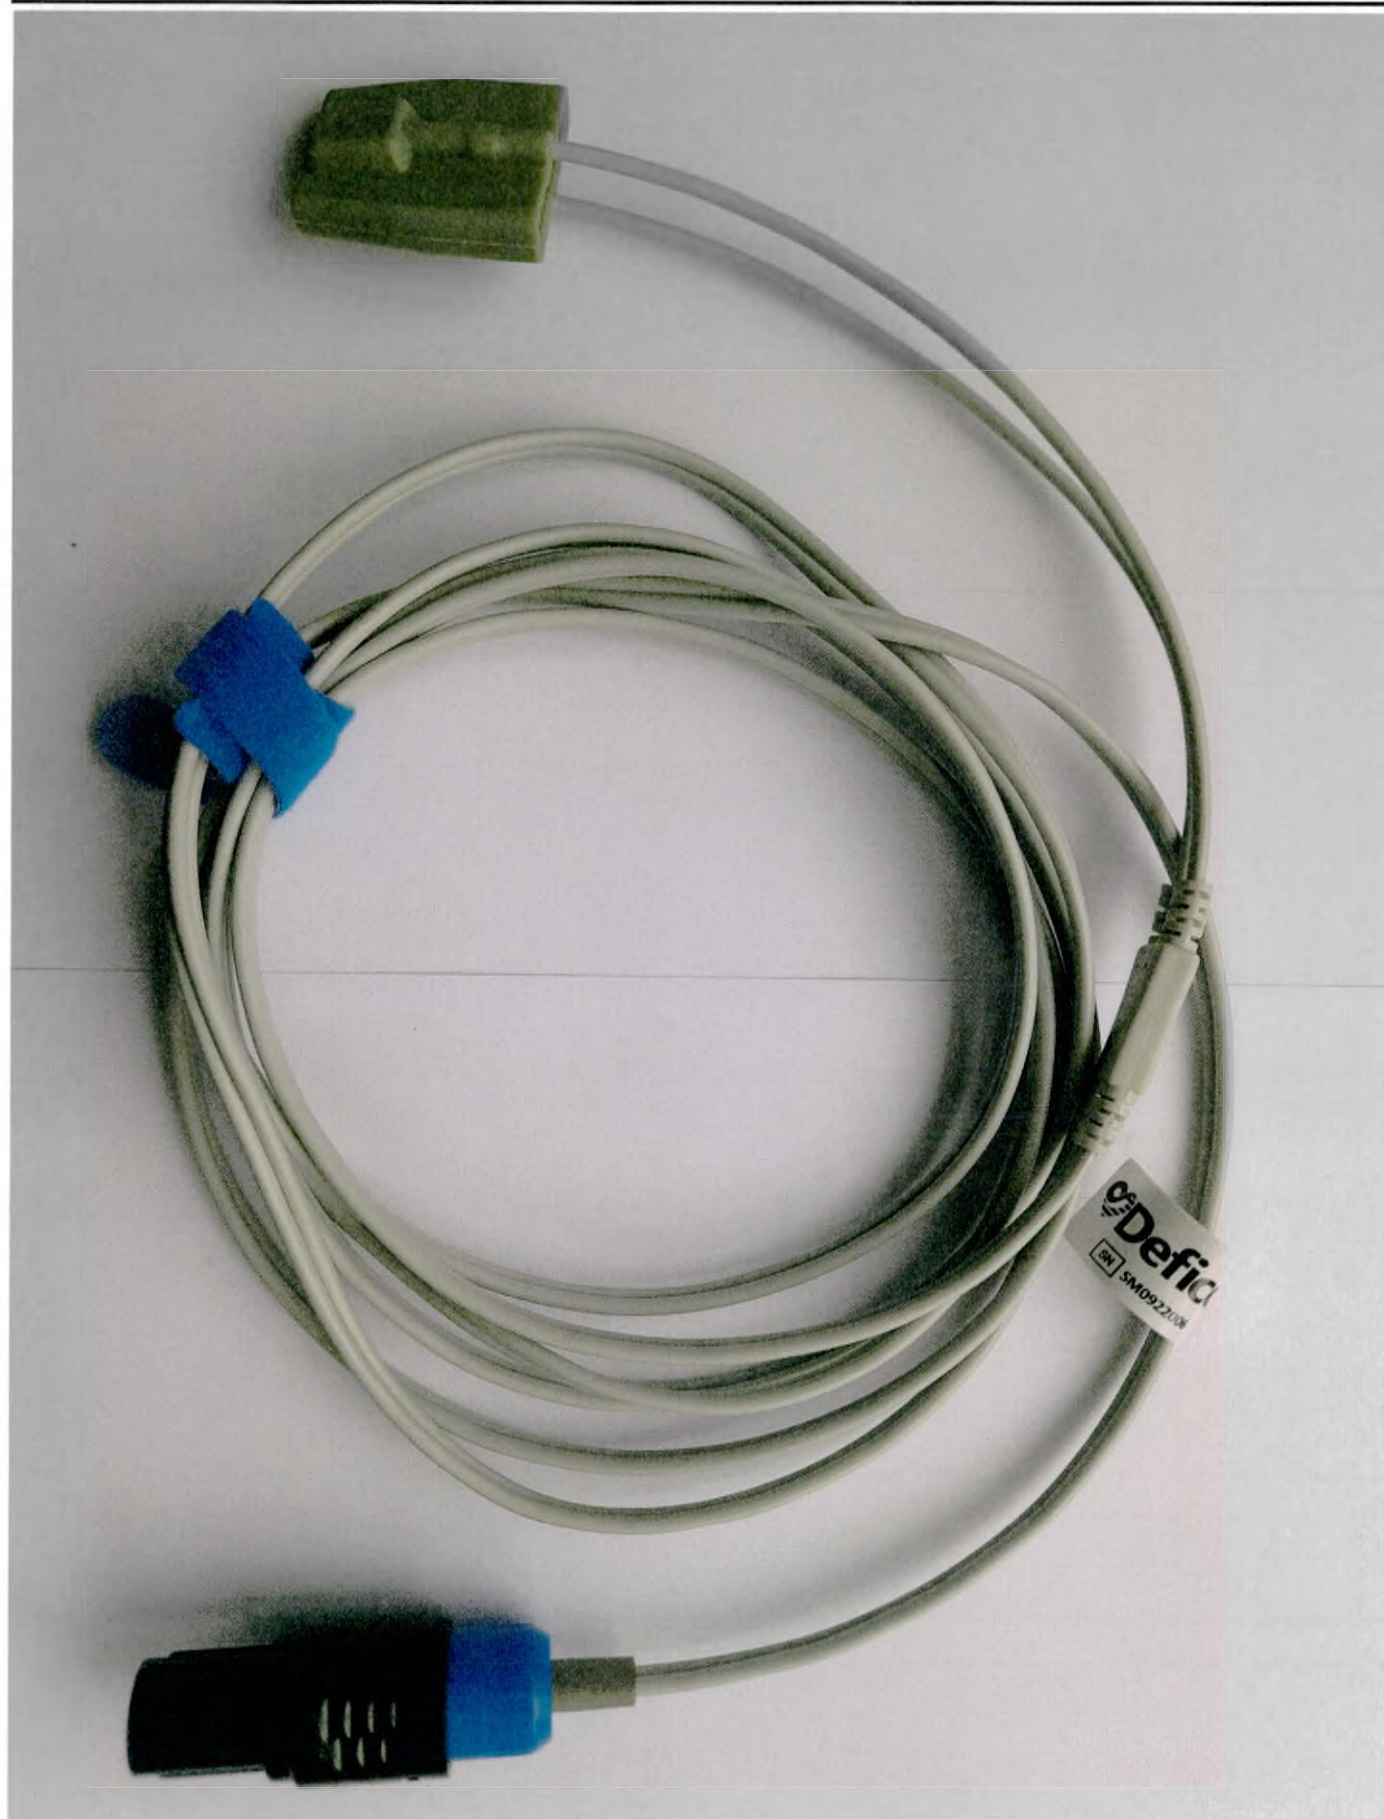


Рисунок 30 — Датчик SpO₂ «манжета» для детей (ЛТБВ.943119.002)

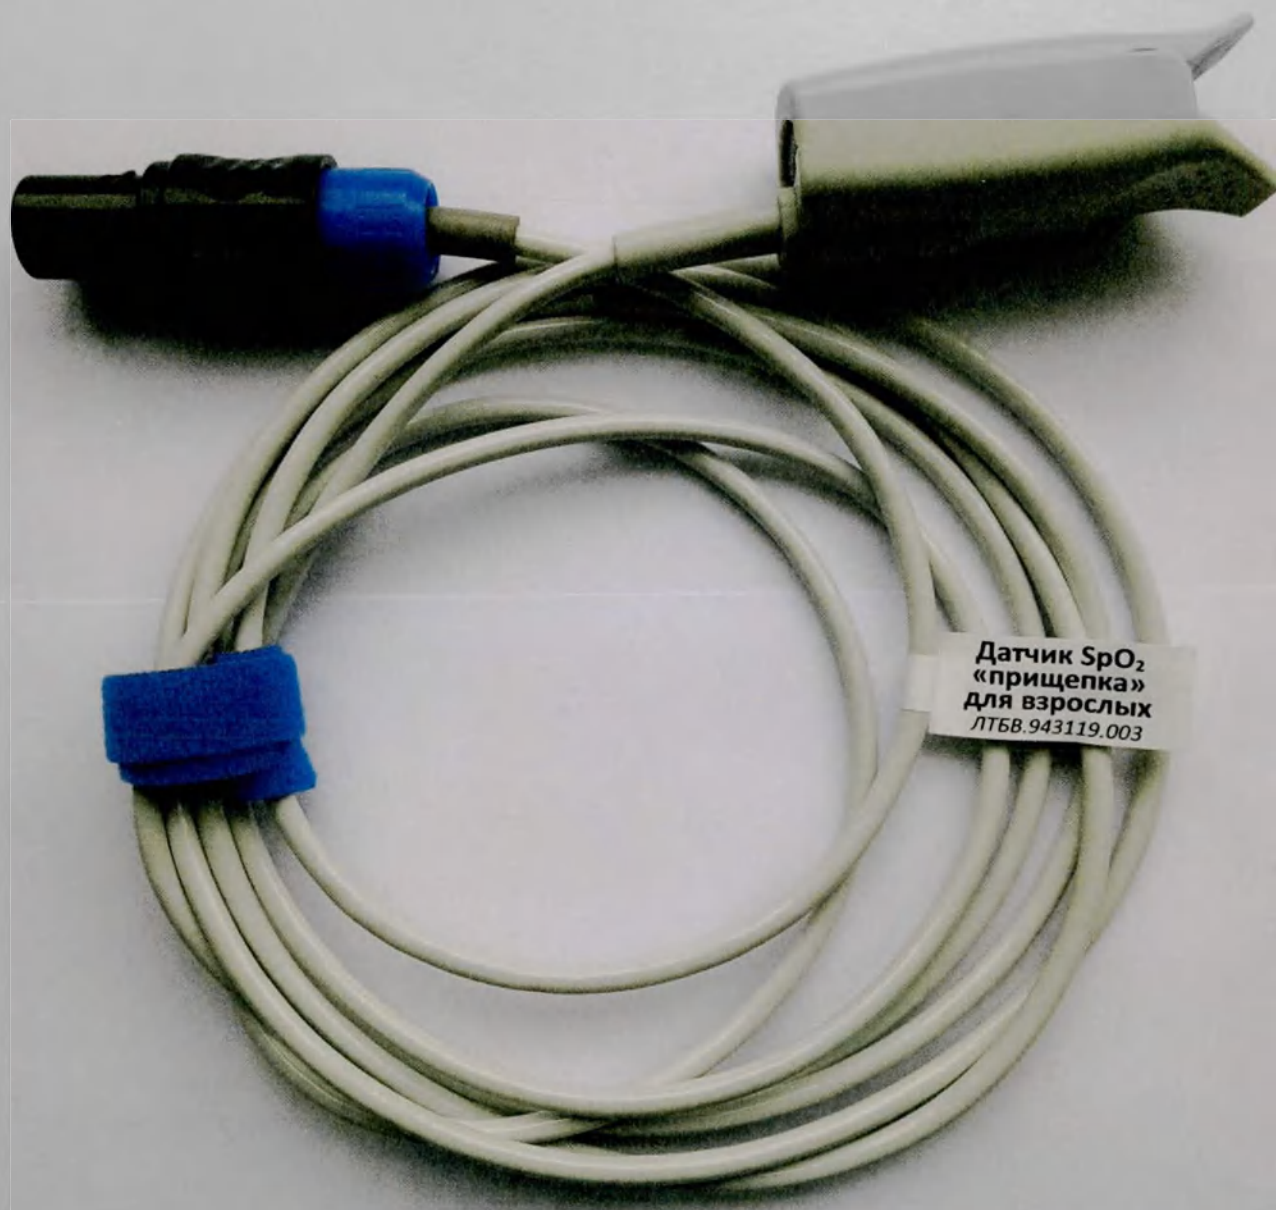


Рисунок 31 — Датчик SpO₂ «прищепка» для взрослых (ЛТБВ.943119.003)

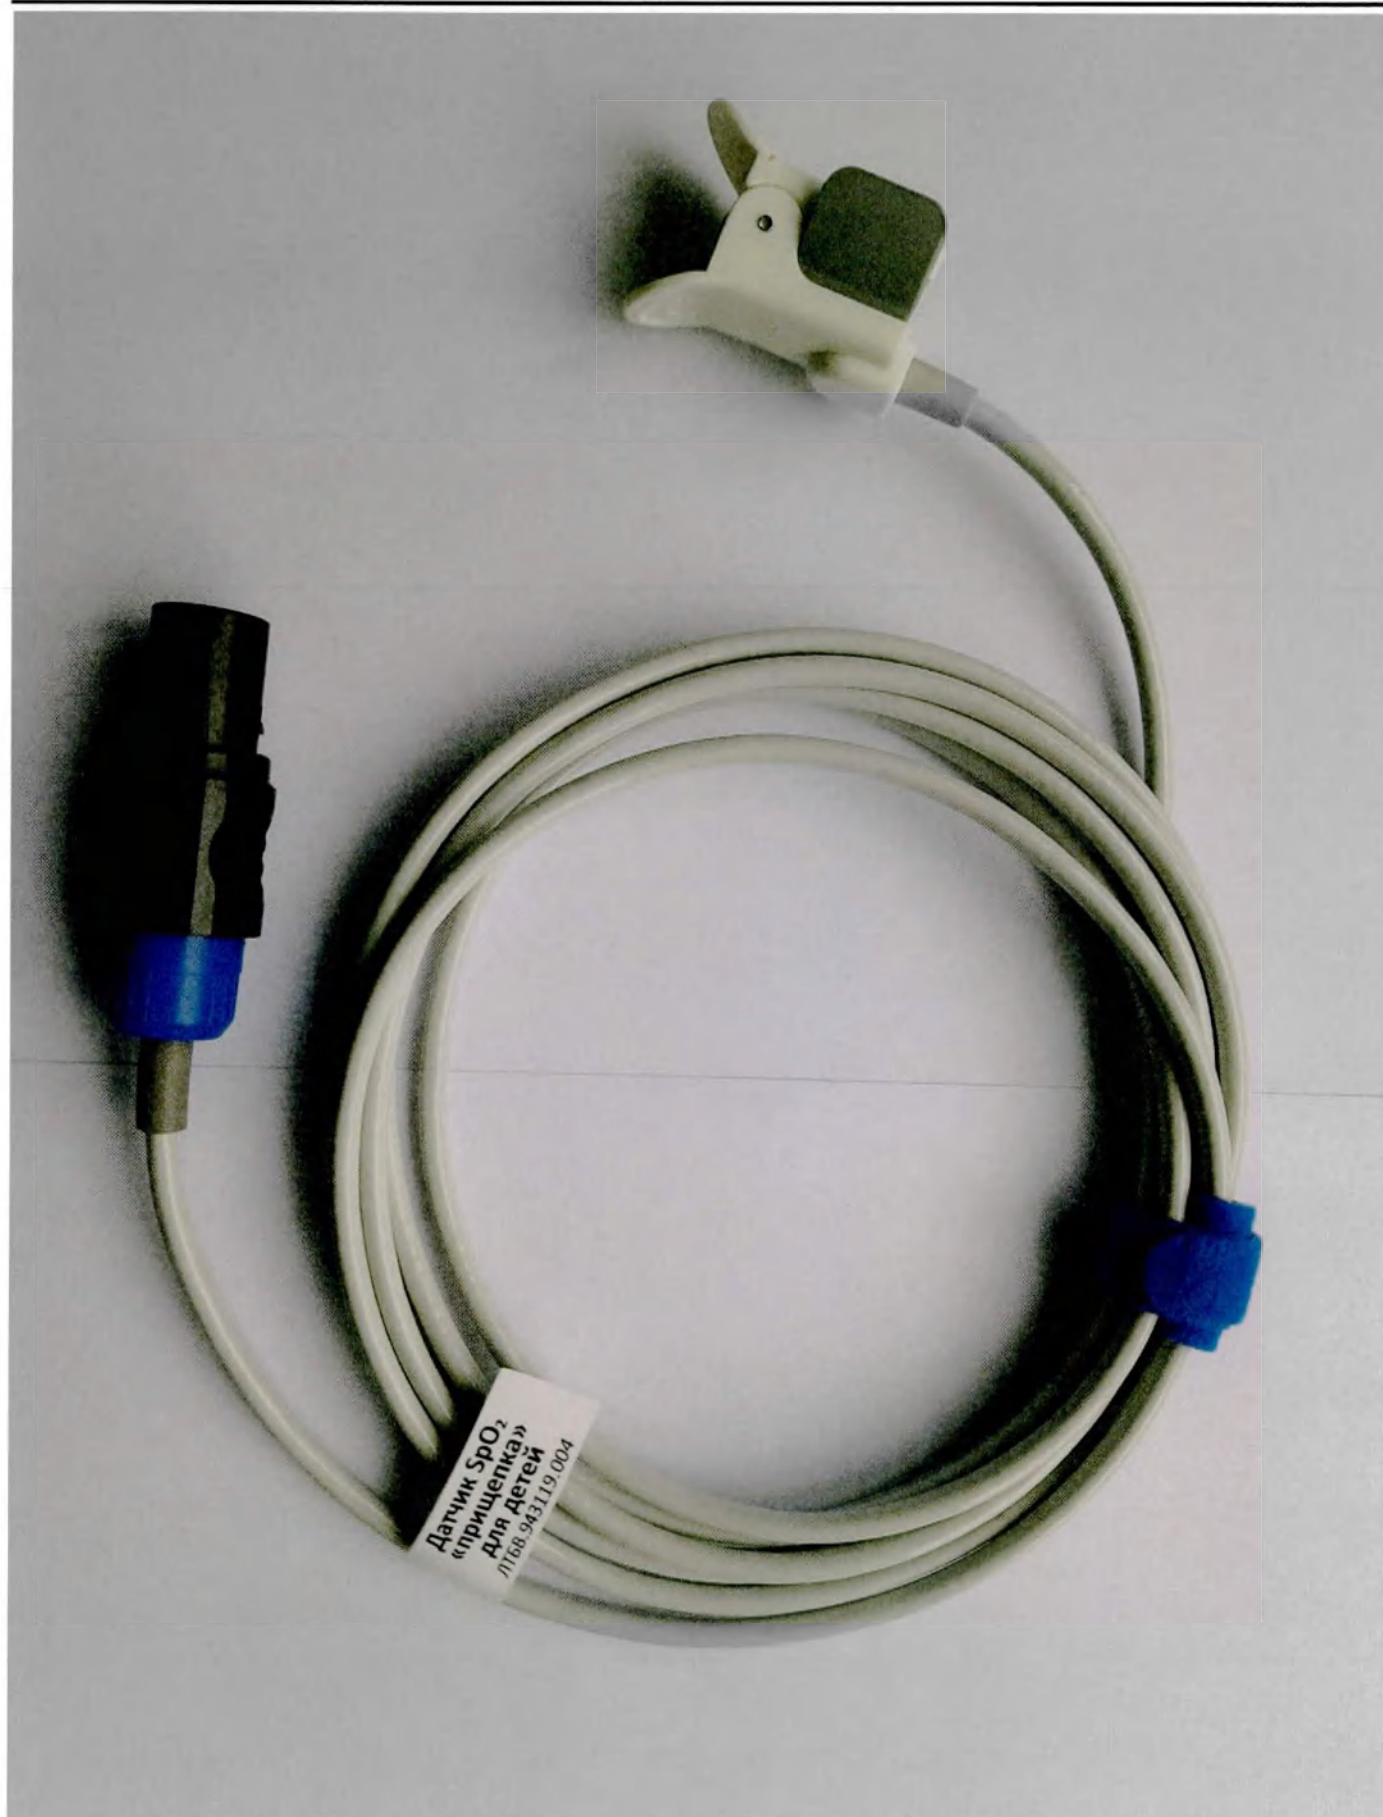


Рисунок 32 — Датчик SpO₂ «прищепка» для детей (ЛТБВ.943119.004)

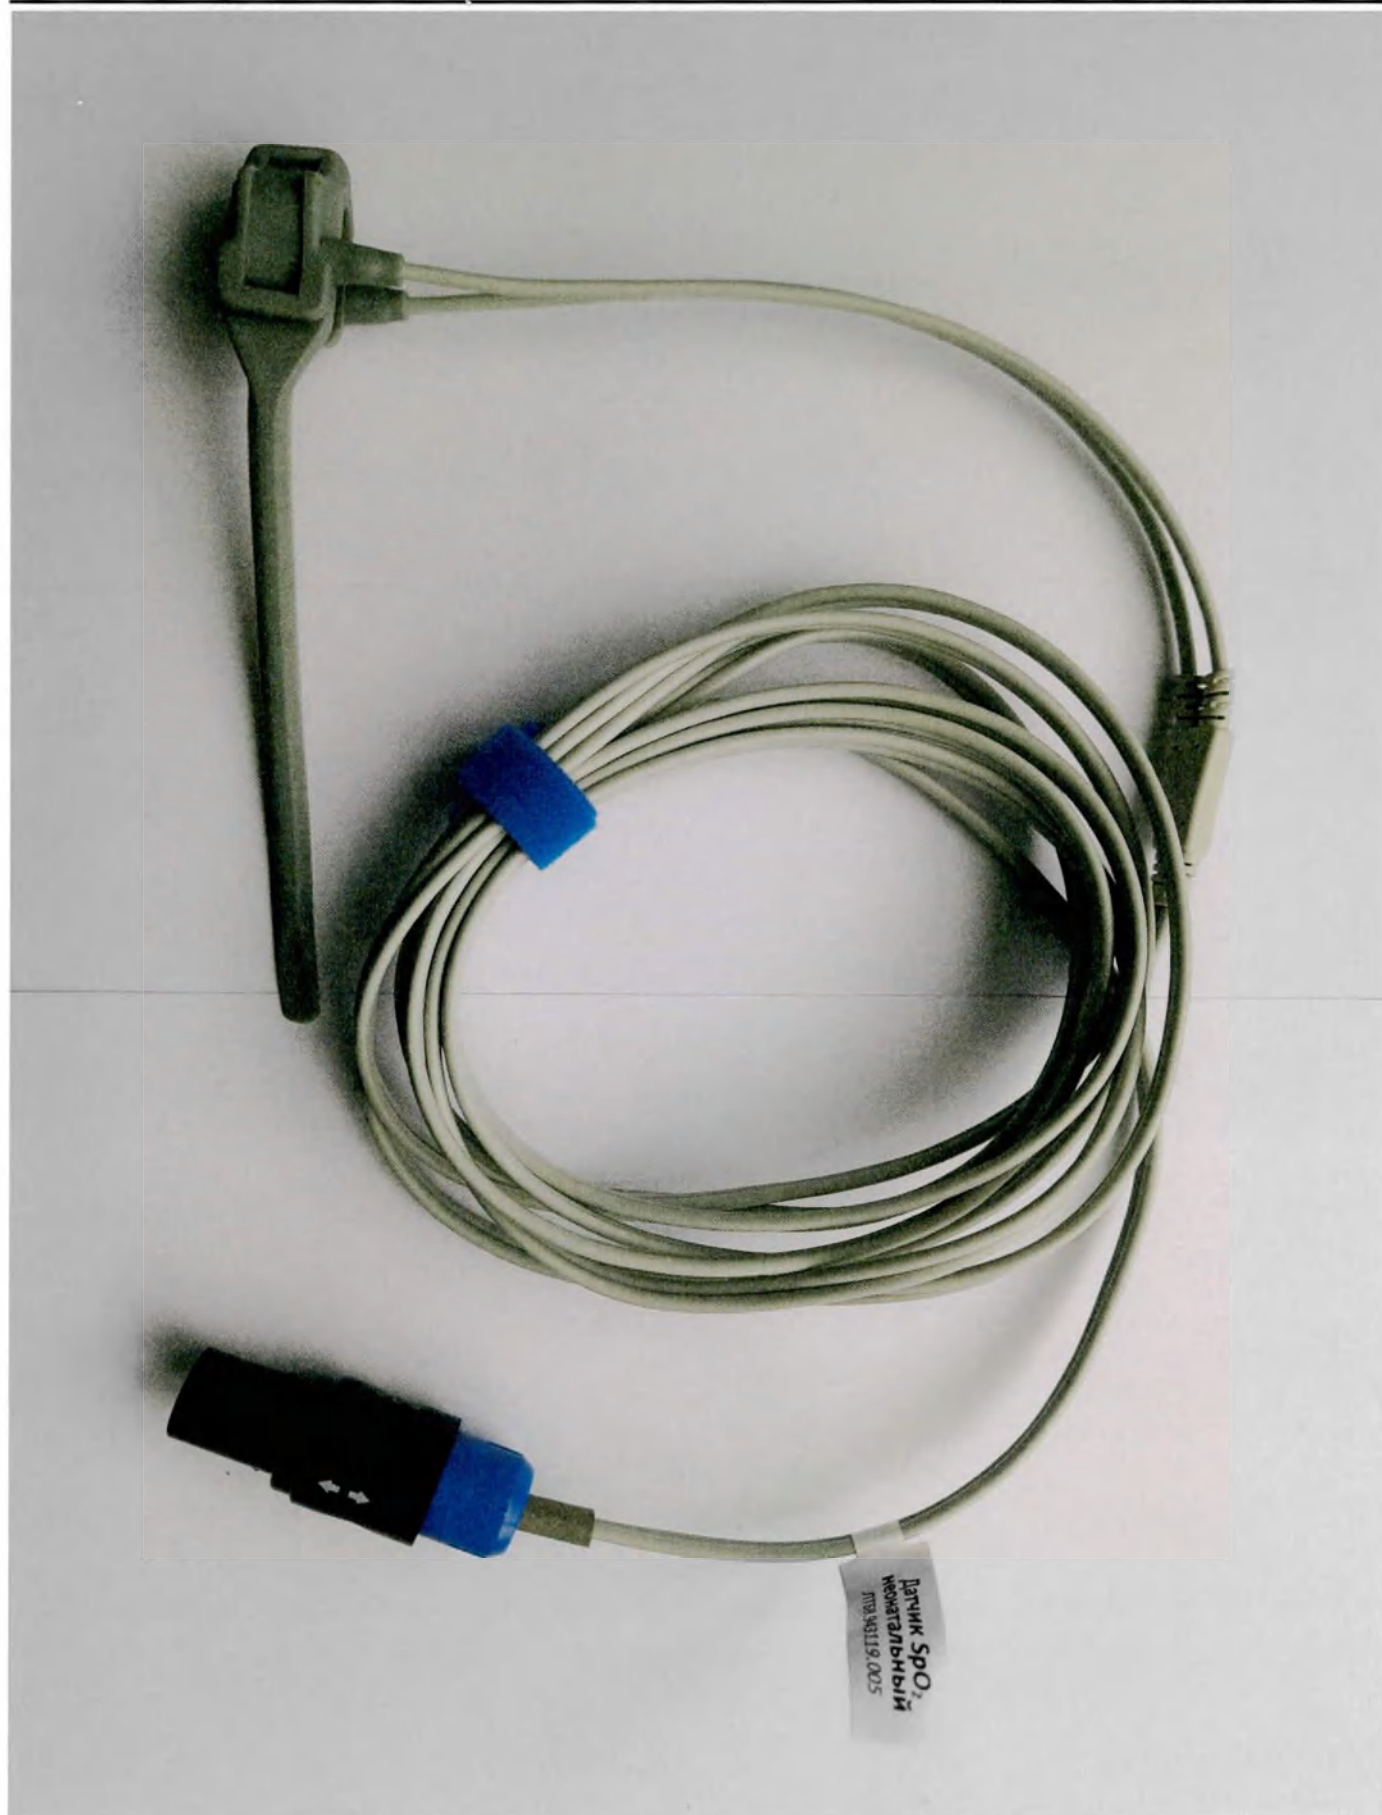


Рисунок 33 — Датчик SpO₂ неонатальный (ЛТБВ.943119.005)

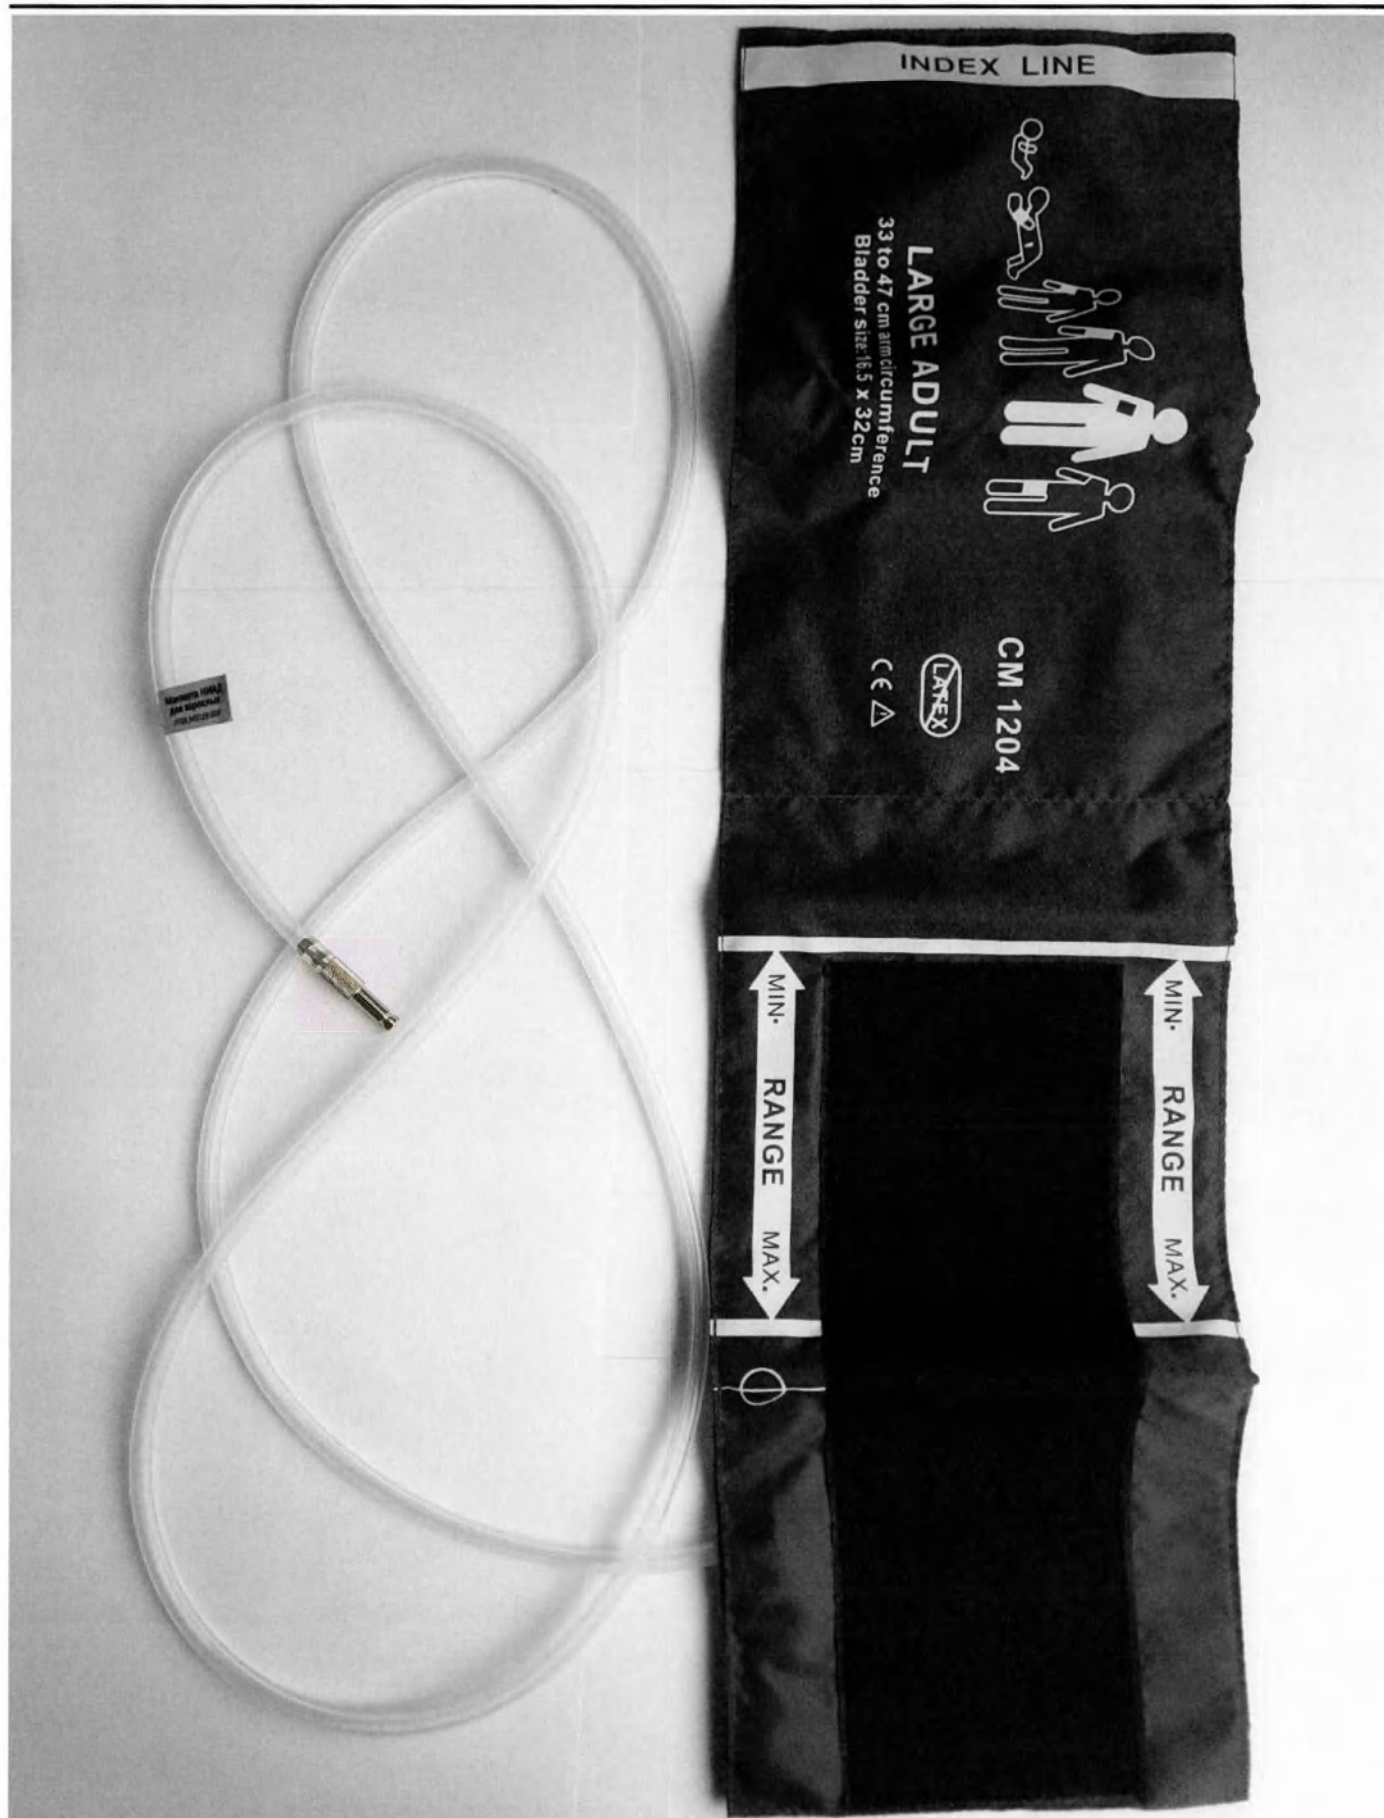


Рисунок 34 — Манжета НИАД для взрослых (ЛТБВ.943119.008)

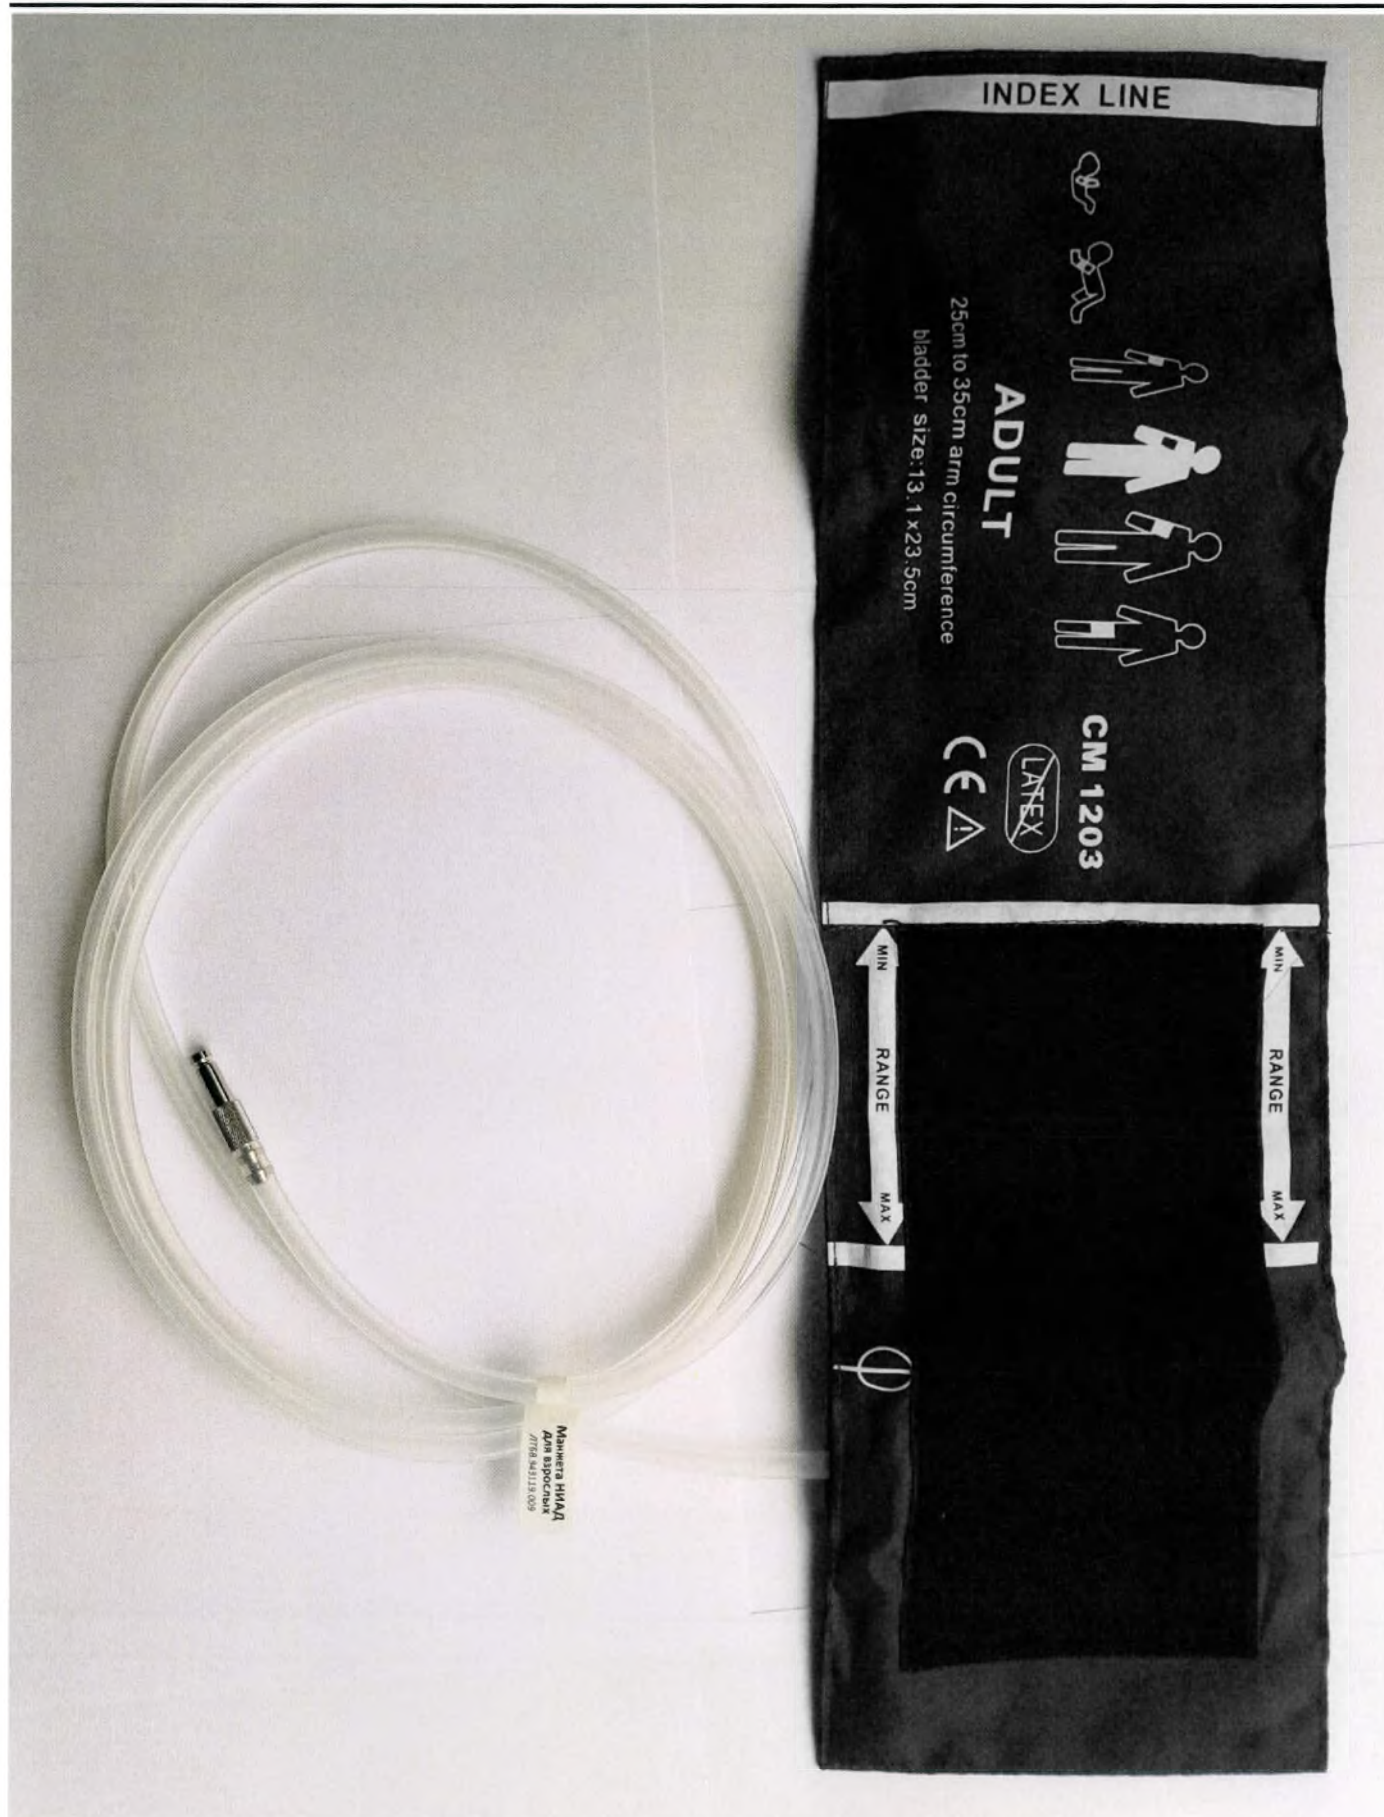


Рисунок 35 — Манжета НИАД для взрослых (ЛТБВ.943119.009)

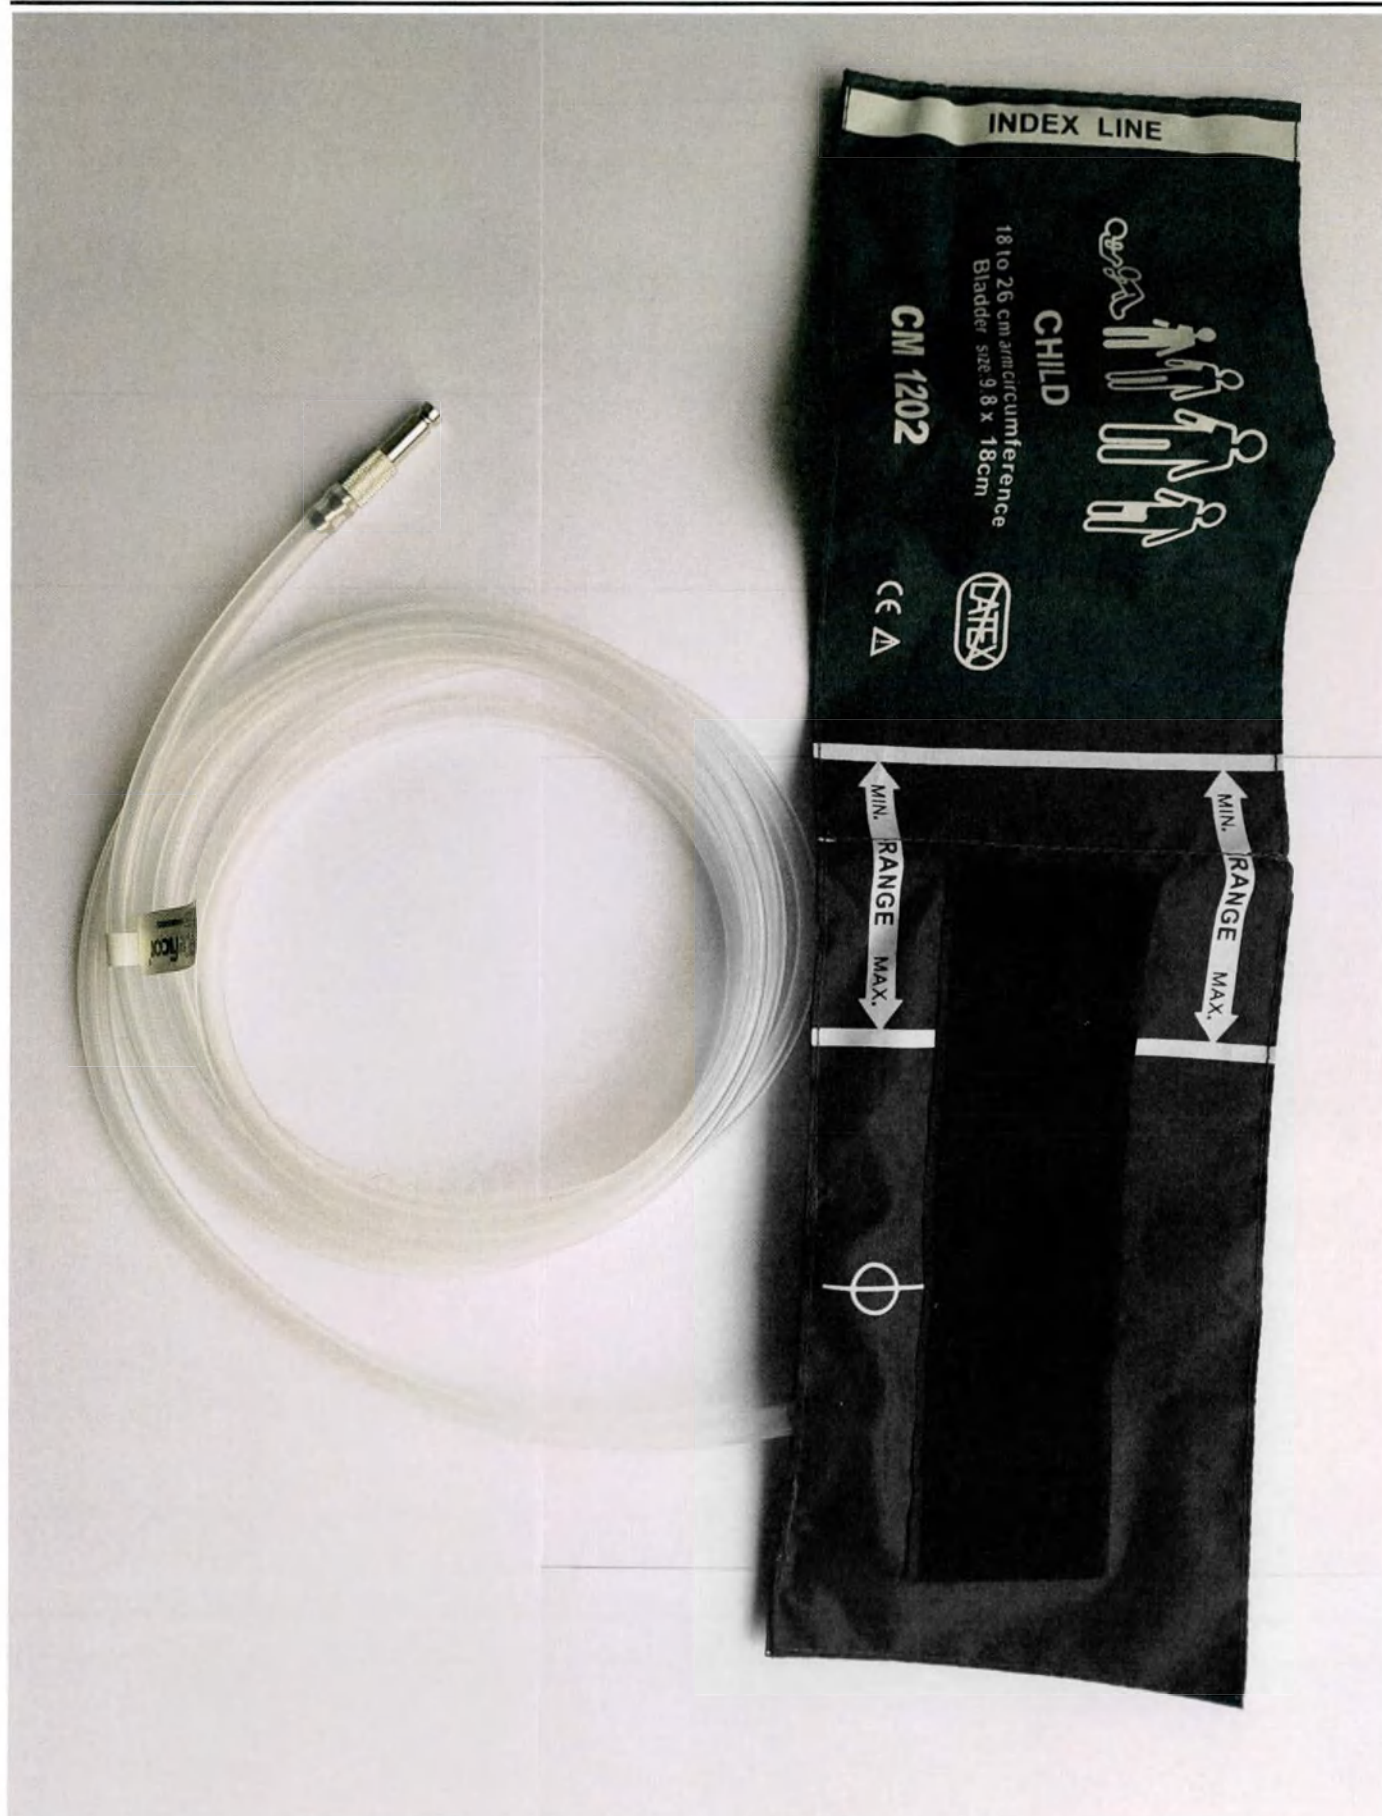


Рисунок 36 — Манжета НИАД для детей (ЛТБВ.943119.010)



Рисунок 37 — Манжета НИАД неонатальная (ЛТБВ.943119.011)



Рисунок 38 — Манжета НИАД неонатальная (ЛТБВ.943119.012)

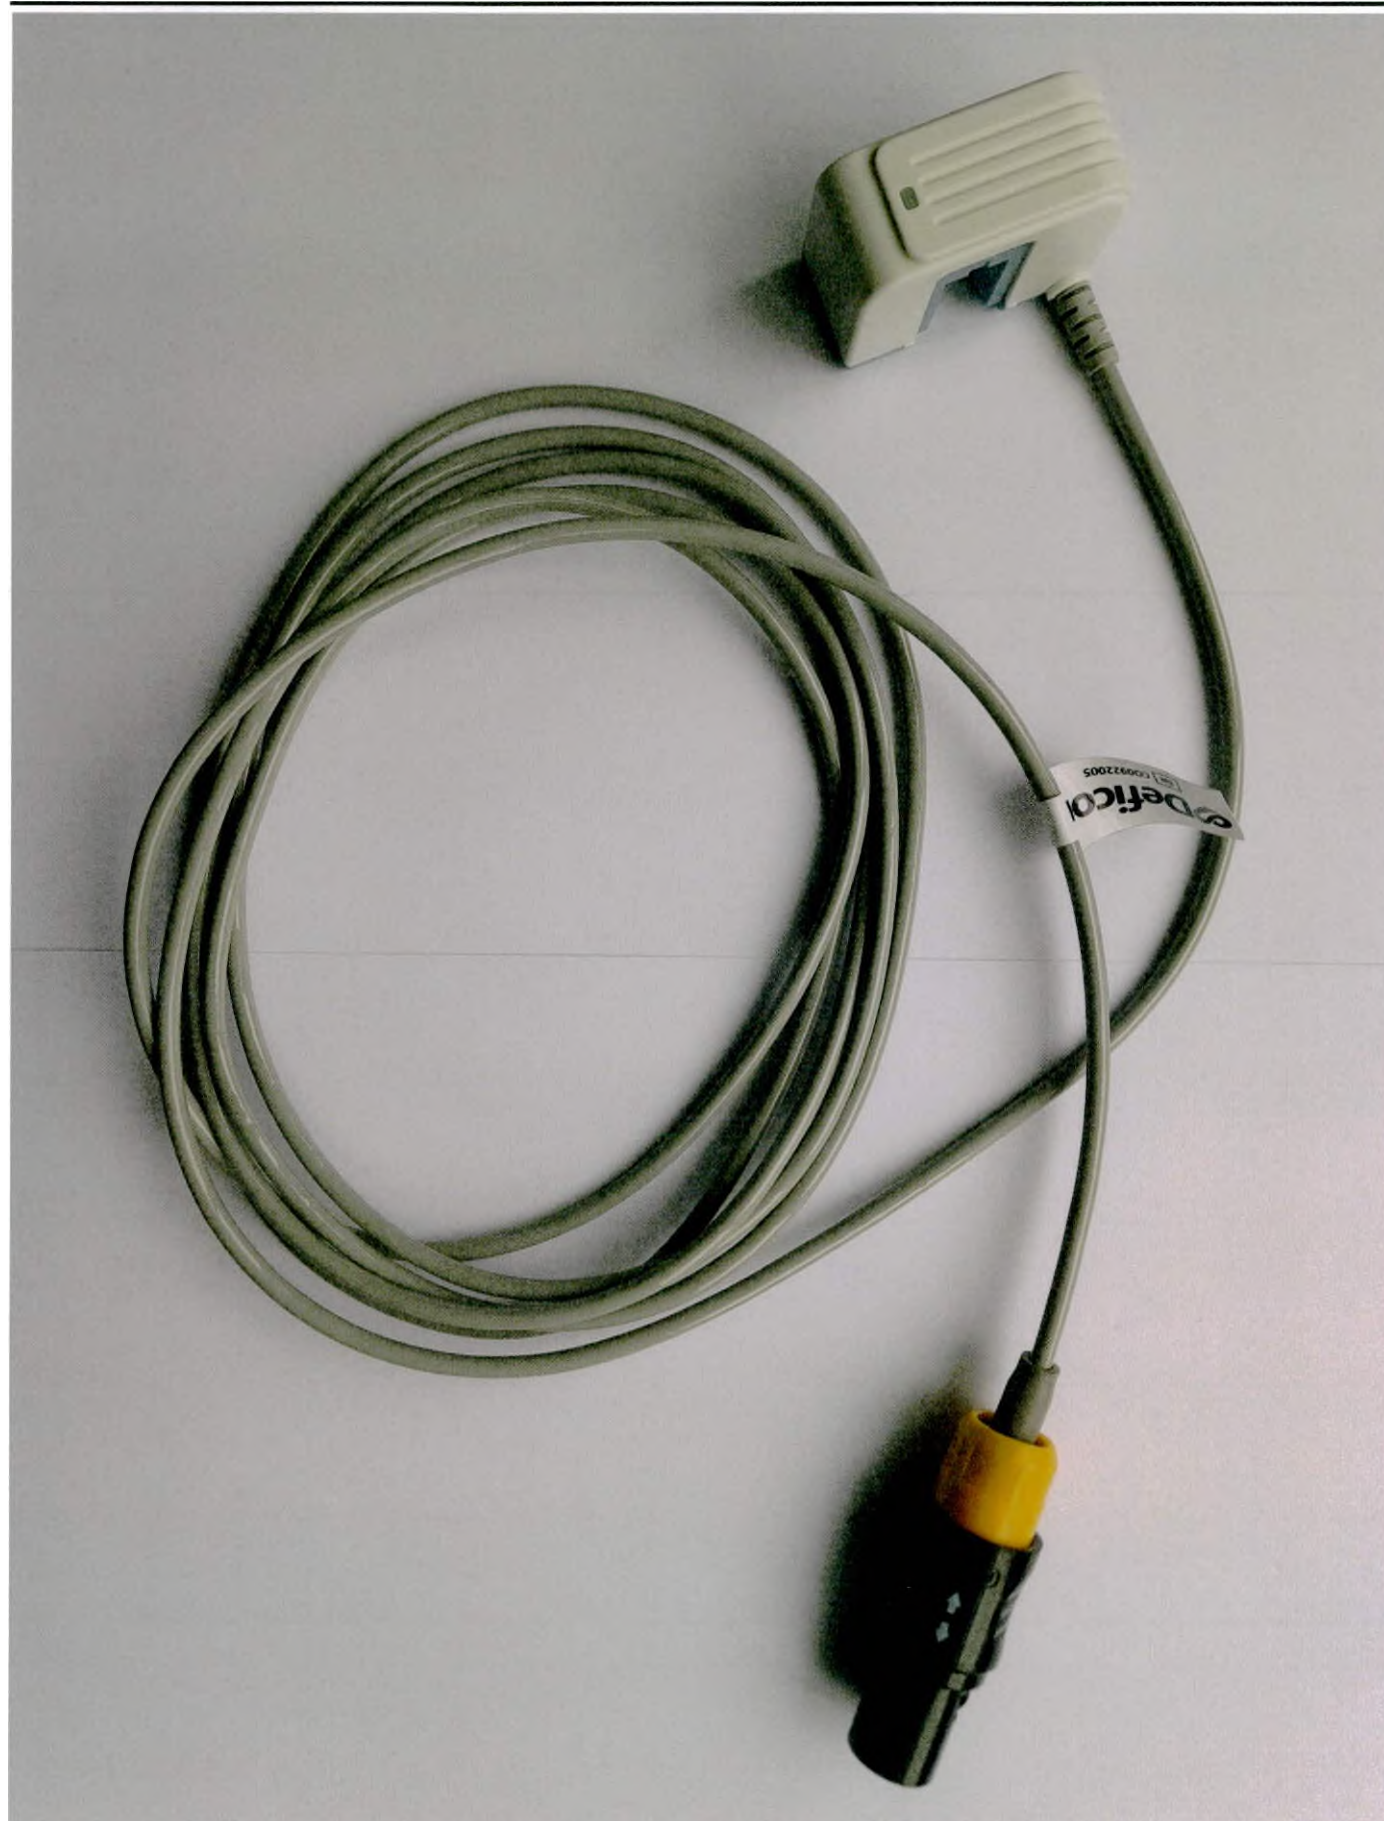


Рисунок 39 — Датчик CO₂ (ЛТБВ.943119.006)



Рисунок 40 — Датчик компрессий (ЛТБВ.943119.007)



**Рисунок 41 — Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии
ЛР-«Регистрон» по ТУ 9441-001-51115963-2000 (5723/12-Н)**



УТВЕРЖДЕН
ЛТБВ 941135.001-01 РЭ-ЛУ

**Дефибриллятор-монитор
Deficor-DM по ЛТБВ.941135.001 ТУ**

Руководство по эксплуатации
ЛТБВ.941135.001-01 РЭ

Редакция от 02.2024

Рисунок 42 — Руководство по эксплуатации (ЛТБВ.941135.001-01 РЭ)

Принадлежности



Рисунок 43 — Кронштейн (ЛТБВ.943129.008, вид спереди)



Рисунок 44 — Кронштейн (ЛТБВ.943129.008, вид сбоку)



Рисунок 45 — Ручка для переноски (ЛТБВ.943129.009)



Рисунок 46 — Сумка для переноски (ЛТБВ.943129.010, вид спереди)



Рисунок 47 — Сумка для переноски (ЛТБВ.943129.010, вид сбоку)



Рисунок 48 — Карманы для сумки (ЛТБВ.943129.011)

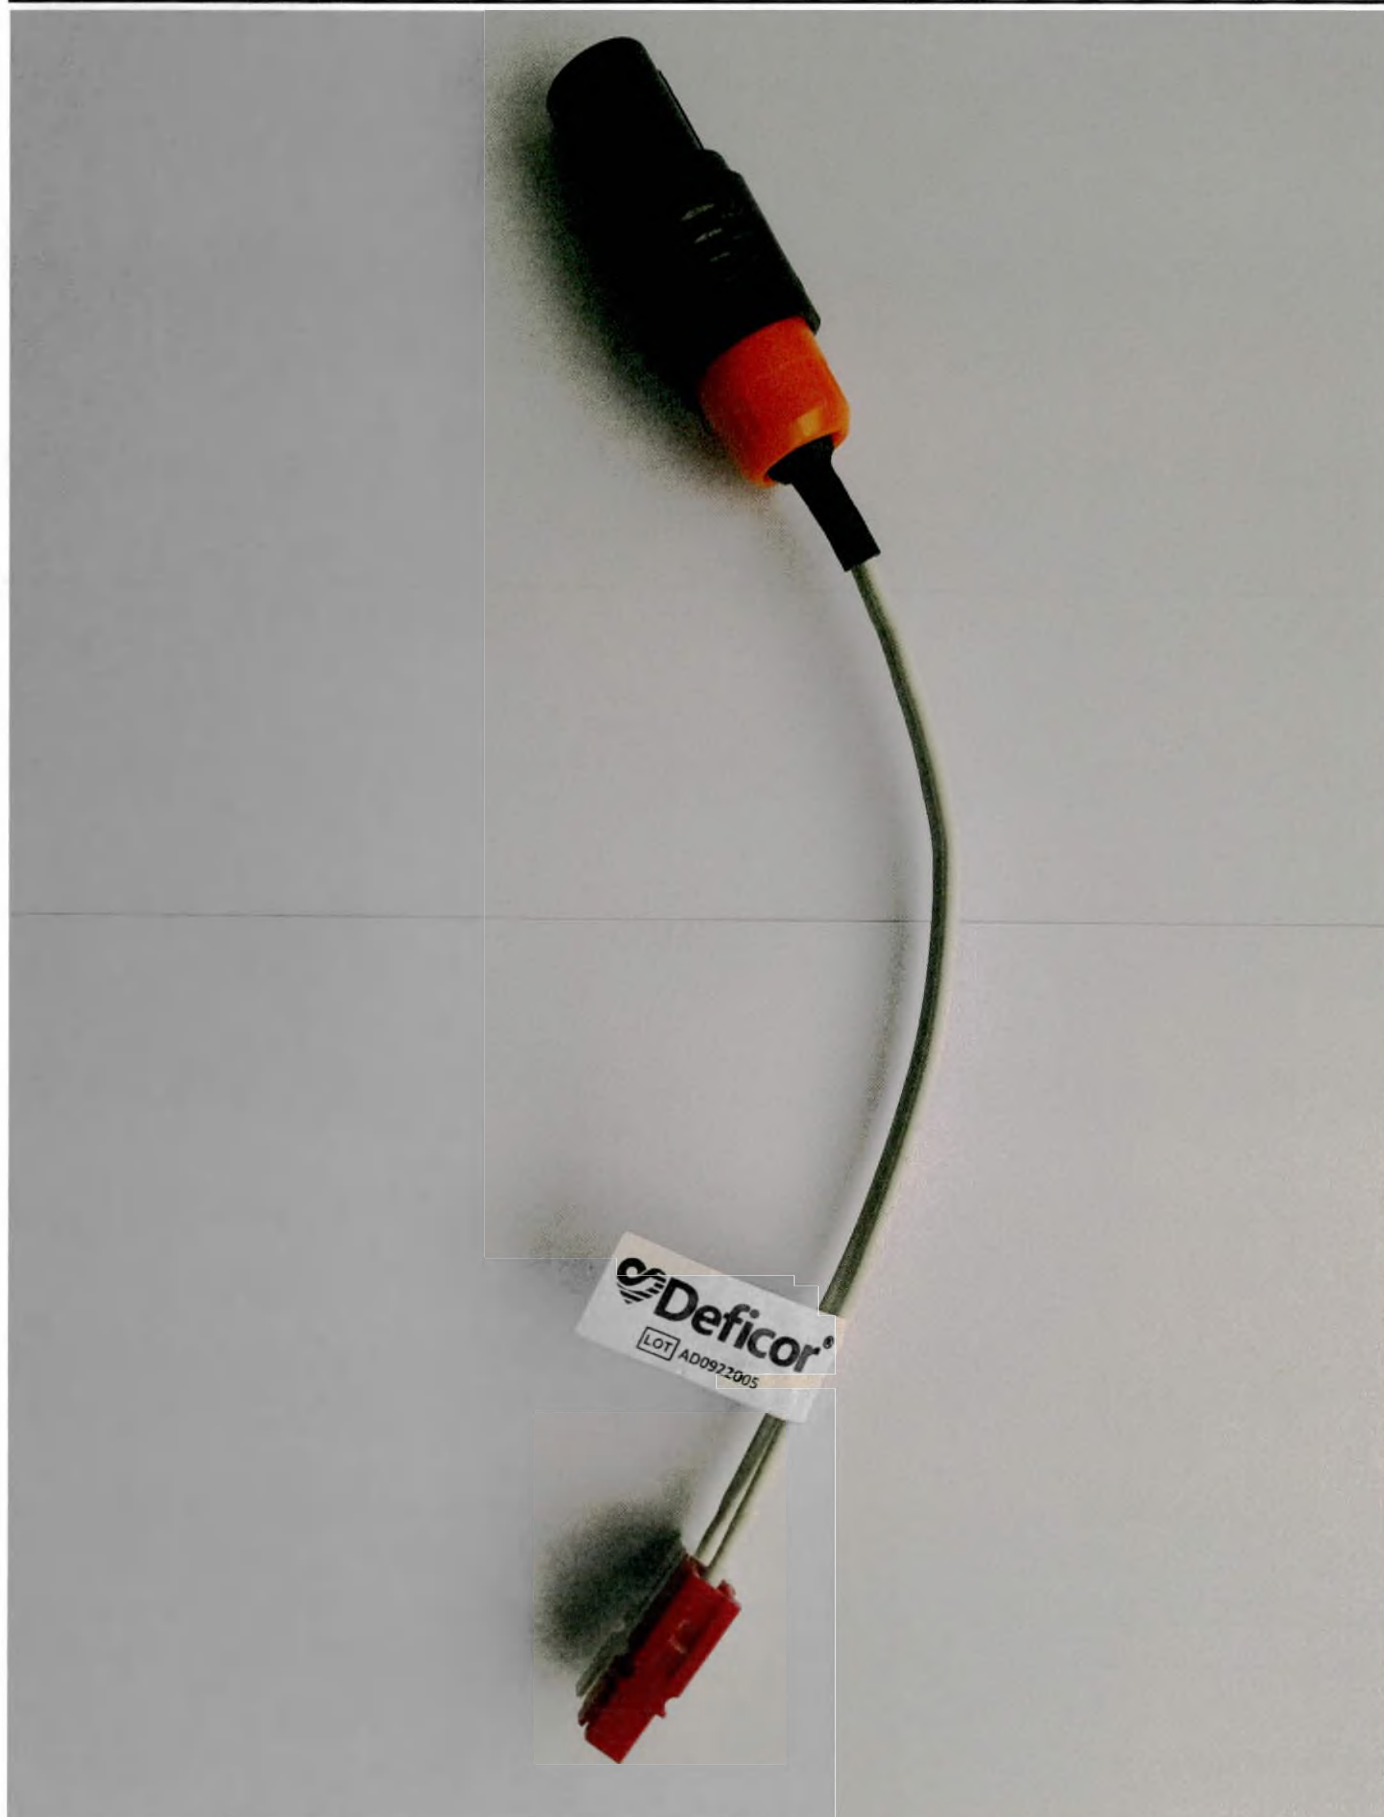


Рисунок 49 — Адаптер для электродов дефибрилляции (ЛТБВ.943129.013)

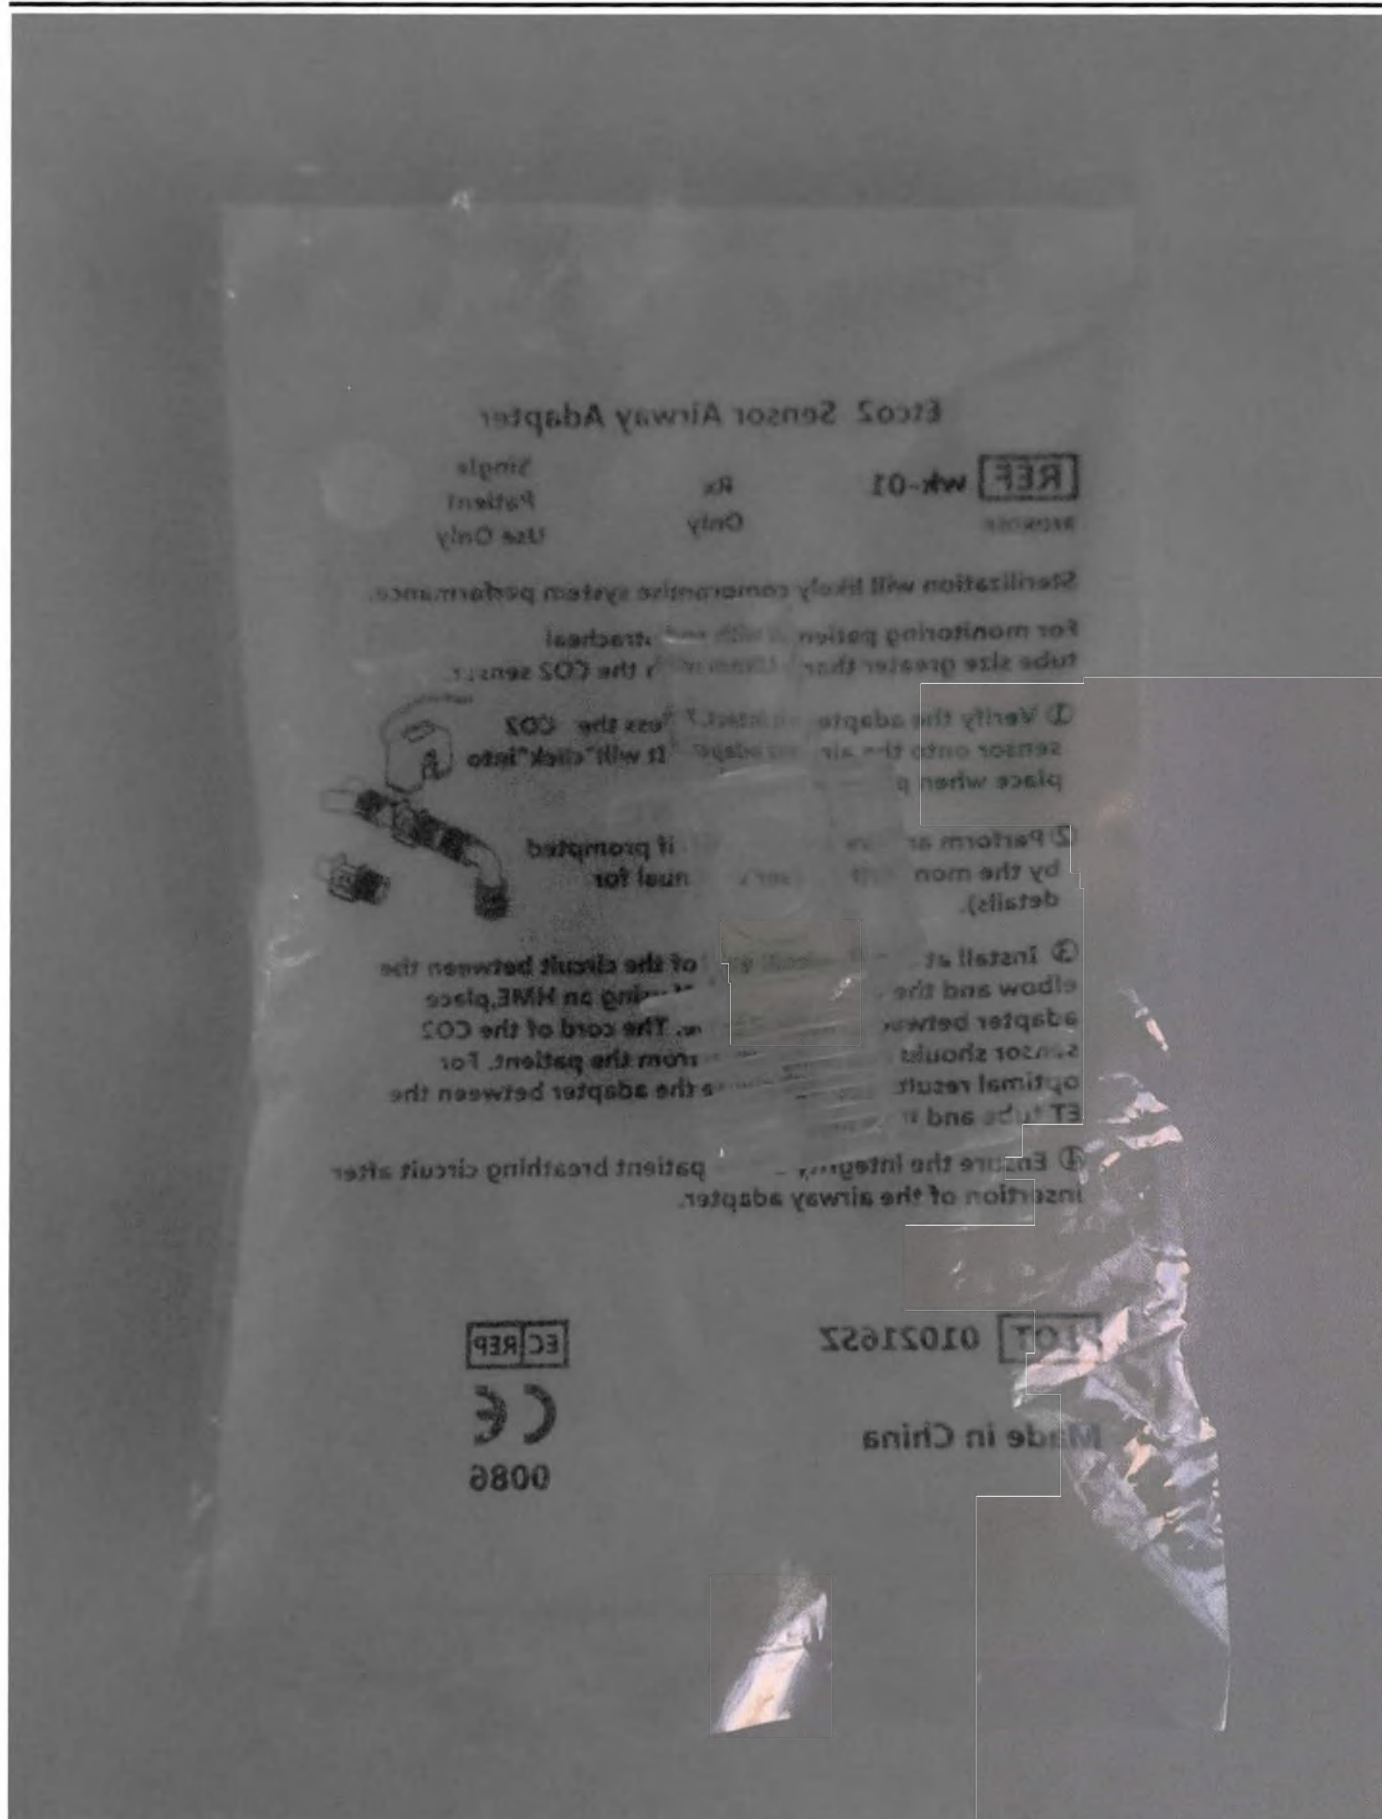


Рисунок 50 — Адаптер для датчика CO₂ (YKDMED WK01)

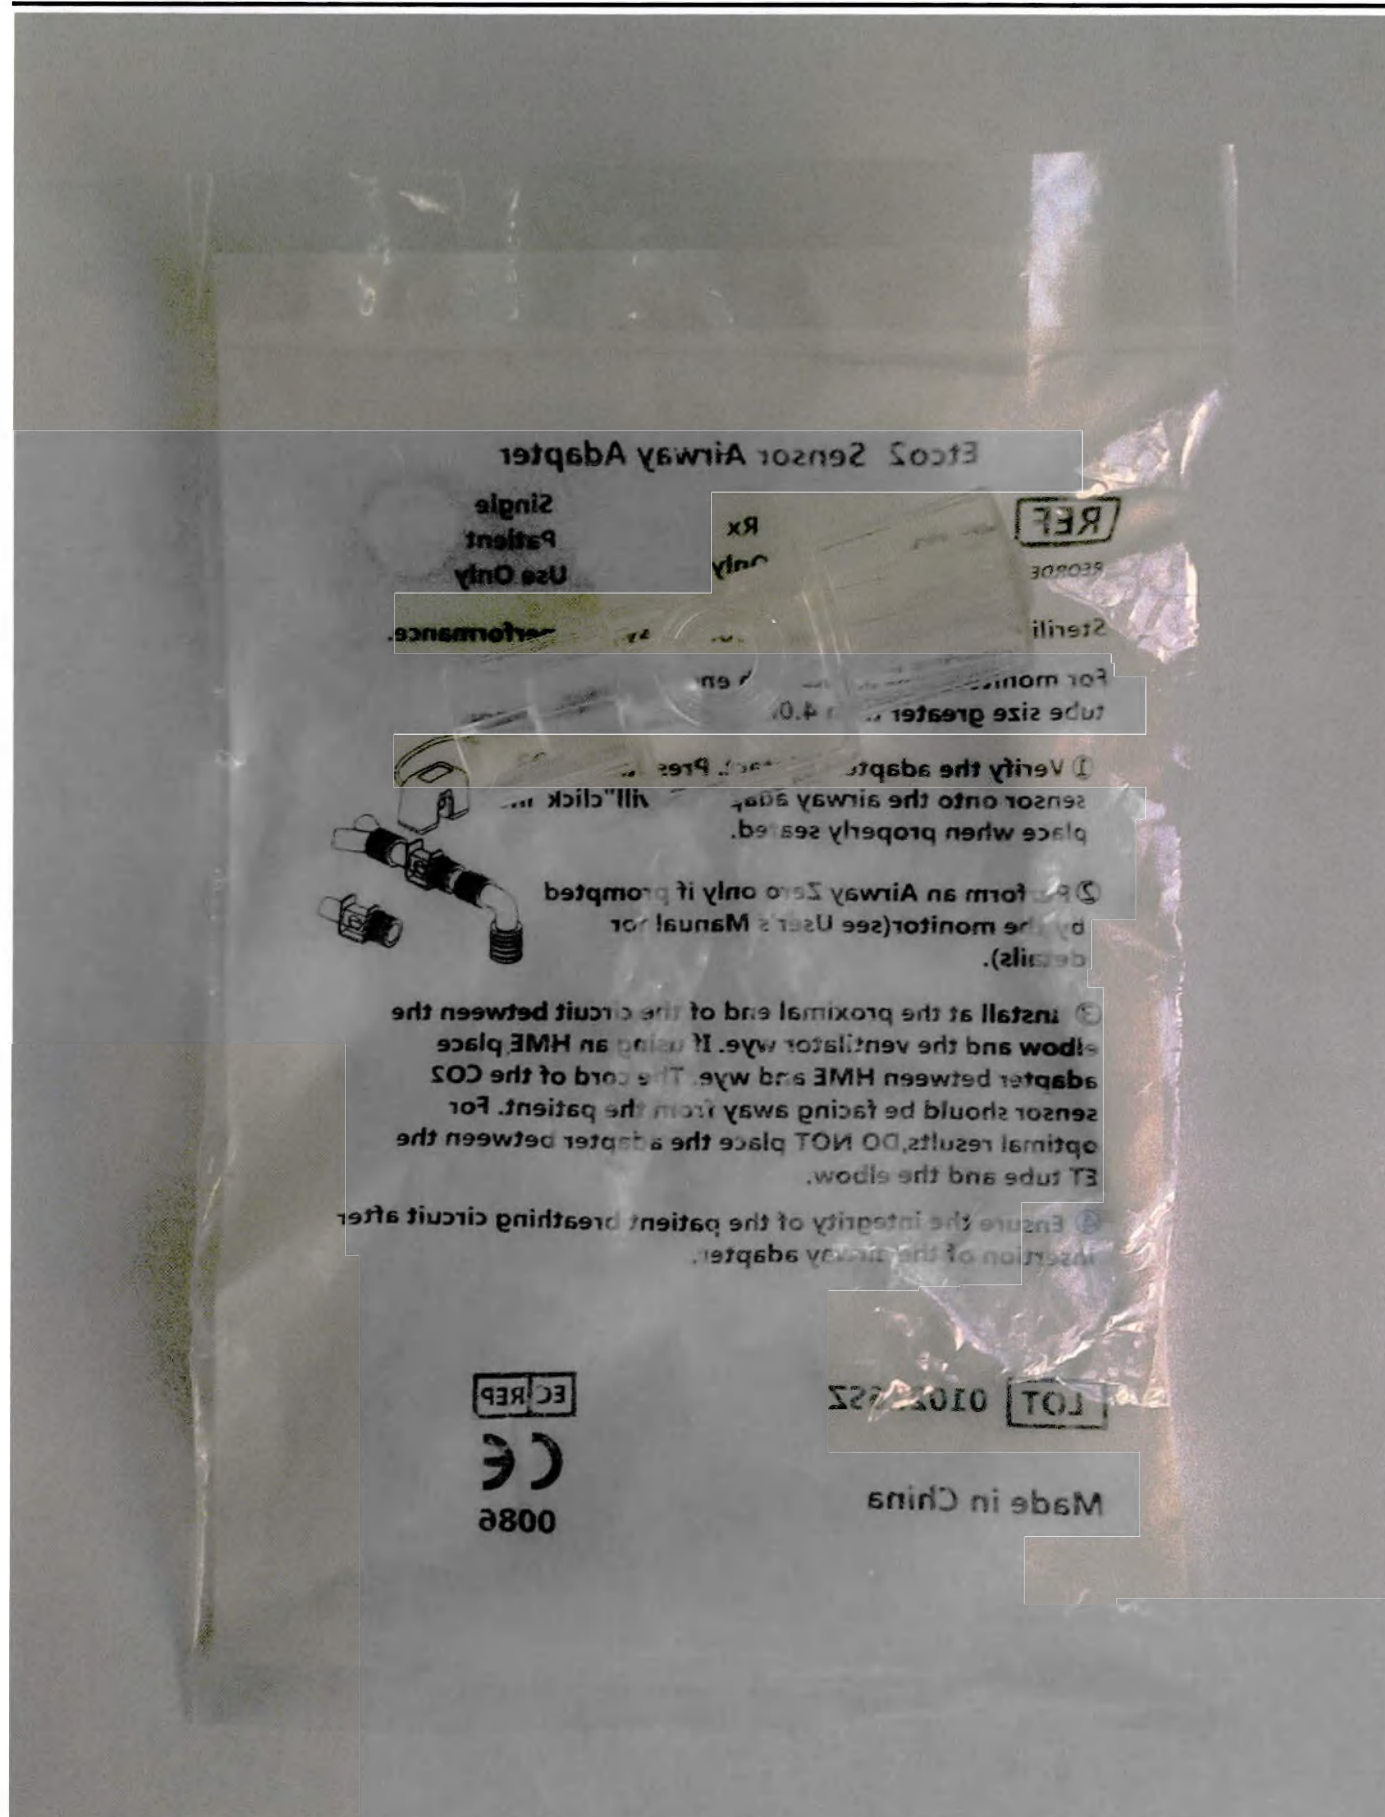


Рисунок 51 — Адаптер для датчика CO₂ (YKDMED WK02)



Рисунок 52 — Карта памяти



Рисунок 53 — Кабель USB

Упаковка



Рисунок 54 — Пример первичной упаковки (основной блок изделия в первичной упаковке)



Рисунок 55 — Потребительская тара

Маркировка

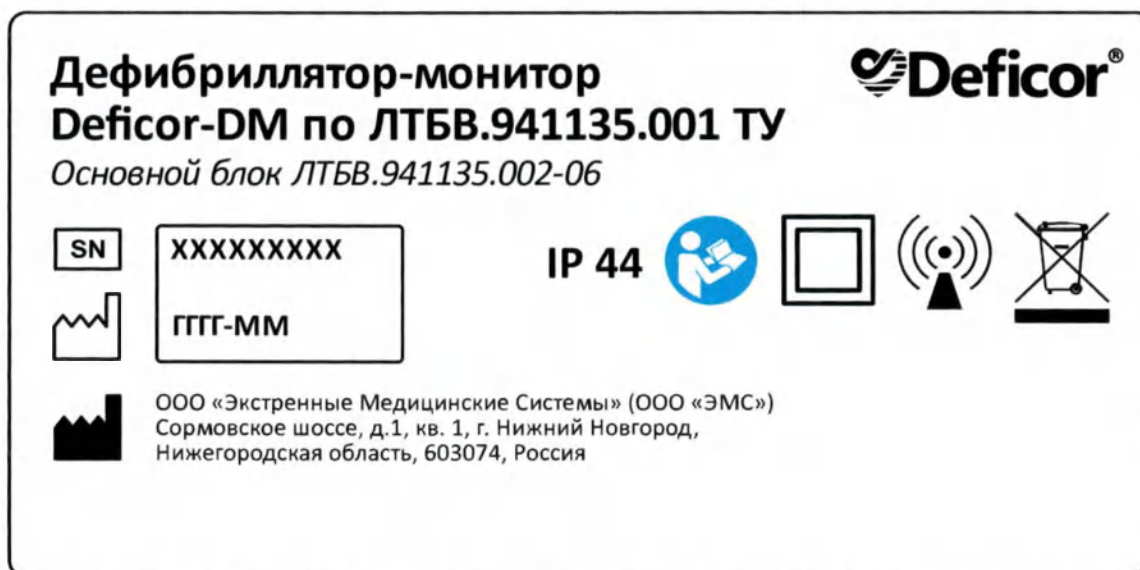


Рисунок 56 — Макет этикетки на задней крышке основного блока (ЛТБВ.941135.002-01)

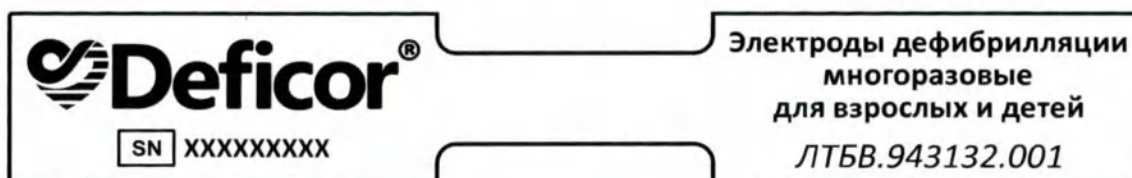


Рисунок 57 — Макет маркировки электродов дефибрилляции многоразовых для взрослых и детей (ЛТБВ.943132.001)



Рисунок 58 — Макет маркировки электродов дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовых для взрослых (ЛТБВ.943.132.002)



Рисунок 59 — Макет маркировки электродов дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовых для детей (ЛТБВ.943.132.003)



Рисунок 60 — Макет маркировки аккумуляторной батареи (ЛТБВ.943129.001)



Рисунок 61 — Макет маркировки неперезаряжаемой батареи (ЛТБВ.943129.002)

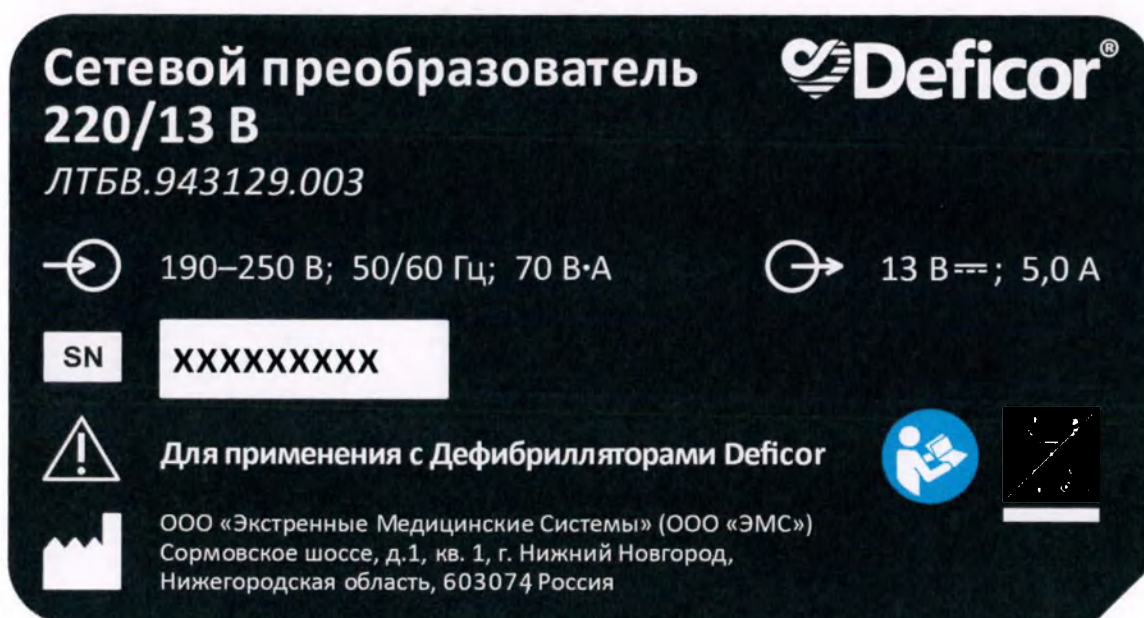


Рисунок 62 — Макет маркировки сетевого преобразователя 220/13 В (ЛТБВ.943129.003)

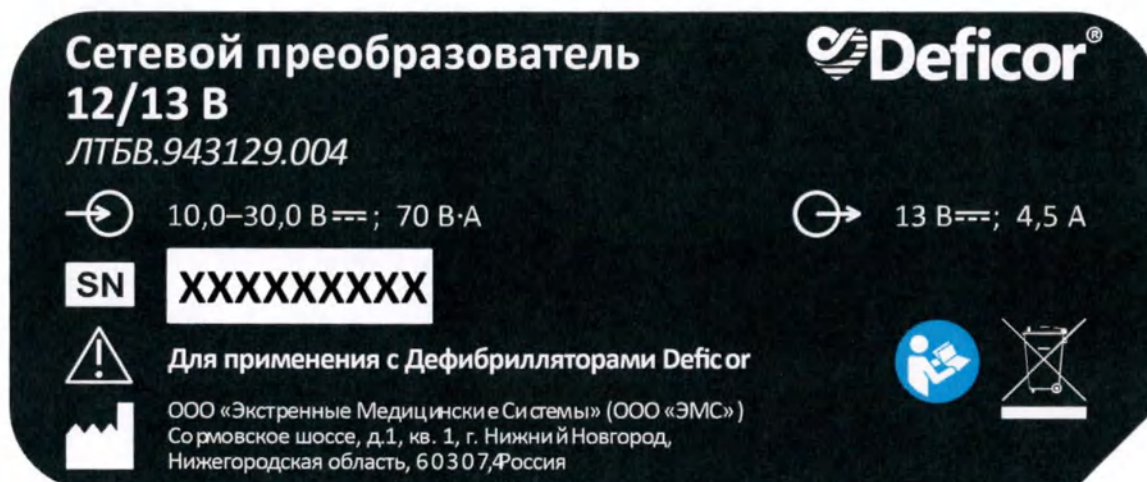


Рисунок 63 — Макет маркировки сетевого преобразователя 12/13 В (ЛТБВ.943129.004)

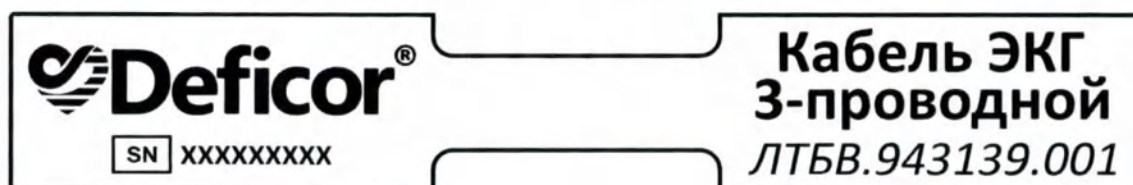


Рисунок 64 — Макет маркировки кабеля ЭКГ 3-проводного (ЛТБВ.943139.001)

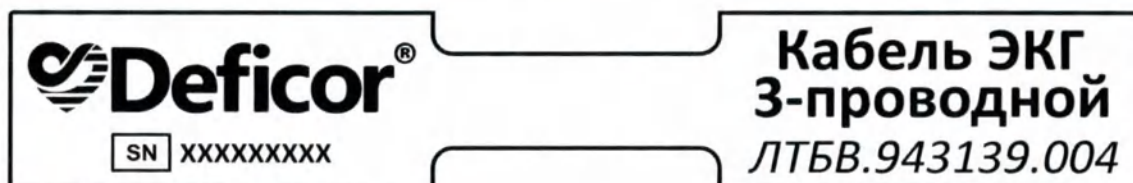


Рисунок 65 — Макет маркировки кабеля ЭКГ 3-проводного (ЛТБВ.943139.004)

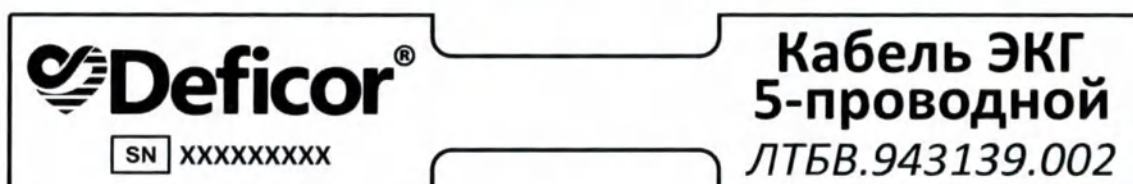


Рисунок 66 — Макет маркировки кабеля ЭКГ 5-проводного (ЛТБВ.943139.002)

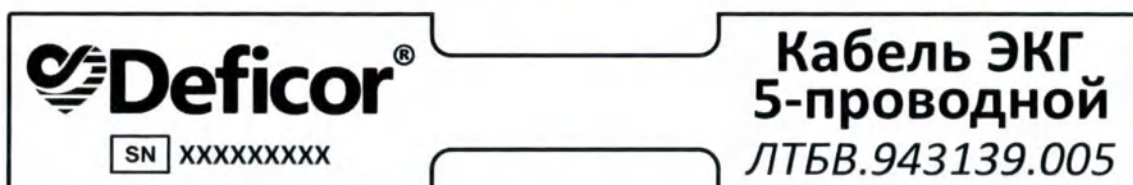


Рисунок 67 — Макет маркировки кабеля ЭКГ 5-проводного (ЛТБВ.943139.005)

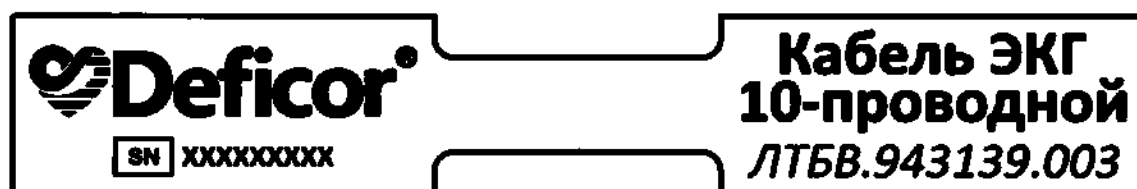


Рисунок 68 — Макет маркировки кабеля ЭКГ 10-проводного (ЛТБВ.943139.003)

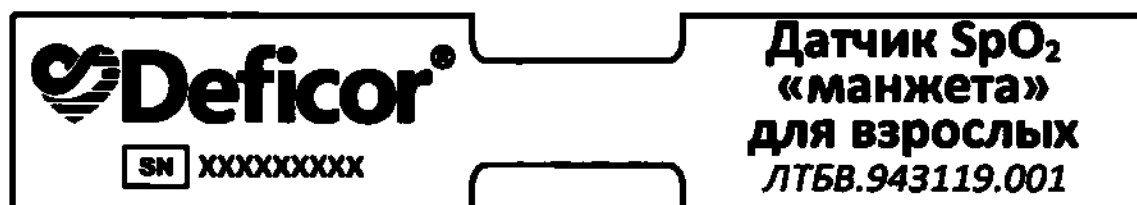


Рисунок 69 — Макет маркировки датчика SpO₂ «манжета» для взрослых (ЛТБВ.943119.001)

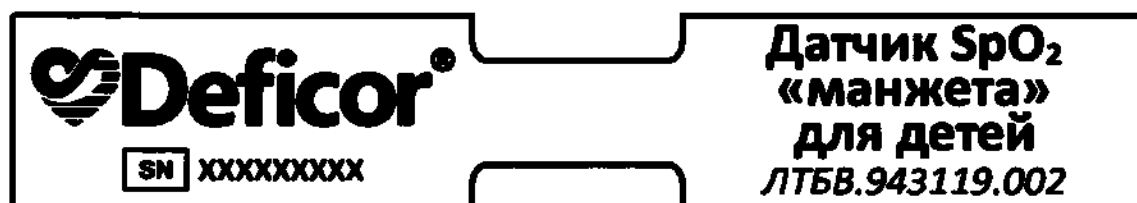


Рисунок 70 — Макет маркировки датчика SpO₂ «манжета» для детей (ЛТБВ.943119.002)

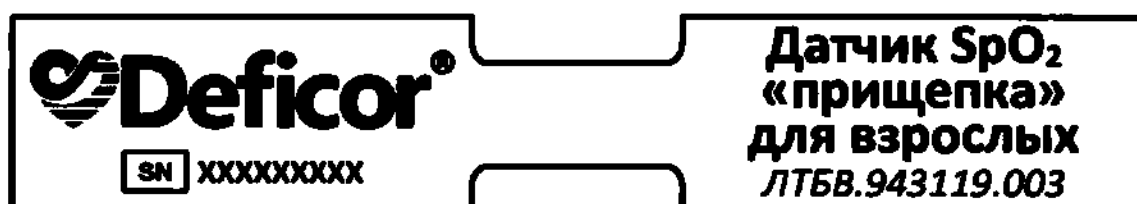


Рисунок 71 — Макет маркировки датчика SpO₂ «прищепка» для взрослых (ЛТБВ.943119.003)

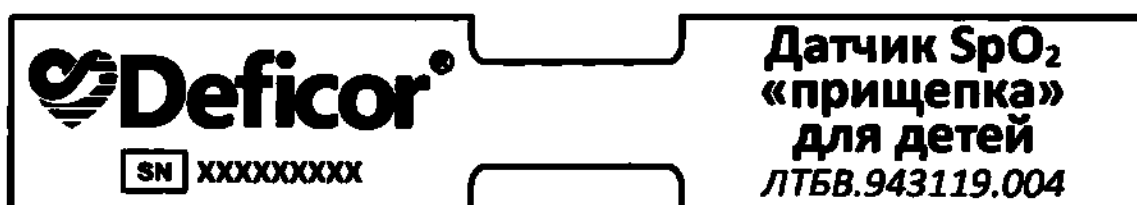


Рисунок 72 — Макет маркировки датчика SpO₂ «прищепка» для детей (ЛТБВ.943119.004)

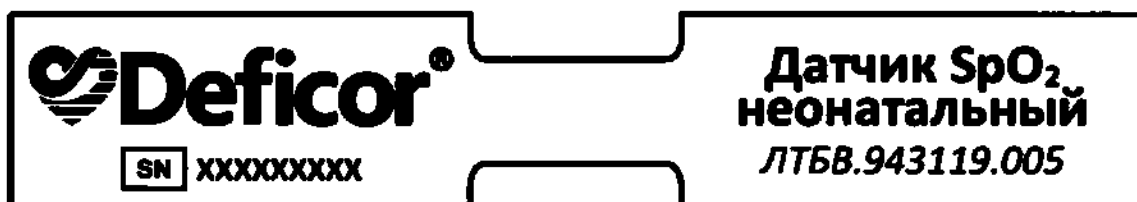


Рисунок 73 — Макет маркировки датчика SpO₂ неонатального (ЛТБВ.943119.005)

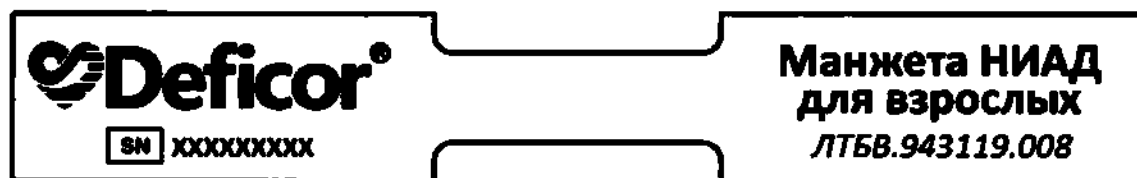


Рисунок 74 — Макет маркировки манжеты НИАД для взрослых (ЛТБВ.943119.008)

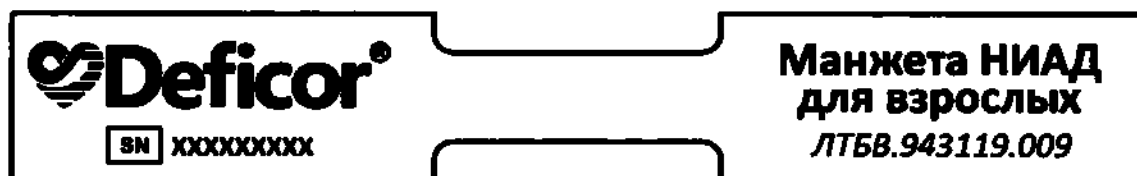


Рисунок 75 — Макет маркировки манжеты НИАД для взрослых (ЛТБВ.943119.009)

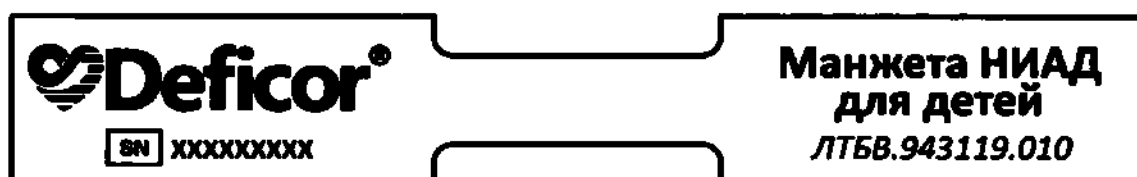


Рисунок 76 — Макет маркировки манжеты НИАД для детей (ЛТБВ.943119.010)

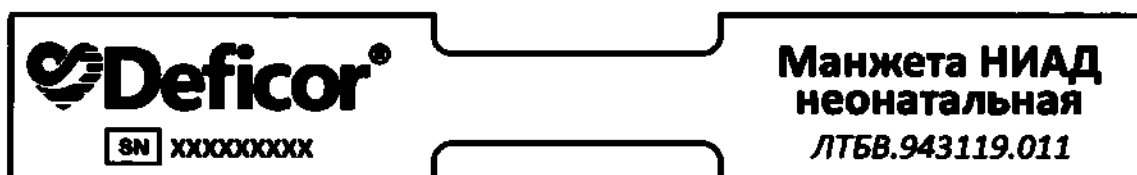


Рисунок 77 — Макет маркировки манжеты НИАД неонатальной (ЛТБВ.943119.011)

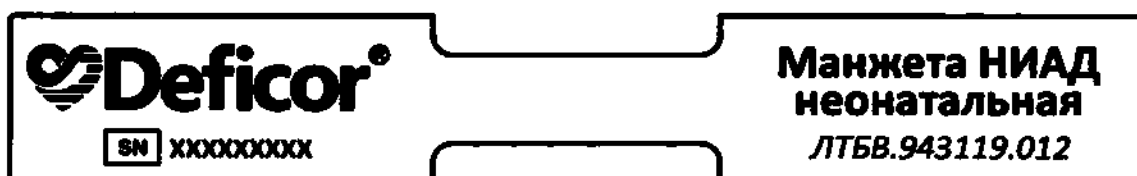


Рисунок 78 — Макет маркировки манжеты НИАД неонатальной (ЛТБВ.943119.012)

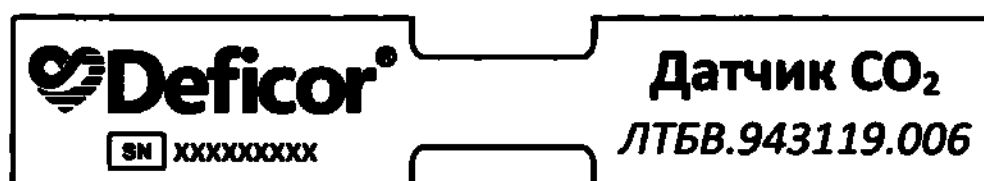


Рисунок 79 — Макет маркировки датчика CO₂ (ЛТБВ.943119.006)

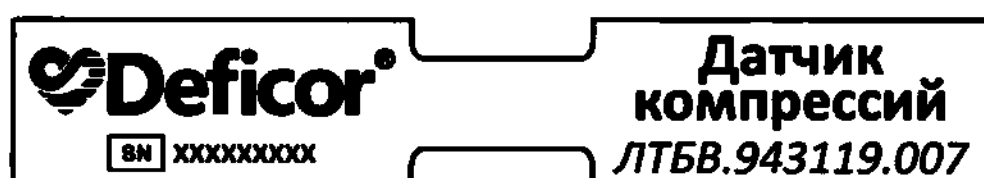


Рисунок 80 — Макет маркировки датчика компрессионный (ЛТБВ.943119.007)



Рисунок 81 — Макет маркировки кронштейна (ЛТБВ.943129.008)



Рисунок 82 — Макет маркировки ручки для переноски (ЛТБВ.943129.009)



Рисунок 83 — Макет маркировки сумки для переноски (ЛТБВ.943129.010)



Рисунок 84 — Макет маркировки карманов для сумки (ЛТБВ.943129.011)

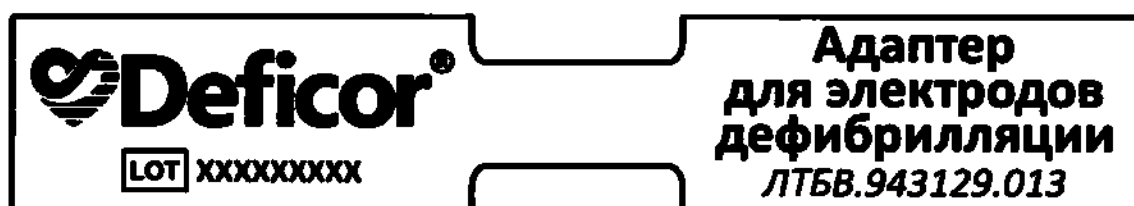


Рисунок 85 — Макет маркировки адаптера для электродов дефибрилляции (ЛТБВ.943129.013)

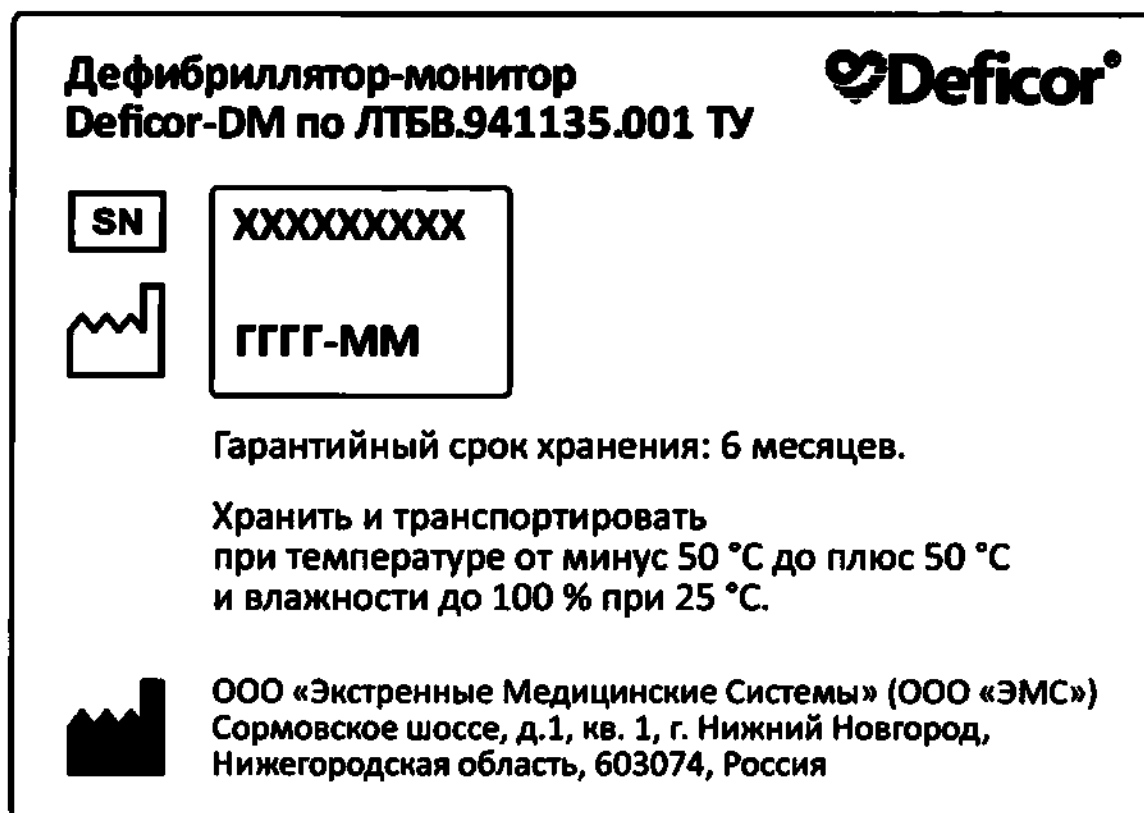


Рисунок 86 — Макет маркировки потребительской тары


Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

65 (Мессажей №86) листов

Должность Ин. Жуков

Подпись Д.И. Рязанский

" 20 " сентября 20 14 г М.П.

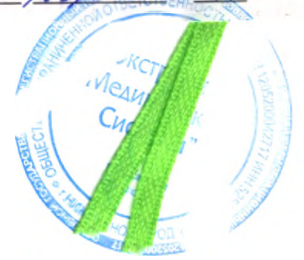

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭМС»

Галынин А.И.



Дефибриллятор автоматический наружный

Deficor-AED-N по ЛТБВ.941135.001 ТУ

Альбом фотографий

Общий вид

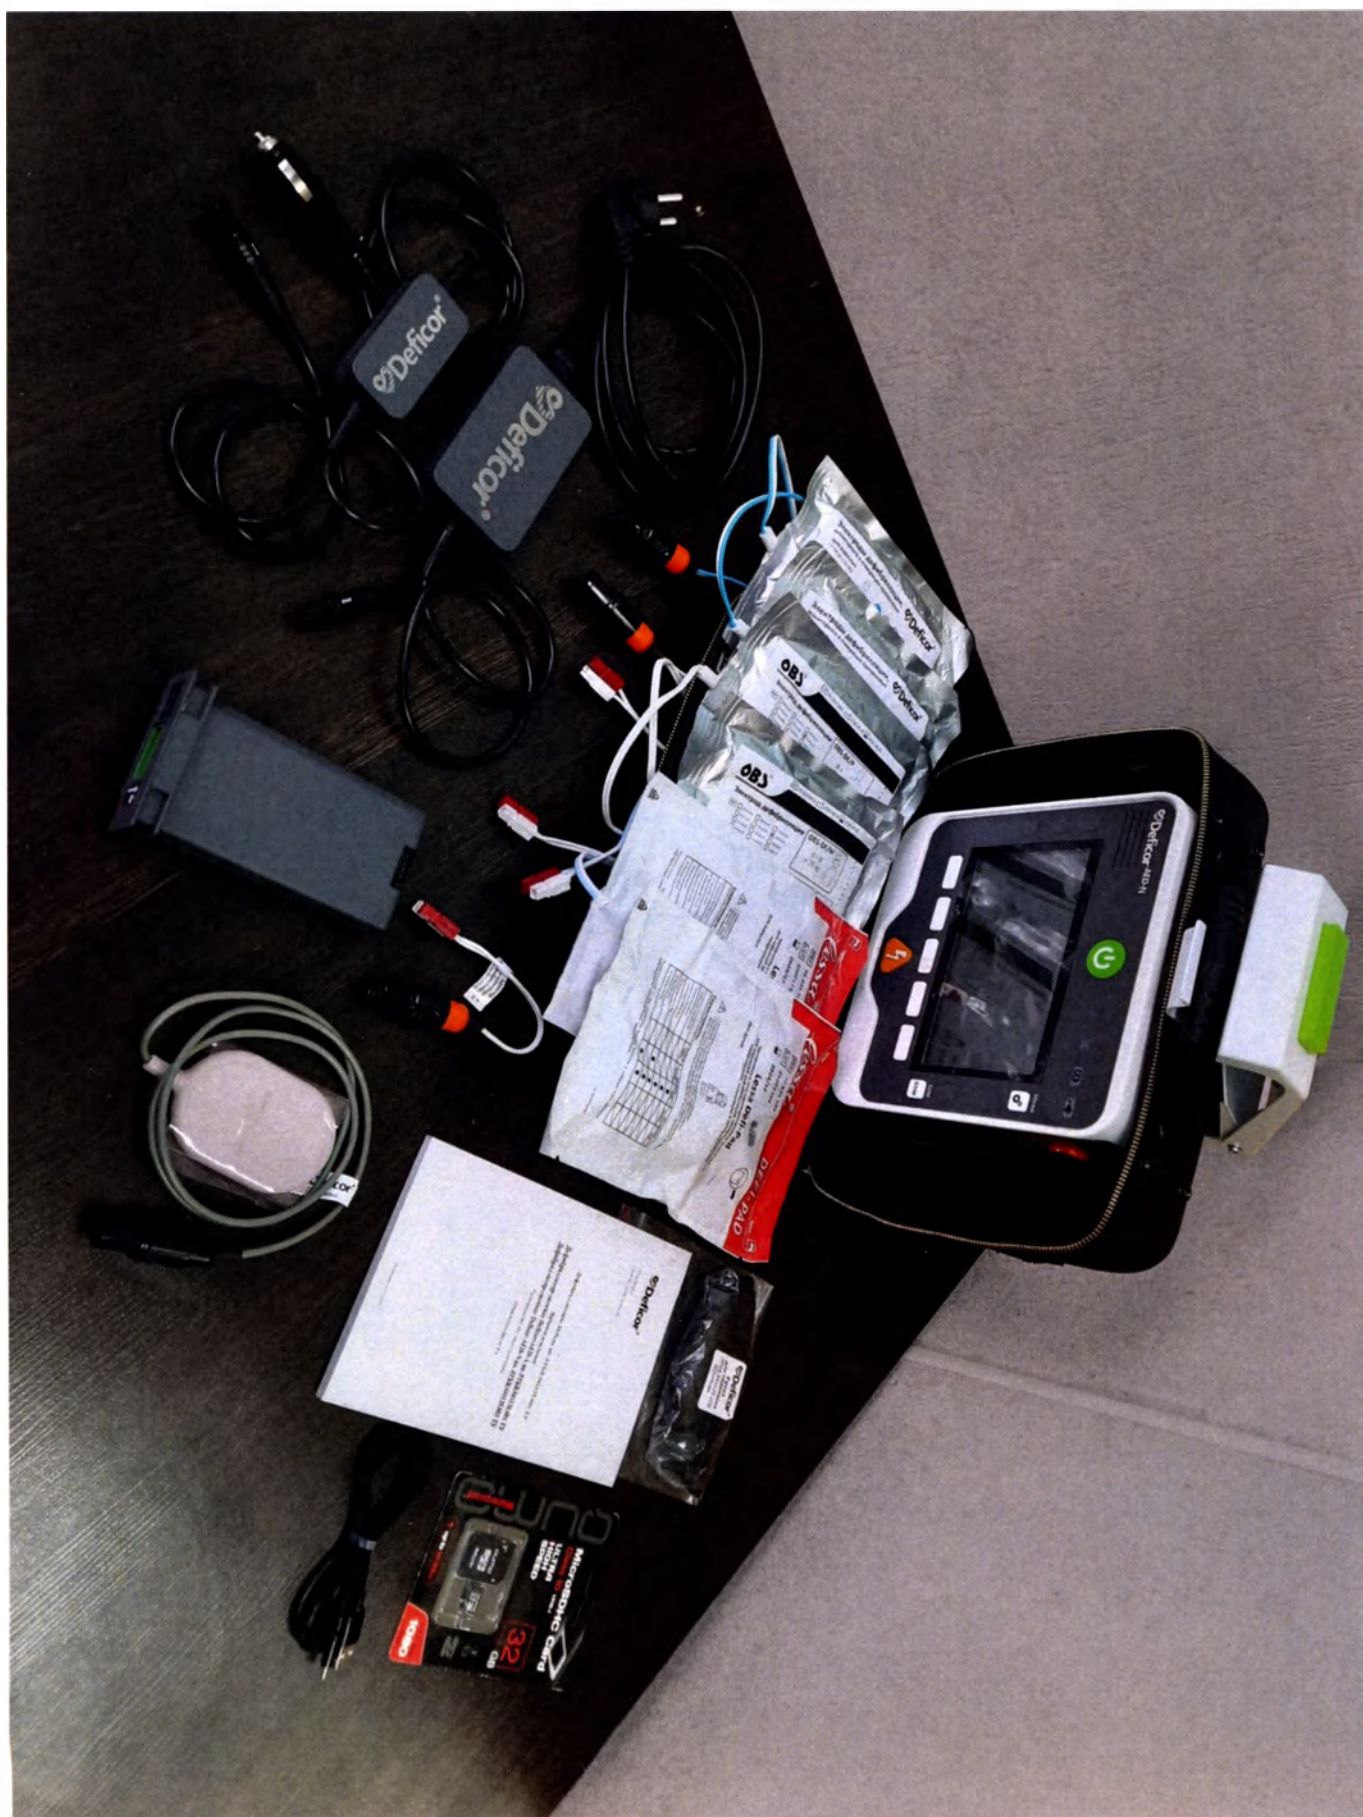


Рисунок 1 — Общий вид изделия со всеми составными частями и принадлежностями

Составные части



Рисунок 2 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-01, панель управления)

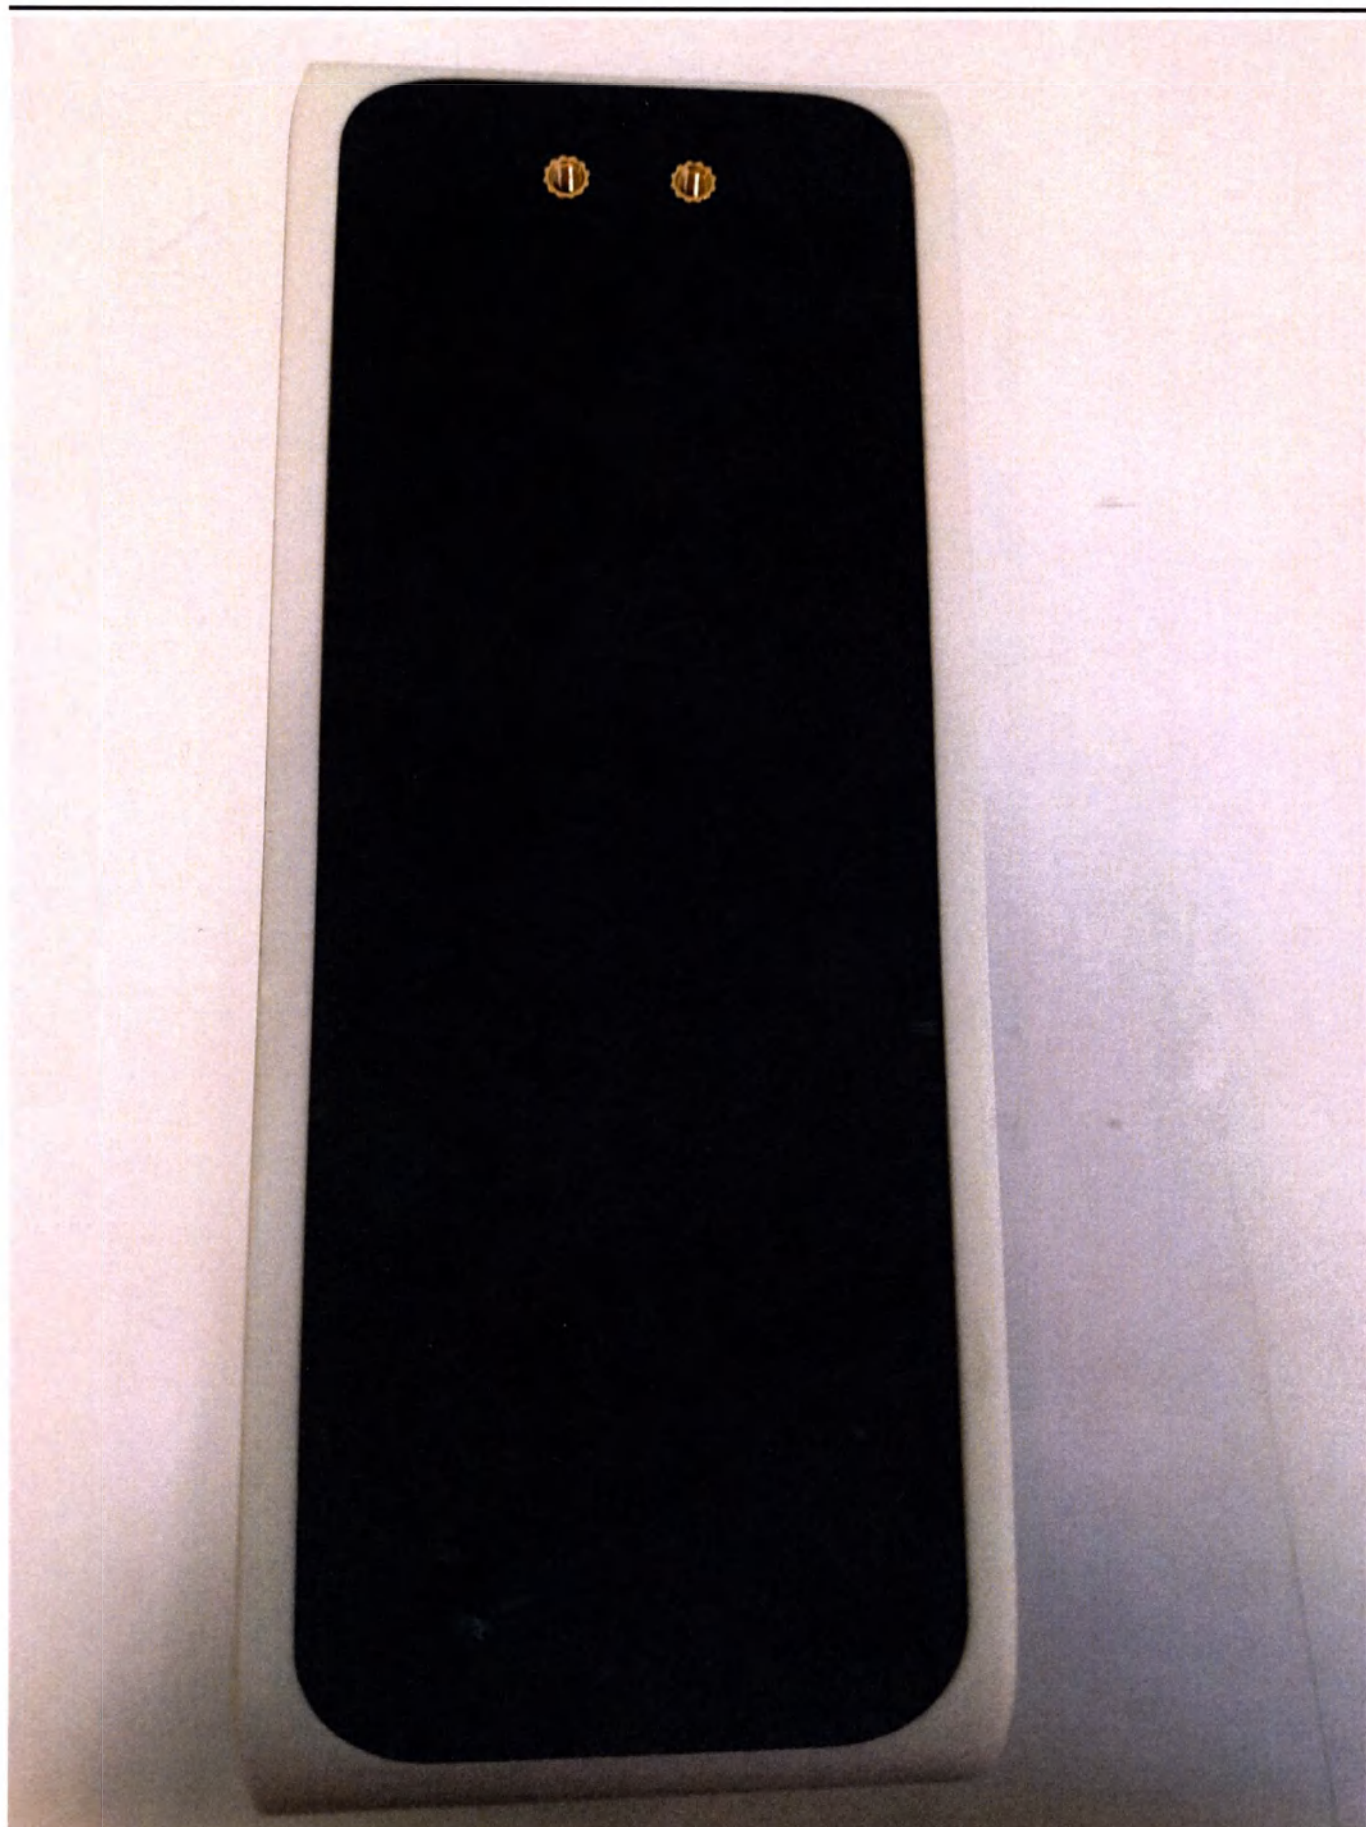


Рисунок 3 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-01, левая панель)



Рисунок 4 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-01, правая панель)



Рисунок 5 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-01, задняя крышка)



Рисунок 6 — Электроды дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовые для взрослых (ЛТБВ.943.132.002, в упаковке)

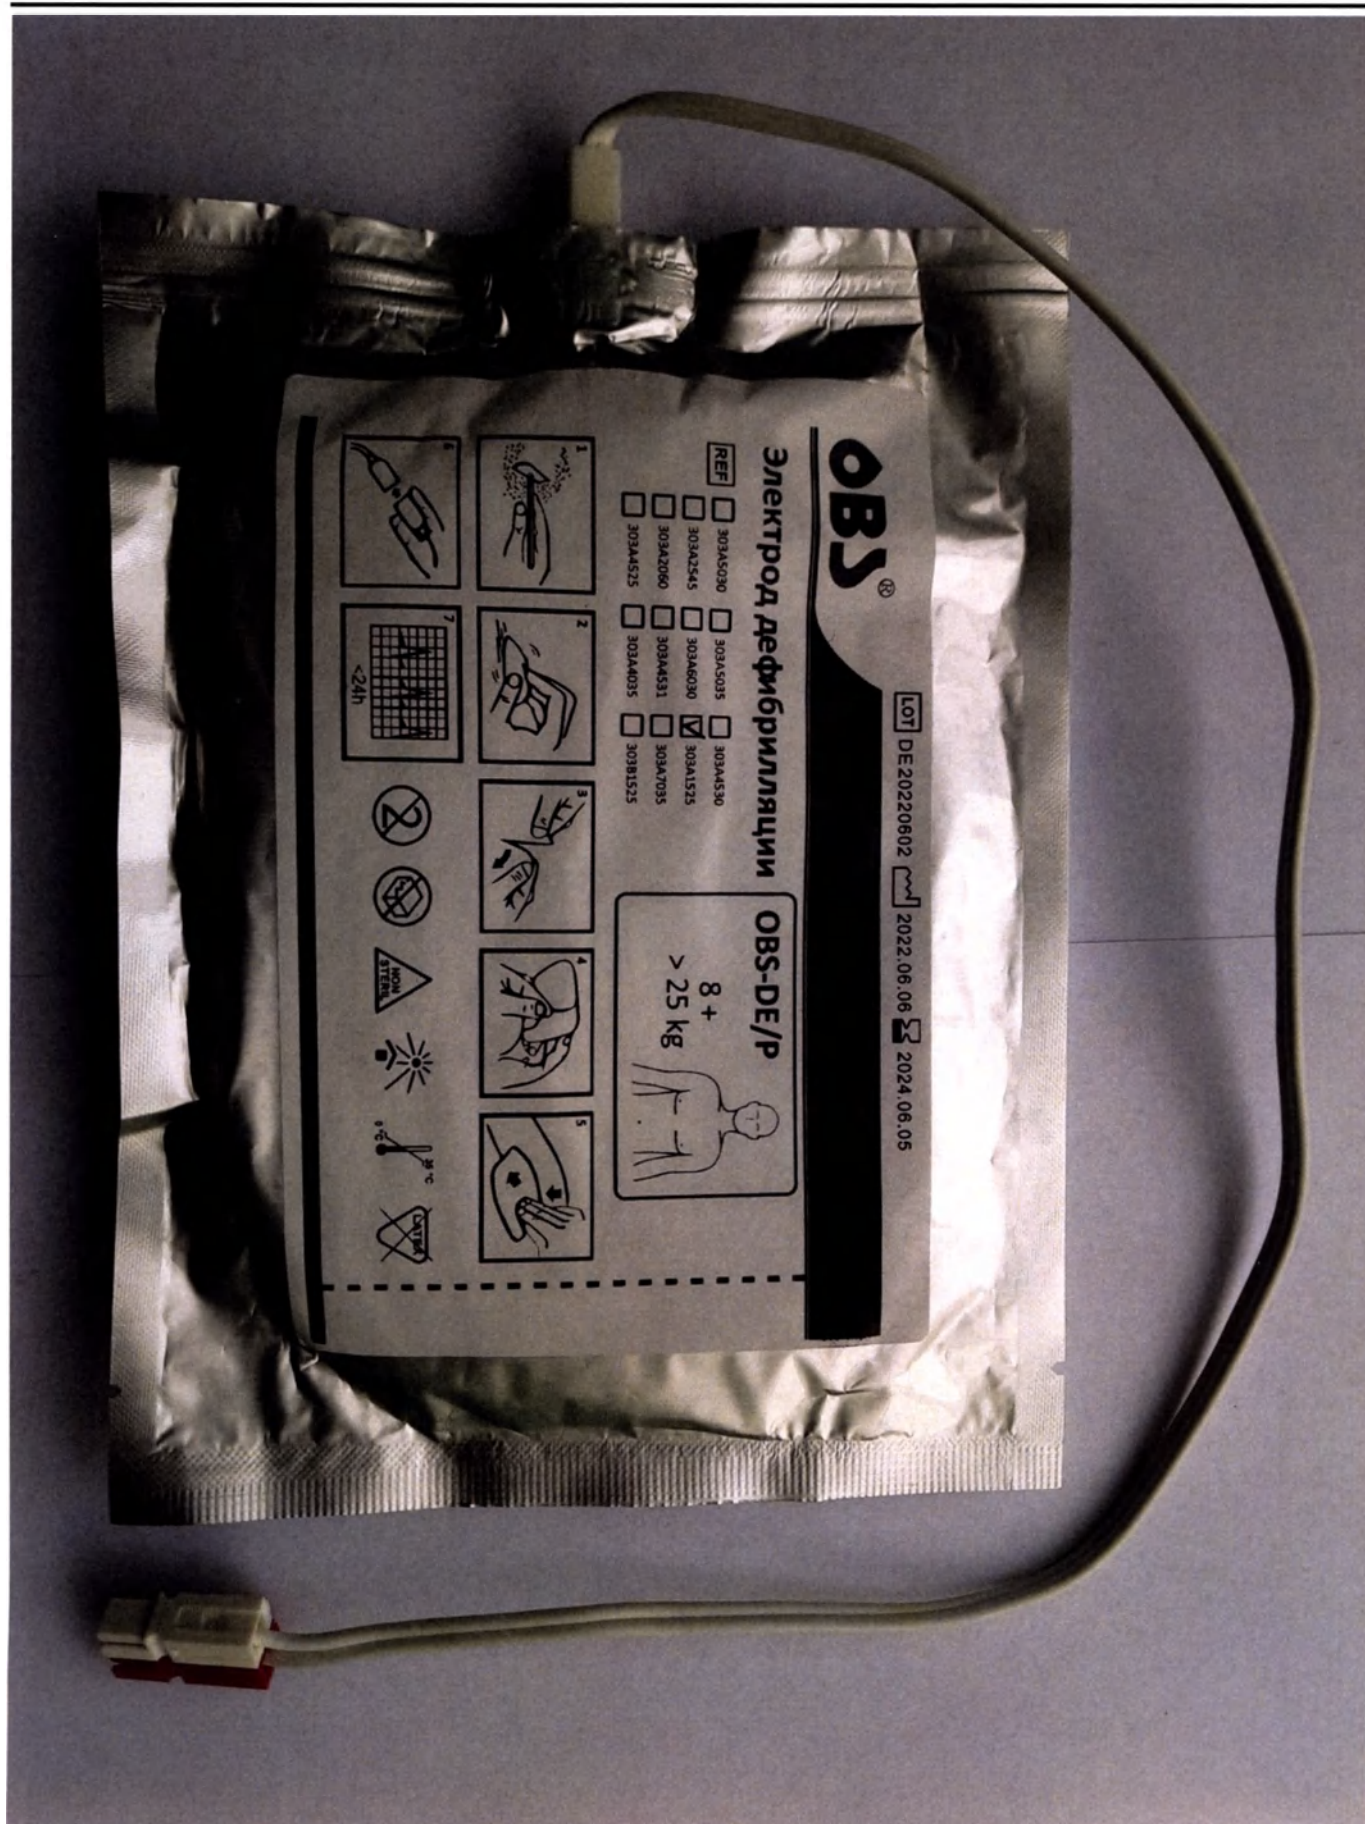


Рисунок 7 — Электрод дефибриляции OBS-DE/P (303A1525, в упаковке)



Рисунок 8 — Одноразовые многофункциональные электроды для наружной дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ Lessa Defi-Pad (99.835.102, в упаковке)



Рисунок 9 — Электроды дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовые для детей (ЛТБВ.943.132.003, в упаковке)

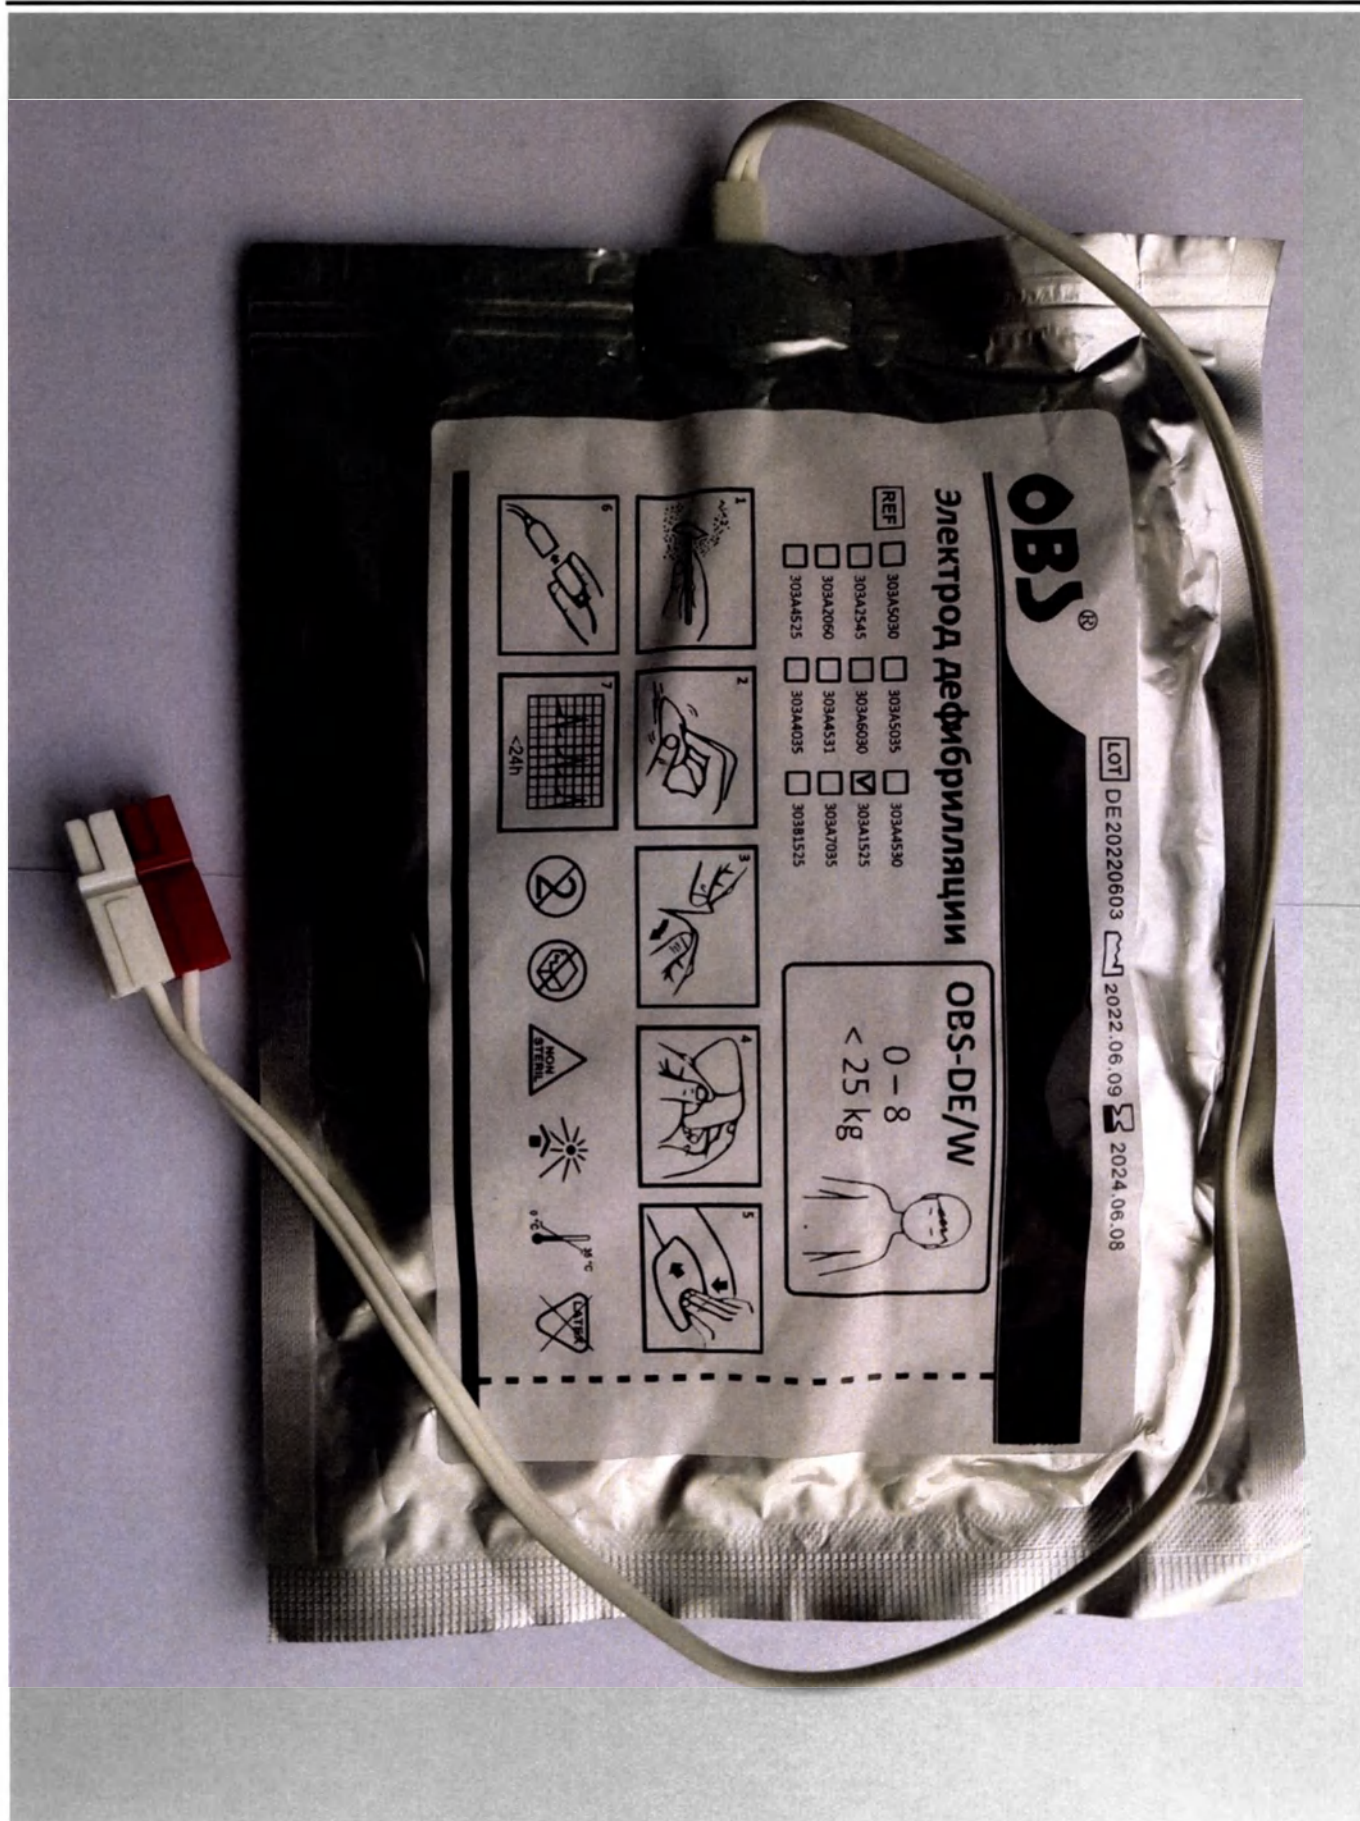


Рисунок 10 — Электрод дефибрилляции OBS-DE/W (303A1525, в упаковке)



Рисунок 11 — Одноразовые многофункциональные электроды для наружной дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ Lessa Defi-Pad (99.835.103, в упаковке)



Рисунок 12 — Неperезаряжаемая батарея (ЛТБВ.943129.002)

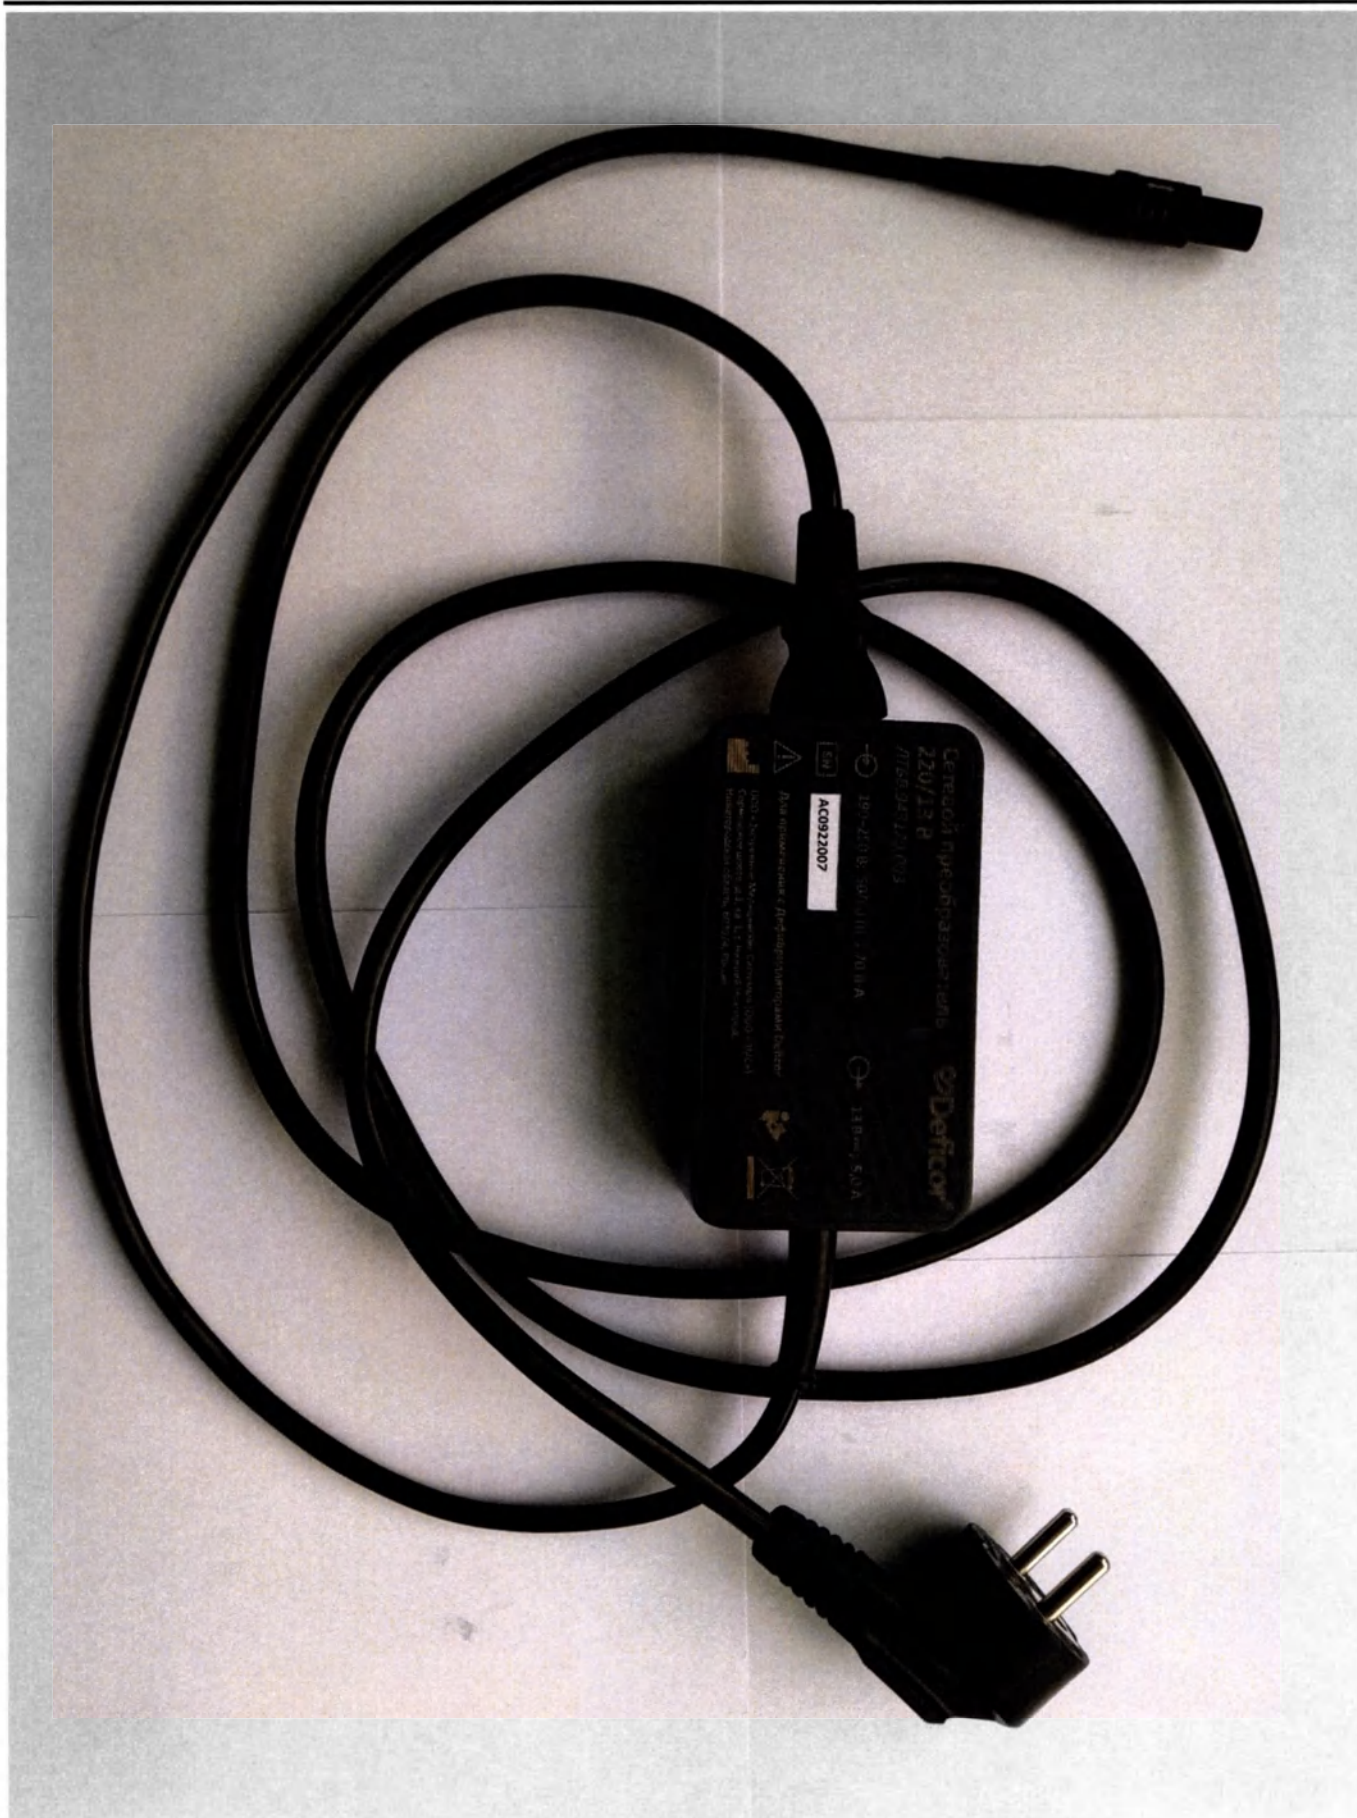


Рисунок 13 — Сетевой преобразователь 220/13 В (ЛТБВ.943129.003)



Рисунок 14 — Сетевой преобразователь 12/13 В (ЛТБВ.943129.004)

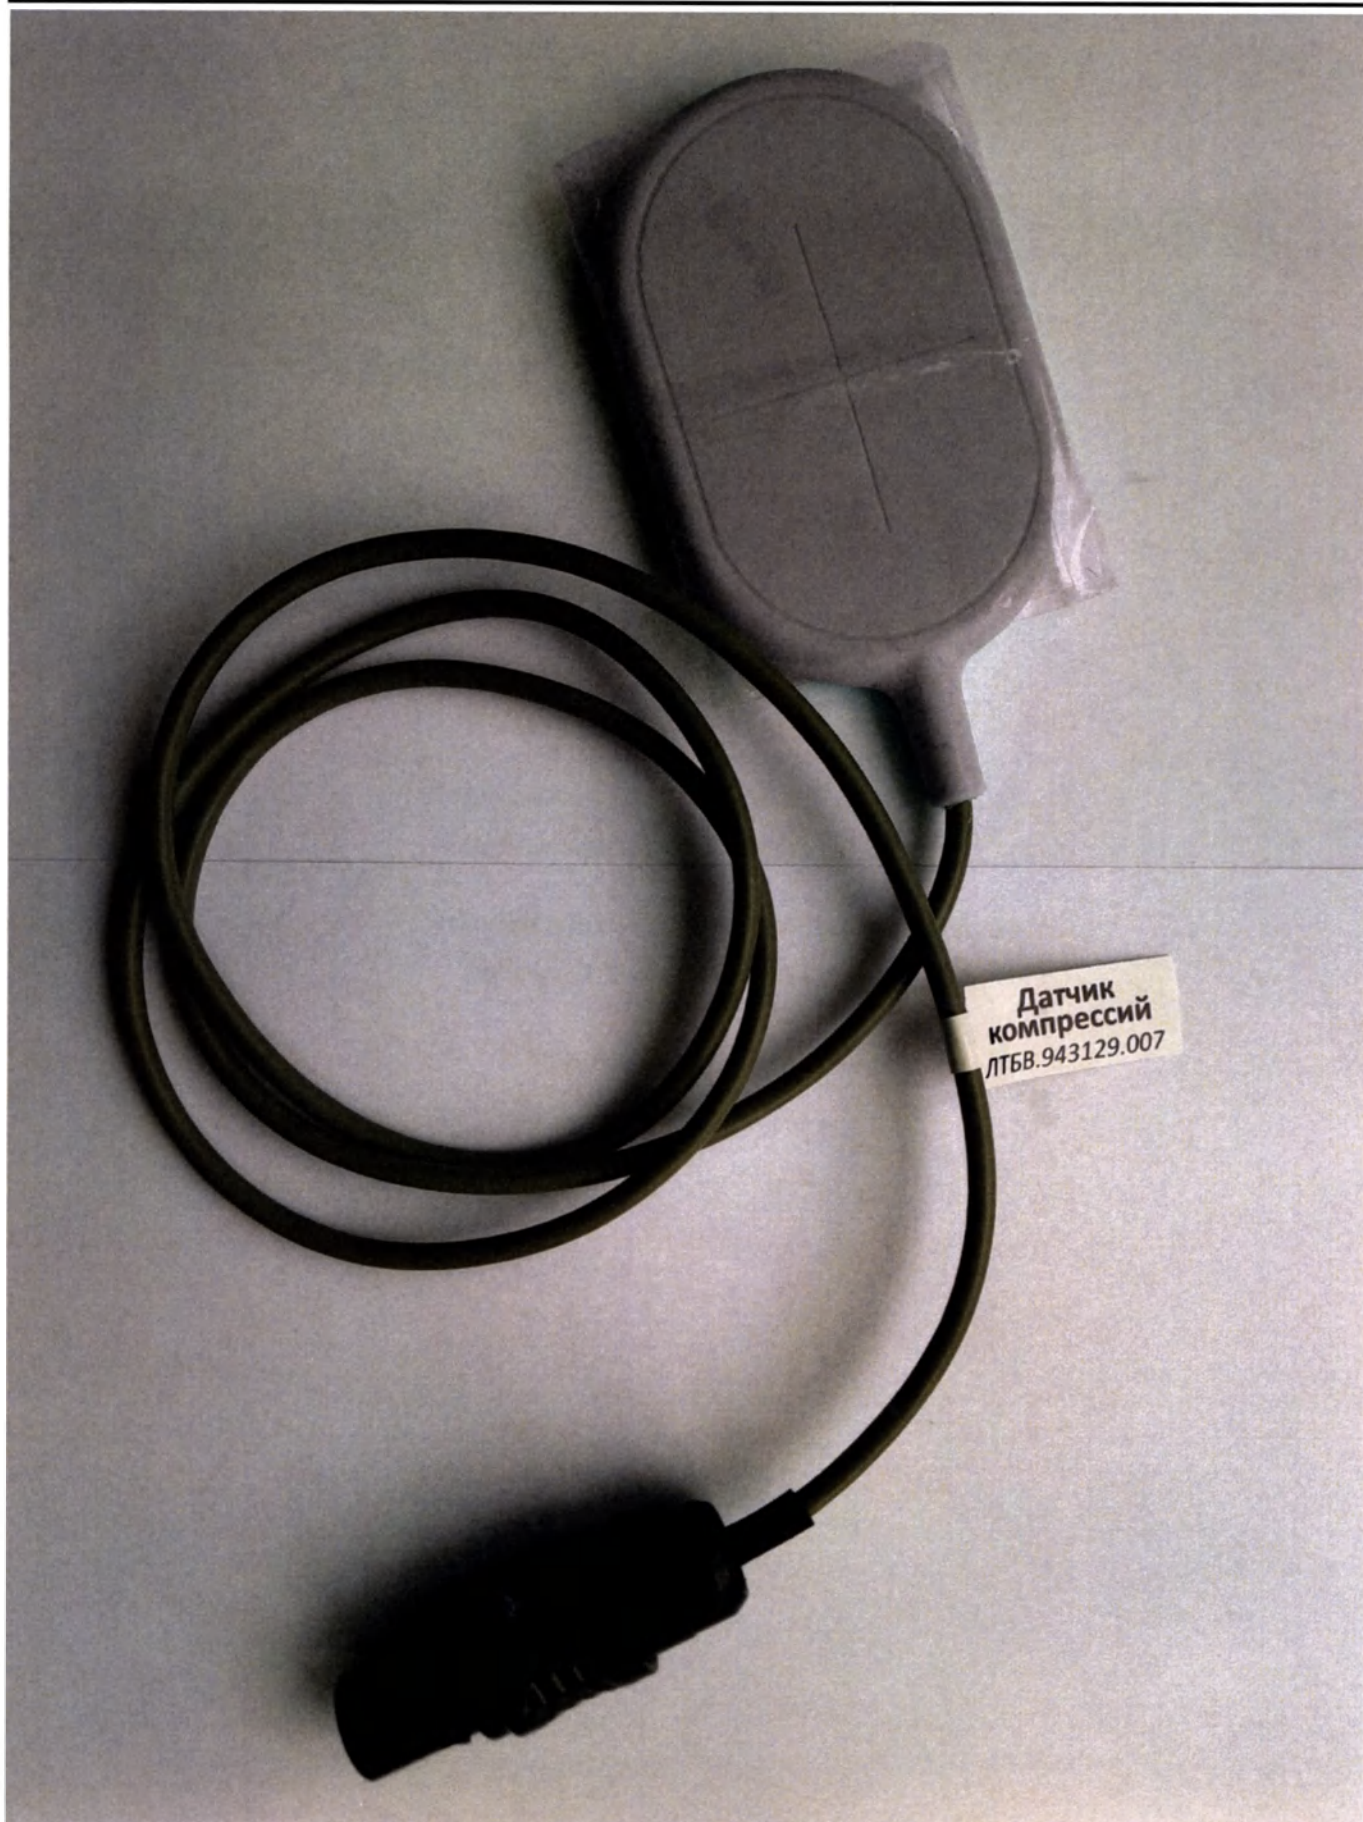


Рисунок 15 — Датчик компрессий (ЛТБВ.943119.007)



УТВЕРЖДЕН
ЛТБВ 941135 001-02 РЭ-ЛУ

Дефибриллятор автоматический наружный
Deficor-AED-A по ЛТБВ.941135.001 ТУ

Дефибриллятор автоматический наружный
Deficor-AED-N по ЛТБВ.941135.001 ТУ

Руководство по эксплуатации

ЛТБВ.941135.001-02 РЭ

Редакция от 02.2024

Рисунок 16 — Руководство по эксплуатации (ЛТБВ.941135.001-02 РЭ)

Принадлежности

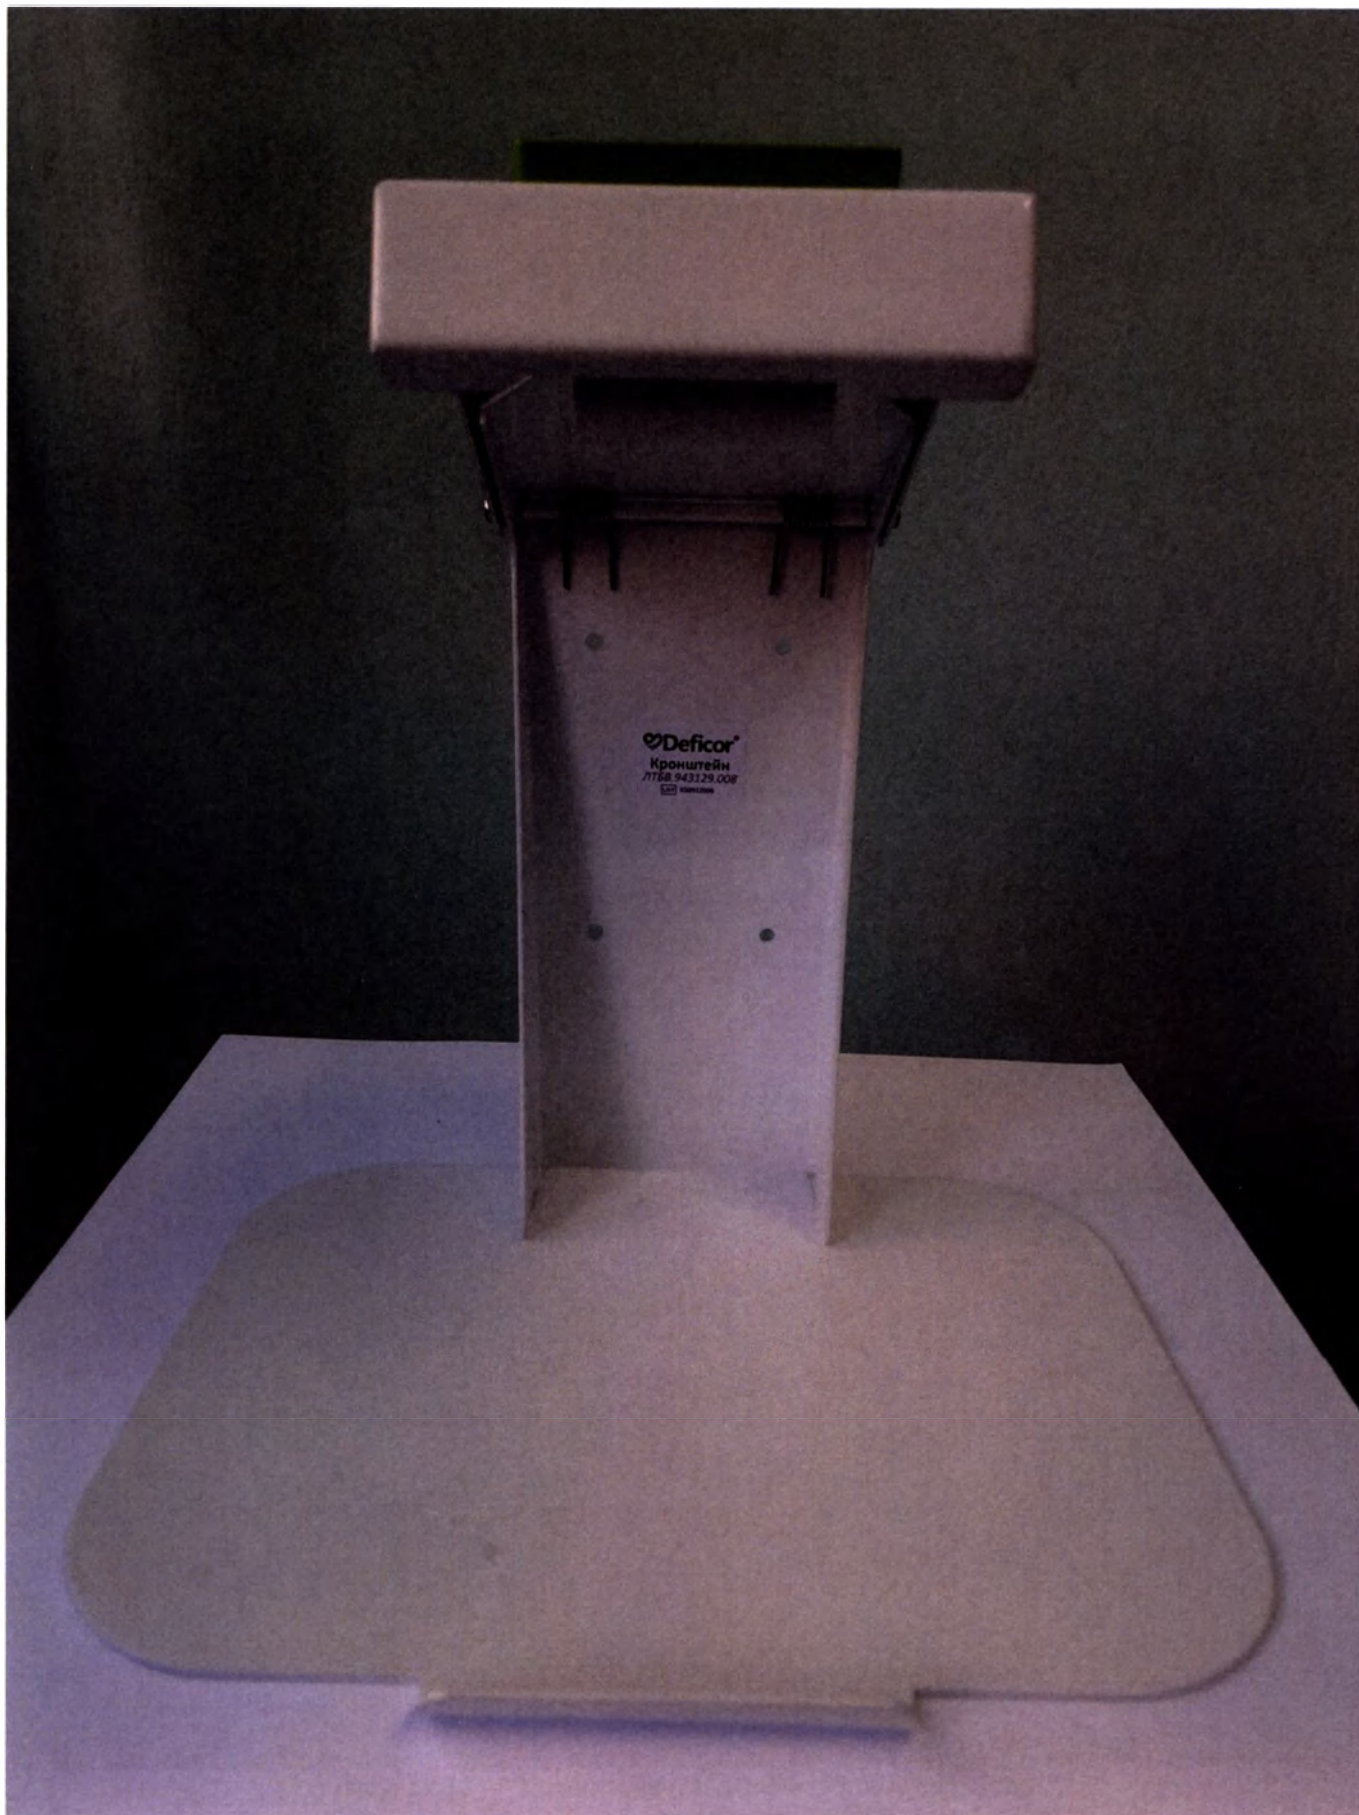


Рисунок 17 — Кронштейн (ЛТБВ.943129.008, вид спереди)



Рисунок 18 — Кронштейн (ЛТБВ.943129.008, вид сбоку)



Рисунок 19 — Ручка для переноски (ЛТБВ.943129.009)



Рисунок 20 — Сумка для переноски (ЛТБВ.943129.010, вид спереди)



Рисунок 21 — Сумка для переноски (ЛТБВ.943129.010, вид сбоку)

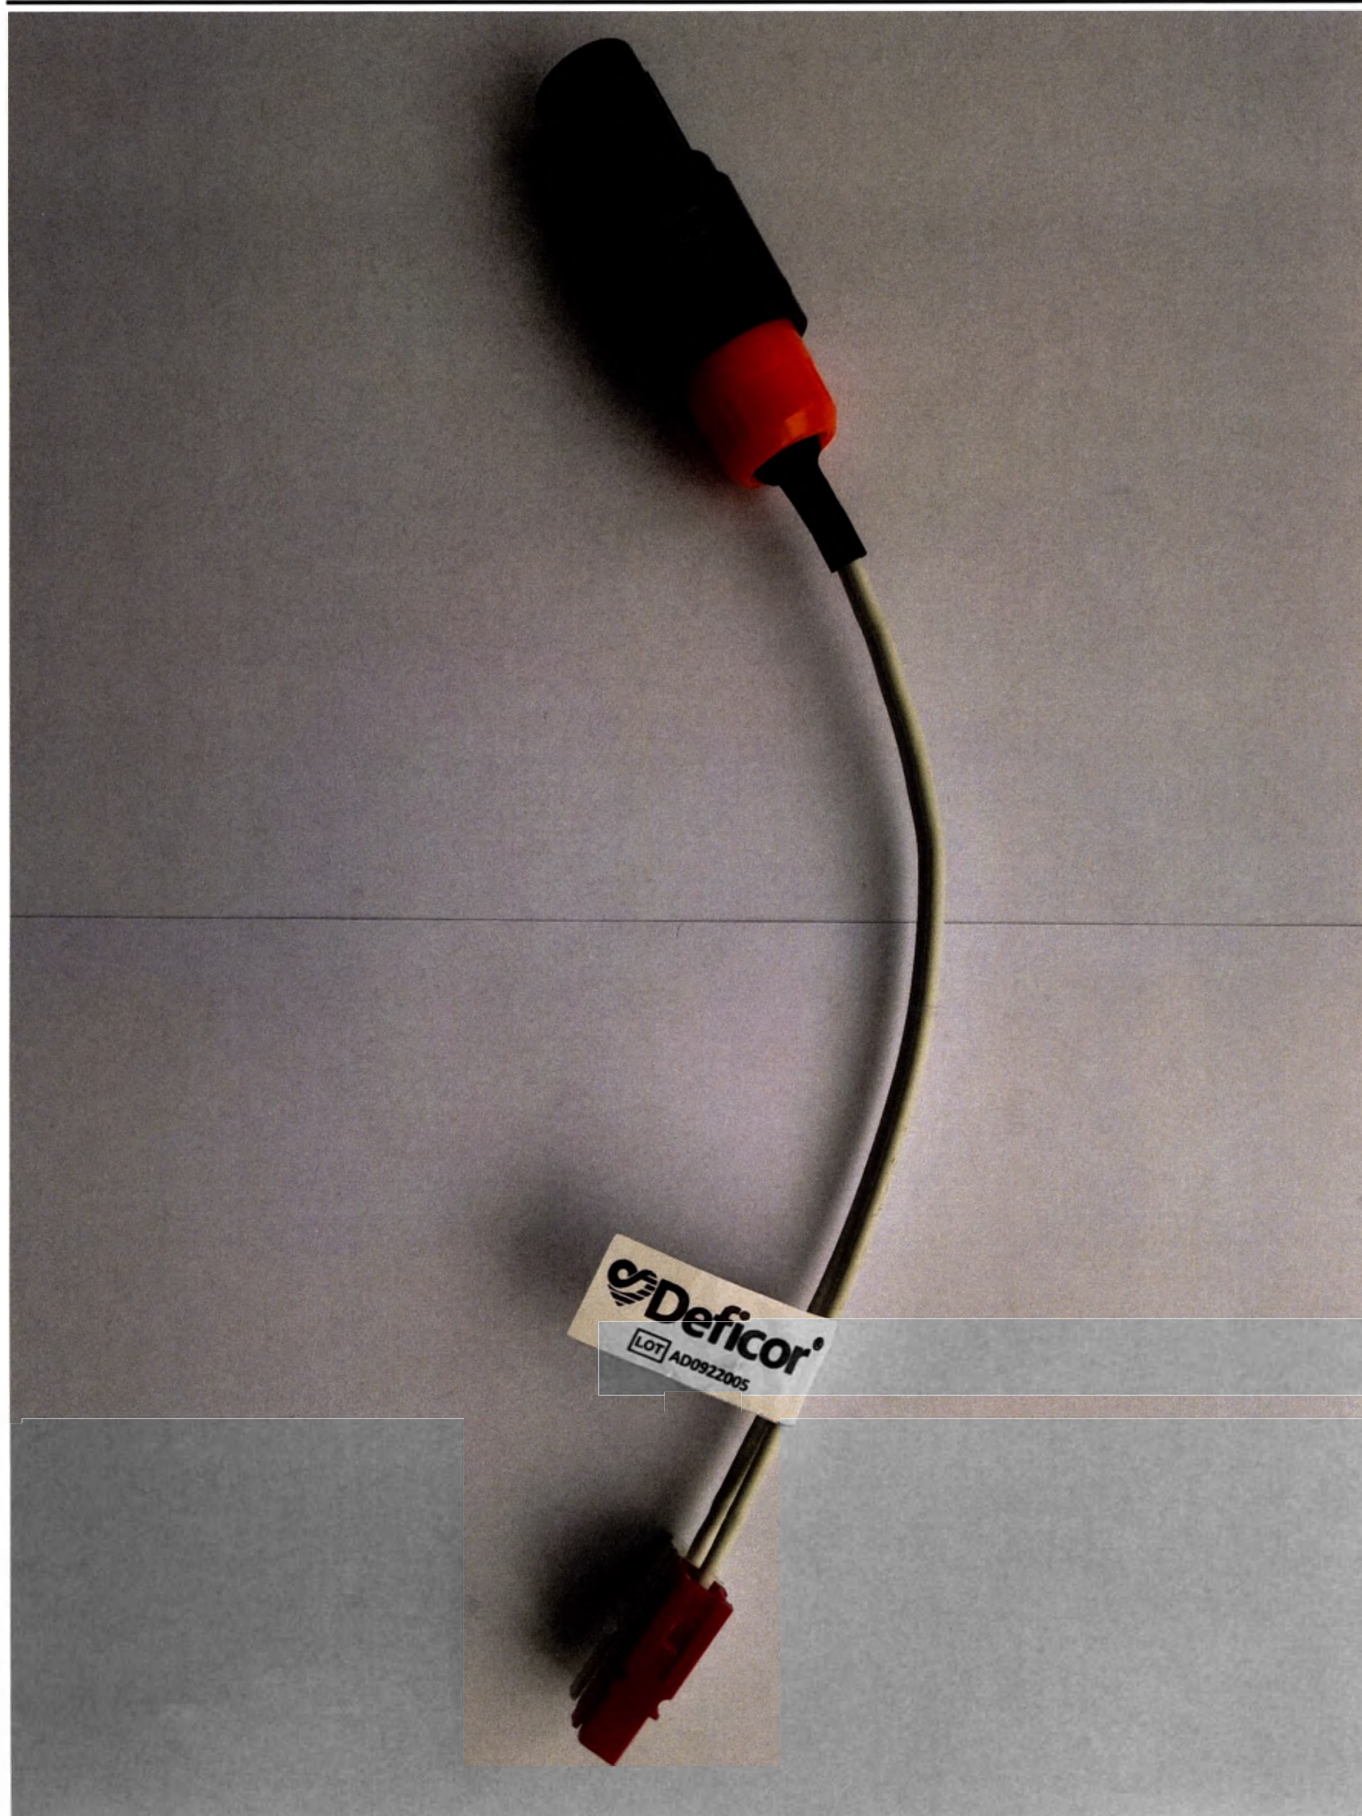


Рисунок 22 — Адаптер для электродов дефибрилляции (ЛТБВ.943129.013)



Рисунок 23 — Карта памяти



Рисунок 24 — Кабель USB

Упаковка



Рисунок 25 — Пример первичной упаковки (основной блок изделия в первичной упаковке)



Рисунок 26 — Потребительская тара

Маркировка

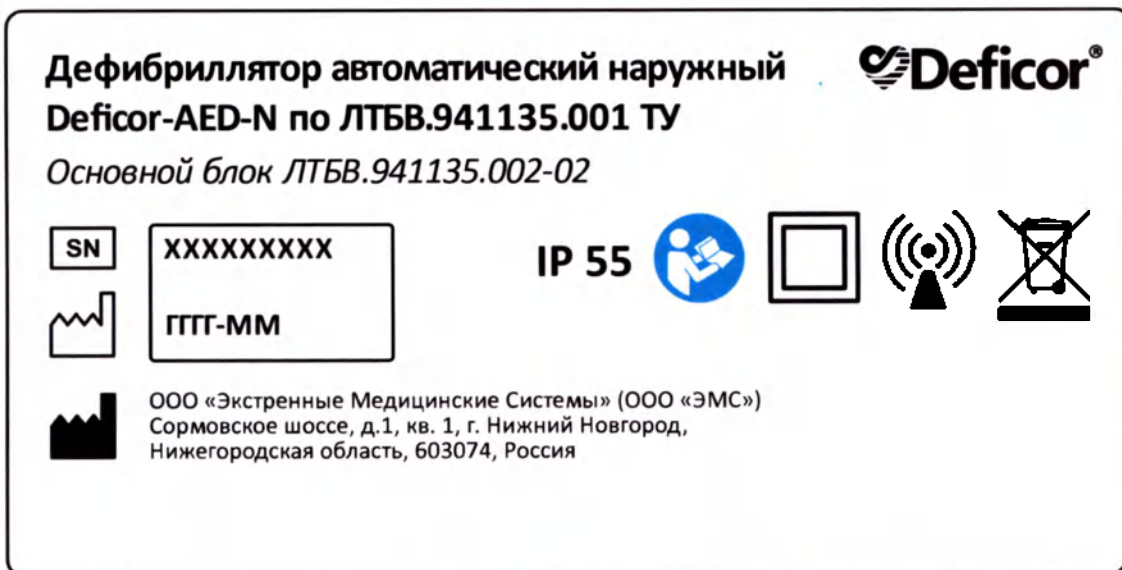


Рисунок 27 — Макет этикетки на задней крышке основного блока (ЛТБВ.941135.002-01)



Рисунок 28 — Макет маркировки электродов дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовых для взрослых (ЛТБВ.943.132.002)



Рисунок 29 — Макет маркировки электродов дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовых для детей (ЛТБВ.943.132.003)

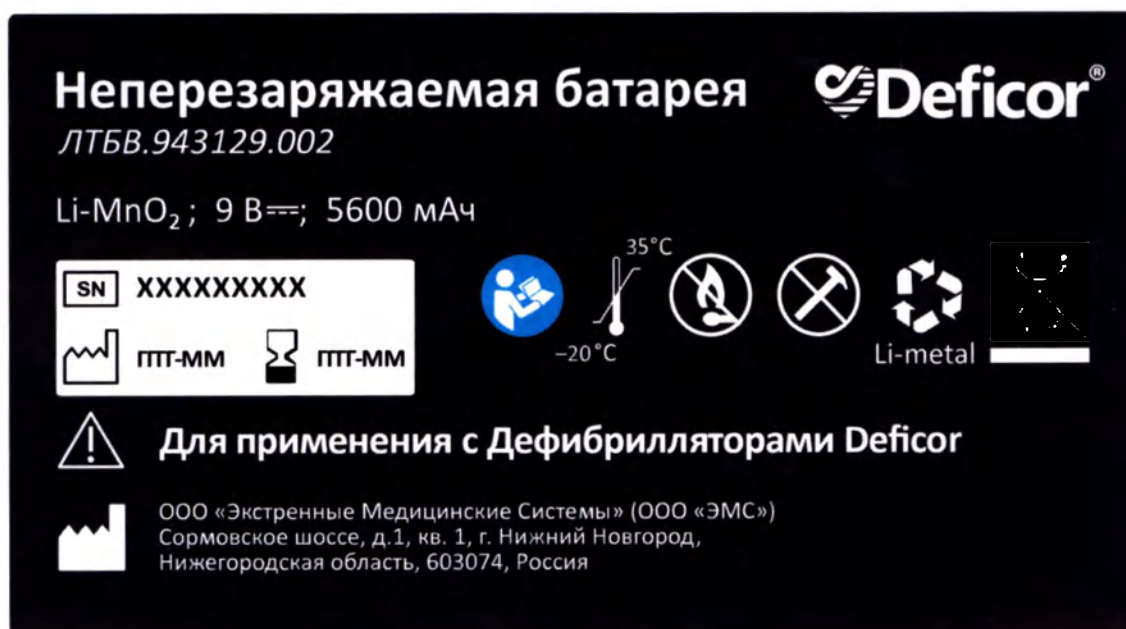


Рисунок 30 — Макет маркировки неперезаряжаемой батареи (ЛТБВ.943129.002)

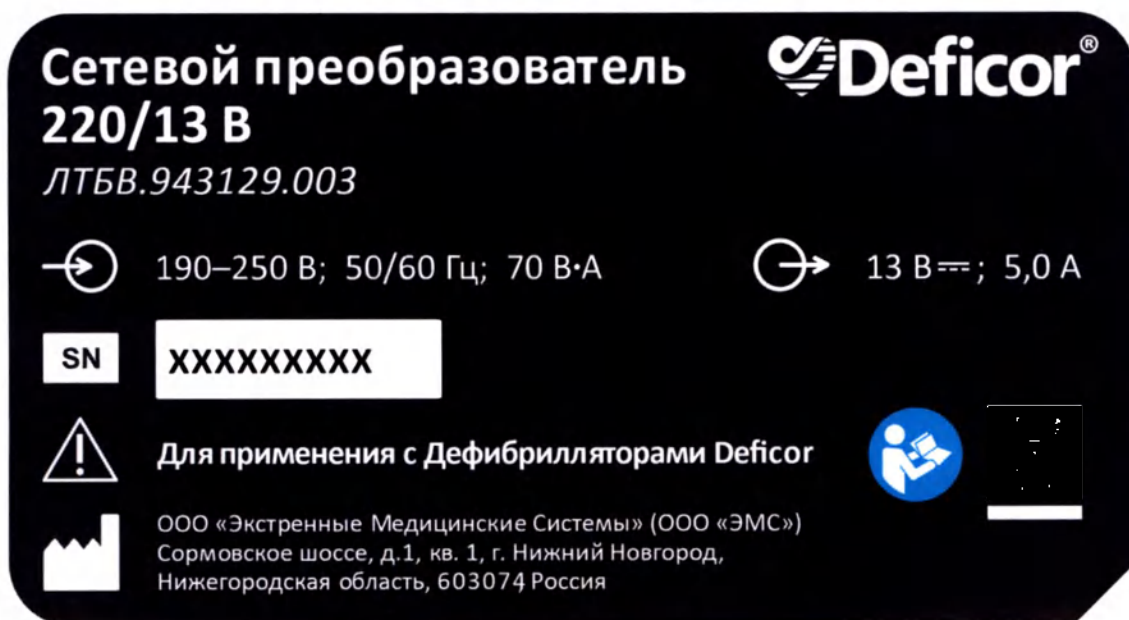


Рисунок 31 — Макет маркировки сетевого преобразователя 220/13 В (ЛТБВ.943129.003)

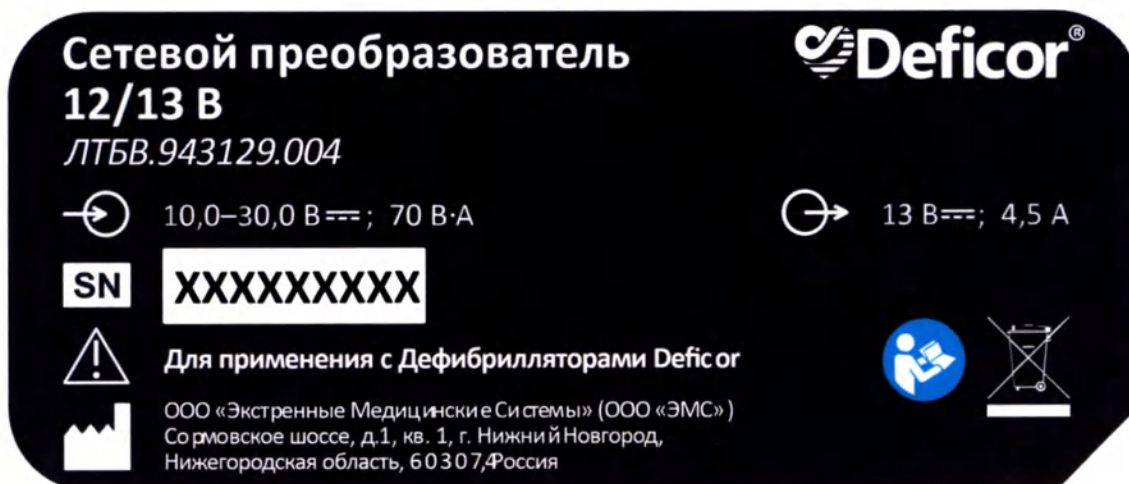


Рисунок 32 — Макет маркировки сетевого преобразователя 12/13 В (ЛТБВ.943129.004)

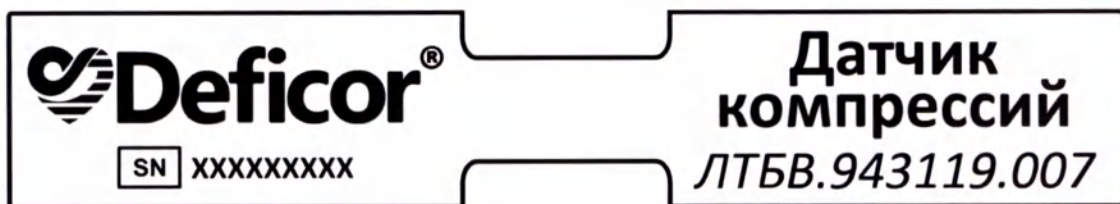


Рисунок 33 — Макет маркировки датчика компрессионный (ЛТБВ.943119.007)



Рисунок 34 — Макет маркировки кронштейна (ЛТБВ.943129.008)



Рисунок 35 — Макет маркировки ручки для переноски (ЛТБВ.943129.009)



Рисунок 36 — Макет маркировки сумки для переноски (ЛТБВ.943129.010)

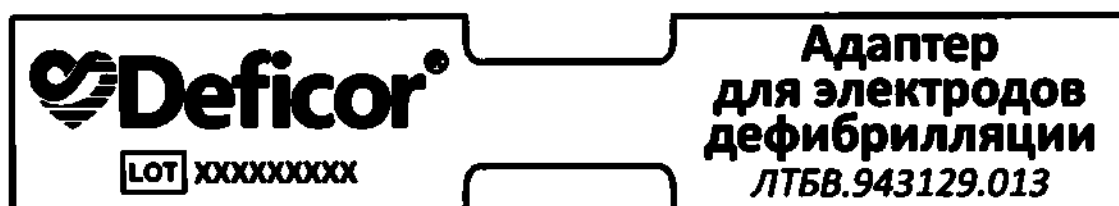


Рисунок 37 — Макет маркировки адаптера для электродов дефибрилляции (ЛТБВ.943129.013)

Дефибриллятор автоматический наружный
Deficor-AED-N по ЛТБВ.941135.001 ТУ



SN

XXXXXXXXXX



ГГГГ-ММ

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.

Хранить и транспортировать
при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С
и влажности до 100 % при 25 °С.



ООО «Экстренные Медицинские Системы» (ООО «ЭМС»)
Сормовское шоссе, д.1, кв. 1, г. Нижний Новгород,
Нижегородская область, 603074, Россия

Рисунок 38 — Макет маркировки потребительской тары

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

33 (Индивидуальное) листов

Должность Секретарь

Подпись А. И. Рогозин

"28" февраля 2024 г. М.П.

