

Фотографические изображения образца (образцов) медицинского изделия «Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022», принадлежностей и его (их) маркировки

Фото 1. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Потребительская упаковка.

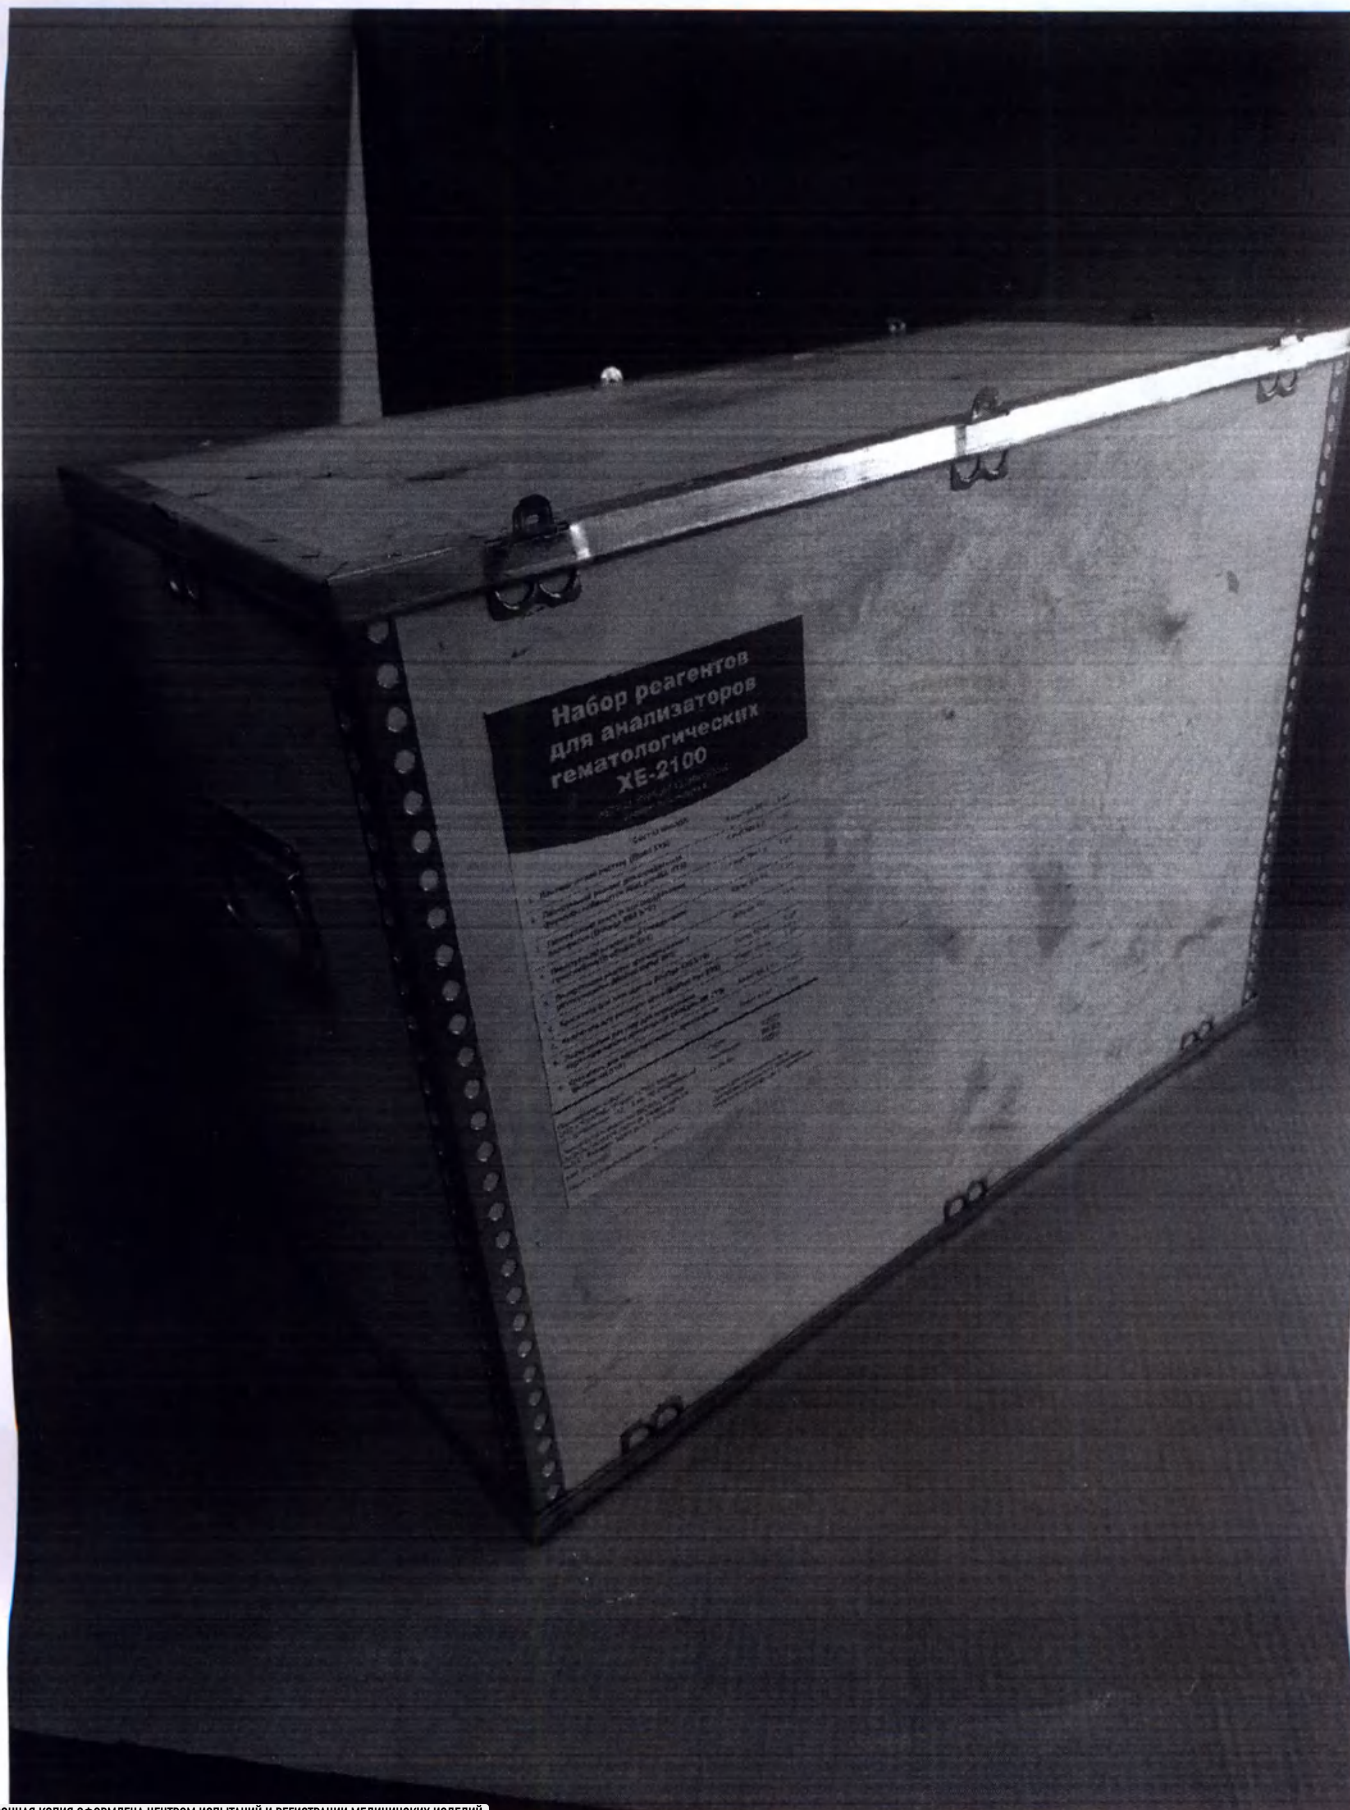


Фото 2. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Состав набора.

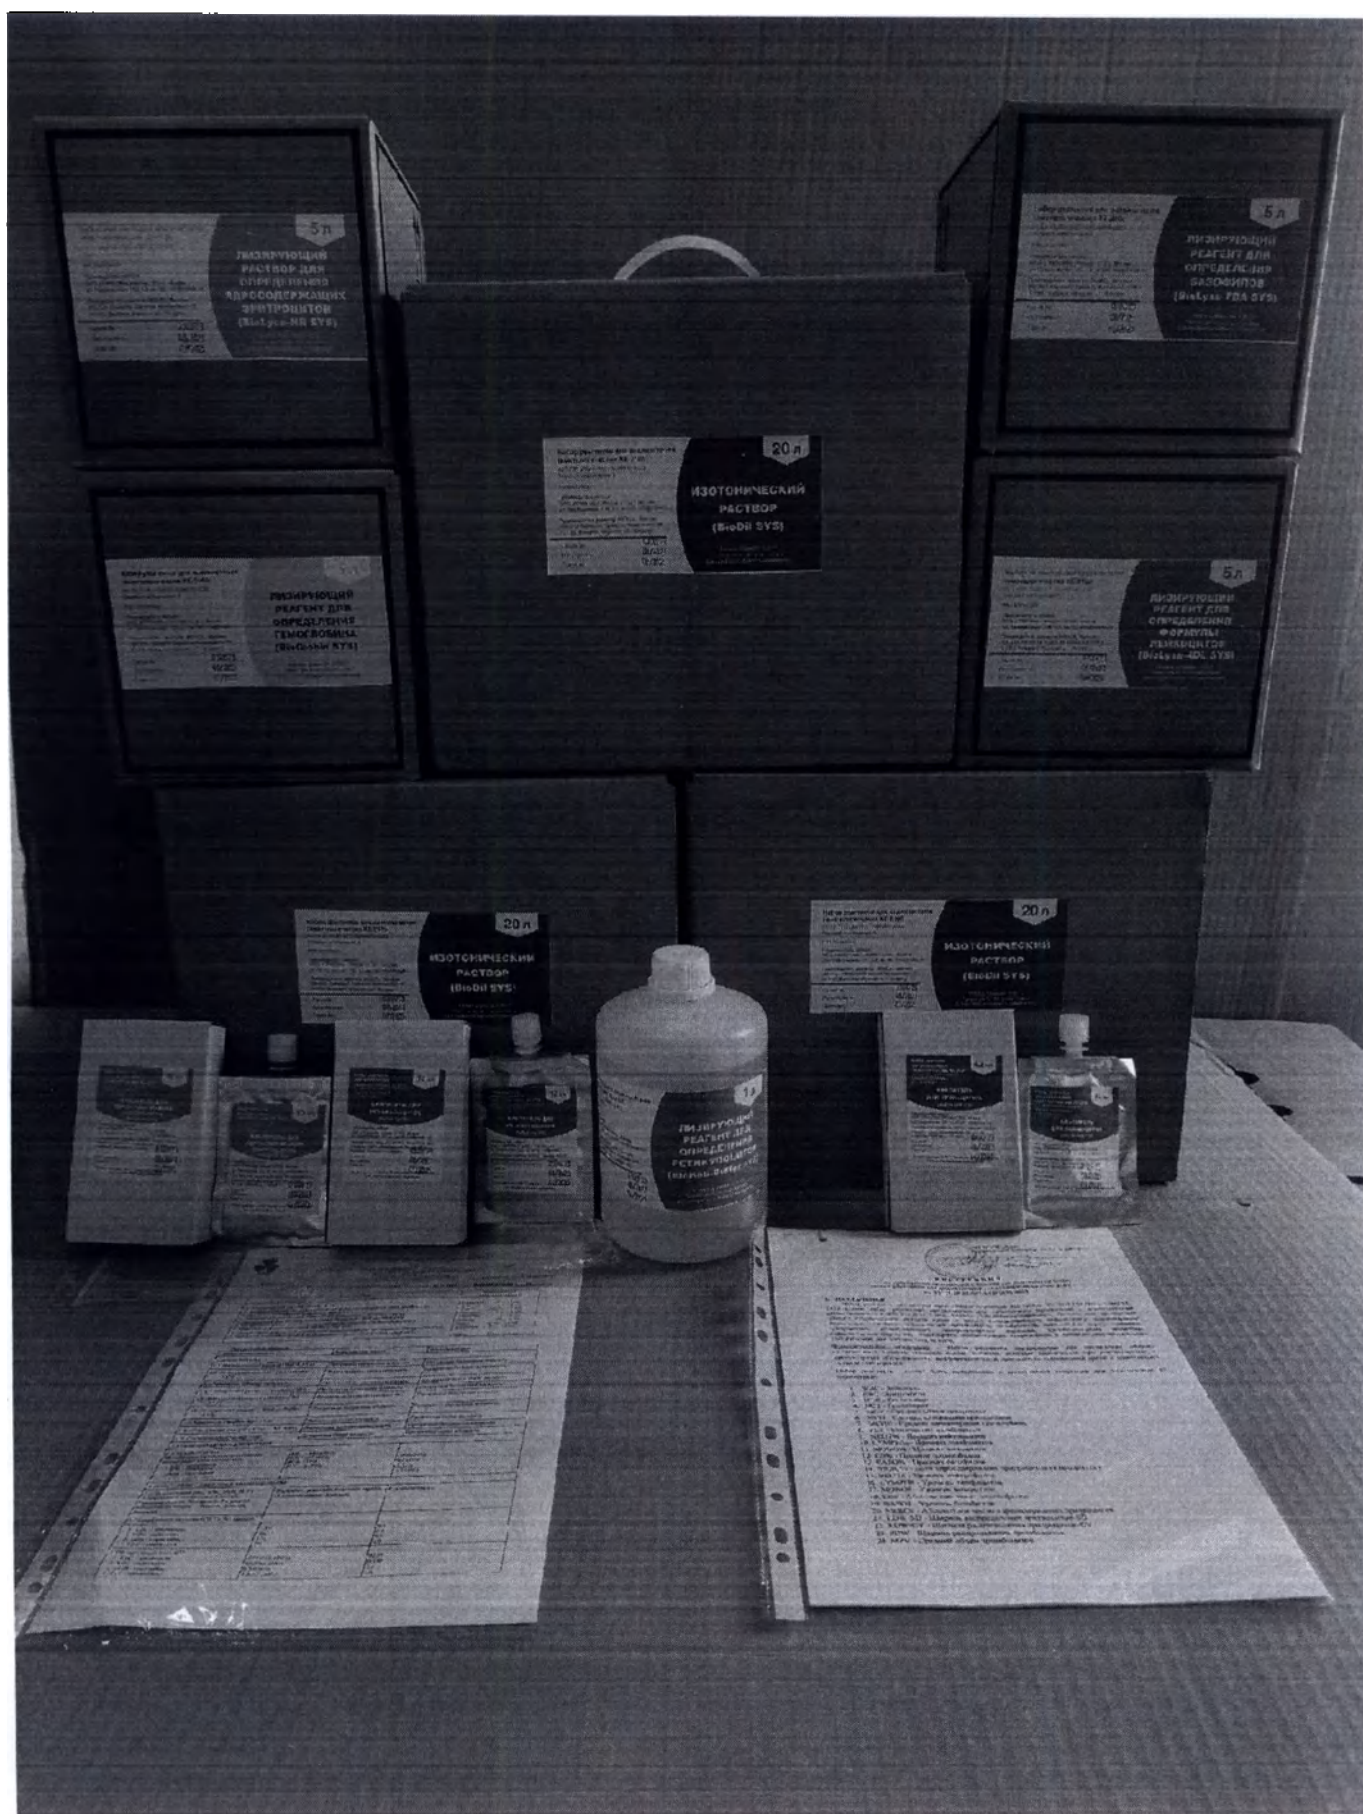


Фото 3. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Изотонический раствор (BioDil-SYS)



Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100
по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022
Вариант исполнения А

20 л

**ИЗОТОНИЧЕСКИЙ
РАСТВОР
(BioDil SYS)**

Предназначен набор:
ООО «ЦИРМИ» (Россия, 117321, Москва,
ул. Ярославская, 152, к.3, кв.152) (info@cirmi.ru)

Применяется реагент в БСКОЛ, в котором
(включая реагент Свободный в М-1150, Водород, Метасил и 1. Метасил)

Серия №: 0300723
История: 08/2023
Год: 02/2025

ИМЕЮТ ВРЕМЯ 2-3 лет
После и до истечения срока
для хранения, хранения, хранения

Фото 4. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения формулы лейкоцитов (BioLyse-4DL SYS)



Фото 5. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Краситель для лейкоцитов (BioDye-4DS SYS)

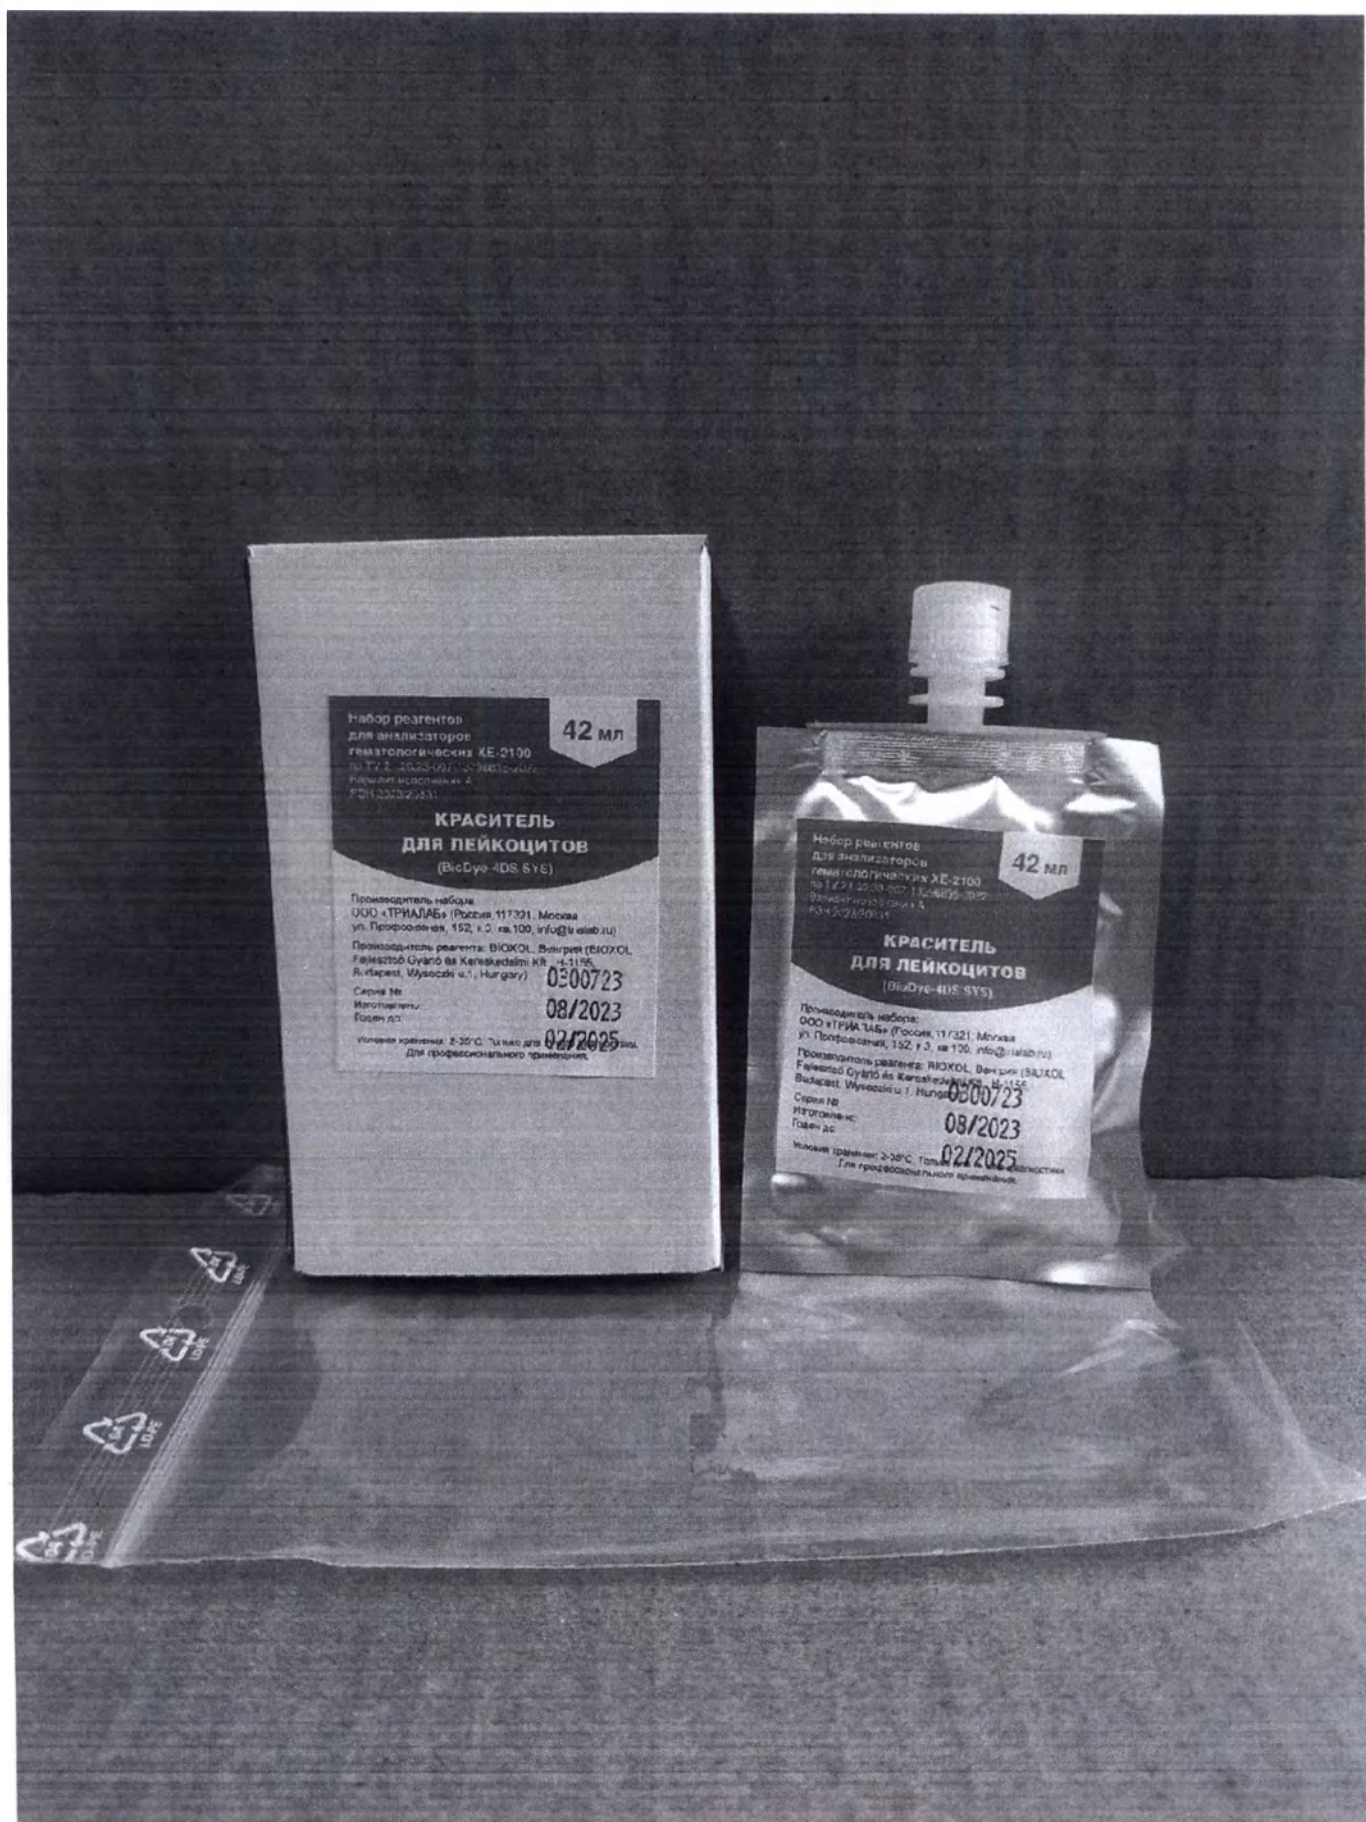


Фото 6. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022.
Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения гемоглобина (BioGlobin SYS)

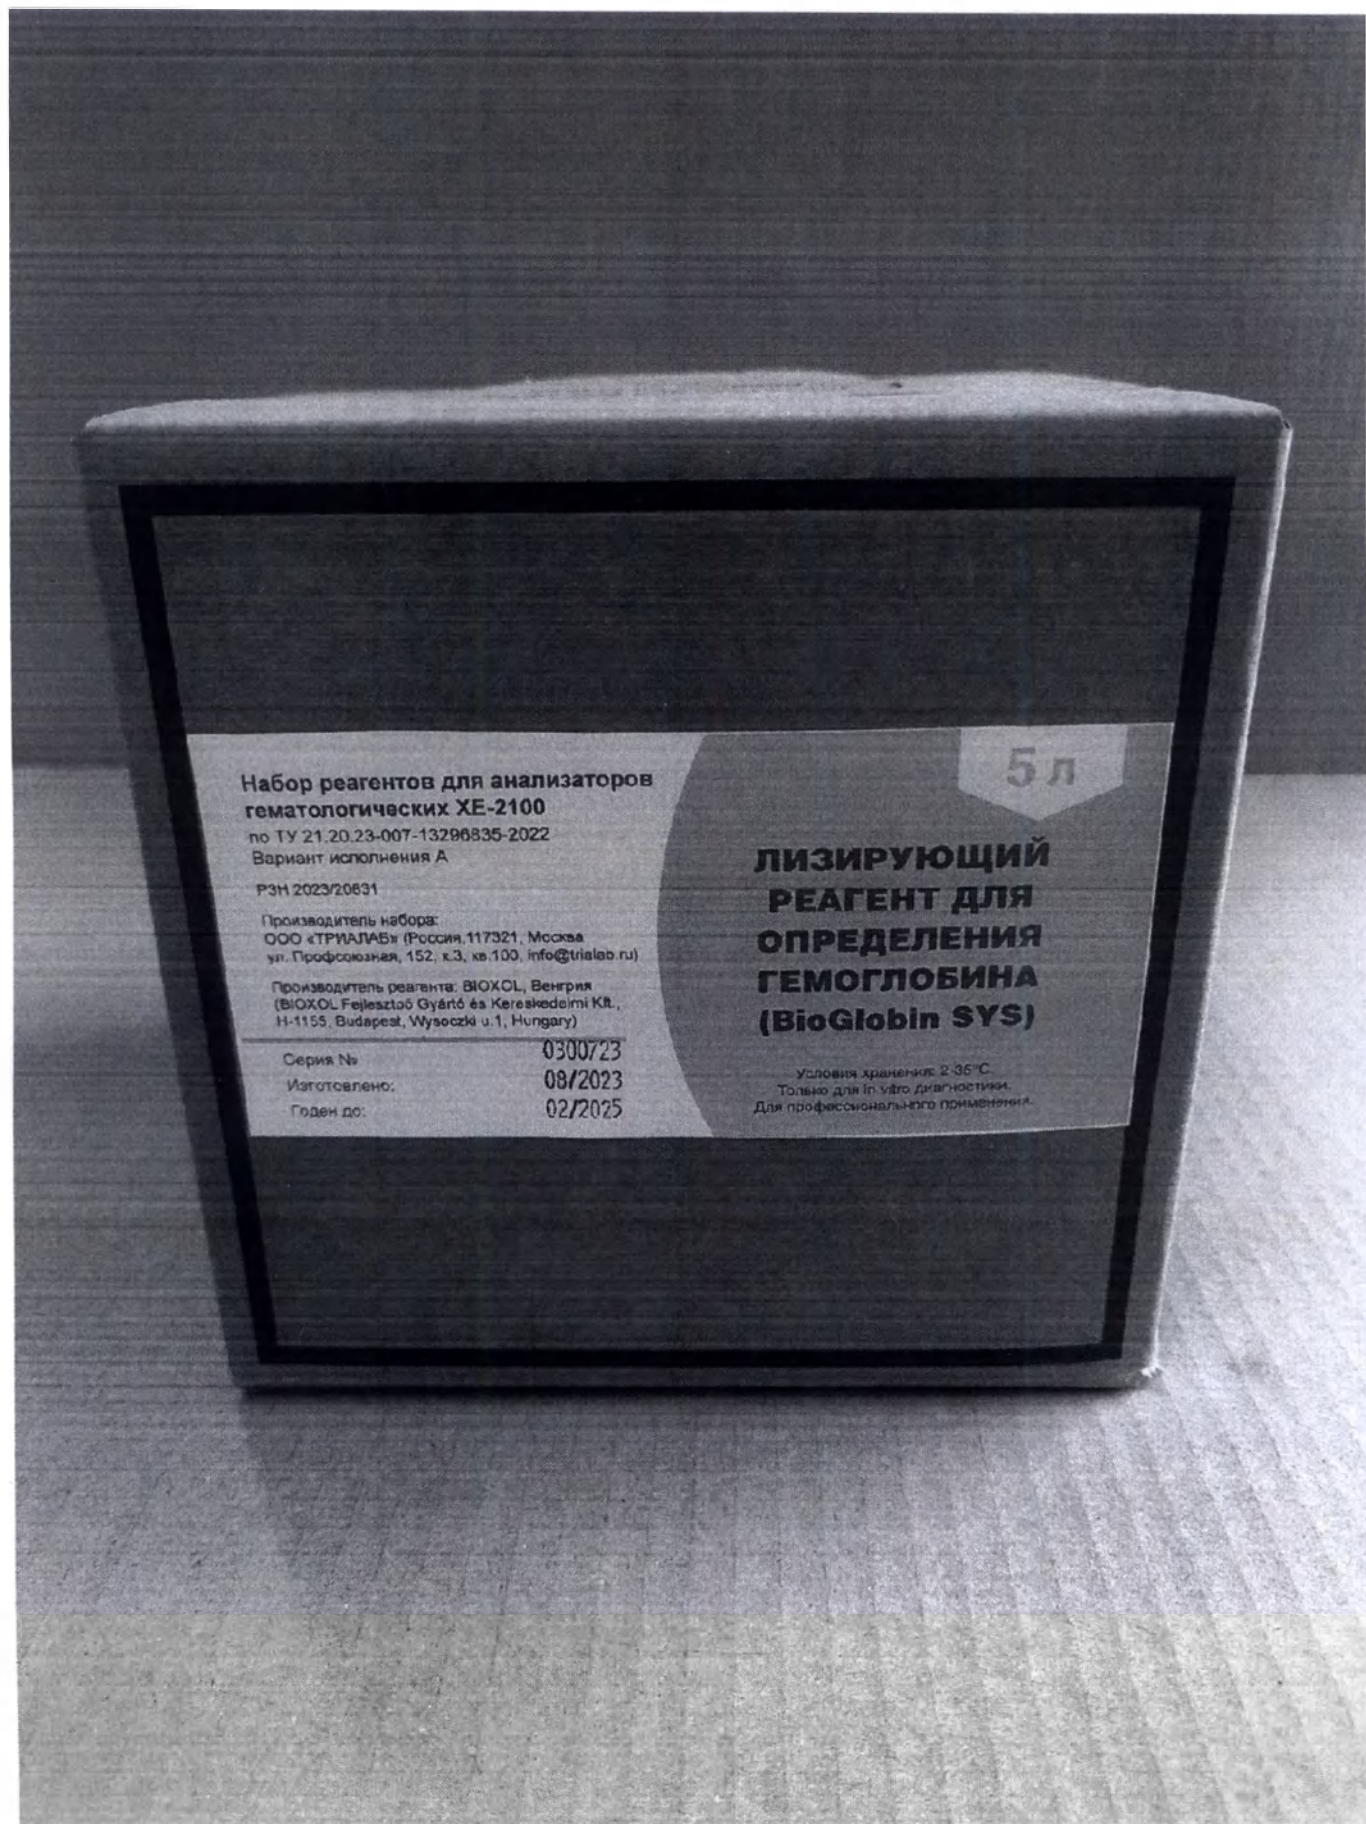


Фото 7. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения базофилов (BioLyse-FBA SYS)

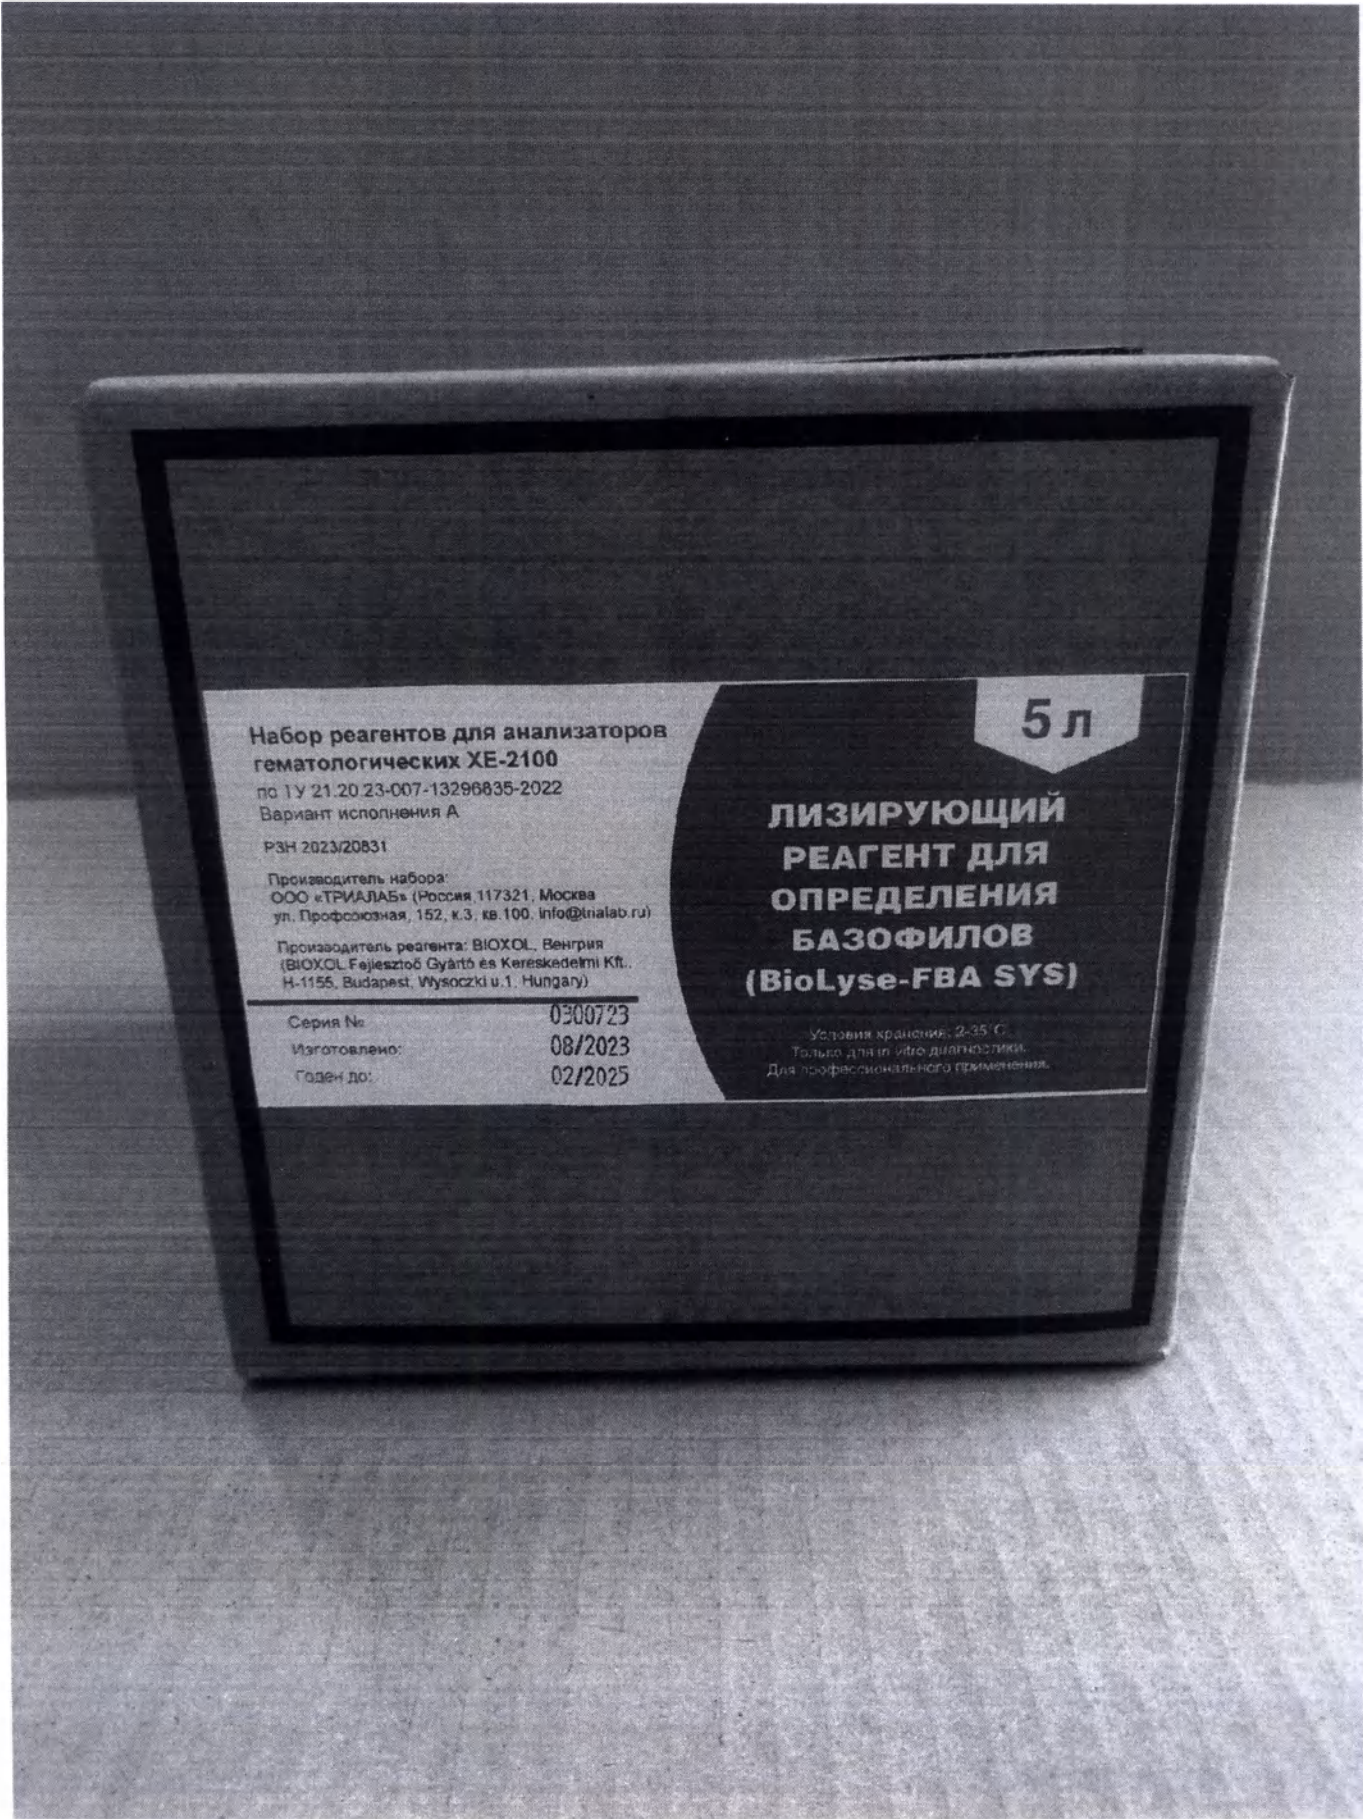


Фото 8. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022.
Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения ретикулоцитов (BioReti-Buffer SYS)

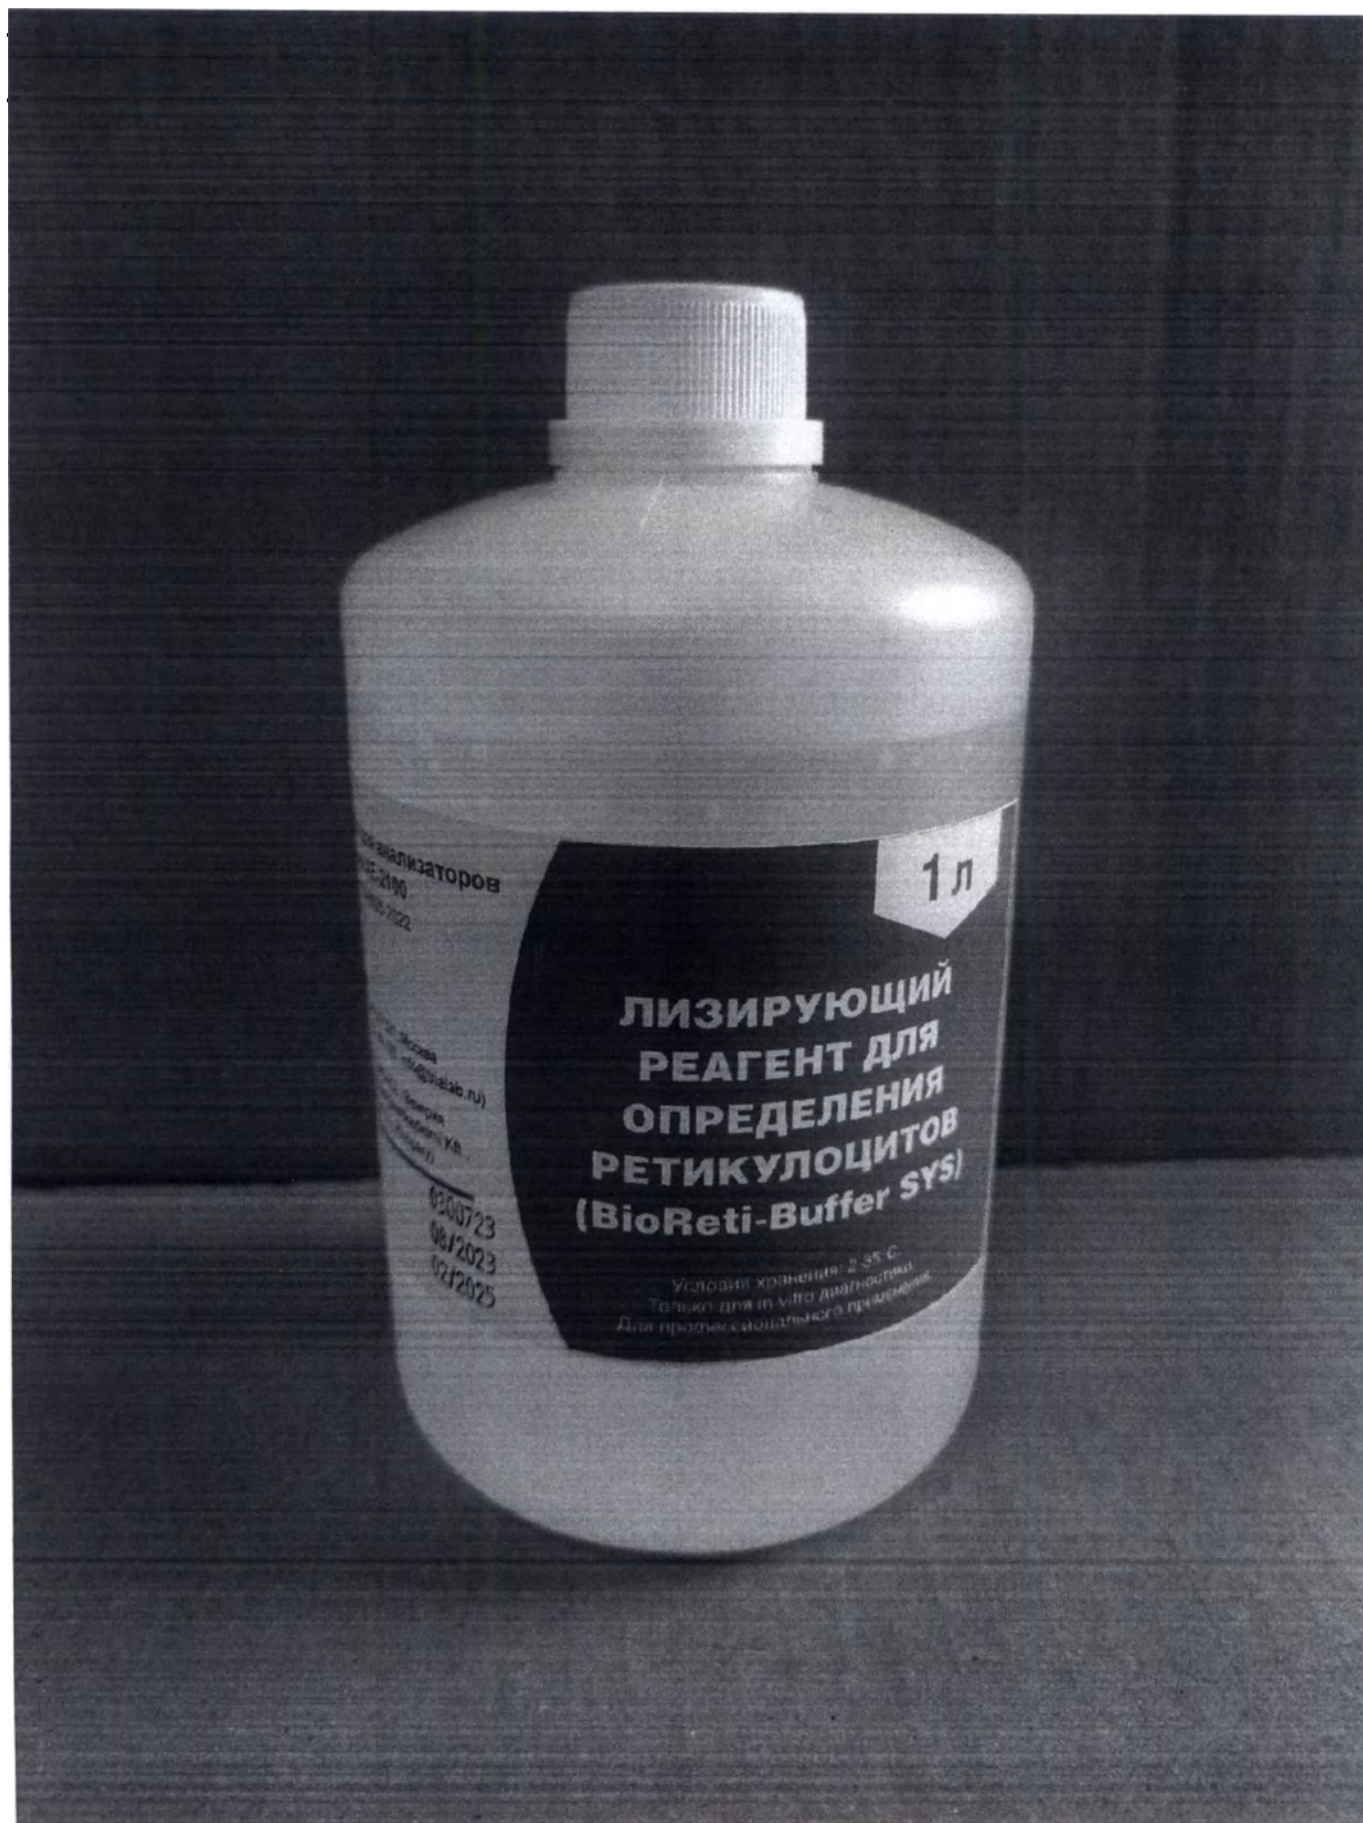


Фото 9. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Краситель для ретикулоцитов (BioReti-Dye SYS)

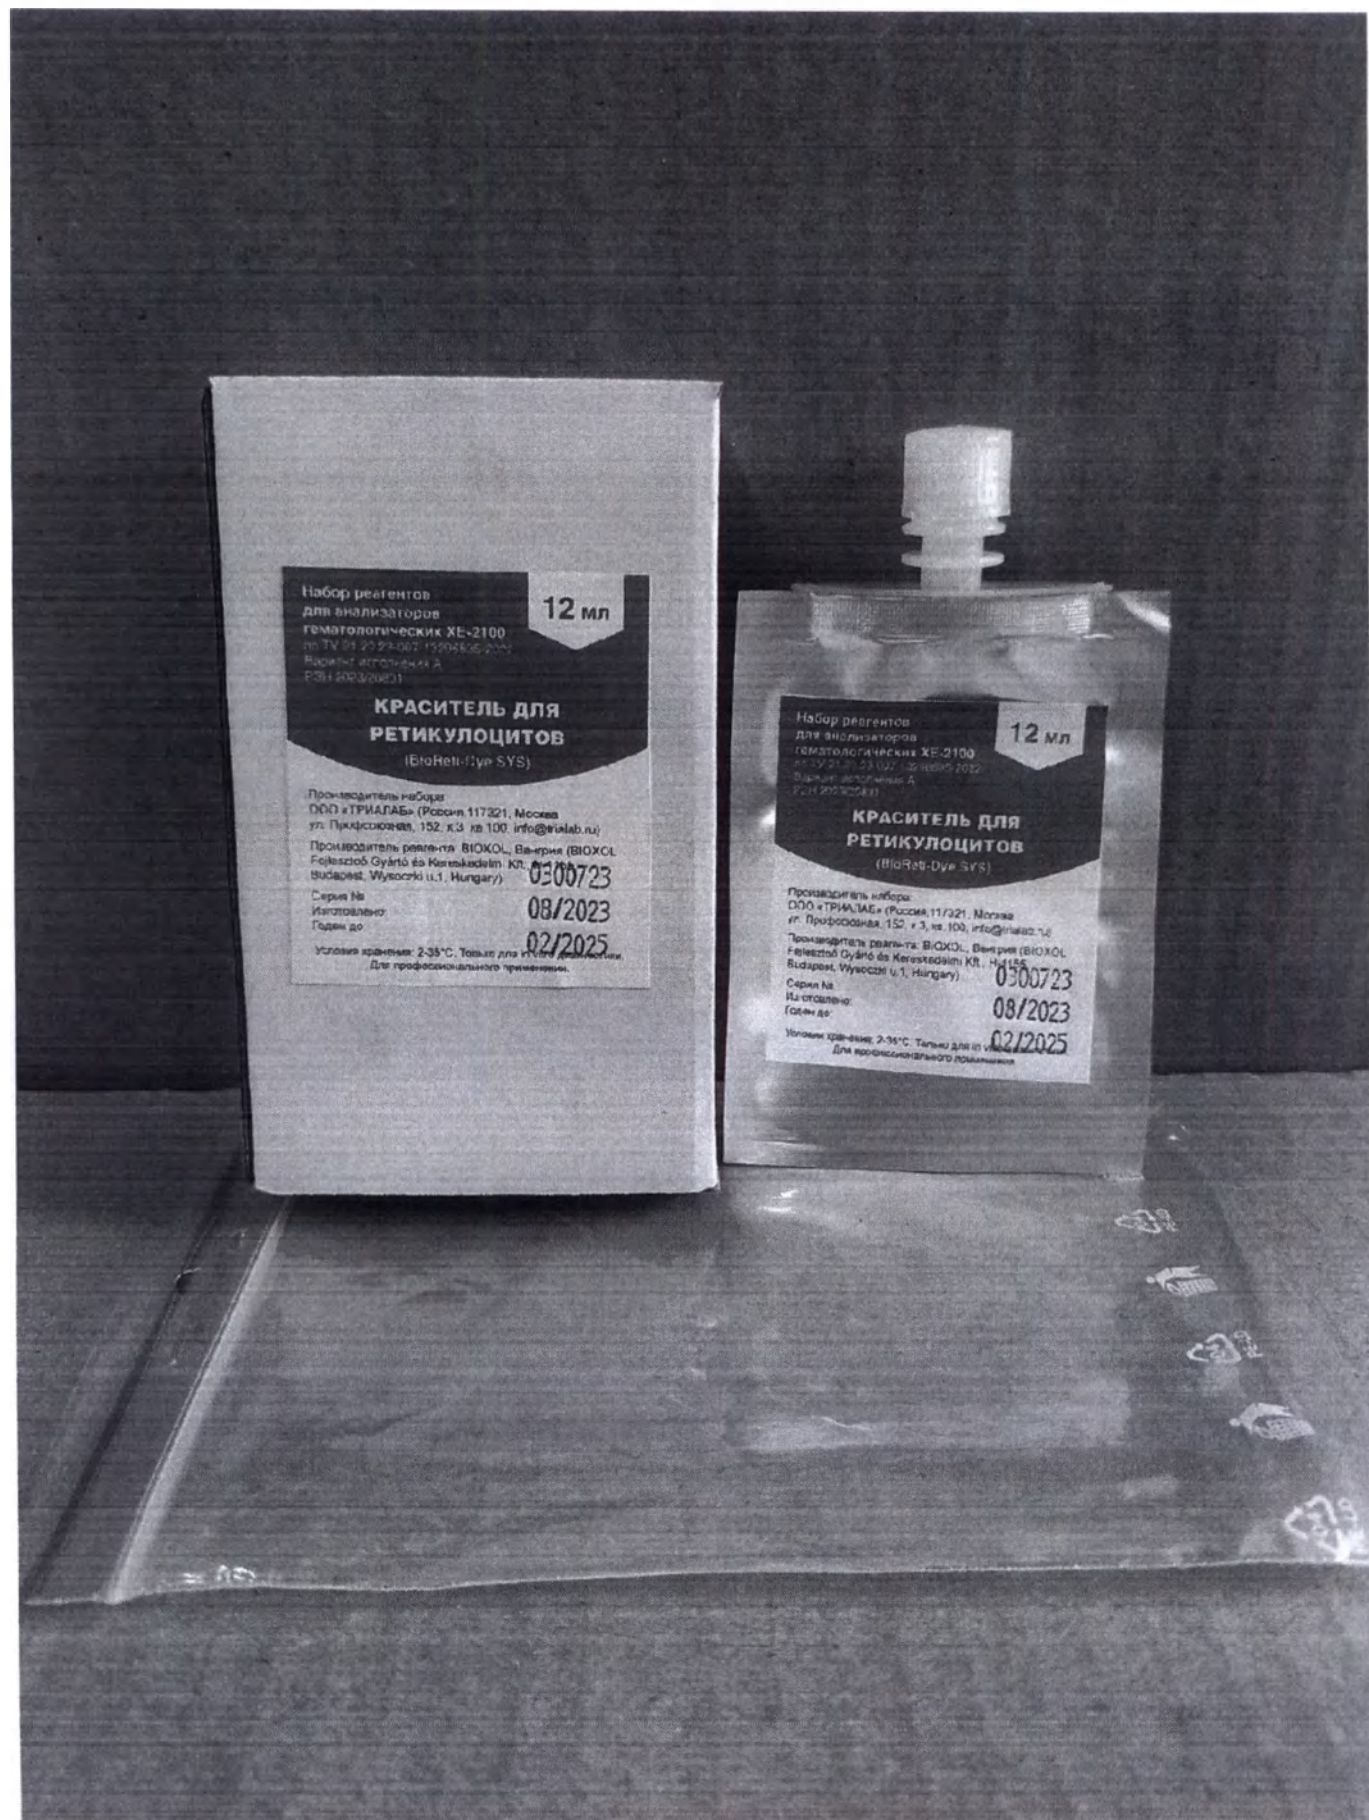


Фото 10. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения ядросодержащих эритроцитов (BioLyse-NR SYS)



Фото 11. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Краситель для ядросодержащих эритроцитов (BioDye-NR SYS)



Фото 12. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Потребительская упаковка.

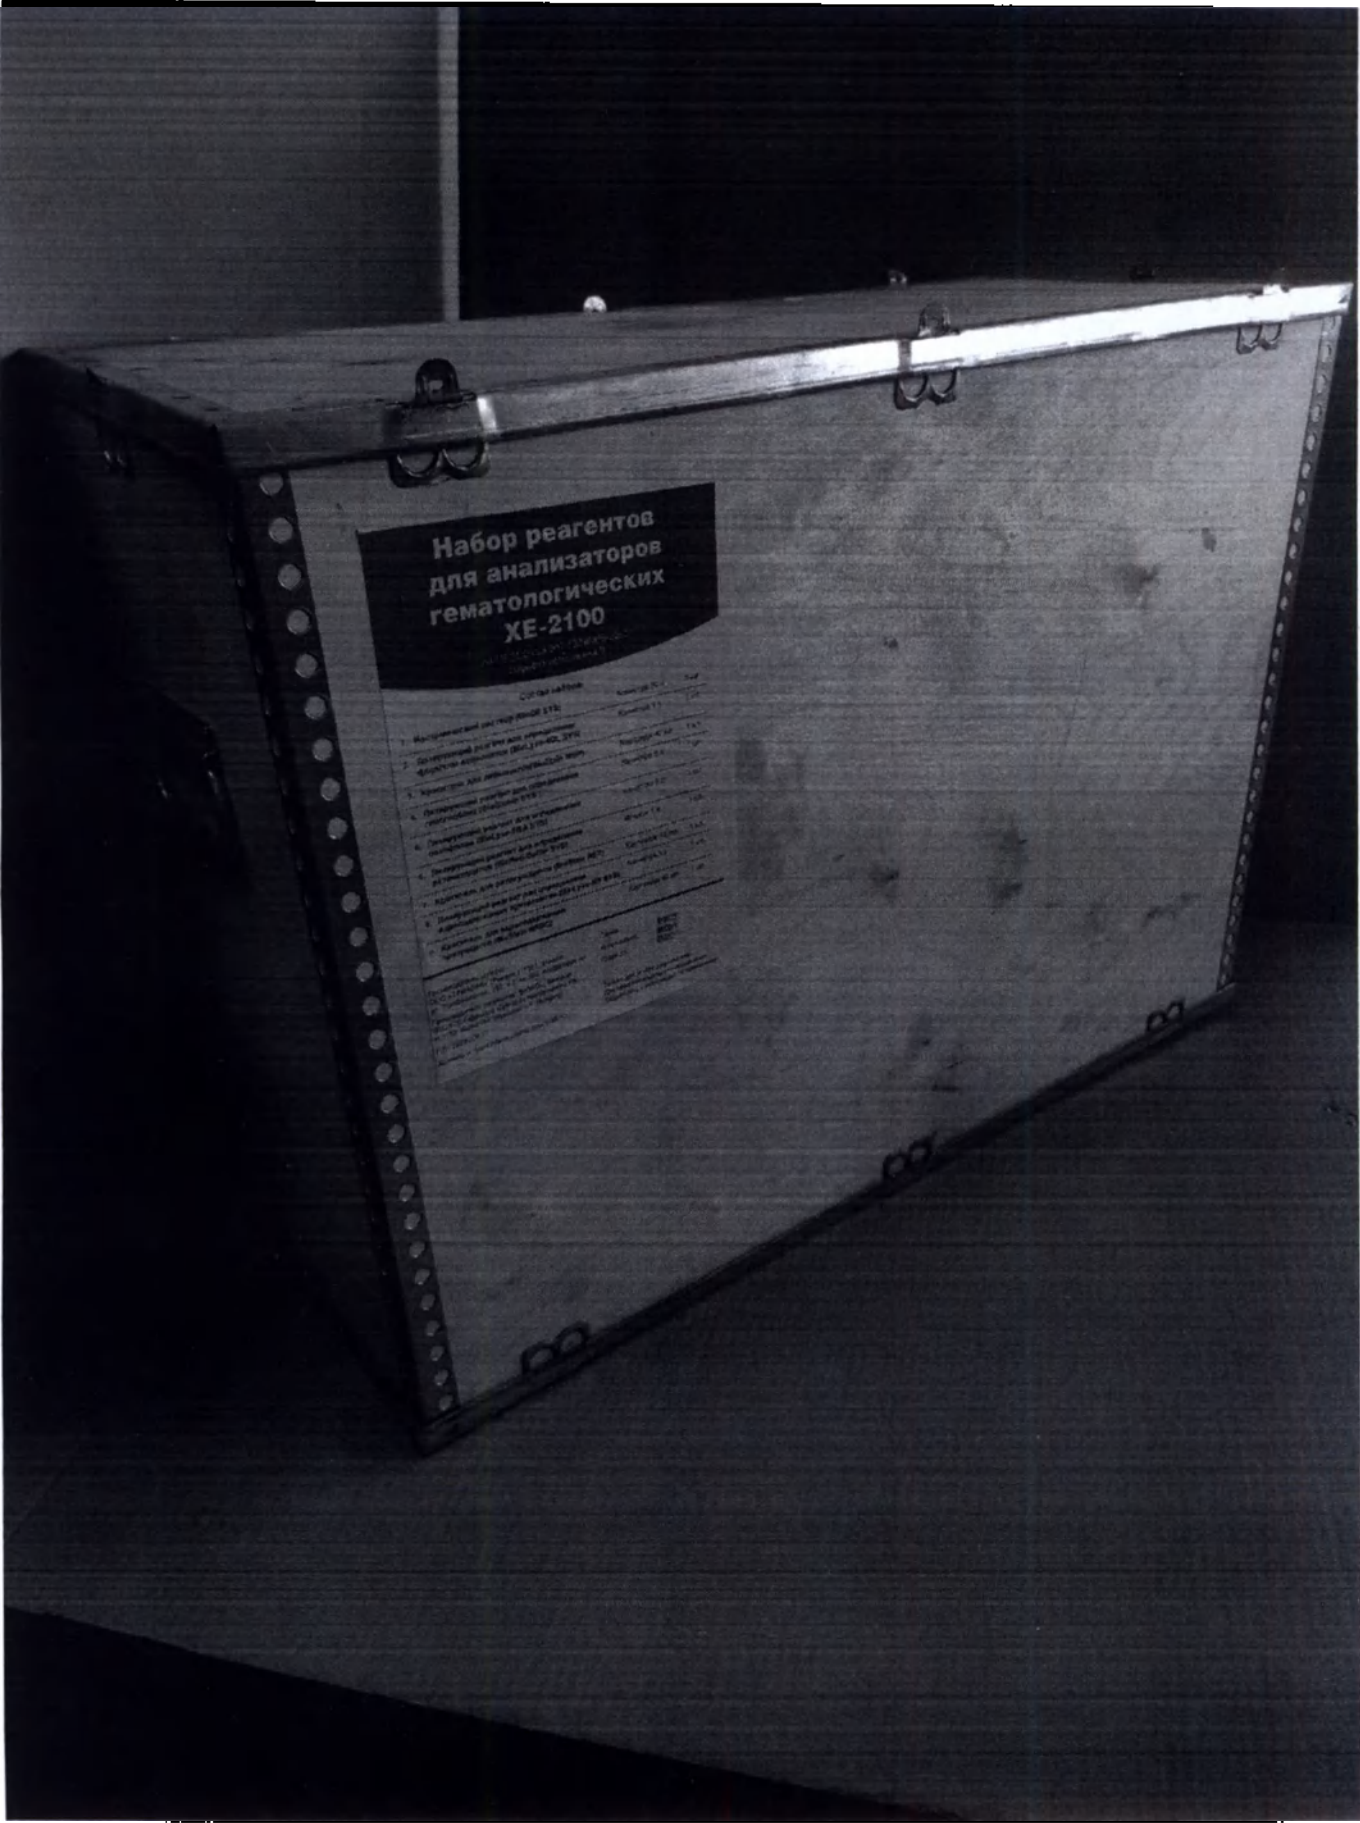


Фото 13. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Состав набора.

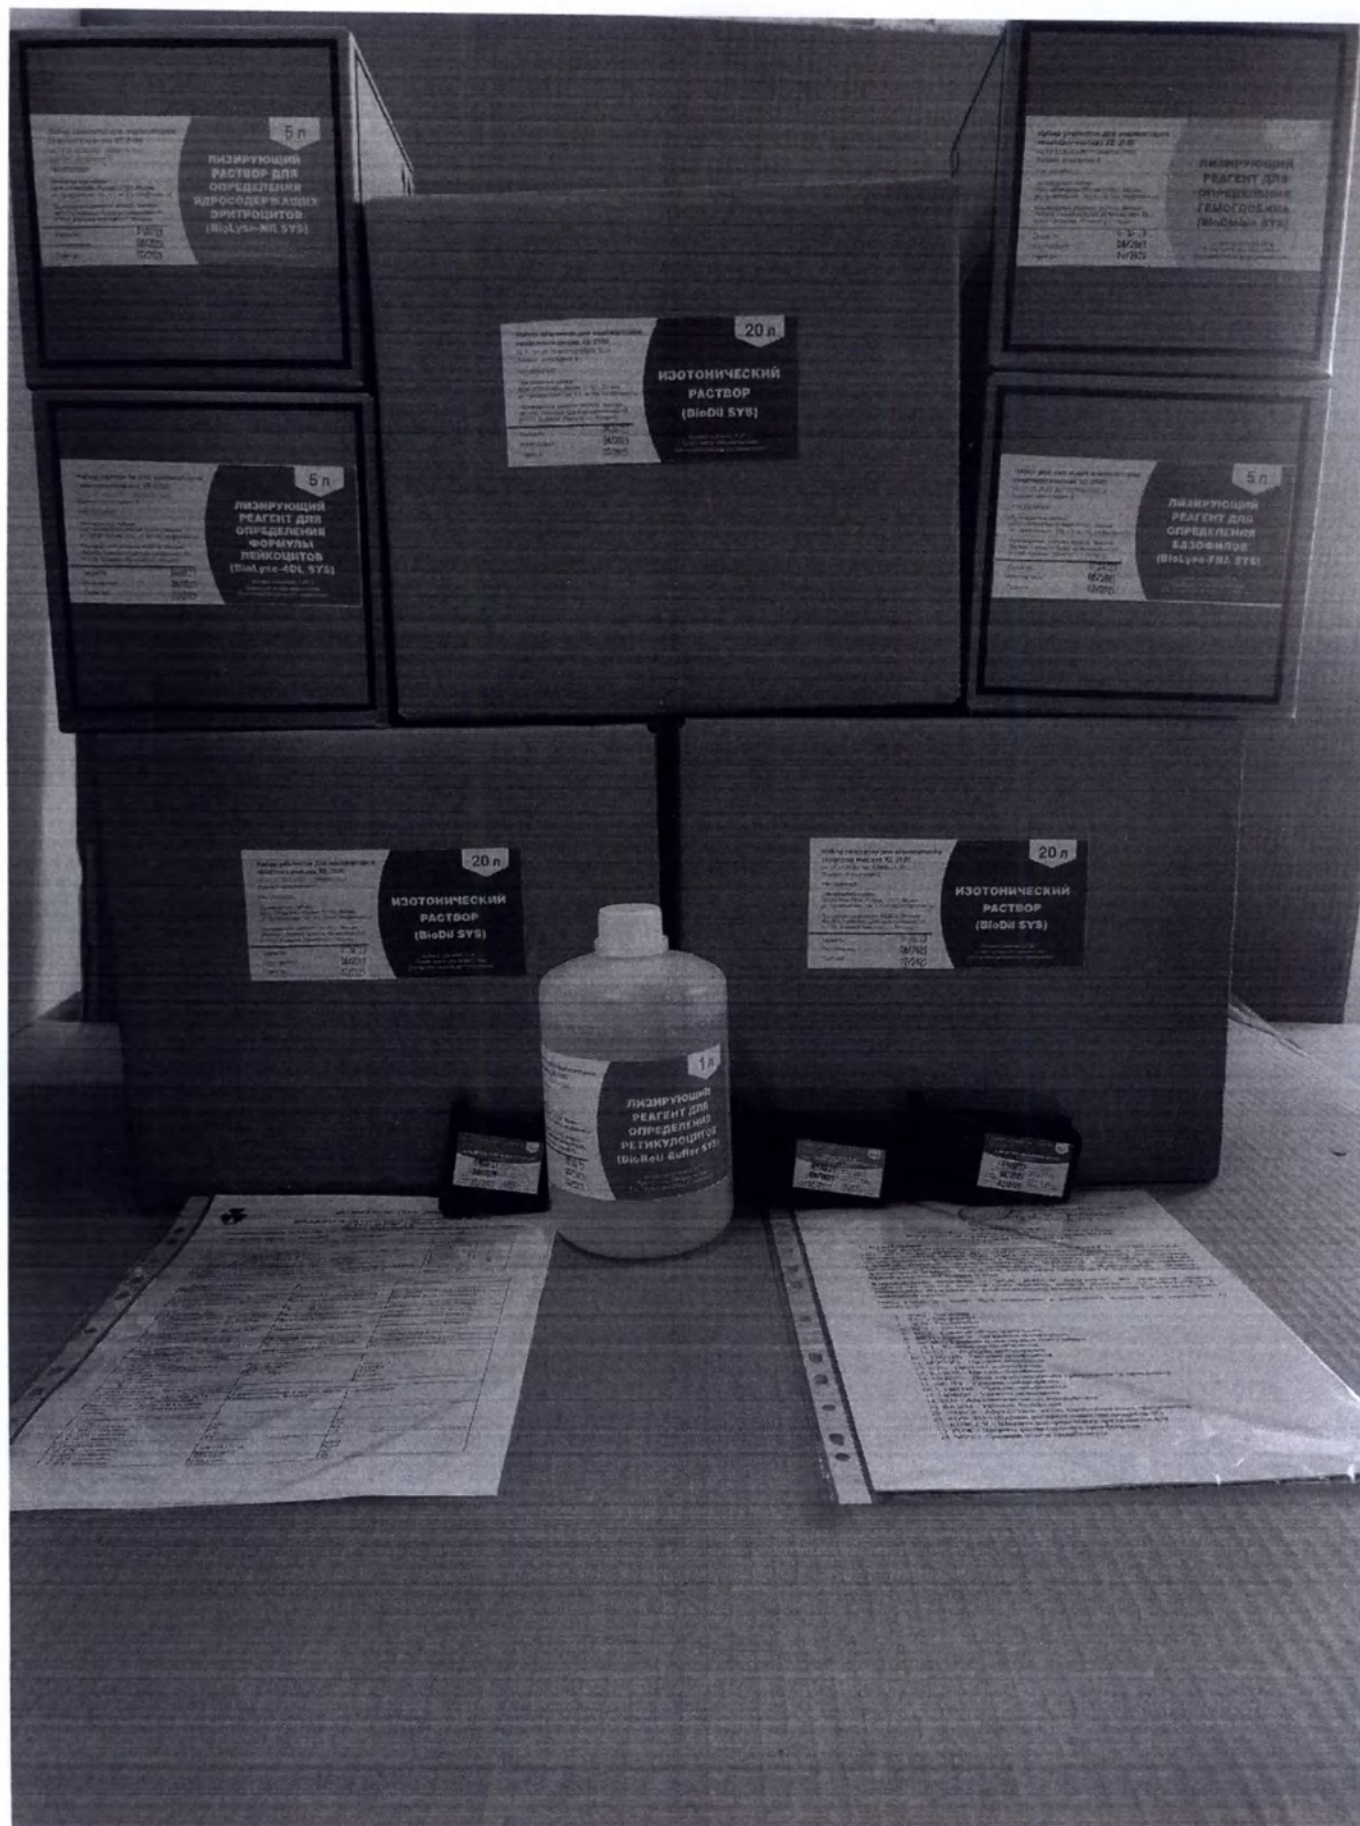


Фото 14. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Изотонический раствор (BioDil-SYS)



Фото 15. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения формулы лейкоцитов (BioLyse-4DL SYS)

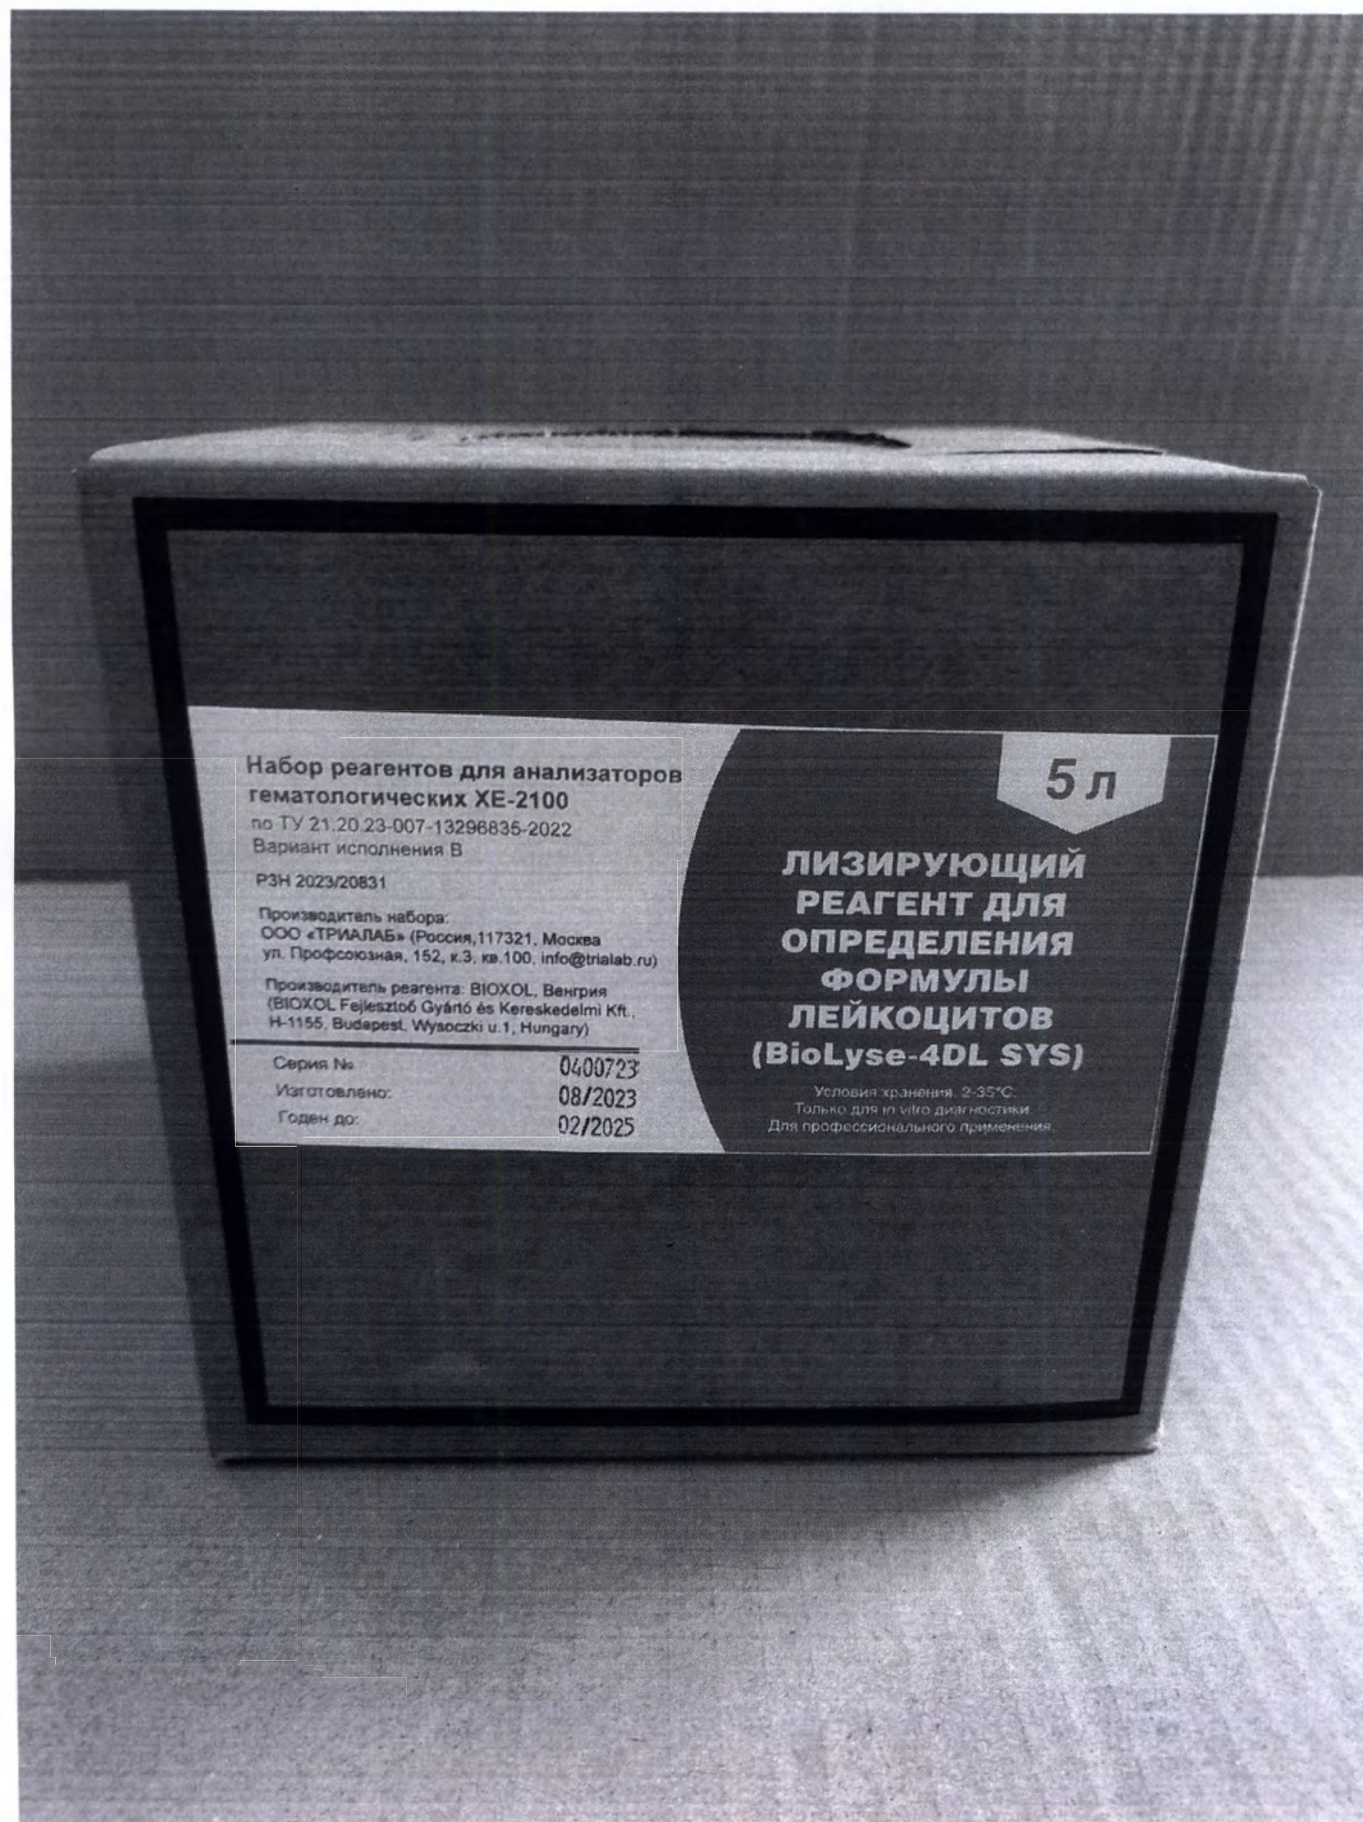


Фото 16. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Краситель для лейкоцитов(BioStain W5P)


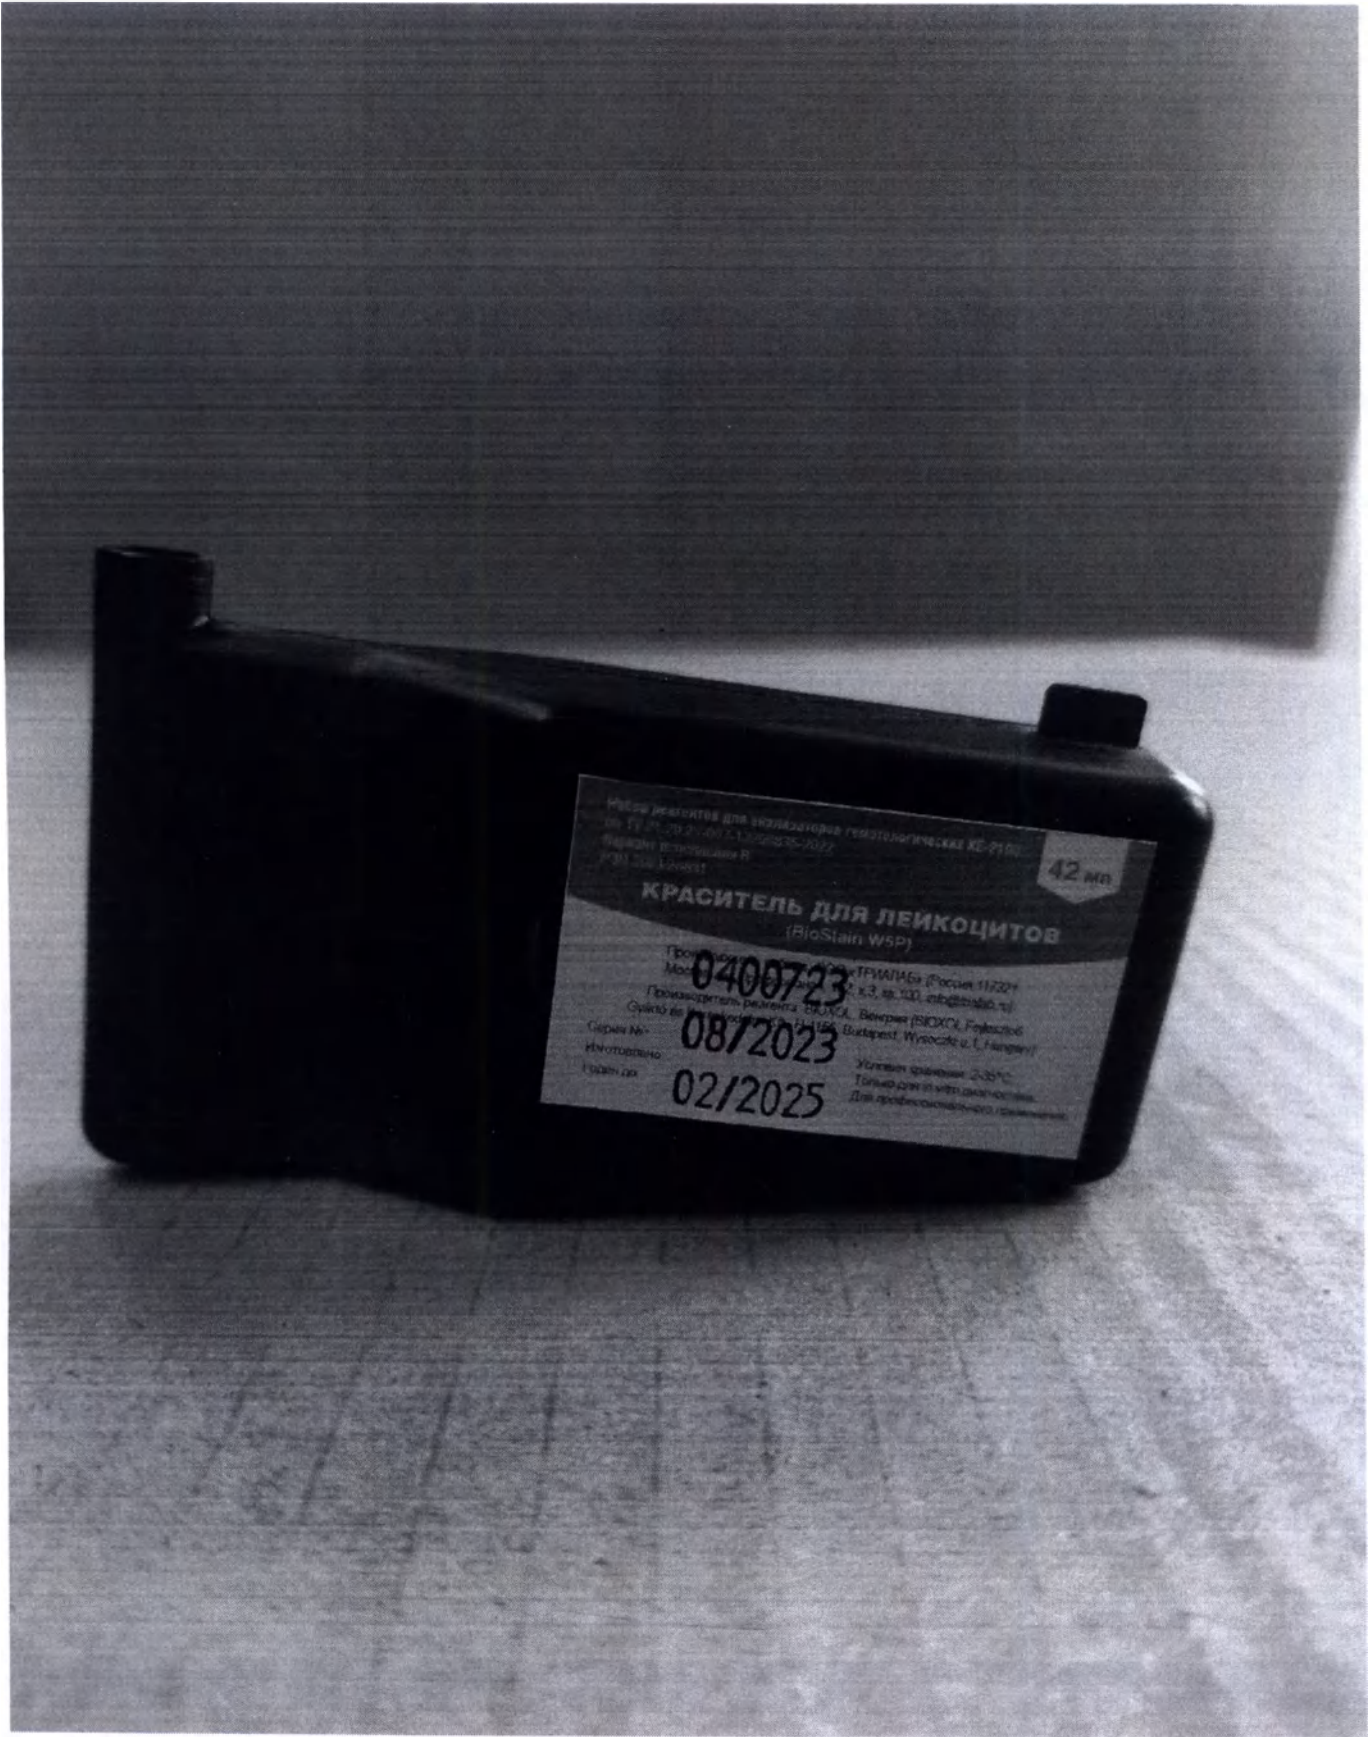


Фото 17. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения гемоглобина (BioGlobin SYS)

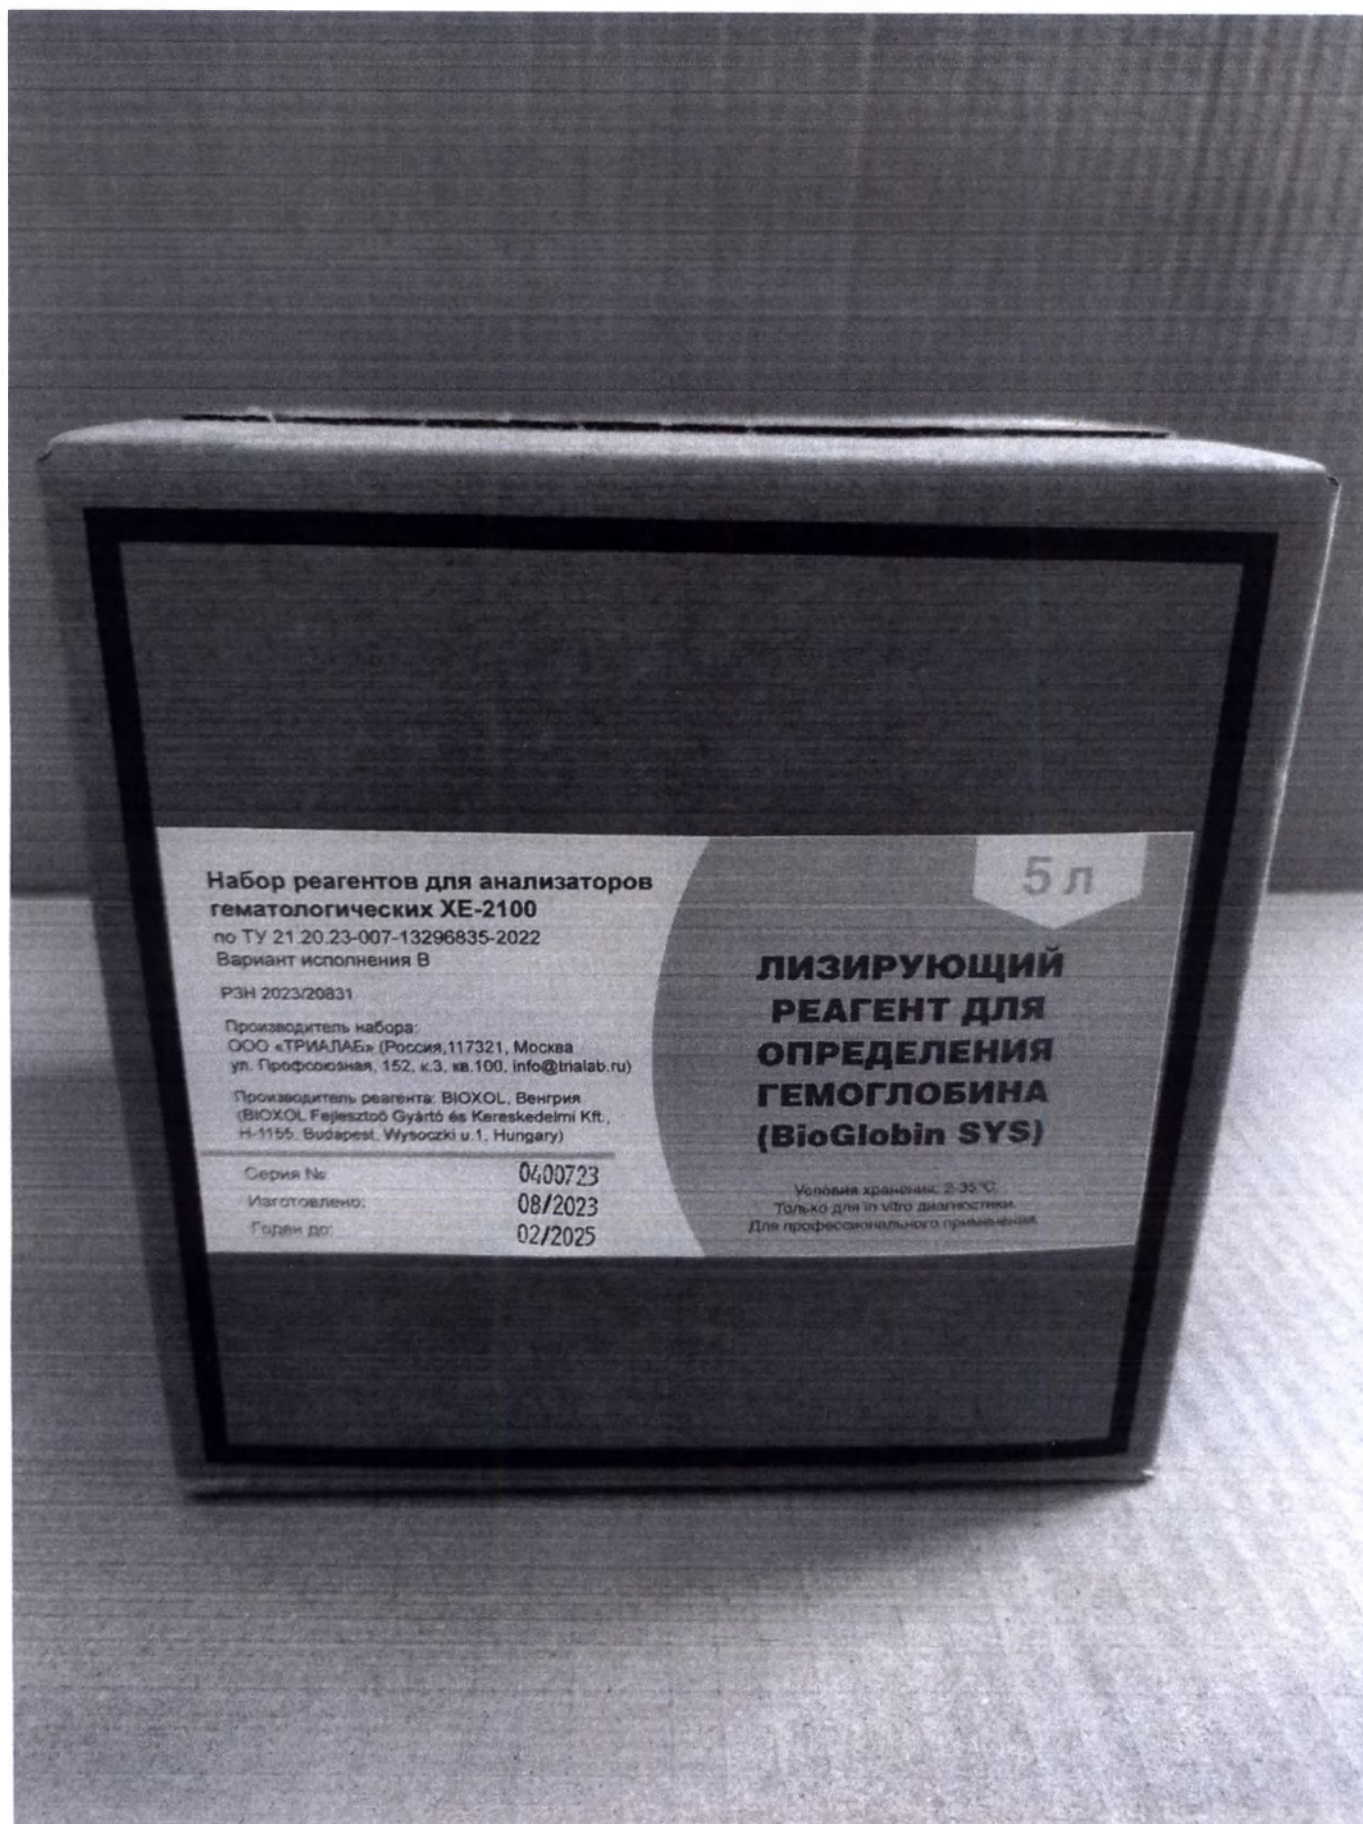

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022
Вариант исполнения В

РЭН 2023/20831

Производитель набора:
ООО «ТРИАЛЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №:	0400723
Изготовлено:	08/2023
Годен до:	02/2025

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕМОГЛОБИНА
(BioGlobin SYS)**

Условия хранения: 2-35 °С
Только для in vitro диагностики
Для профессионального применения

Фото 18. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения базофилов (BioLyse-FBA SYS)



Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЭН 2023/20831

Производитель набора:
ООО «ТРИАЛБ» (Россия, 117321, Москва,
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв. 100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u. 1, Hungary)

Серия №: 0400723

Изготовлено: 08/2023

Годен до: 02/2025

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЗОФИЛОВ
(BioLyse-FBA SYS)**

Условия хранения: 2-35°C
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

Фото 19. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения ретикулоцитов (BioReti-Buffer SYS)

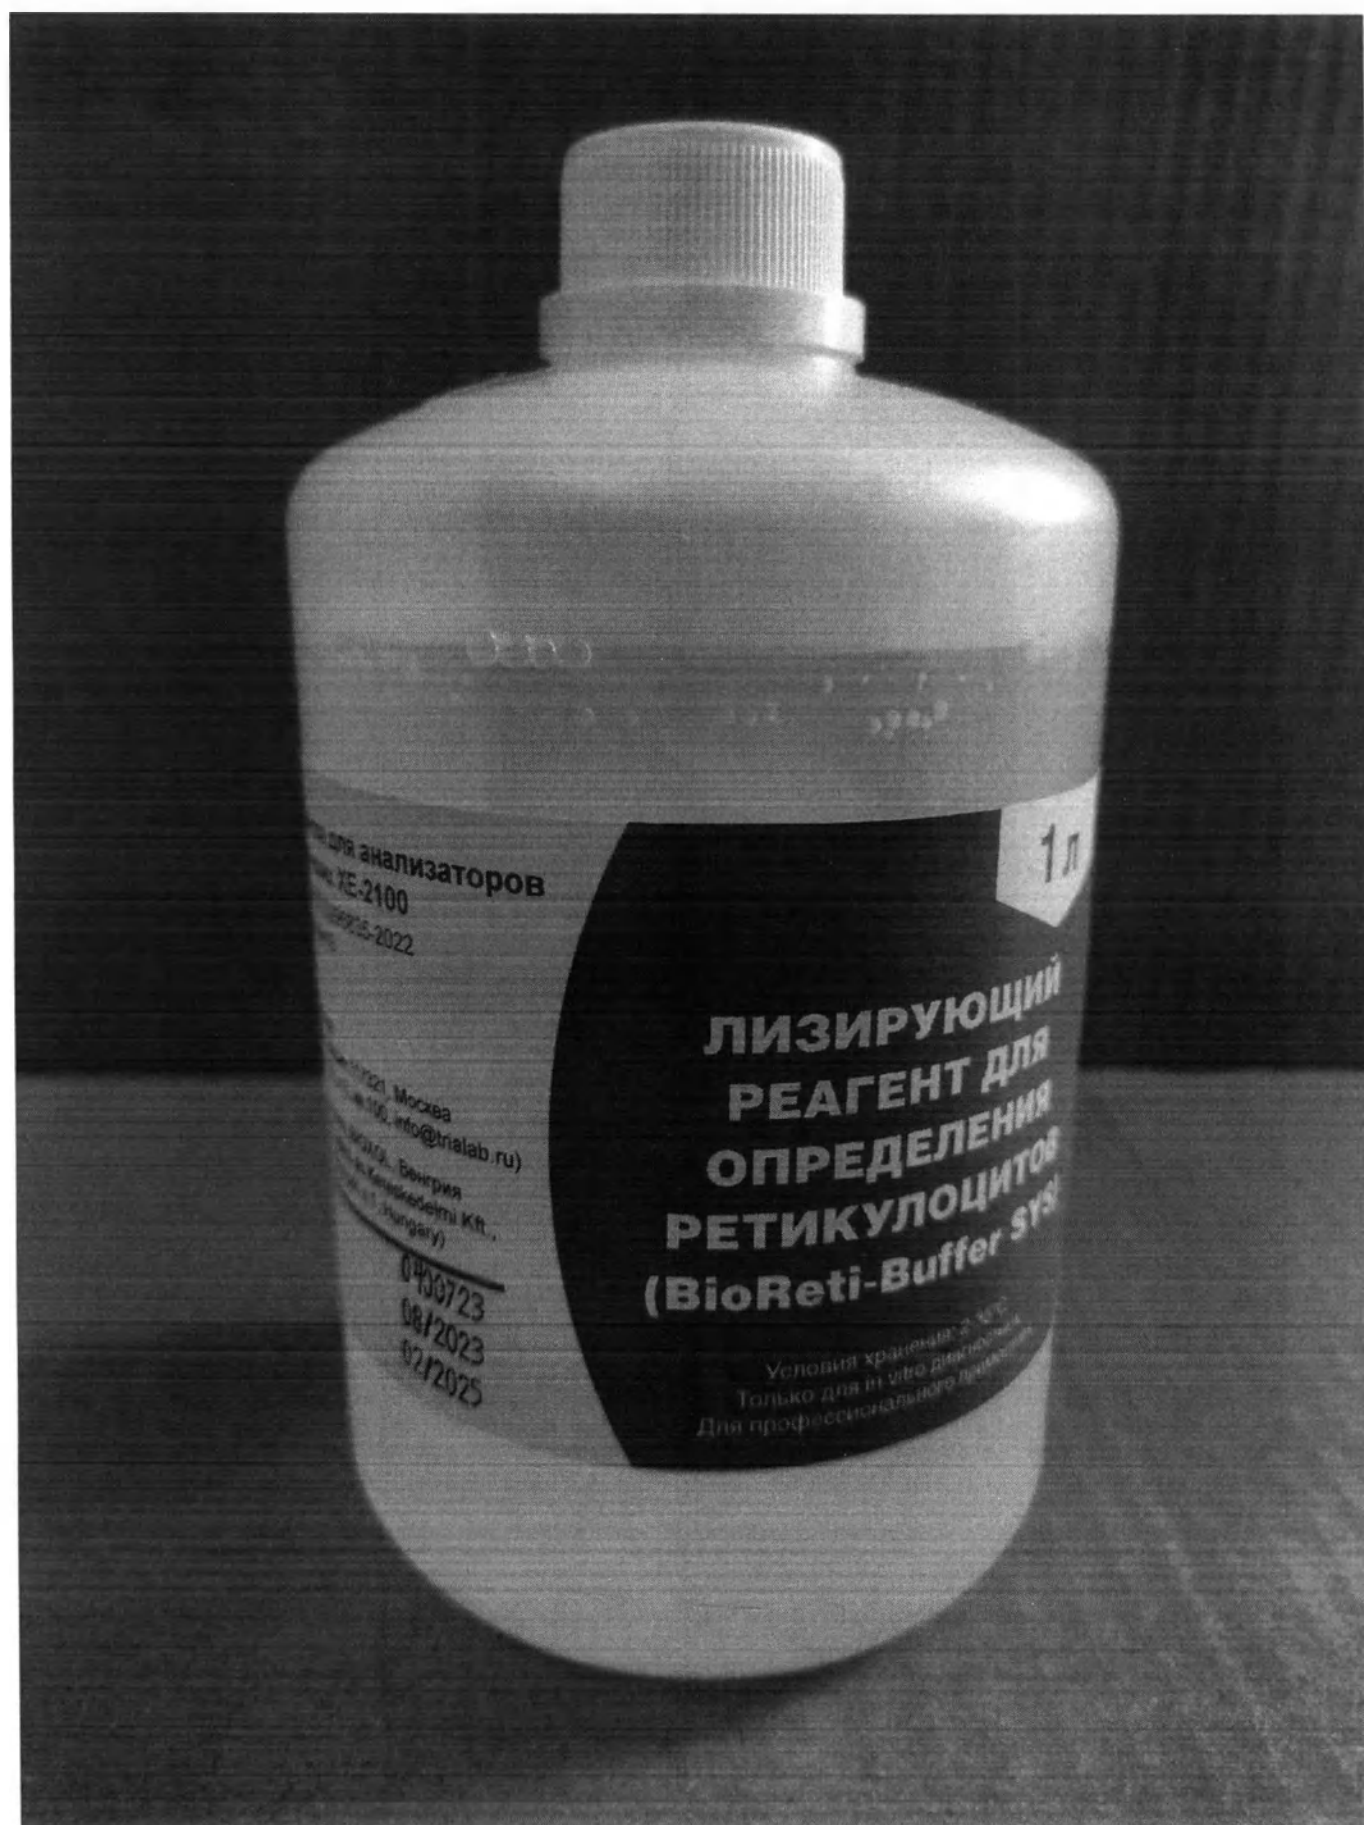


Фото 20. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Краситель для ретикулоцитов (BioStain RET)

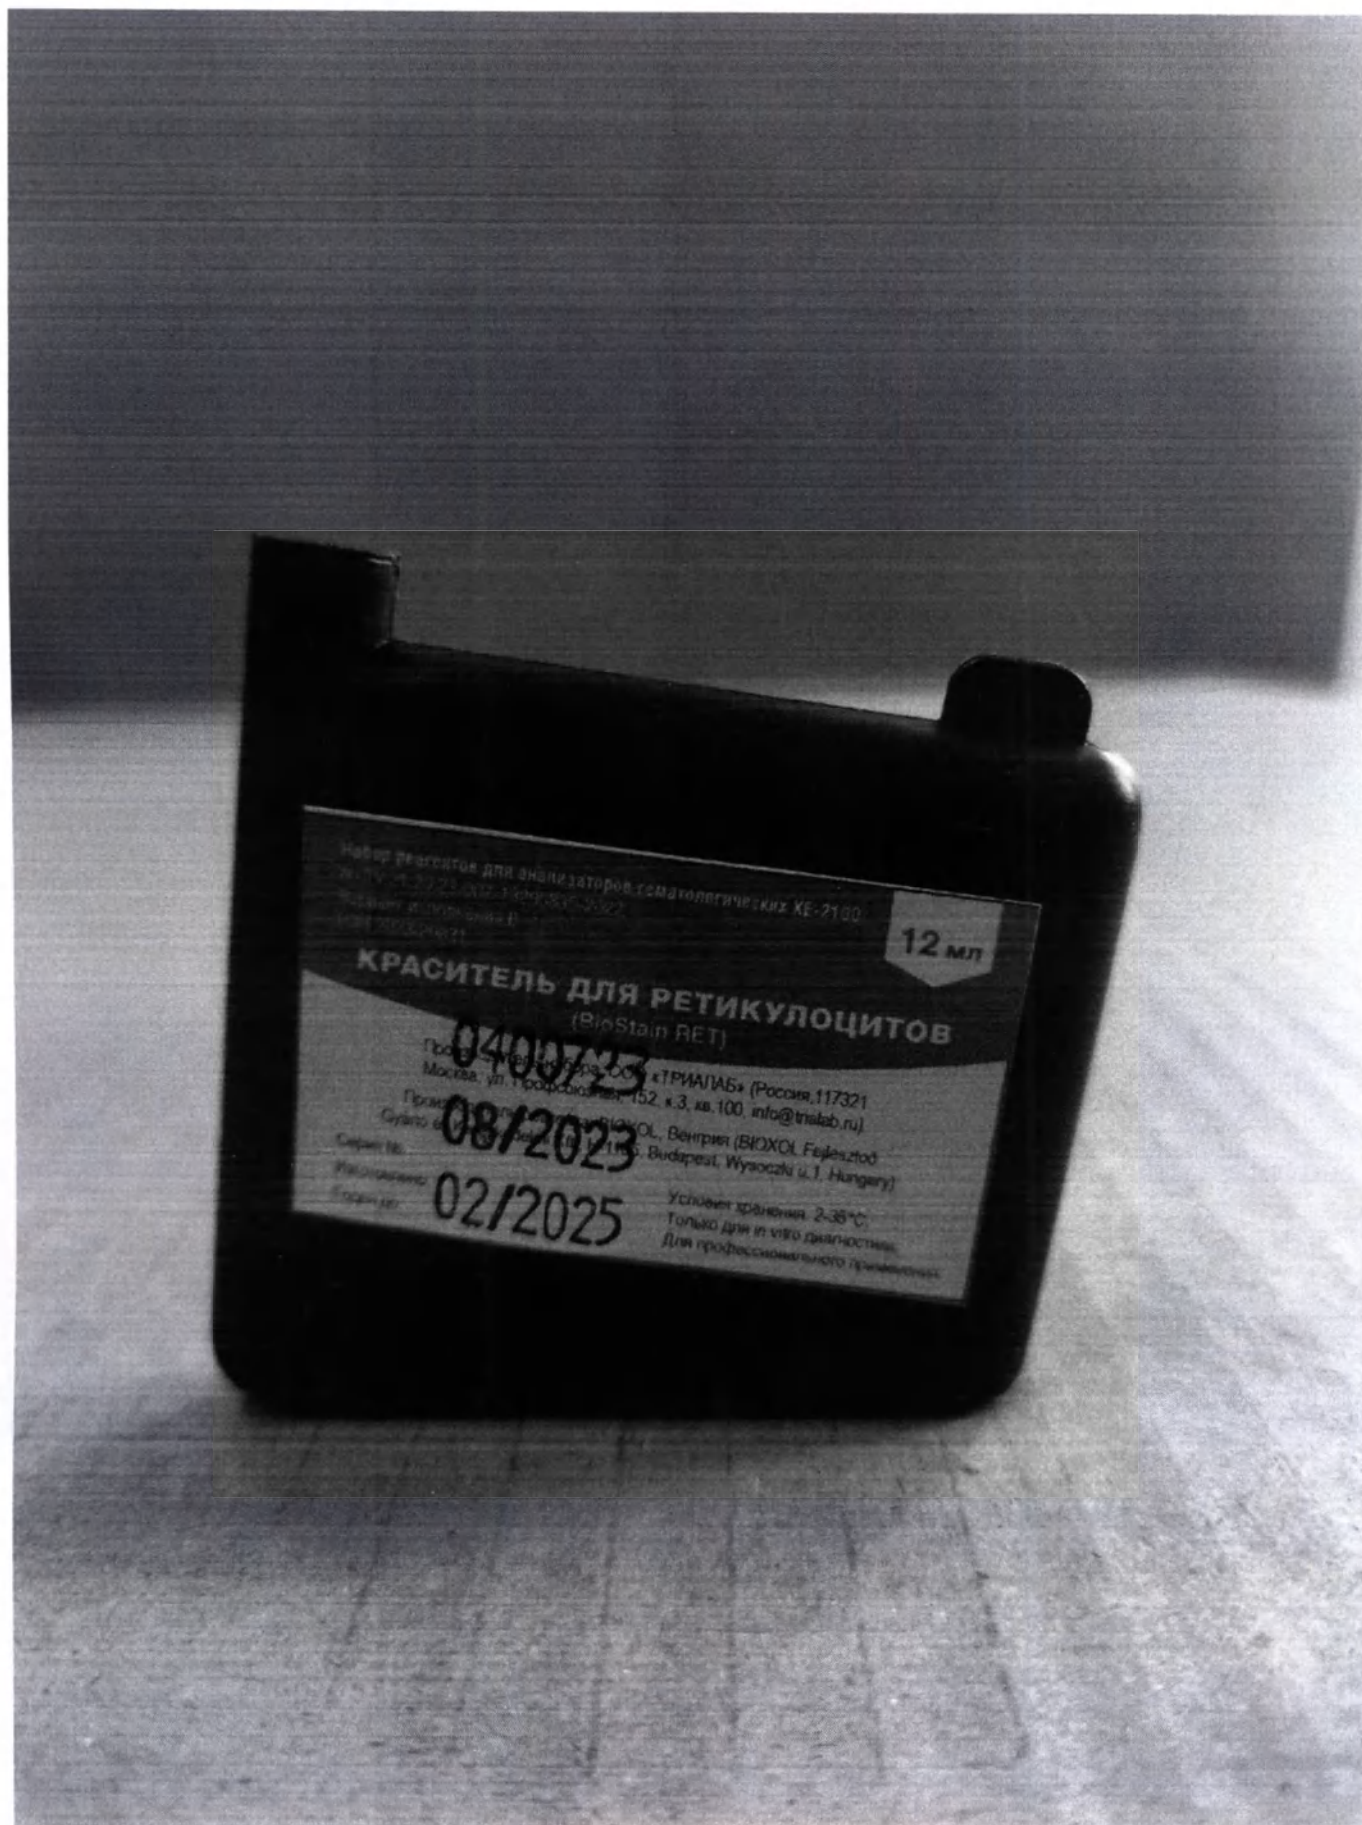


Фото 21. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения ядросодержащих эритроцитов (BioLyse-NR SYS)



Фото 22. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Краситель для ядросодержащих эритроцитов (BioStain NRBC)






Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

(16 листов) листов

Верно

Генеральный директор ООО «Триалаб»

 Прозоровский Н.С.
..20

Фотографические изображения образца (образцов) медицинского изделия «Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022», принадлежностей и его (их) маркировки

Фото 1. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Потребительская упаковка.



Фото 2. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Состав набора.

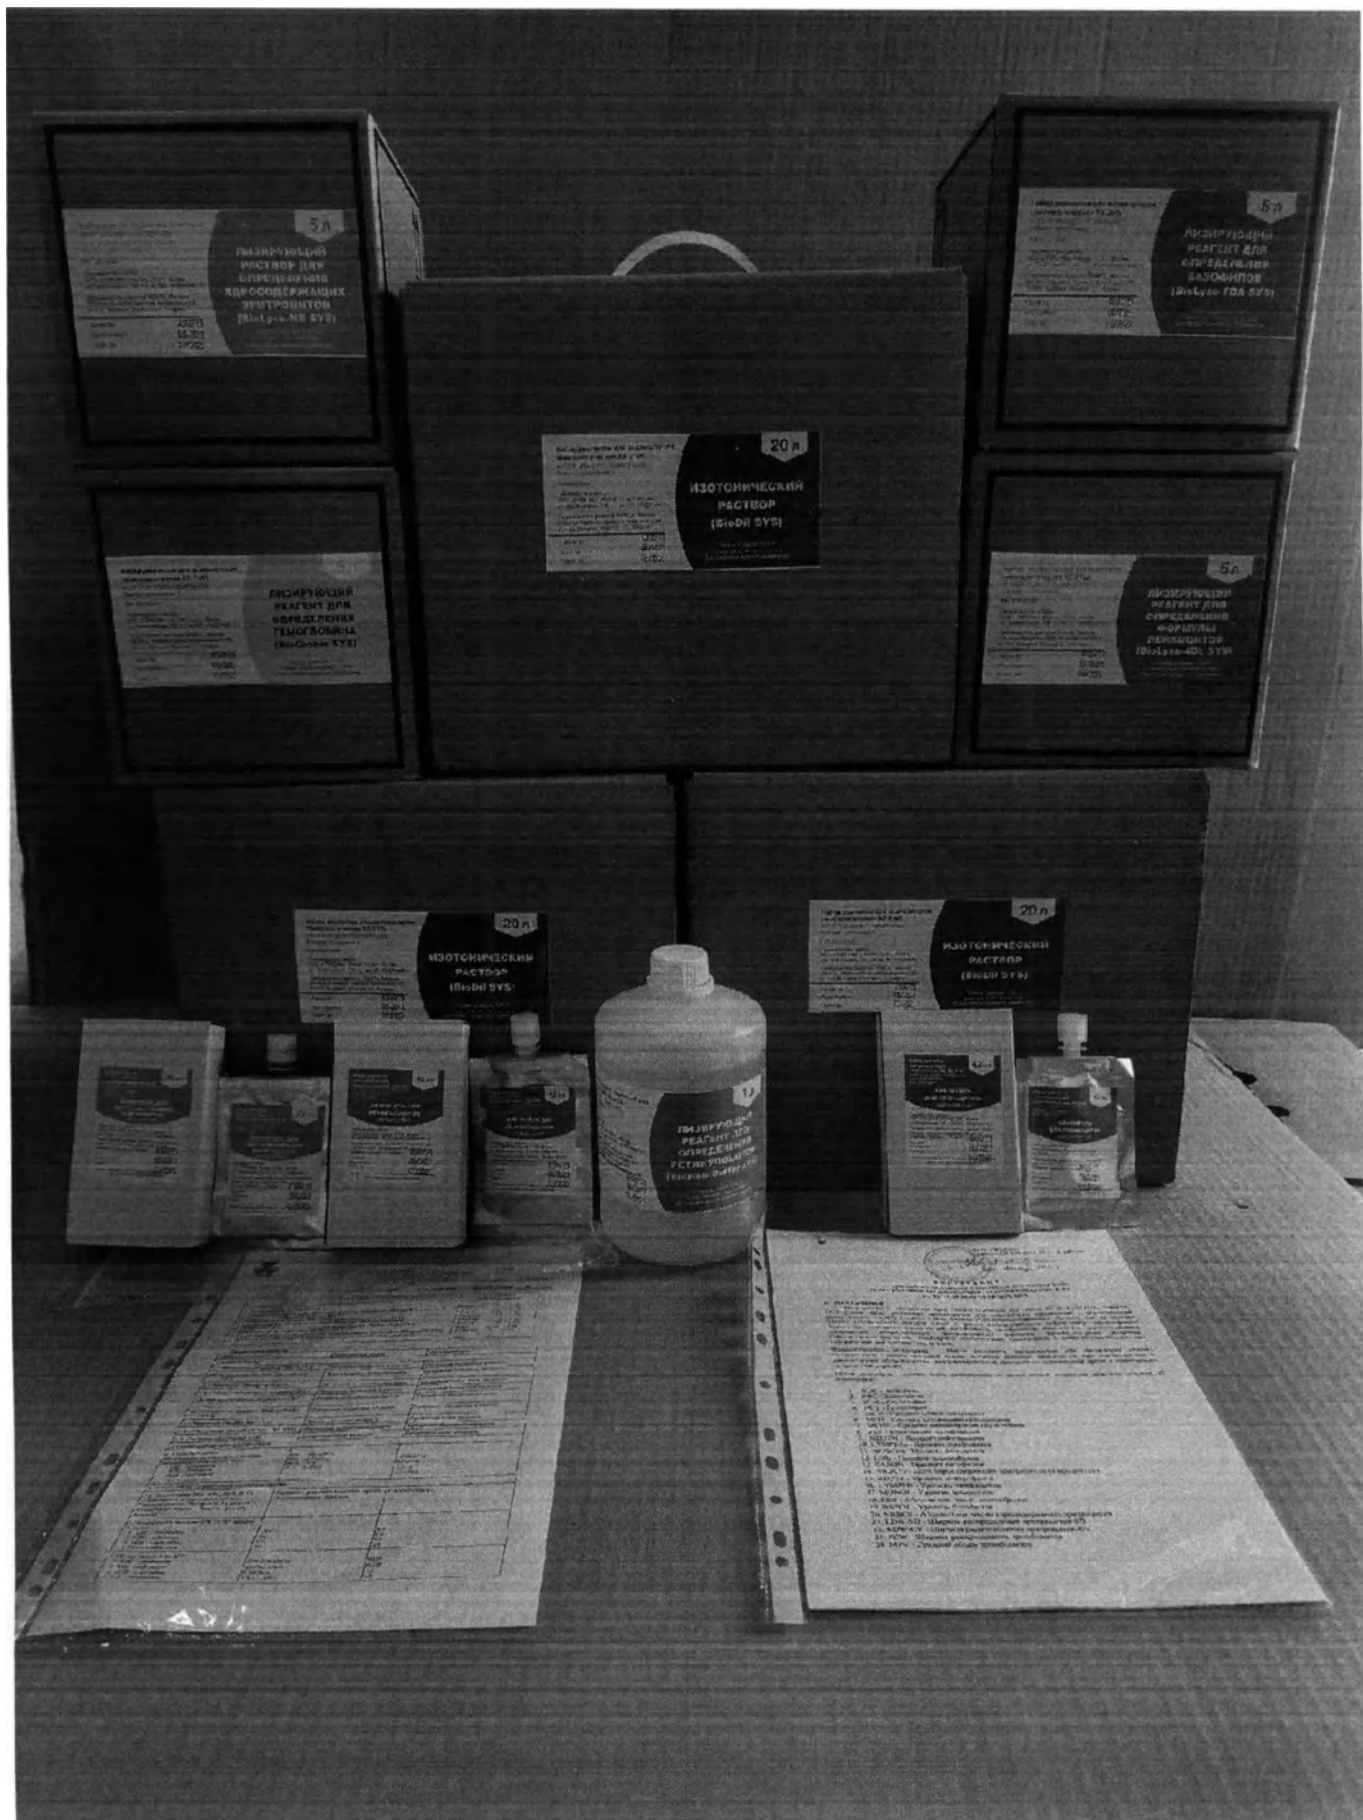


Фото 3. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Изотонический раствор (BioDil-SYS)



Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100
по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022
Вариант исполнения А
Р5Н.0023.00821

Применяется набор:
ООО «ЦИРМИ» Россия (117321, Москва,
ул. Ломоносовская, 152 к.3, вл.150, info@cirmi.ru)

Поставщик реагентов: ВСКОН, Белоруссия
(BIALKAL Fajzenkovi Cyarto na Karpeladom, 88,
H-1150, Minsk, Belarus, H-1, Minsk)

Серийный №	0300723
Исход. срок годности	08/2023
Годен до:	02/2025

20 л

**ИЗОТОНИЧЕСКИЙ
РАСТВОР
(BioDil SYS)**

Используется в комплекте с анализатором ХЕ-2100.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления.
Дополнительная информация: см. инструкцию.

Фото 4. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения формулы лейкоцитов (BioLyse-4DL SYS)



Фото 5. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022.
Вариант исполнения А. Краситель для лейкоцитов (BioDye-4DS SYS)


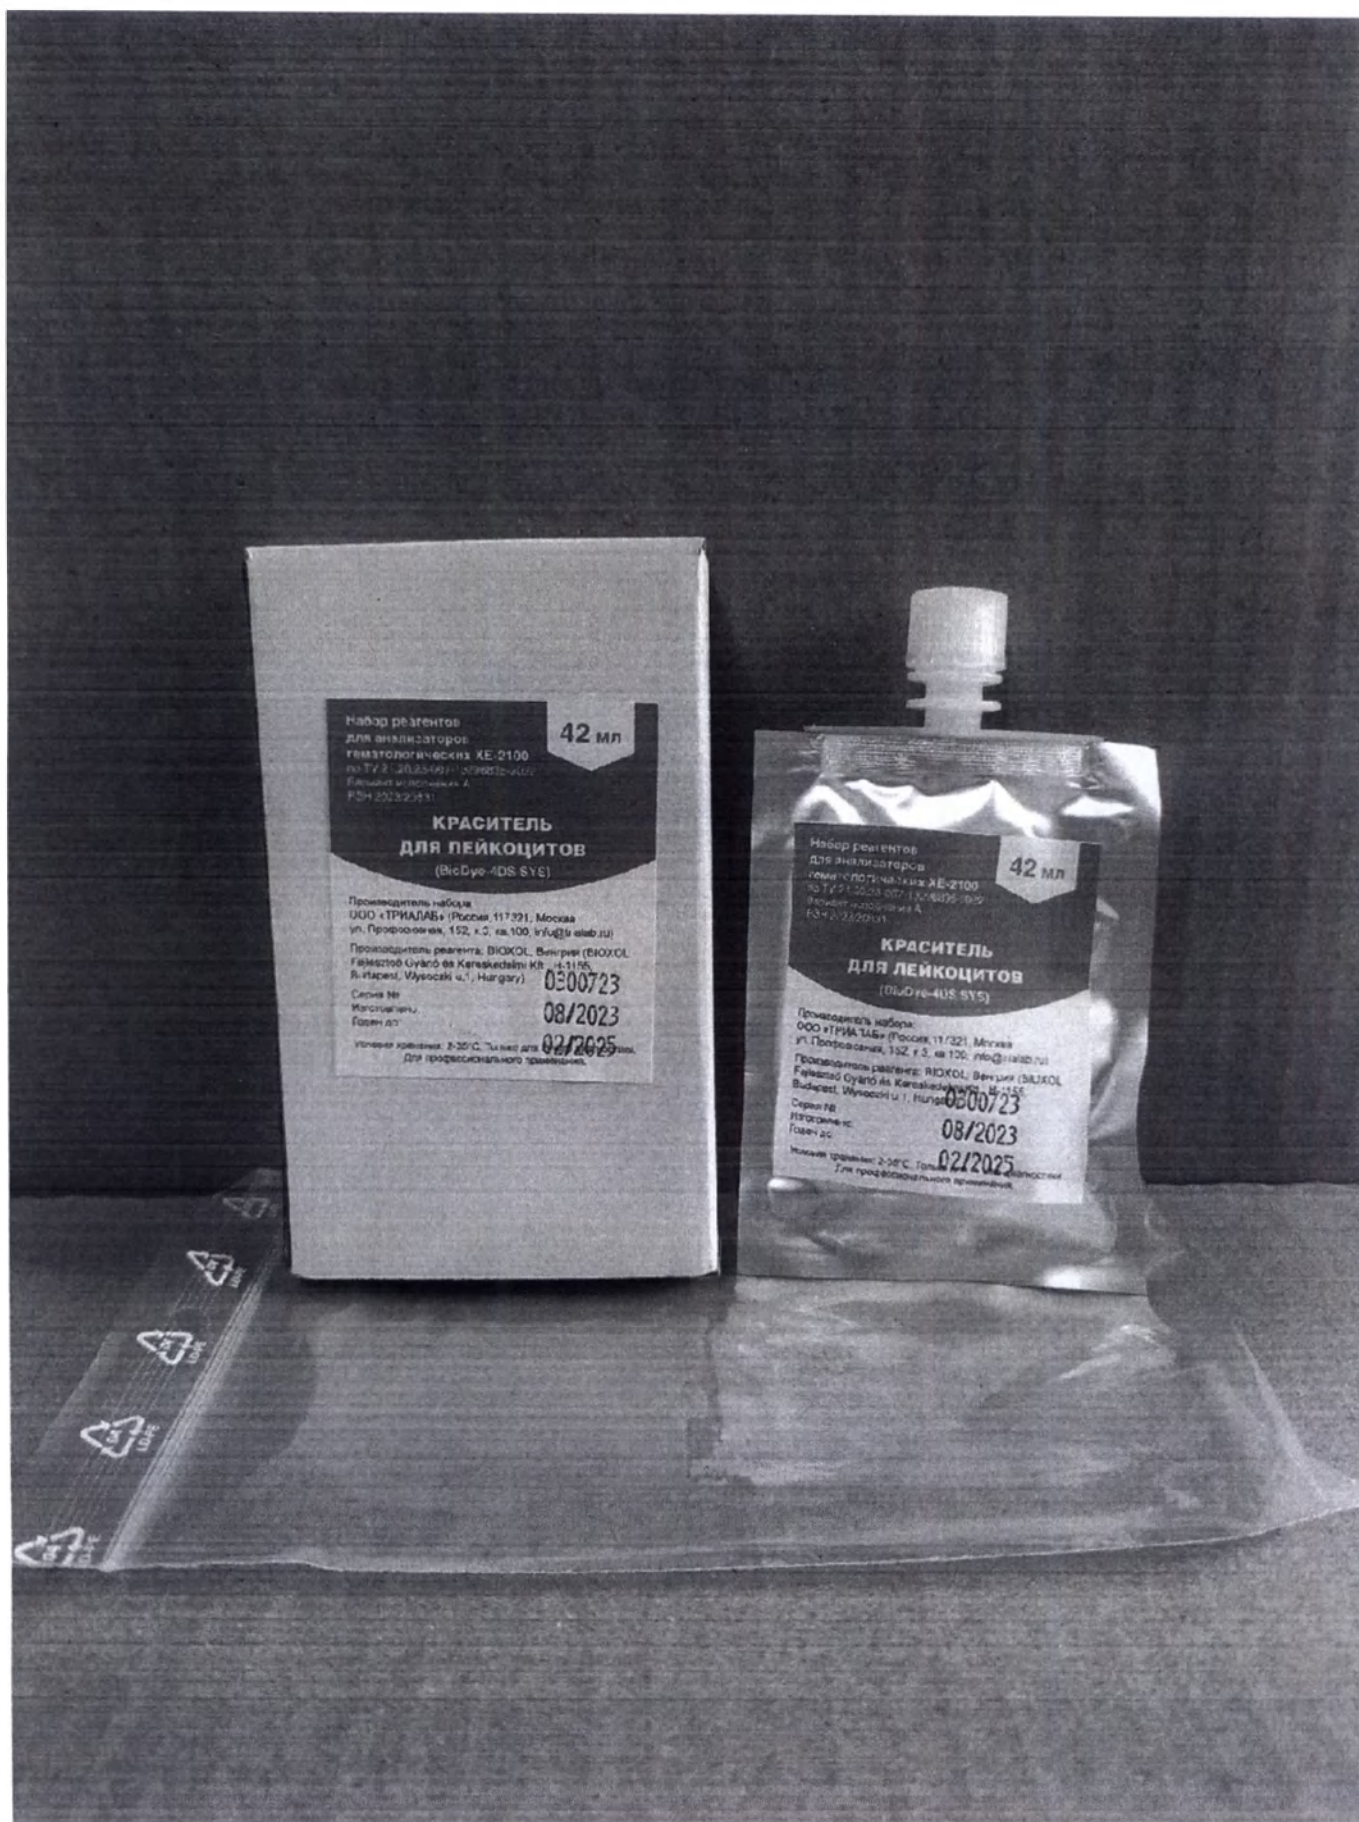


Фото 6. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022.
Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения гемоглобина (BioGlobin SYS)

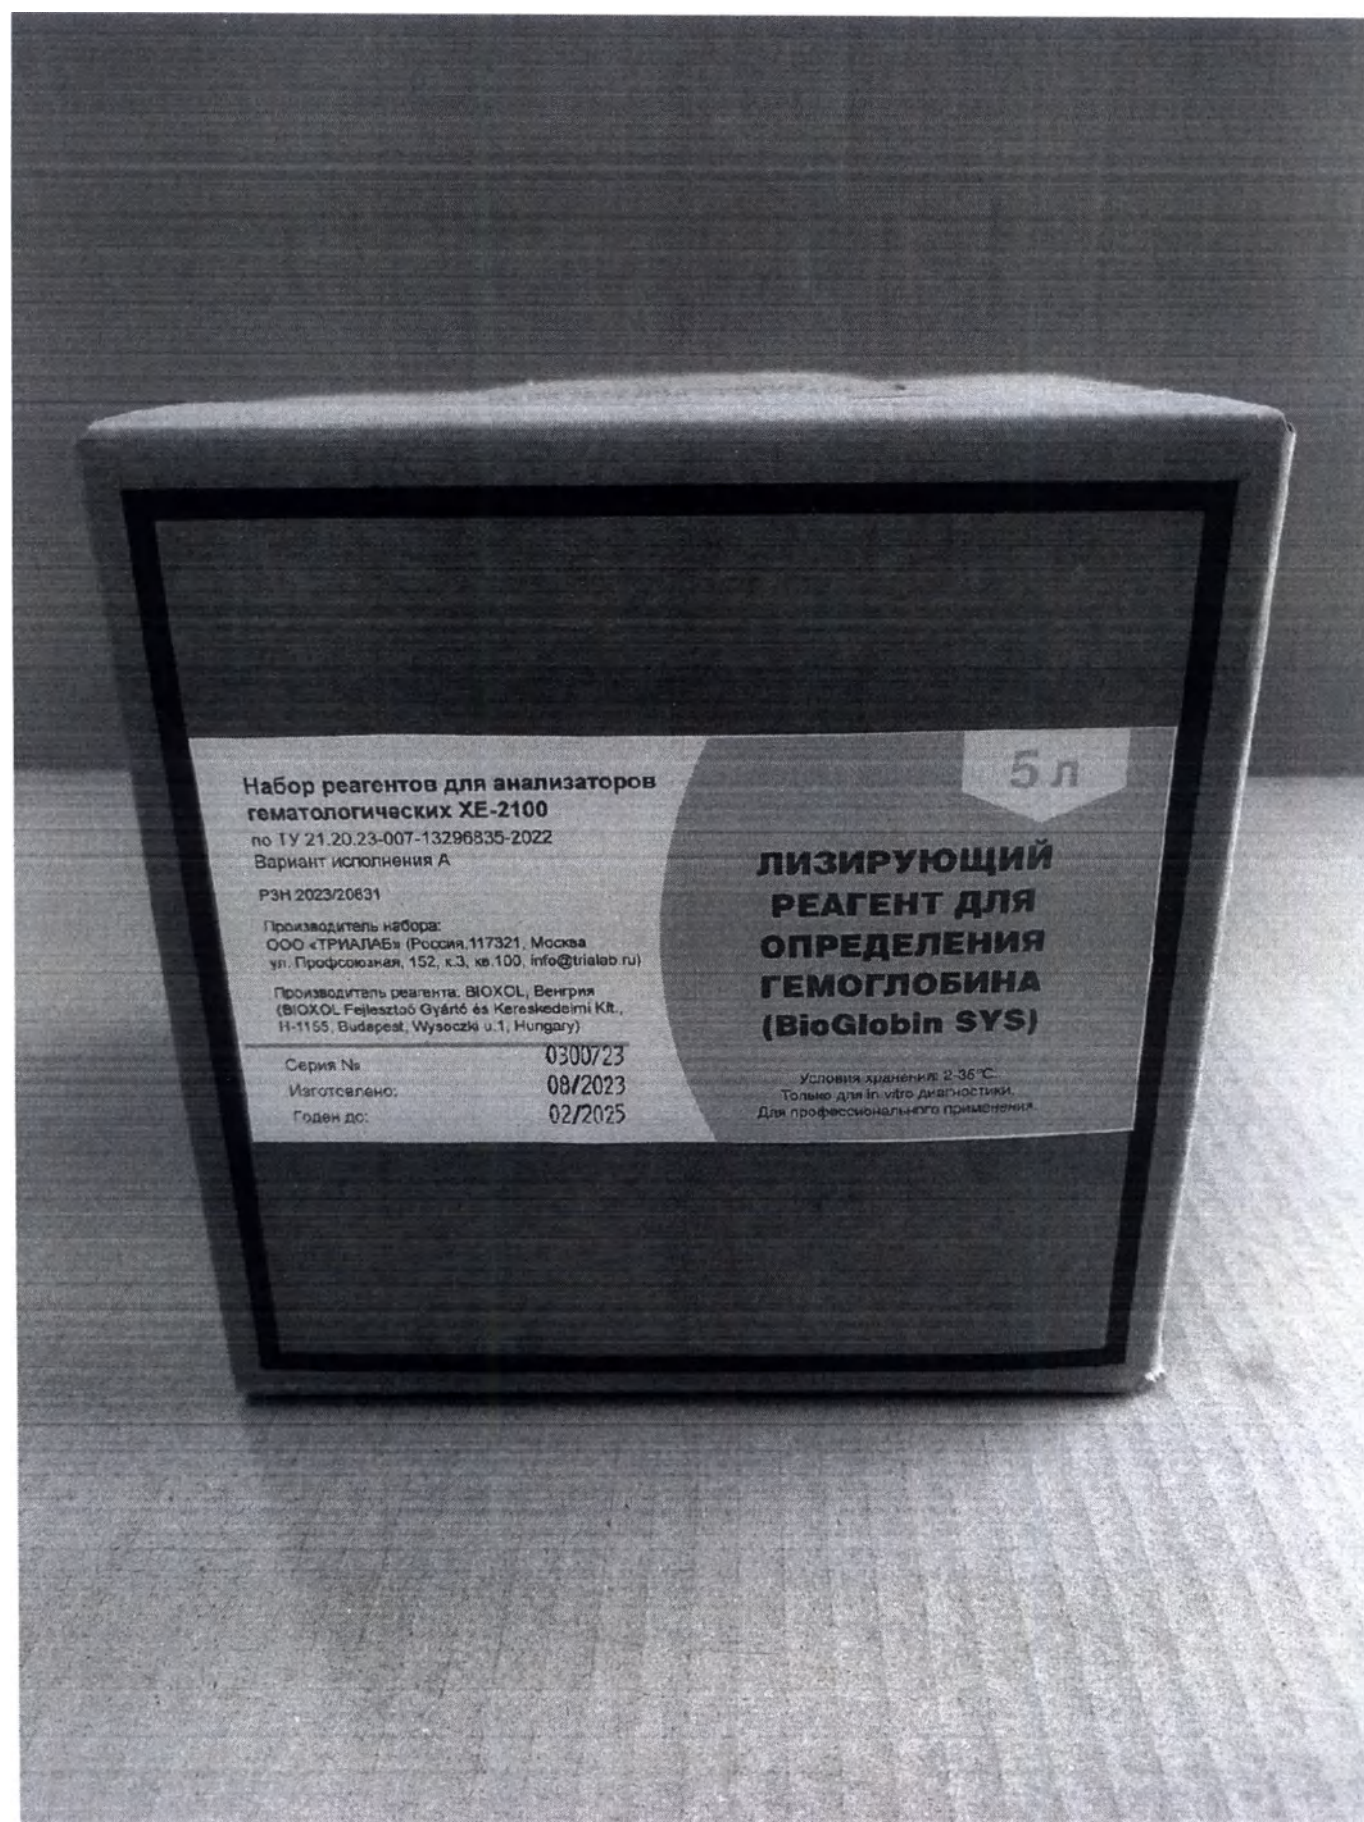

Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022
Вариант исполнения А

РЭН 2023/20631

Производитель набора:
ООО «ТРИАЛБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wyszoczki u.1, Hungary)


Серия №	0300/23
Изготовлено:	08/2023
Годен до:	02/2025

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕМОГЛОБИНА
(BioGlobin SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

Фото 7. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022.
Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения базофилов (BioLyse-FBA SYS)

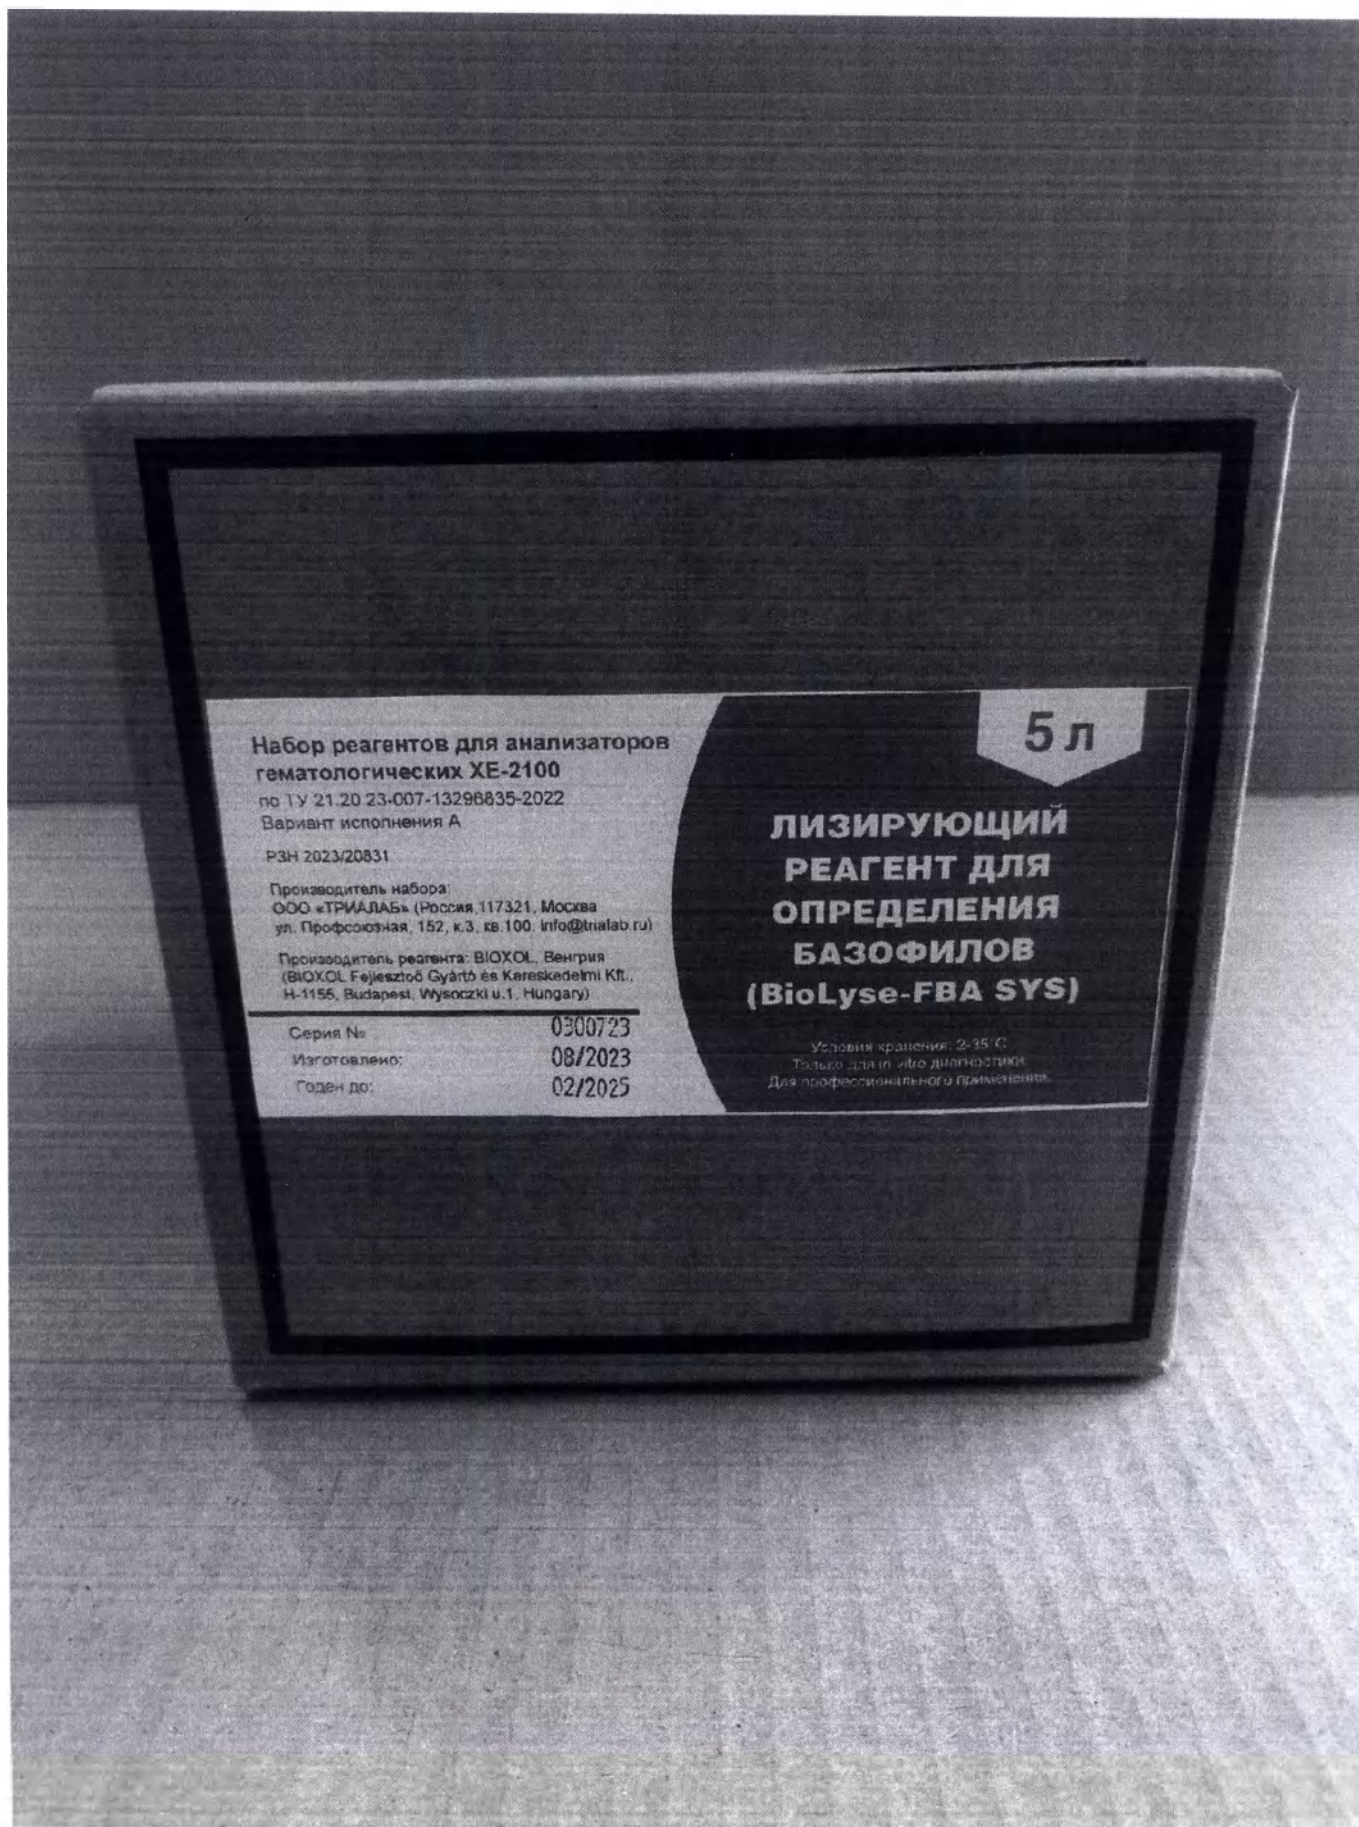

Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения А

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №: 0300723

Изготовлено: 08/2023

Годен до: 02/2025

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЗОФИЛОВ
(BioLyse-FBA SYS)**

Условия хранения: 2-35°C
Только для in vitro диагностики
Для профессионального применения.

Фото 8. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022.
Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения ретикулоцитов (BioReti-Buffer SYS)

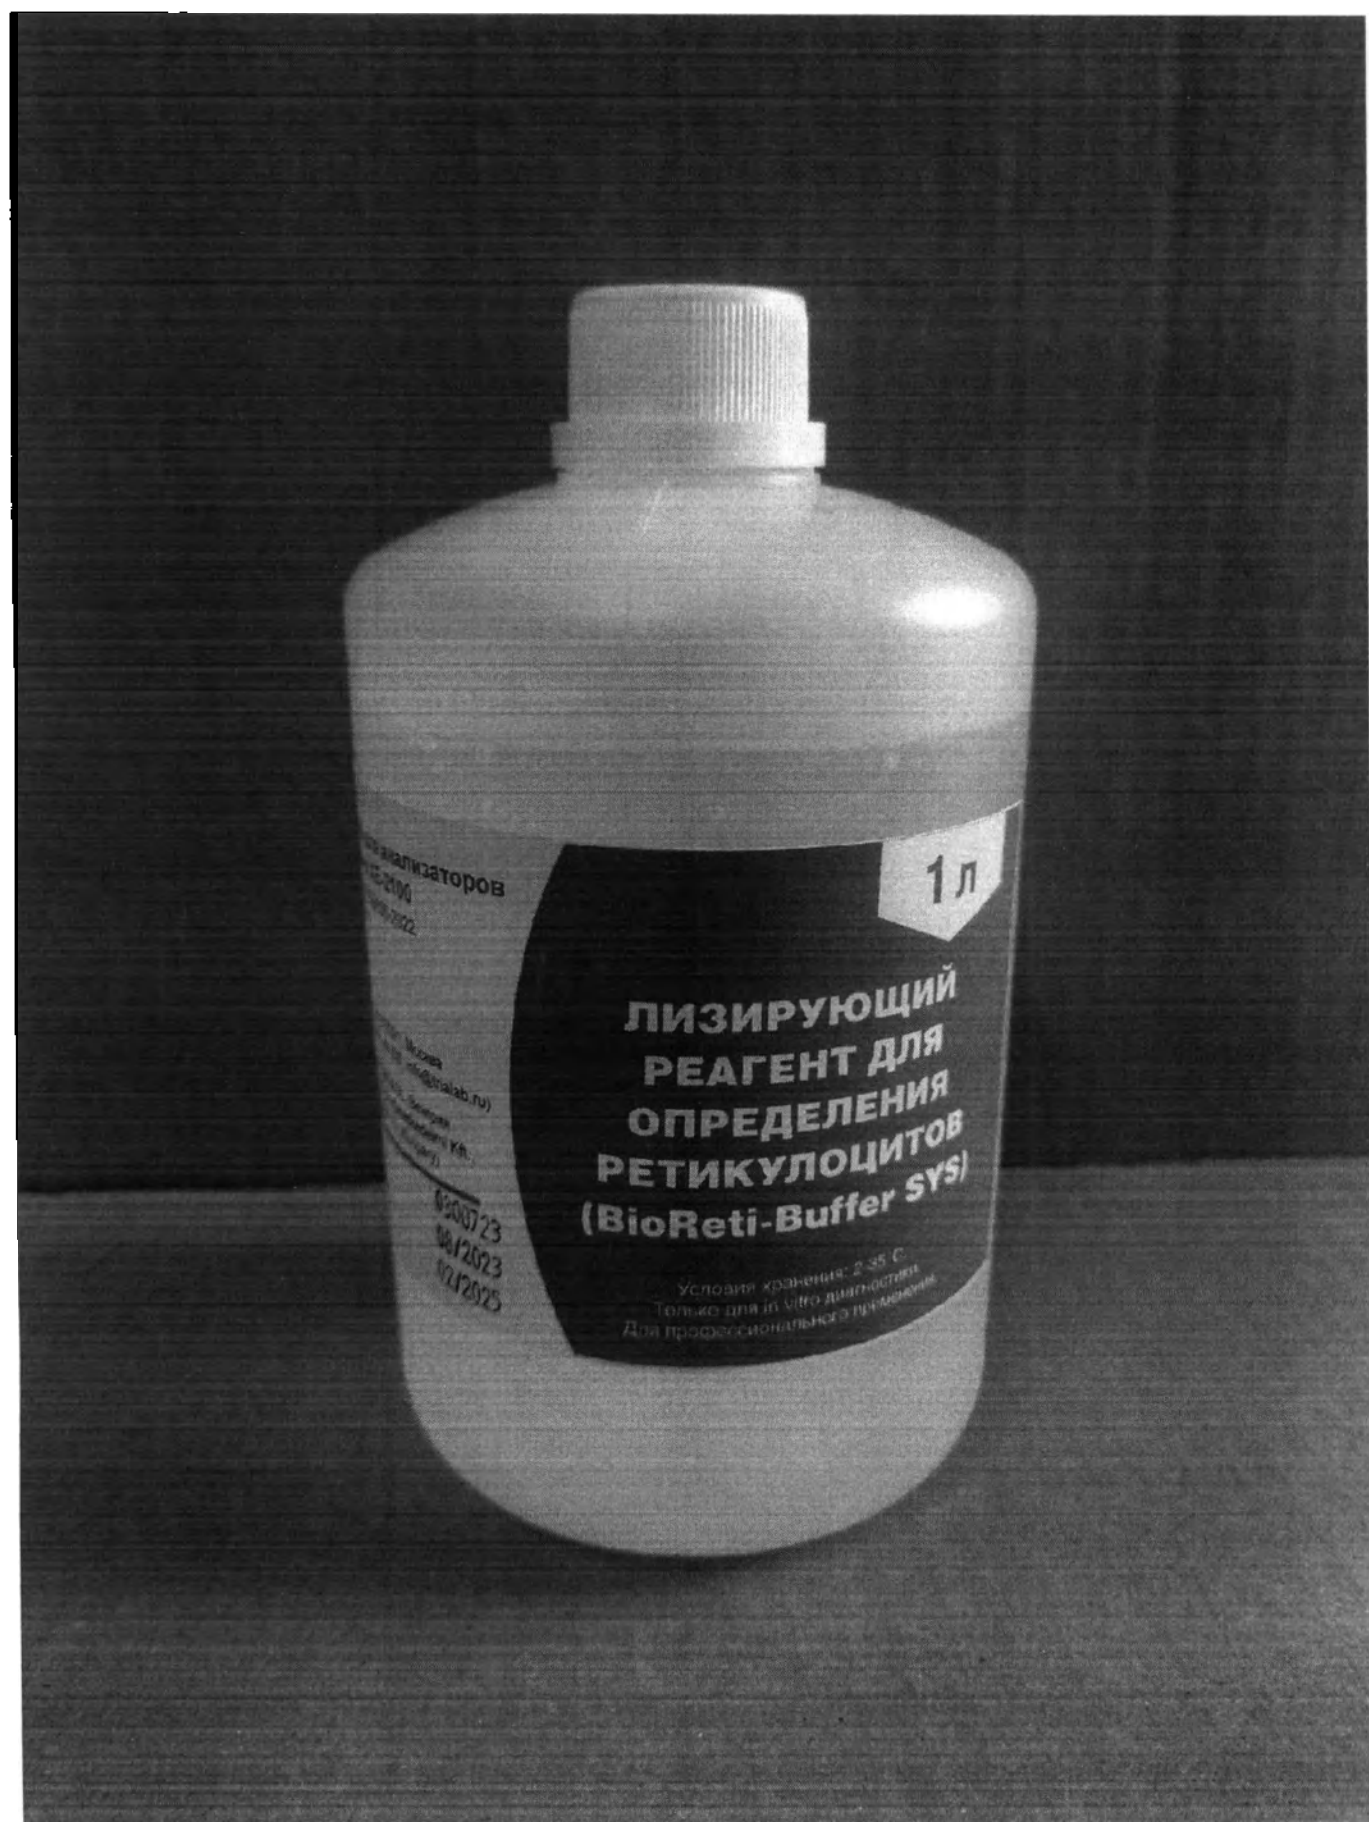


Фото 9. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Краситель для ретикулоцитов (BioReti-Dye SYS)

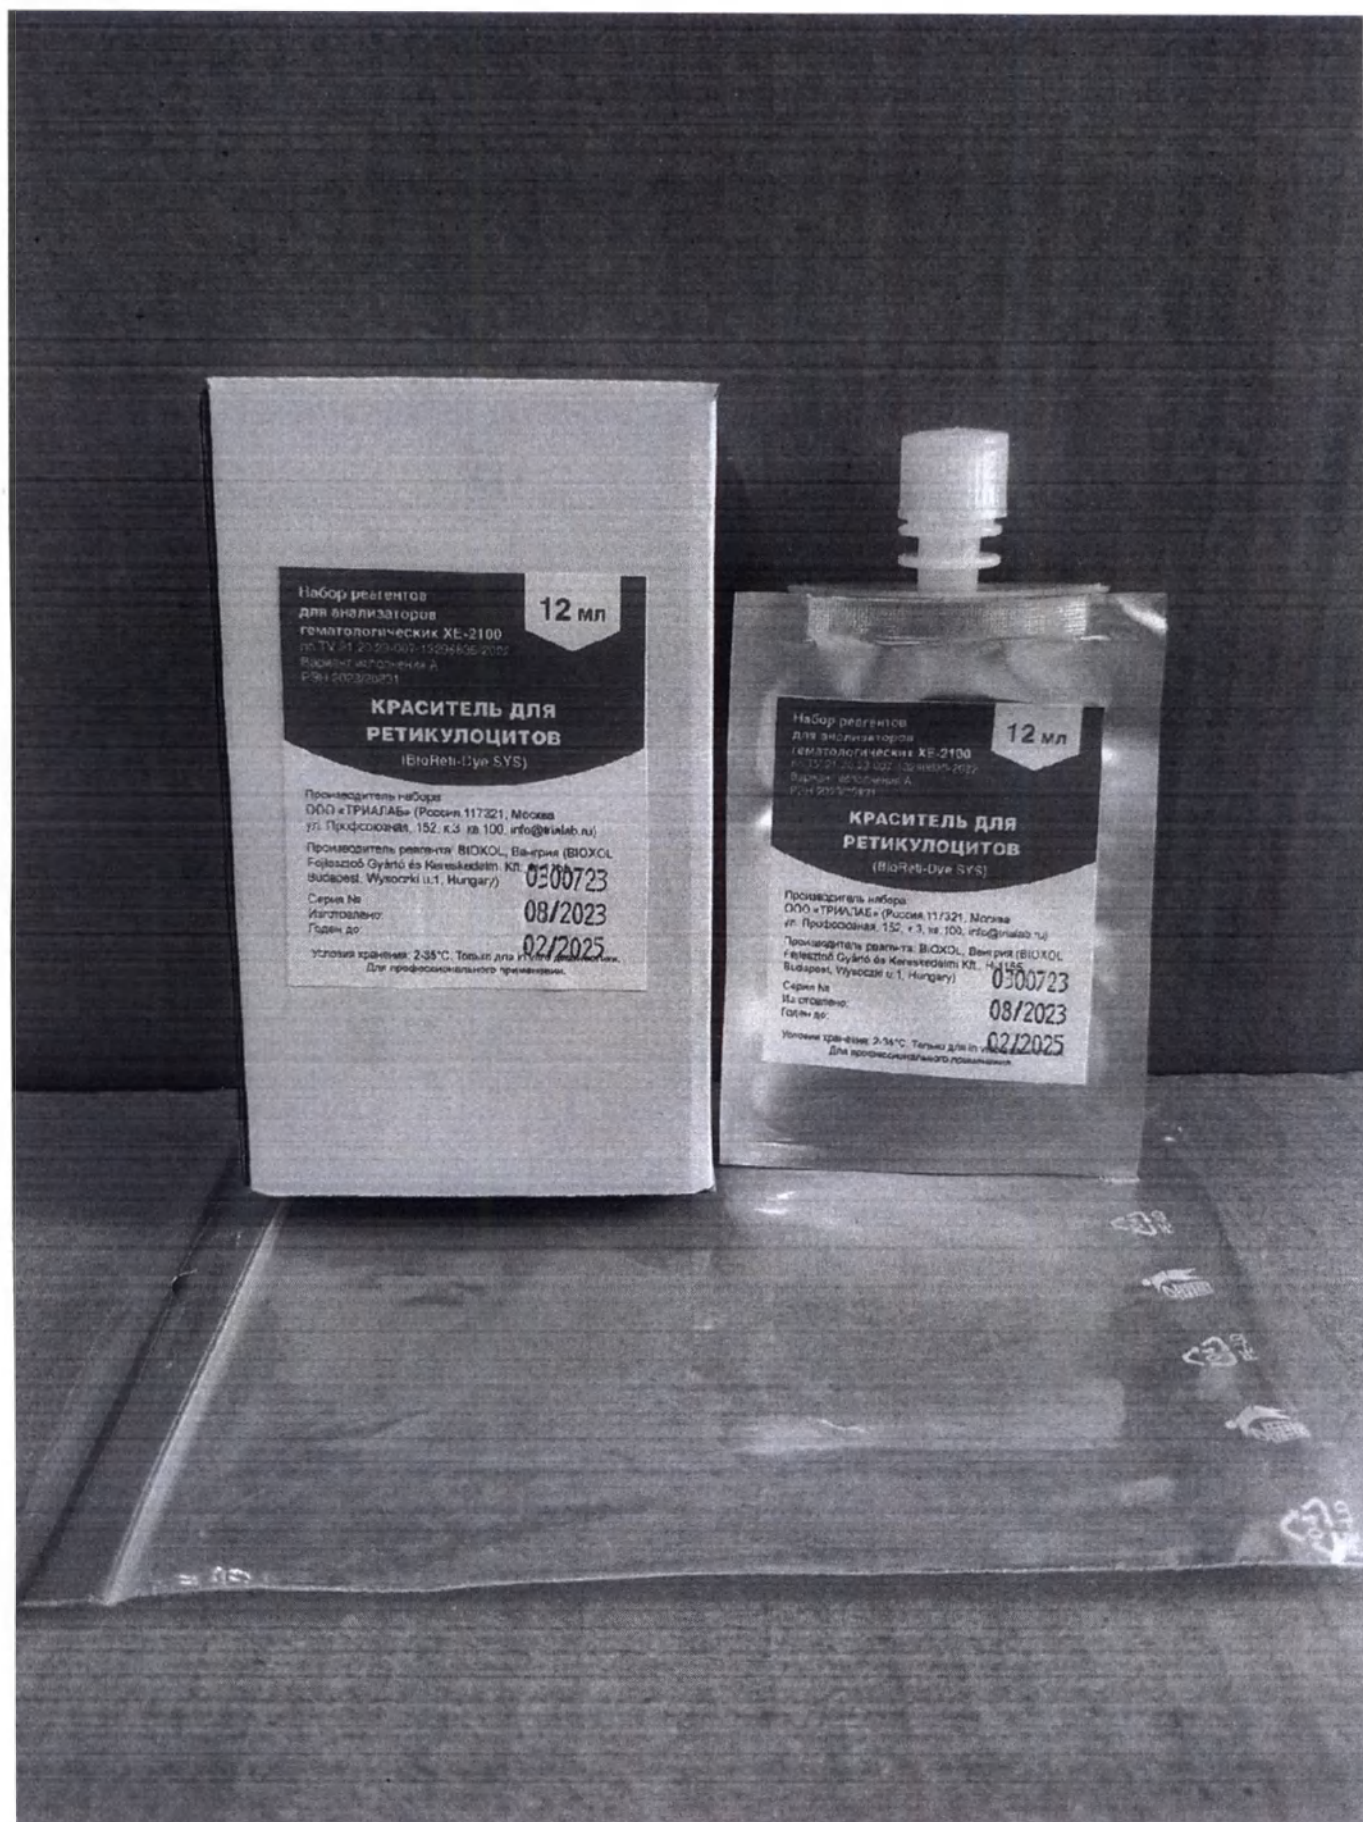


Фото 10. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Лизирующий реагент для определения ядросодержащих эритроцитов (BioLyse-NR SYS)



Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100
по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022
Вариант исполнения А

РЭН 2023/20831

Производитель набора:
ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №	0300723
Изготовлено:	08/2023
Годен до:	02/2025

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РАСТВОР ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ
ЭРИТРОЦИТОВ
(BioLyse-NR SYS)**

Условия хранения: +2...+8°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

Фото 11. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения А. Краситель для ядросодержащих эритроцитов (BioDye-NR SYS)

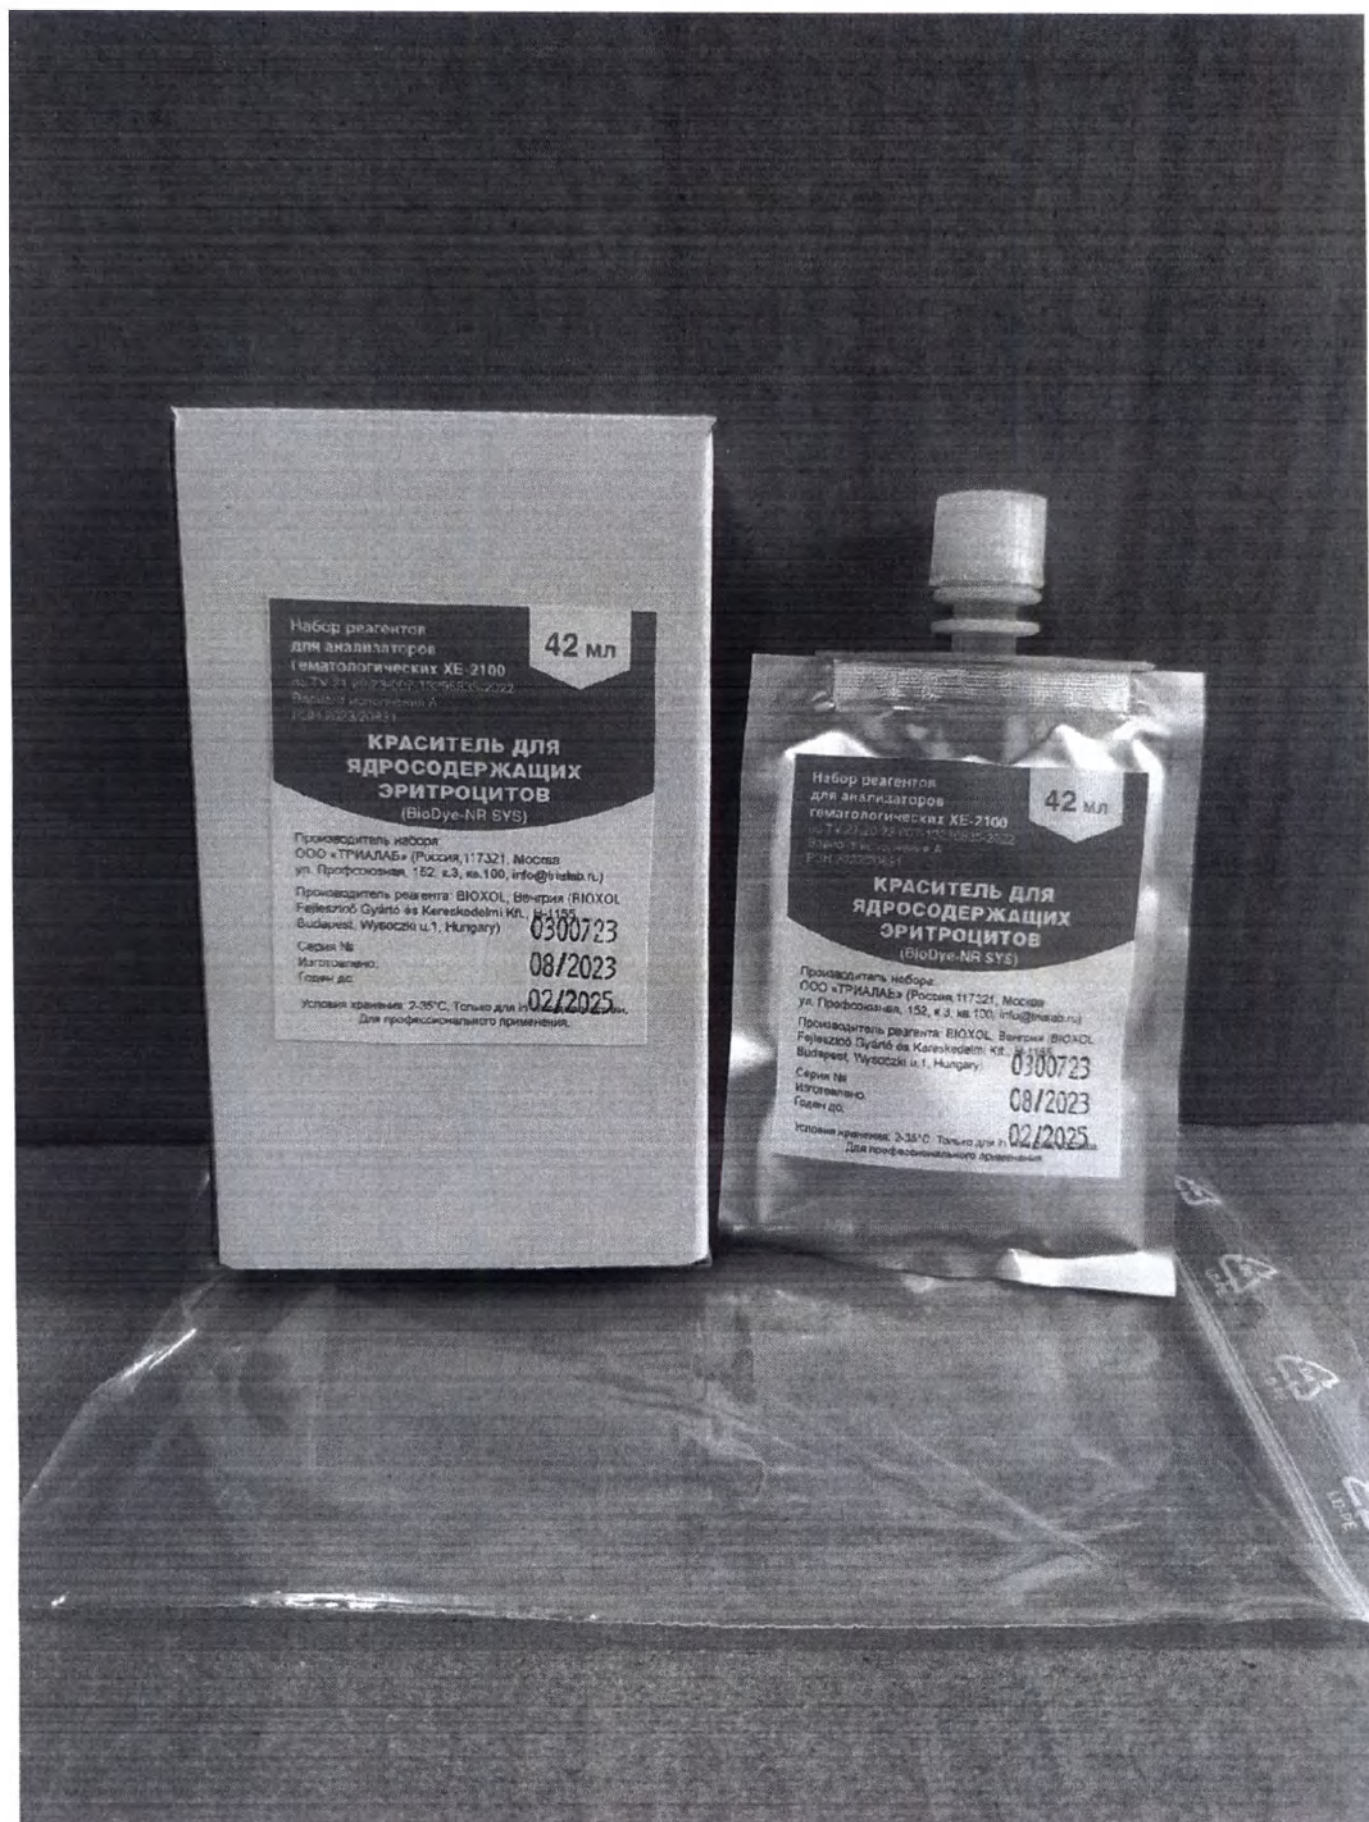


Фото 13. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Состав набора.

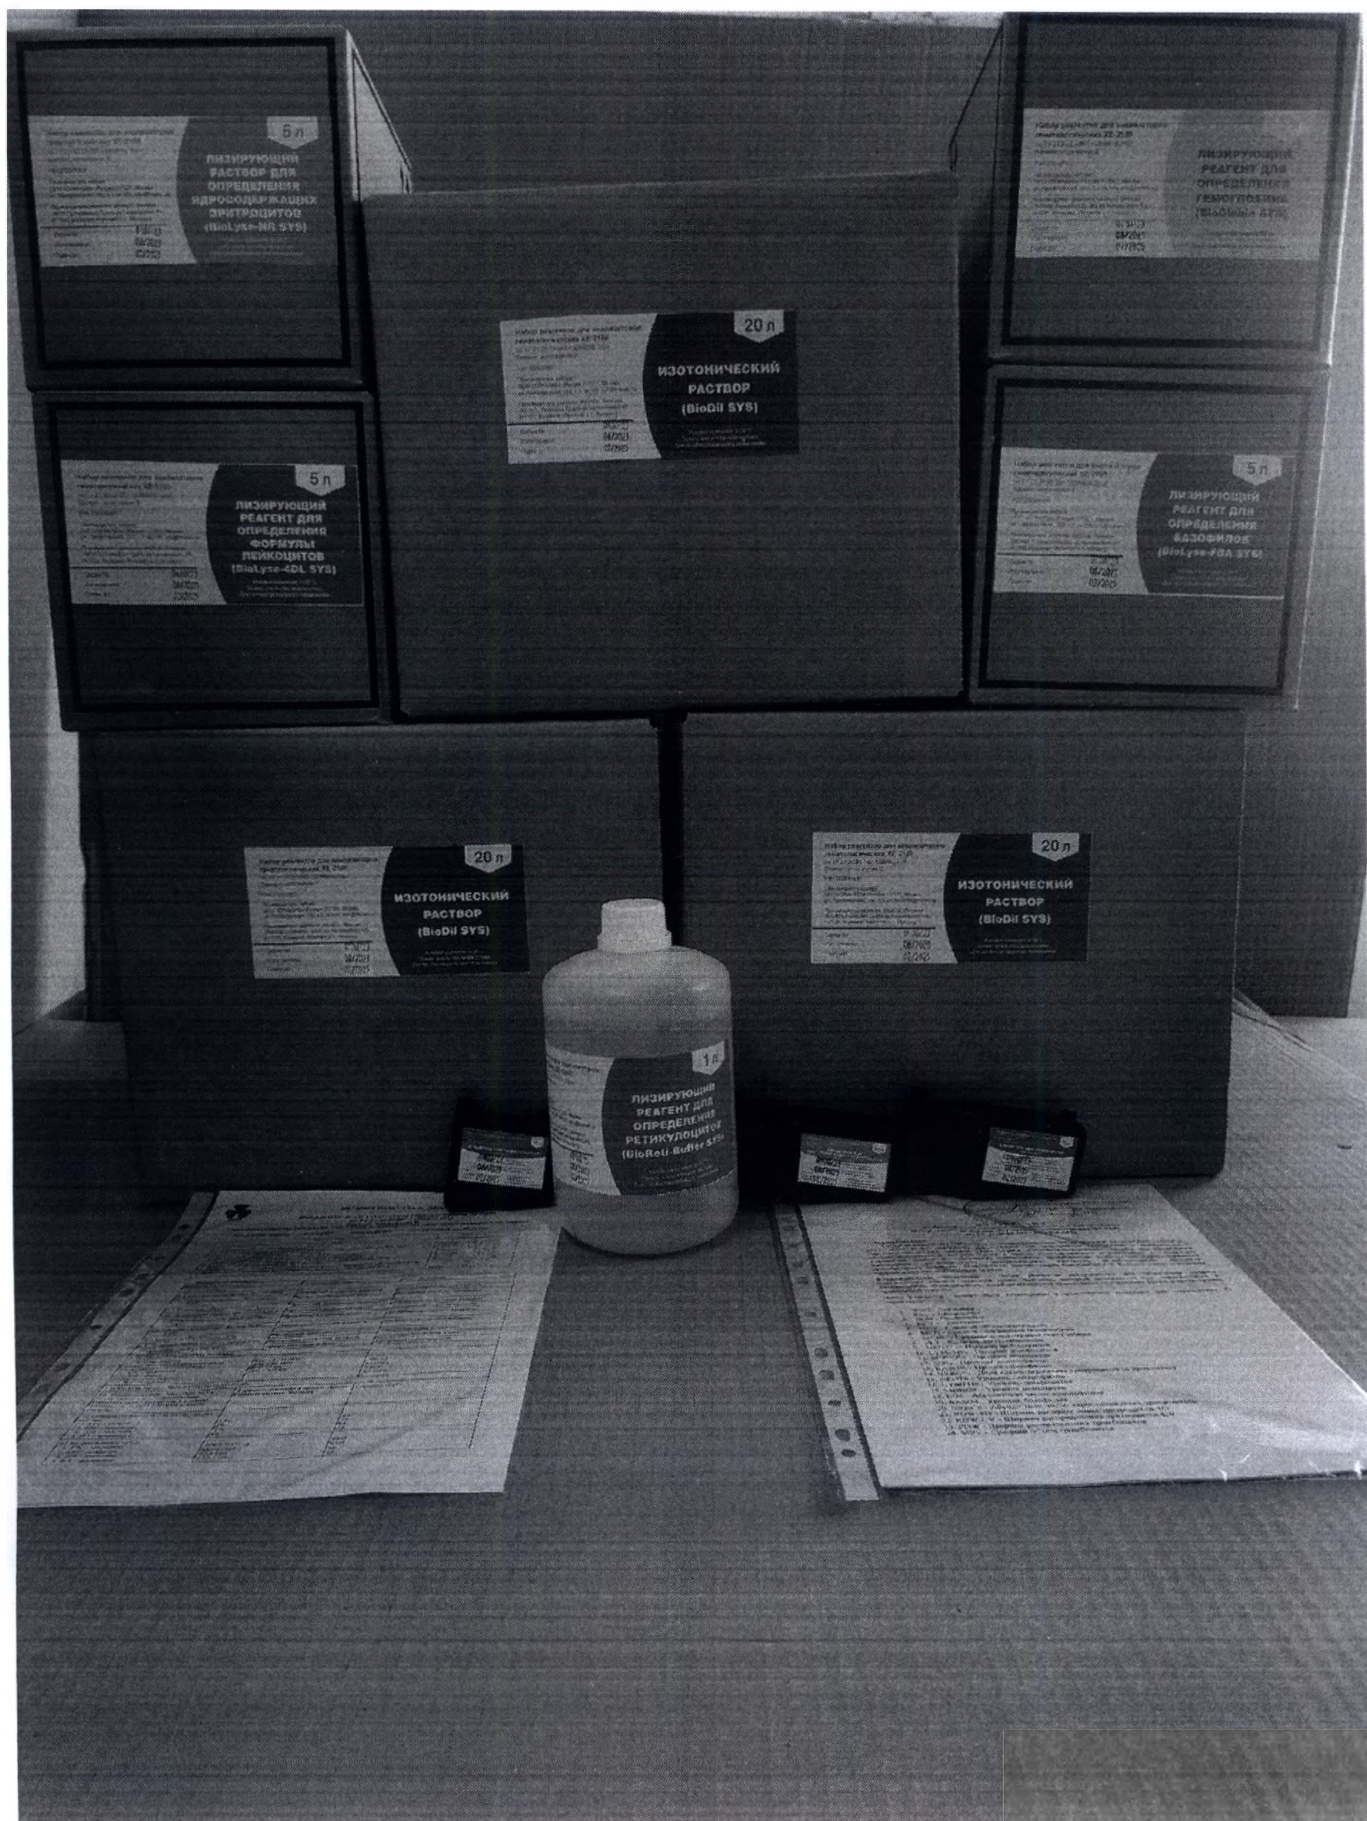


Фото 14. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Изотонический раствор (BioDil-SYS)



Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100
по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022
Вариант исполнения В

РЭН 2023/20831

Производитель набора:
ООО «ТРИАЛЛАБ» (Россия, 117321, Москва,
ул. Профсоюзная, 152, к.3, этаж 100, info@triallab.ru)

Поставщик реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
№1155, Budaörs, Víztorony u.1, Hungary)

Серия №	0400723
Изготовлено:	08/2023
Годен до:	02/2025

20 л

**ИЗОТОНИЧЕСКИЙ
РАСТВОР
(BioDil SYS)**

Условия хранения: 2-8°C.
Используйте до даты окончания.
Для профессионального применения.

Фото 15. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения формулы лейкоцитов (BioLyse-4DL SYS)

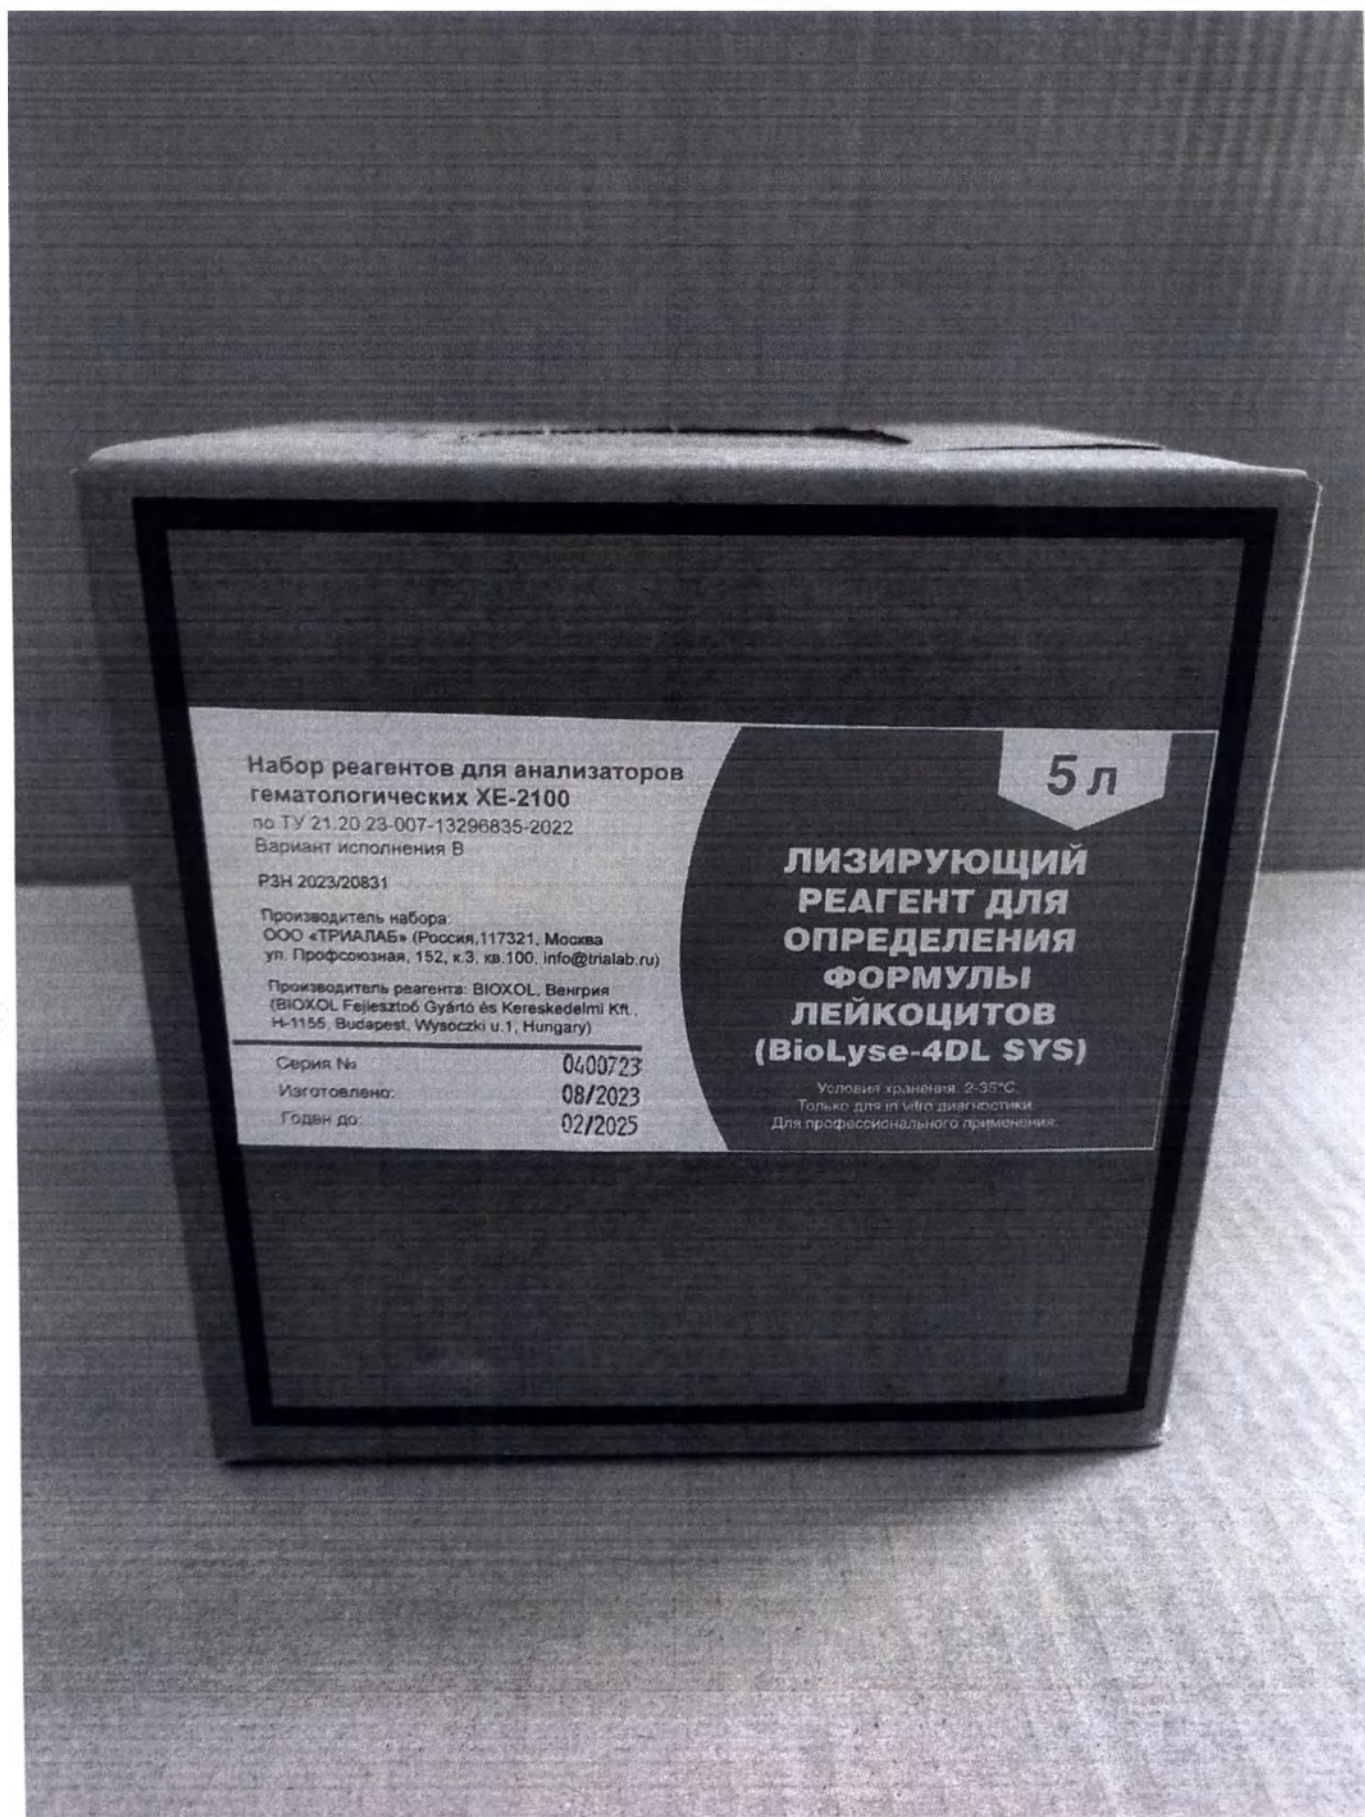


Фото 16. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Краситель для лейкоцитов(BioStain W5P)



Фото 17. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения гемоглобина (BioGlobin SYS)

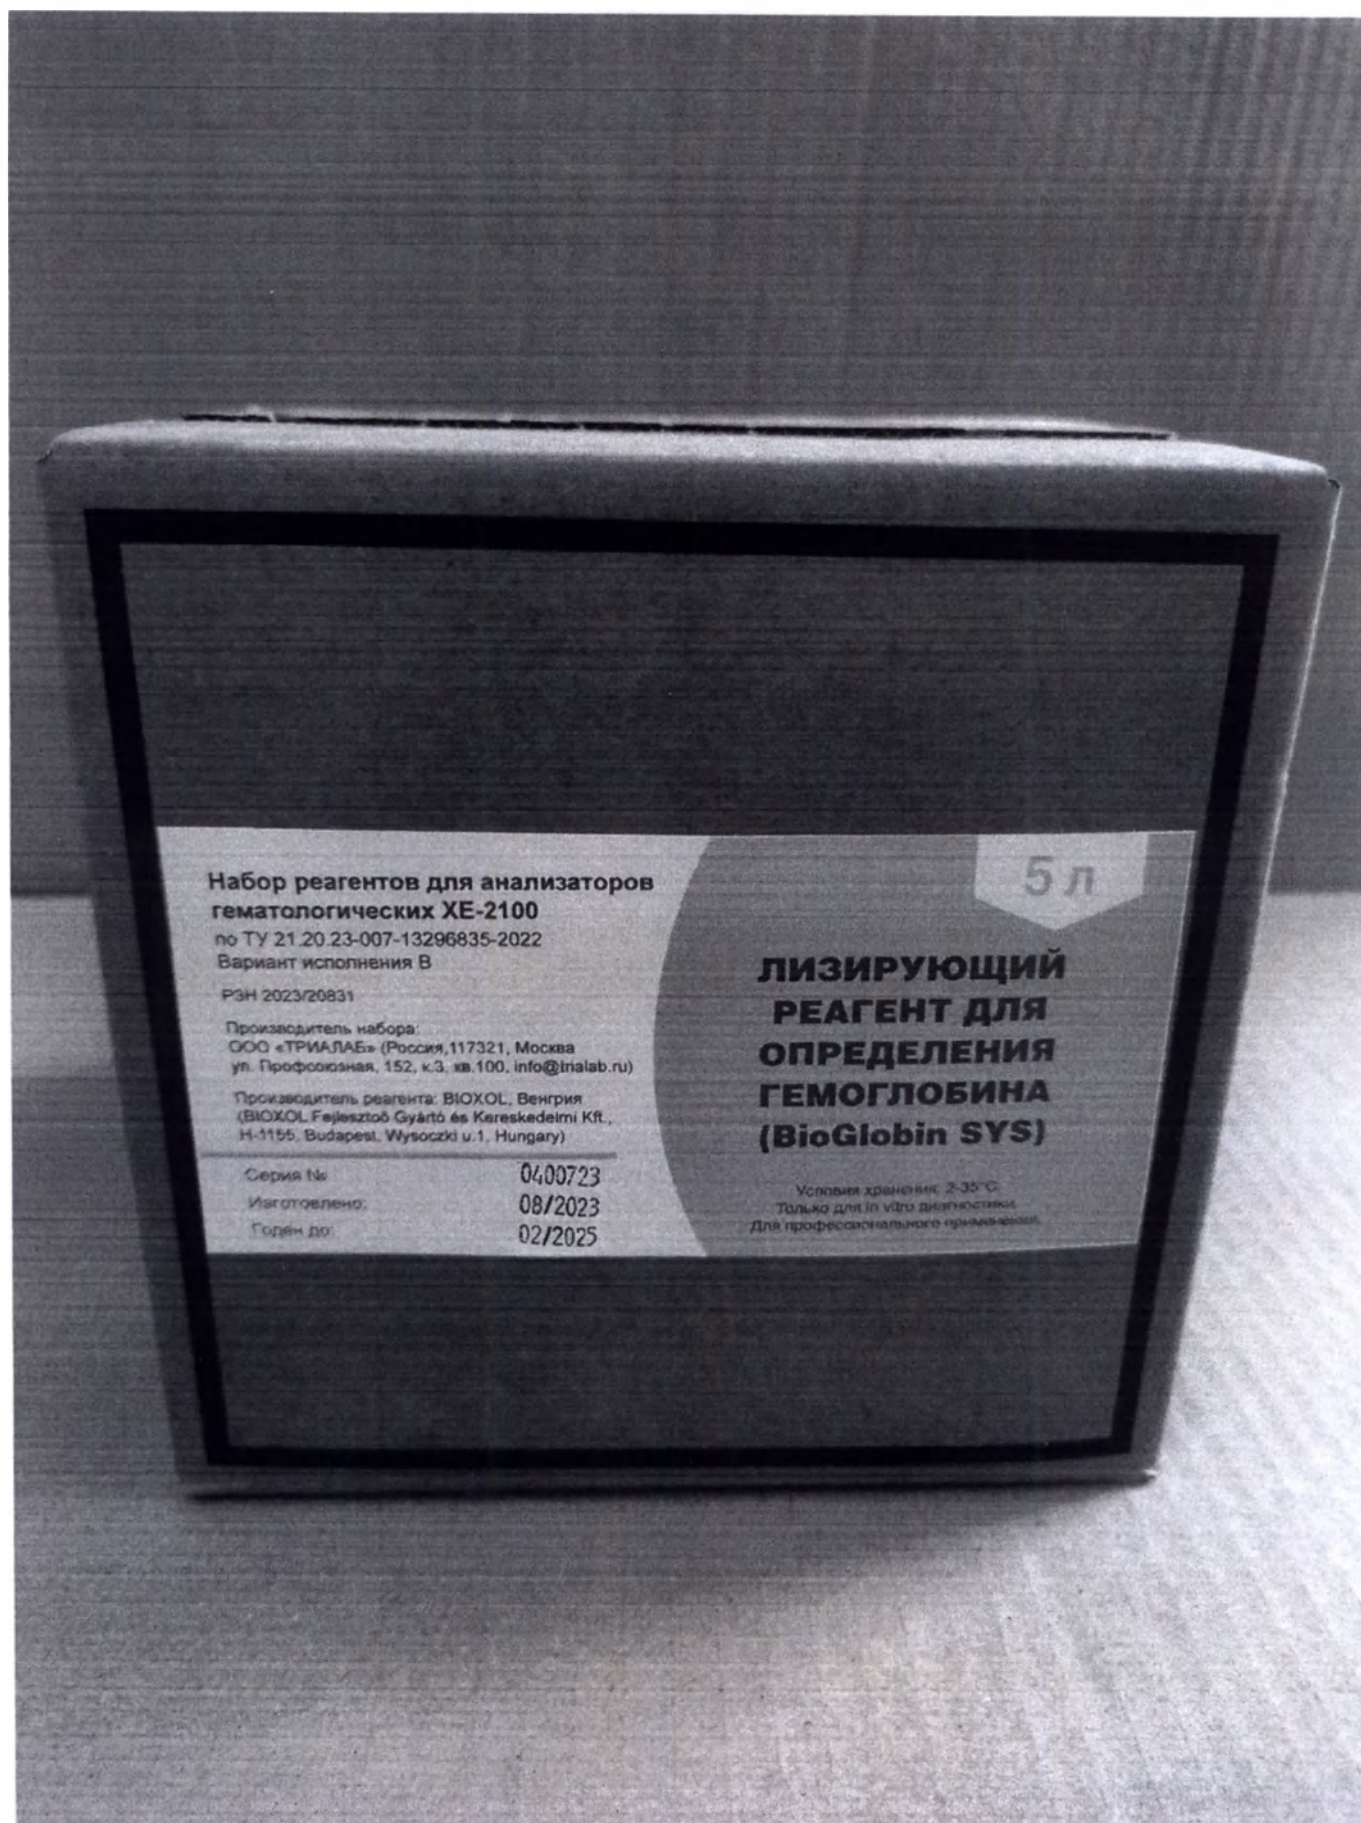


Фото 18. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения базофилов (BioLyse-FBA SYS)



Фото 19. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения ретикулоцитов (BioReti-Buffer SYS)

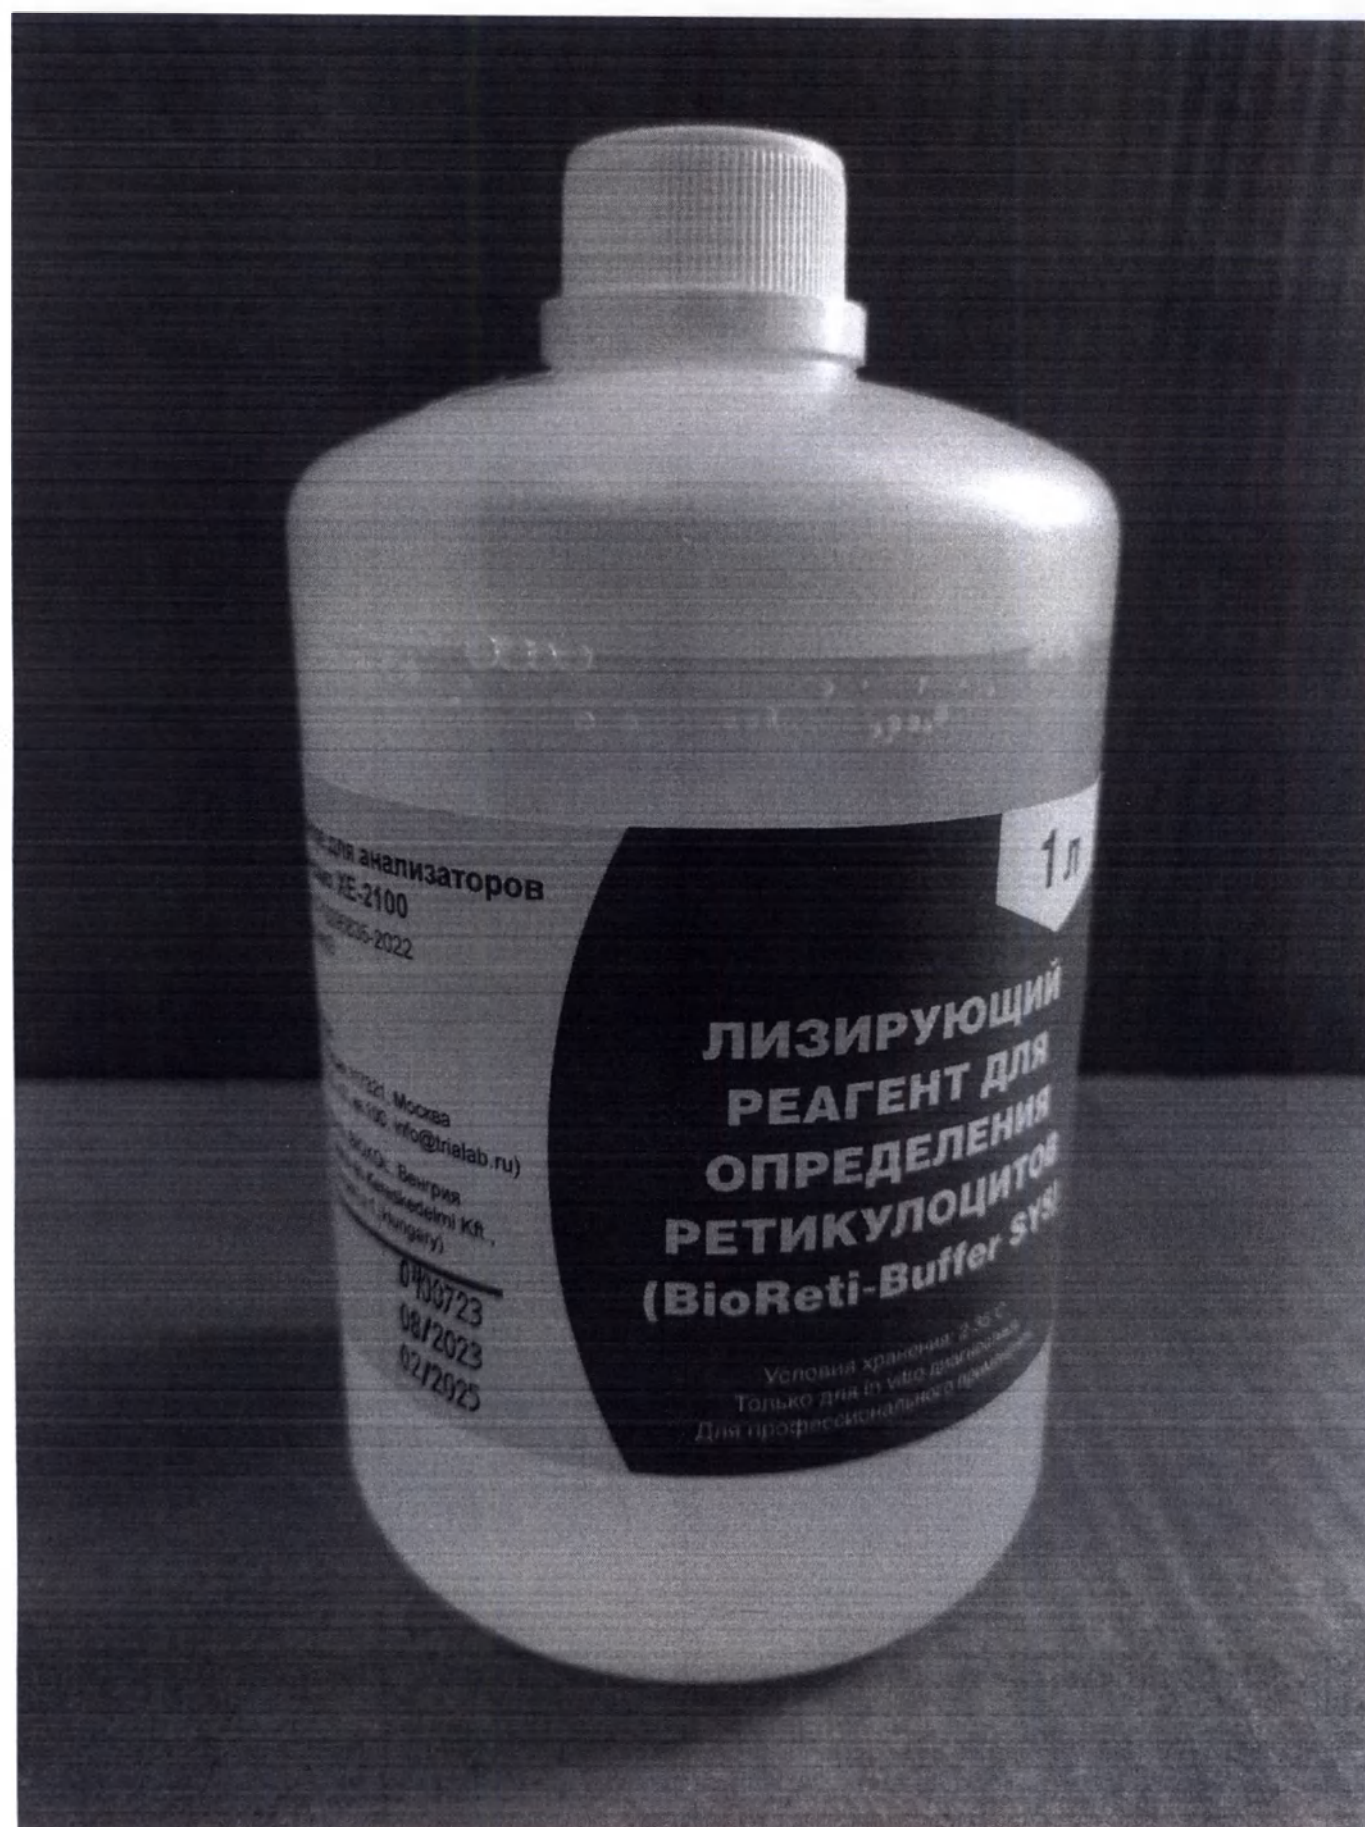


Фото 20. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Краситель для ретикулоцитов (BioStain RET)


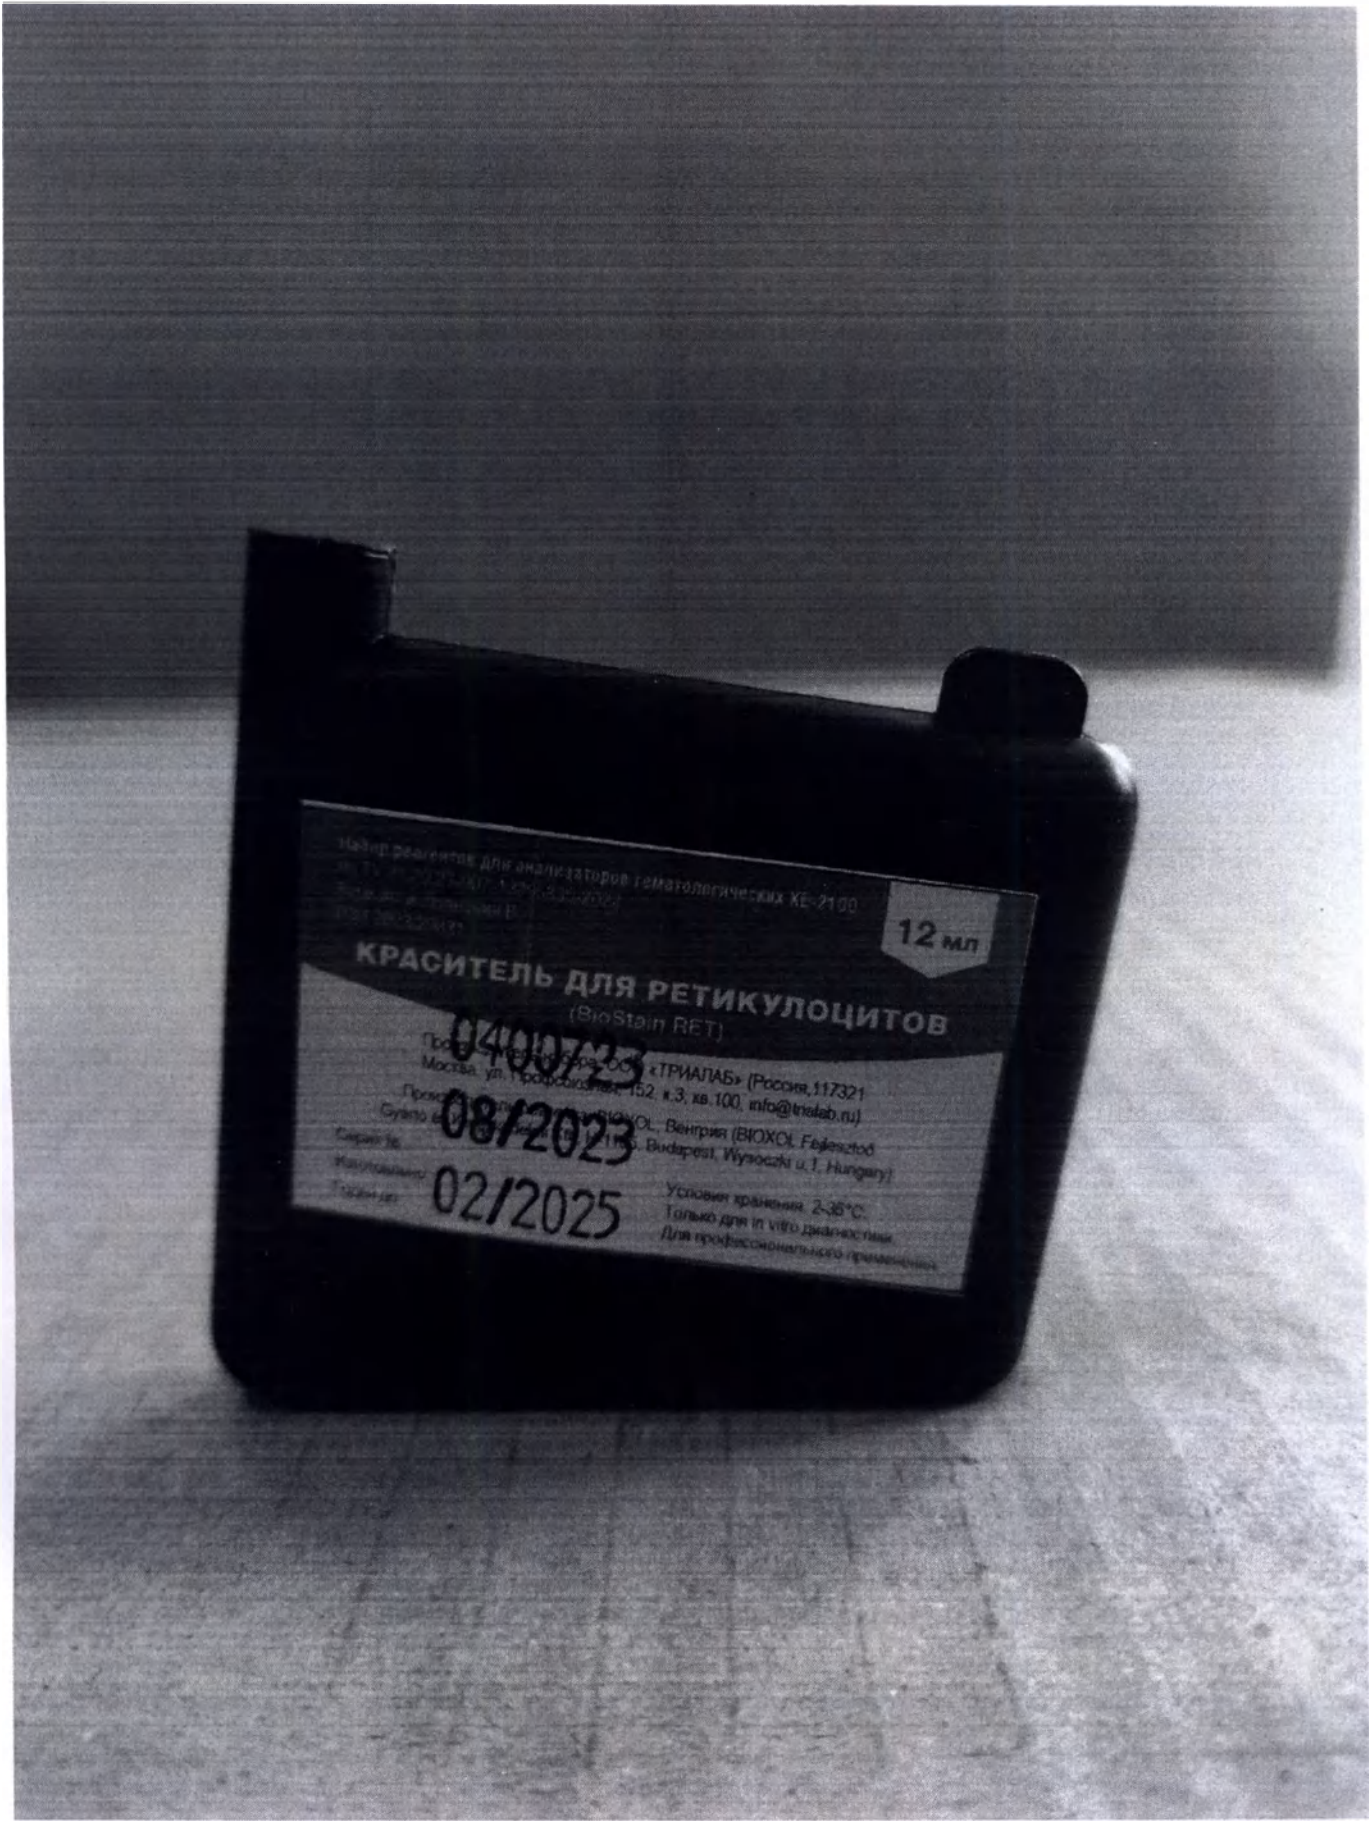


Фото 21. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Лизирующий реагент для определения ядросодержащих эритроцитов (BioLyse-NR SYS)



Фото 22. Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100 по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022. Вариант исполнения В. Краситель для ядросодержащих эритроцитов (BioStain NRBC)



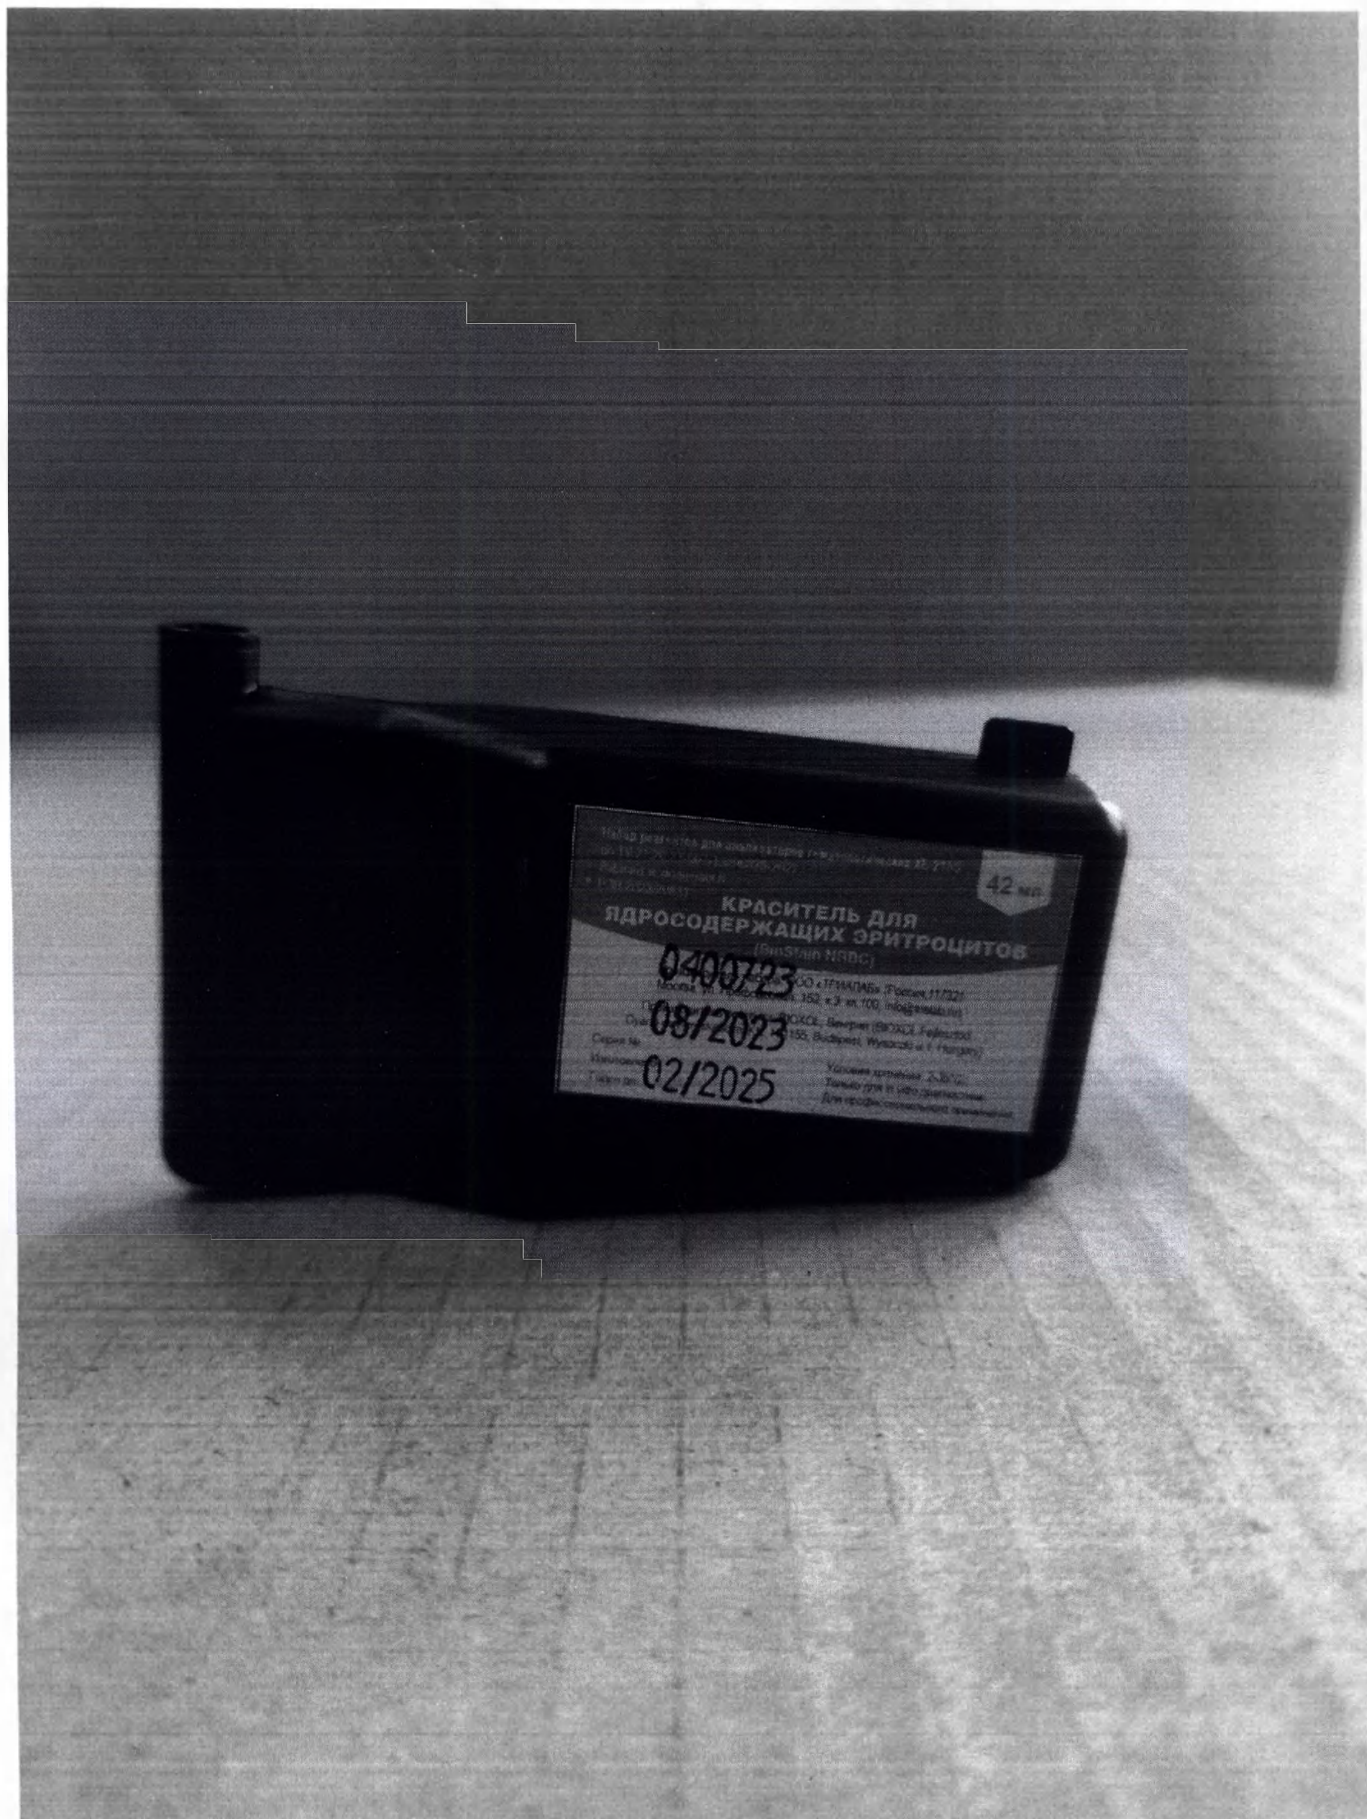

В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

22 листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.

Набор реагентов для анализаторов гематологических XE-2100

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

Состав набора:

1. Изотонический раствор (BioDil SYS)	Канистра 20 л	3 шт.
2. Лизирующий реагент для определения формулы лейкоцитов (BioLyse-4DL SYS)	Канистра 5 л	1 шт.
3. Краситель для лейкоцитов (BioStain W5P)	Картридж 42 мл	1 шт.
4. Лизирующий реагент для определения гемоглобина (BioGlobin SYS)	Канистра 5 л	1 шт.
5. Лизирующий реагент для определения базофилов (BioLyse-FBA SYS)	Канистра 5 л	1 шт.
6. Лизирующий реагент для определения ретикулоцитов (BioReti-Buffer SYS)	Флакон 1 л	1 шт.
7. Краситель для ретикулоцитов (BioStain RET)	Картридж 12 мл	1 шт.
8. Лизирующий реагент для определения ядросодержащих эритроцитов (BioLyse-NR SYS)	Канистра 5 л	1 шт.
9. Краситель для ядросодержащих эритроцитов (BioStain NRBC)	Картридж 42 мл	1 шт.

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагентов: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

РЗН 2023/20831

Хранить и транспортировать: при 2-35 °C

Серия:

Изготовлено:

Годен до:

Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.
Обратитесь к инструкции по применению.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

20 л

**ИЗОТОНИЧЕСКИЙ
РАСТВОР
(BioDil SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФОРМУЛЫ
ЛЕЙКОЦИТОВ
(BioLyse-4DL SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕМОГЛОБИНА
(BioGlobin SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЗОФИЛОВ
(BioLyse-FBA SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

1 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕТИКУЛОЦИТОВ
(BioReti-Buffer SYS)**

Условия хранения: 2-35 °С.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РАСТВОР ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ
ЭРИТРОЦИТОВ
(BioLyse-NR SYS)**

Условия хранения: 2-35 °С.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЙКОЦИТОВ (BioStain W5P)

Производитель набора: ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321
Москва, ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия (BIOXOL Fejlesztő
Gyártó és Kereskedelmi Kft., H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

Условия хранения: 2-35°C.

Только для in vitro диагностики.

Для профессионального применения.

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕТИКУЛОЦИТОВ (BioStain RET)

Производитель набора: ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321
Москва, ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия (BIOXOL Fejlesztő
Gyártó és Kereskedelmi Kft., H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

Условия хранения: 2-35°C.

Только для in vitro диагностики.

Для профессионального применения.

Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100
по TV 21.20.23-007-13296835-2022
Вариант исполнения В
РЗН 2023/20831

42 мл

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ ЭРИТРОЦИТОВ (BioStain NRBC)

Производитель набора: ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321
Москва, ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия (BIOXOL Fejlesztő
Gyártó és Kereskedelmi Kft., H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Условия хранения: 2-35°C.

Изготовлено:

Только для in vitro диагностики.

Годен до:

Для профессионального применения.

В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.



Набор реагентов для анализаторов гематологических XE-2100

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

Состав набора:

1. Изотонический раствор (BioDil SYS)	Канистра 20 л	3 шт.
2. Лизирующий реагент для определения формулы лейкоцитов (BioLyse-4DL SYS)	Канистра 5 л	1 шт.
3. Краситель для лейкоцитов (BioStain W5P)	Картридж 42 мл	1 шт.
4. Лизирующий реагент для определения гемоглобина (BioGlobin SYS)	Канистра 5 л	1 шт.
5. Лизирующий реагент для определения базофилов (BioLyse-FBA SYS)	Канистра 5 л	1 шт.
6. Лизирующий реагент для определения ретикулоцитов (BioReti-Buffer SYS)	Флакон 1 л	1 шт.
7. Краситель для ретикулоцитов (BioStain RET)	Картридж 12 мл	1 шт.
8. Лизирующий реагент для определения ядросодержащих эритроцитов (BioLyse-NR SYS)	Канистра 5 л	1 шт.
9. Краситель для ядросодержащих эритроцитов (BioStain NRBC)	Картридж 42 мл	1 шт.

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагентов: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

РЗН 2023/20831

Хранить и транспортировать: при 2-35 °C

Серия:

Изготовлено:

Годен до:

Только для in vitro диагностики.

Для профессионального применения.

Обратитесь к инструкции по применению.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

20 л

**ИЗОТОНИЧЕСКИЙ
РАСТВОР
(BioDil SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФОРМУЛЫ
ЛЕЙКОЦИТОВ
(BioLyse-4DL SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕМОГЛОБИНА
(BioGlobin SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЗОФИЛОВ
(BioLyse-FBA SYS)**

Условия хранения: 2-35°C.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

1 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РЕАГЕНТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕТИКУЛОЦИТОВ
(BioReti-Buffer SYS)**

Условия хранения: 2-35°С.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

**Набор реагентов для анализаторов
гематологических ХЕ-2100**

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

РЗН 2023/20831

Производитель набора:

ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321, Москва
ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия
(BIOXOL Fejlesztő Gyártó és Kereskedelmi Kft.,
H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

5 л

**ЛИЗИРУЮЩИЙ
РАСТВОР ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ
ЭРИТРОЦИТОВ
(BioLyse-NR SYS)**

Условия хранения: 2-35°С.
Только для in vitro диагностики.
Для профессионального применения.

Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100
по TV 21.20.23-007-13296835-2022
Вариант исполнения В
РЗН 2023/20831

42 мл

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЕЙКОЦИТОВ (BioStain W5P)

Производитель набора: ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321
Москва, ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия (BIOXOL Fejlesztő
Gyártó és Kereskedelmi Kft., H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

Условия хранения: 2-35°C.

Только для in vitro диагностики.

Для профессионального применения.

Набор реагентов для анализаторов гематологических ХЕ-2100

по ТУ 21.20.23-007-13296835-2022

Вариант исполнения В

ИЗН 2023/20831

12 мл

КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ РЕТИКУЛОЦИТОВ

(BioStain RET)

Производитель набора: ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321

Москва, ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия (BIOXOL Fejlesztő
Gyártó és Kereskedelmi Kft., H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

Условия хранения: 2-35°C.

Только для in vitro диагностики.

Для профессионального применения.

**КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ
ЯДРОСОДЕРЖАЩИХ ЭРИТРОЦИТОВ**
(BioStain NRBC)

Производитель набора: ООО «ТРИАЛАБ» (Россия, 117321
Москва, ул. Профсоюзная, 152, к.3, кв.100, info@trialab.ru)

Производитель реагента: BIOXOL, Венгрия (BIOXOL Fejlesztő
Gyártó és Kereskedelmi Kft., H-1155, Budapest, Wysoczki u.1, Hungary)

Серия №

Изготовлено:

Годен до:

Условия хранения: 2-35°C.

Только для in vitro диагностики.

Для профессионального применения.

В настоящем документе
проверено, прошито и
скреплено печатью

листов

Генеральный директор
ООО «Триалаб»

Прозоровский Н.С.

