



ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
«14» 12 2023 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22г
СЫСОВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (РТ)
коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии СХ
для диагностики in vitro

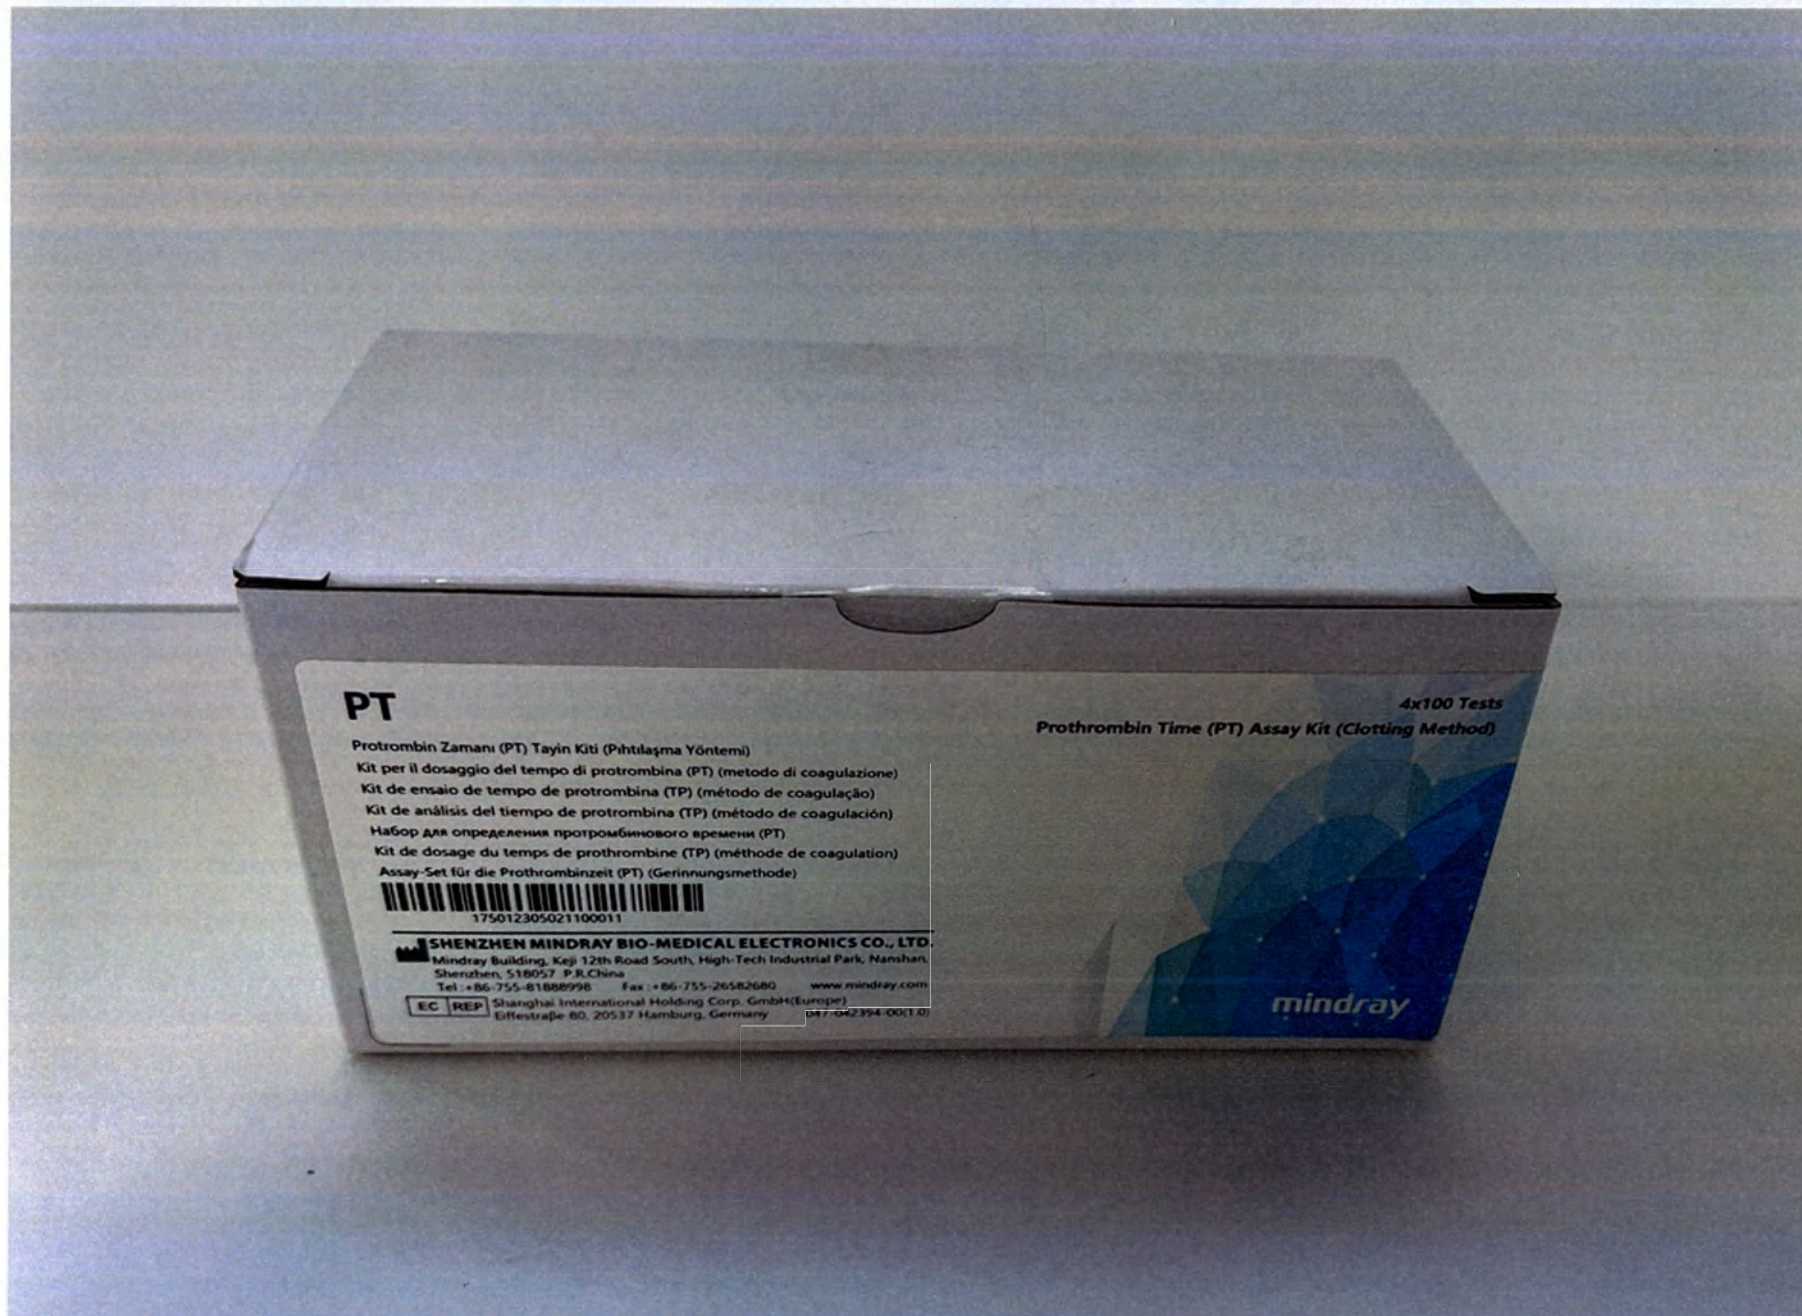


Рисунок 1 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (PT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro, 4 x 100 тестов (вид 1)

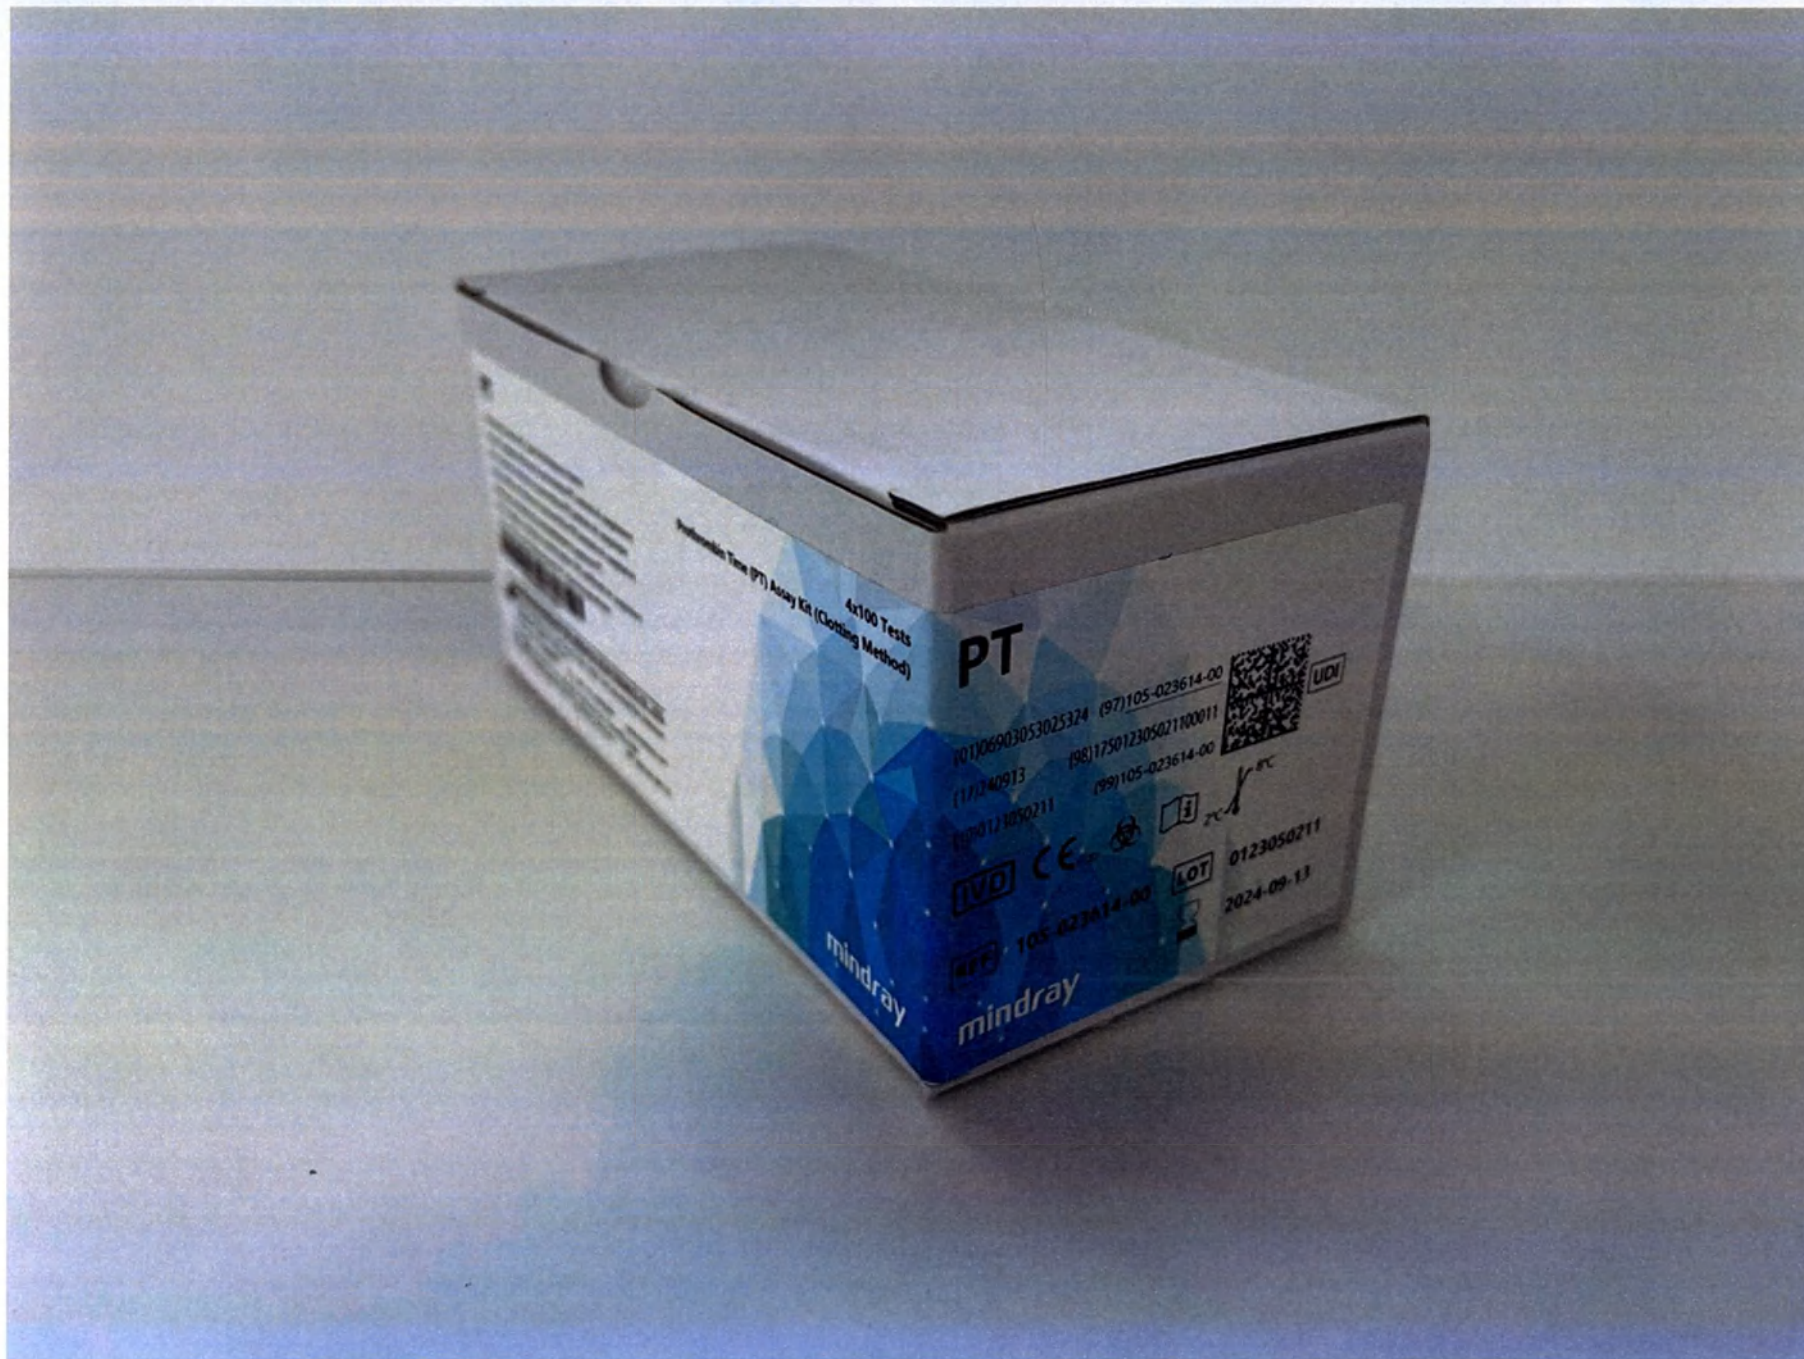


Рисунок 2 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (PT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CV для диагностики in vitro, 4 x 100 тестов (вид 2)

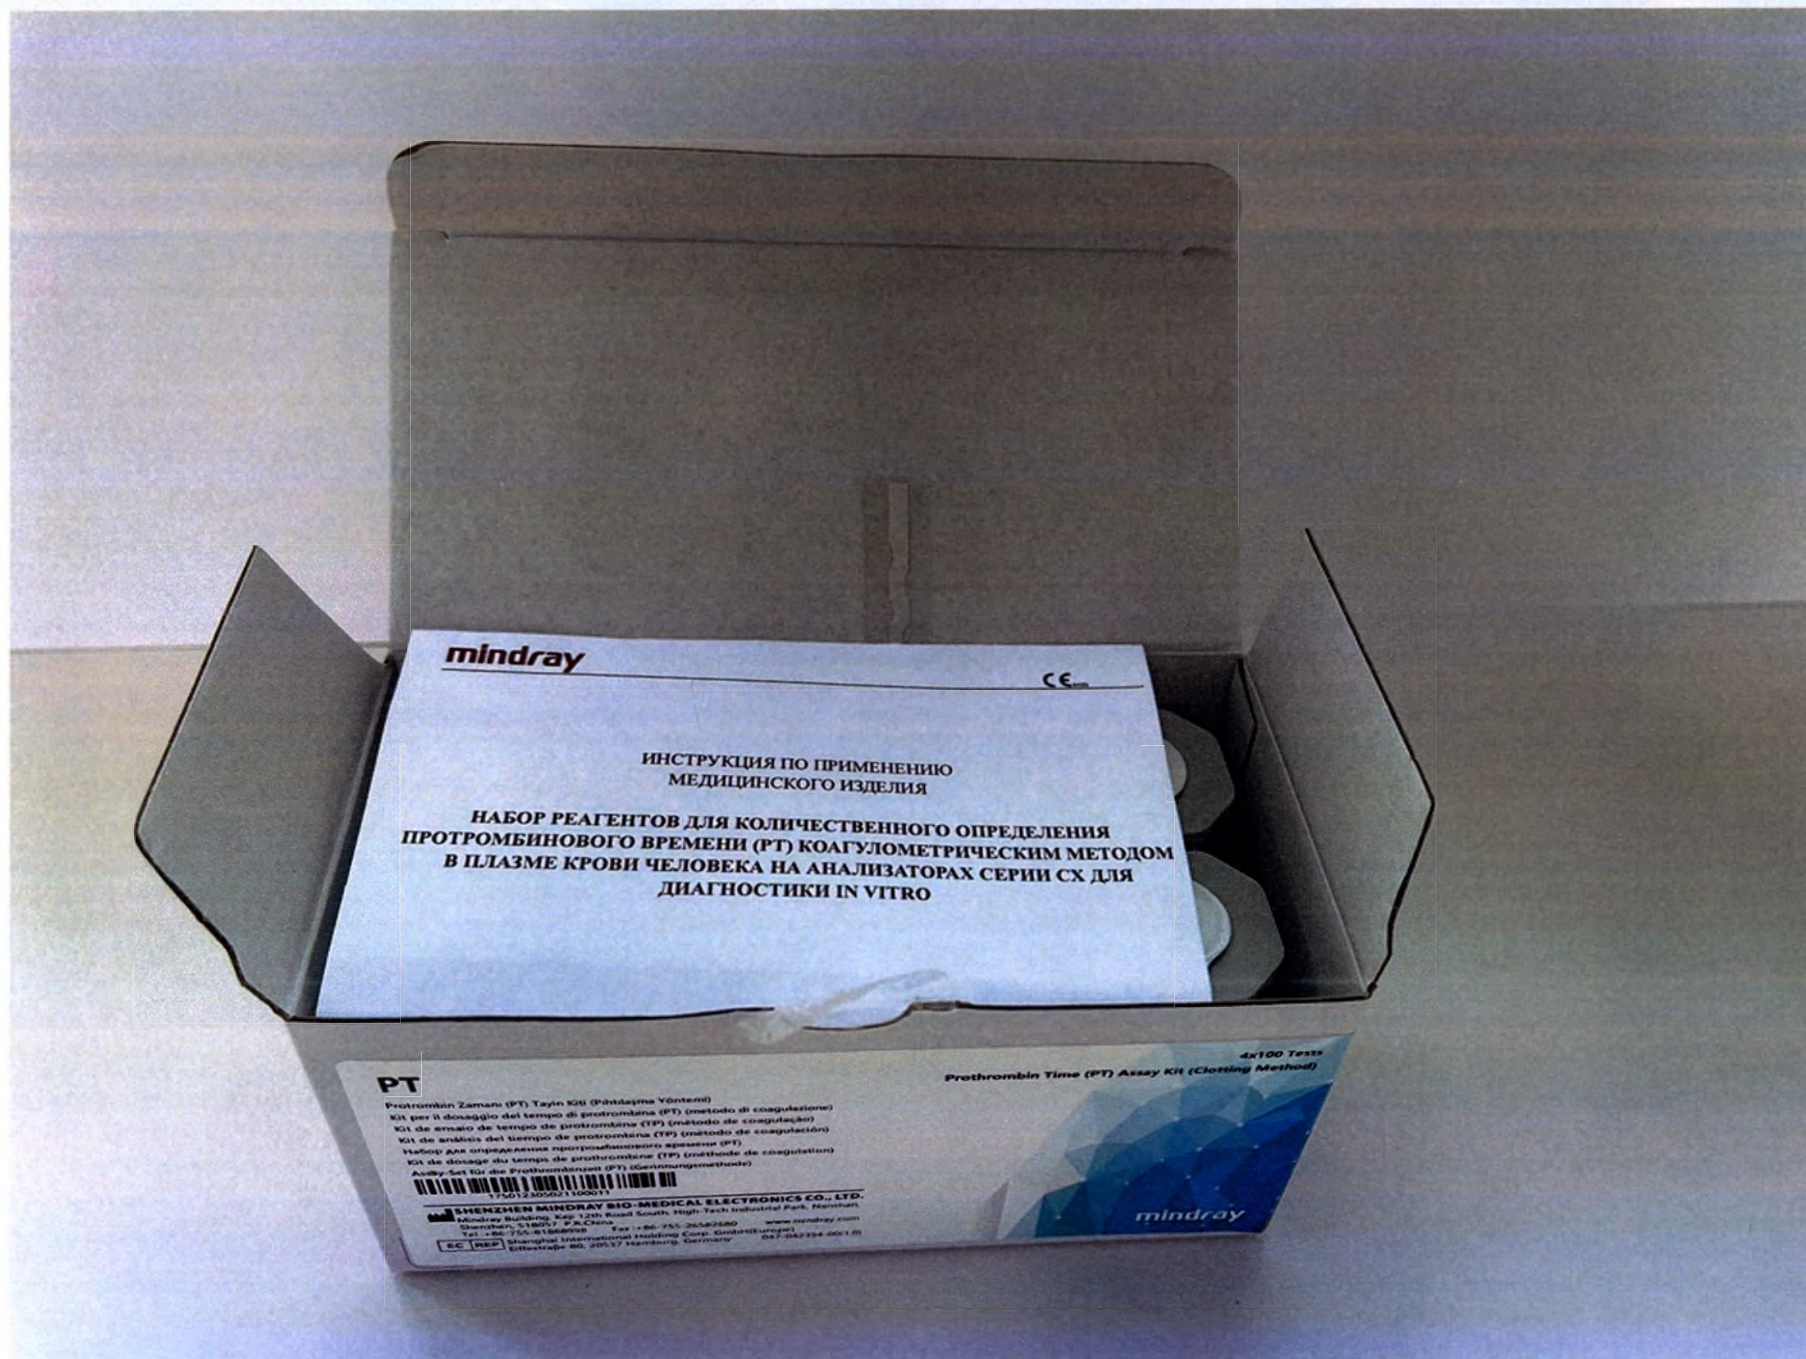


Рисунок 4 Вскрытая упаковка Набор реагентов для количественного определения тромбинового времени (ТТ) коагулометрическим методом в плазме крови человека



Рисунок 5 Вскрытая упаковка Набор реагентов для количественного определения тромбинового времени (ТТ) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro, 4 x 100 тестов (вид 2)

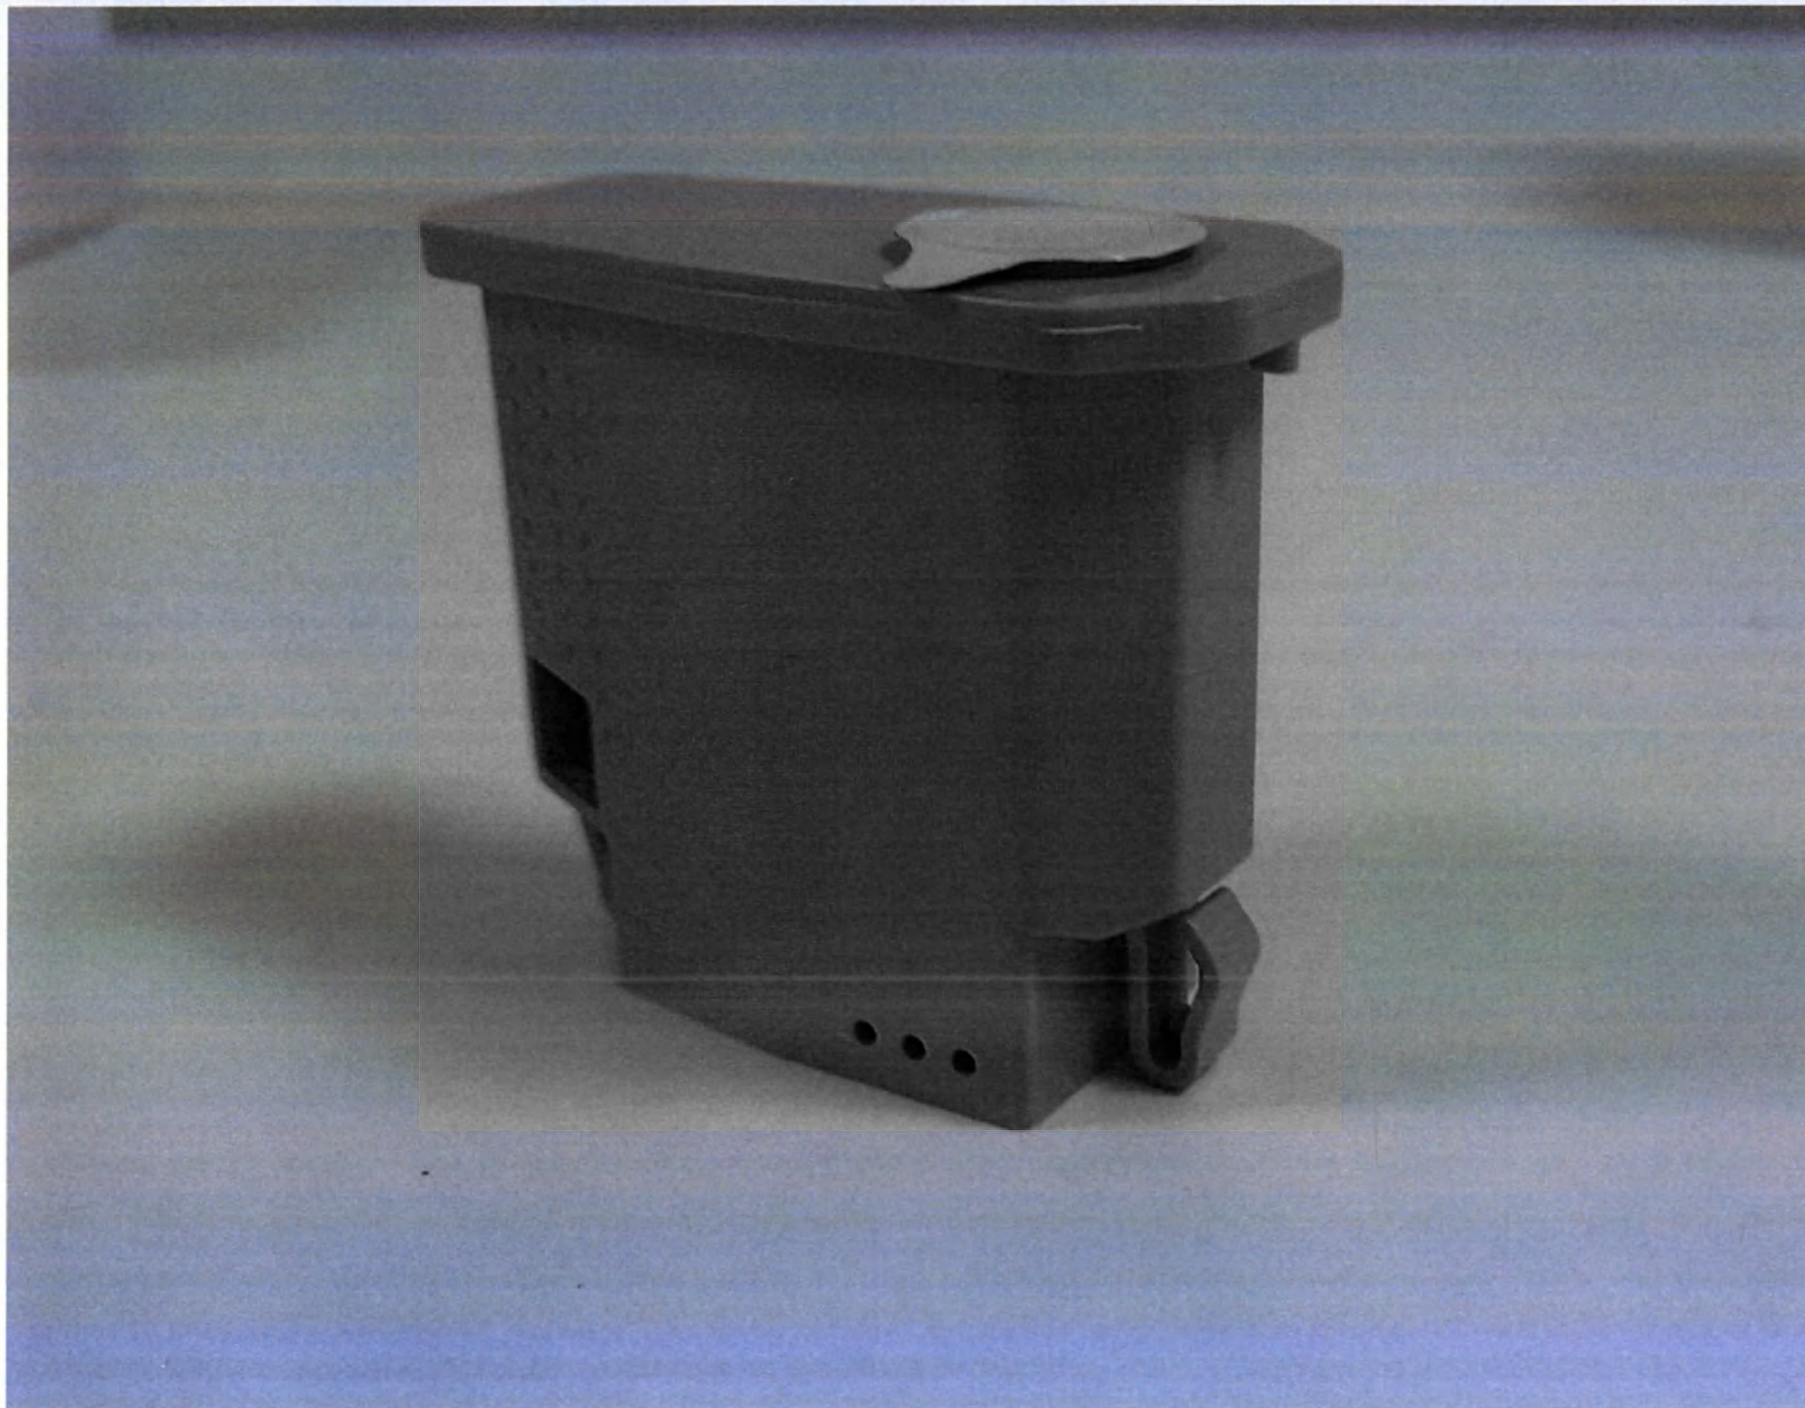


Рисунок 6 Общий вид Набор реагентов для количественного определения тромбинового времени (ТТ) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторе серии CX для диагностики in vitro, 4 x 100 тестов





Рисунок 8 Кассета с реагентом для определения протромбинового времени (PT) на 100 тестов (вид 2)



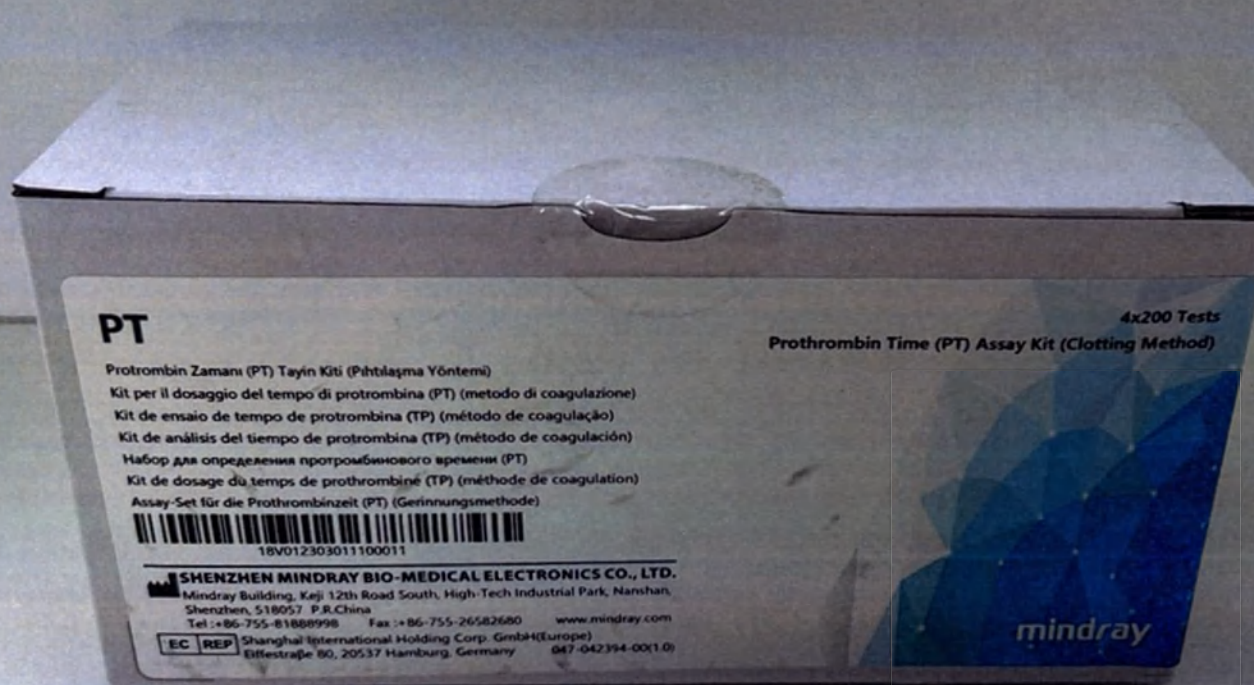


Рисунок 10 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (PT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro, 4 x 200 тестов (вид 1)



Рисунок 11 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (PT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro, 4 x 200 тестов (вид 2)

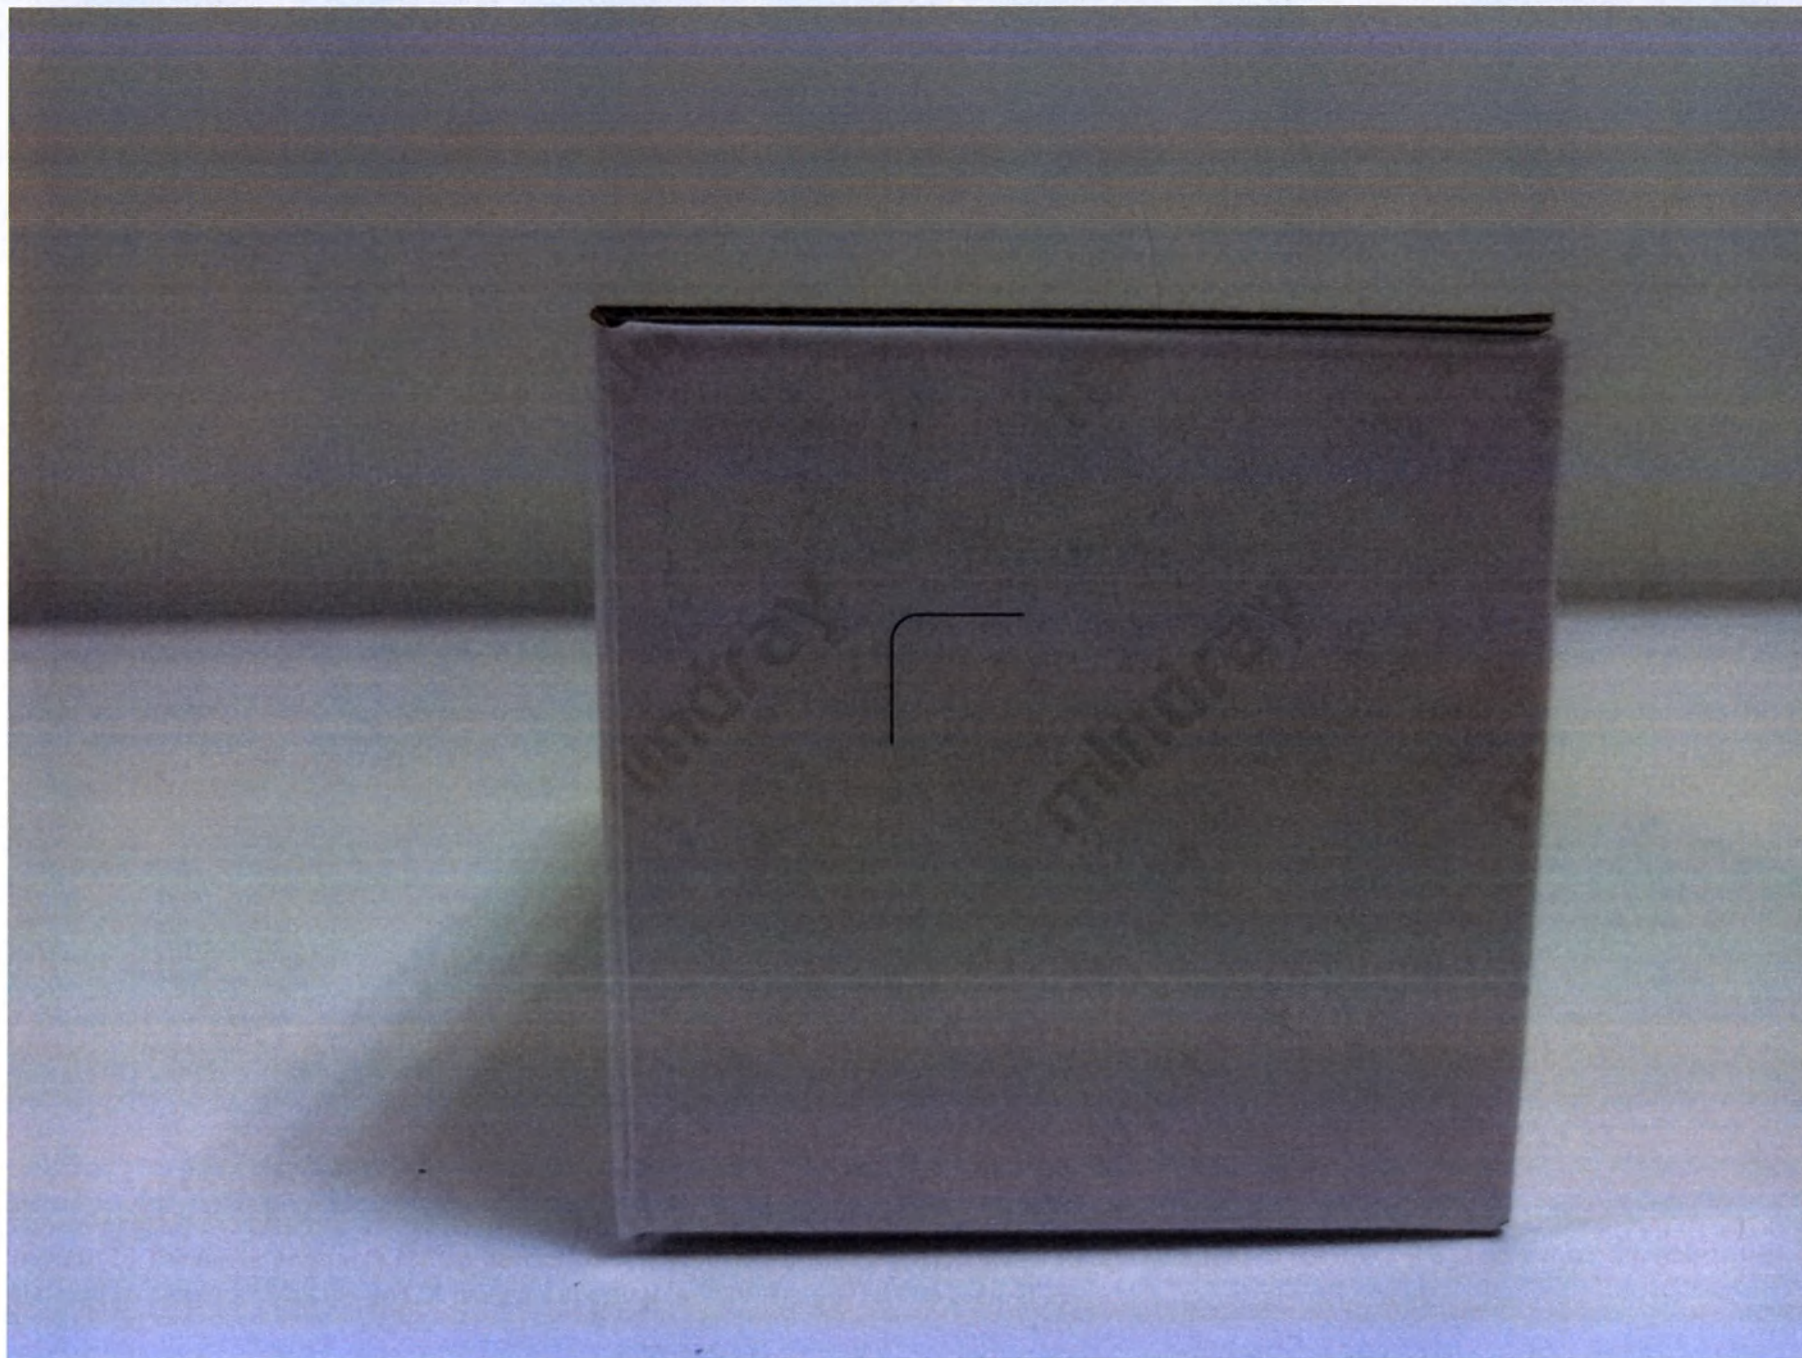


Рисунок 12 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (РТ) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии СХ для диагностики in vitro, 4 x 200 тестов (вид 3)



Рисунок 13 Внешняя упаковка Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (PT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro, 4 x 200 тестов (вид 4)

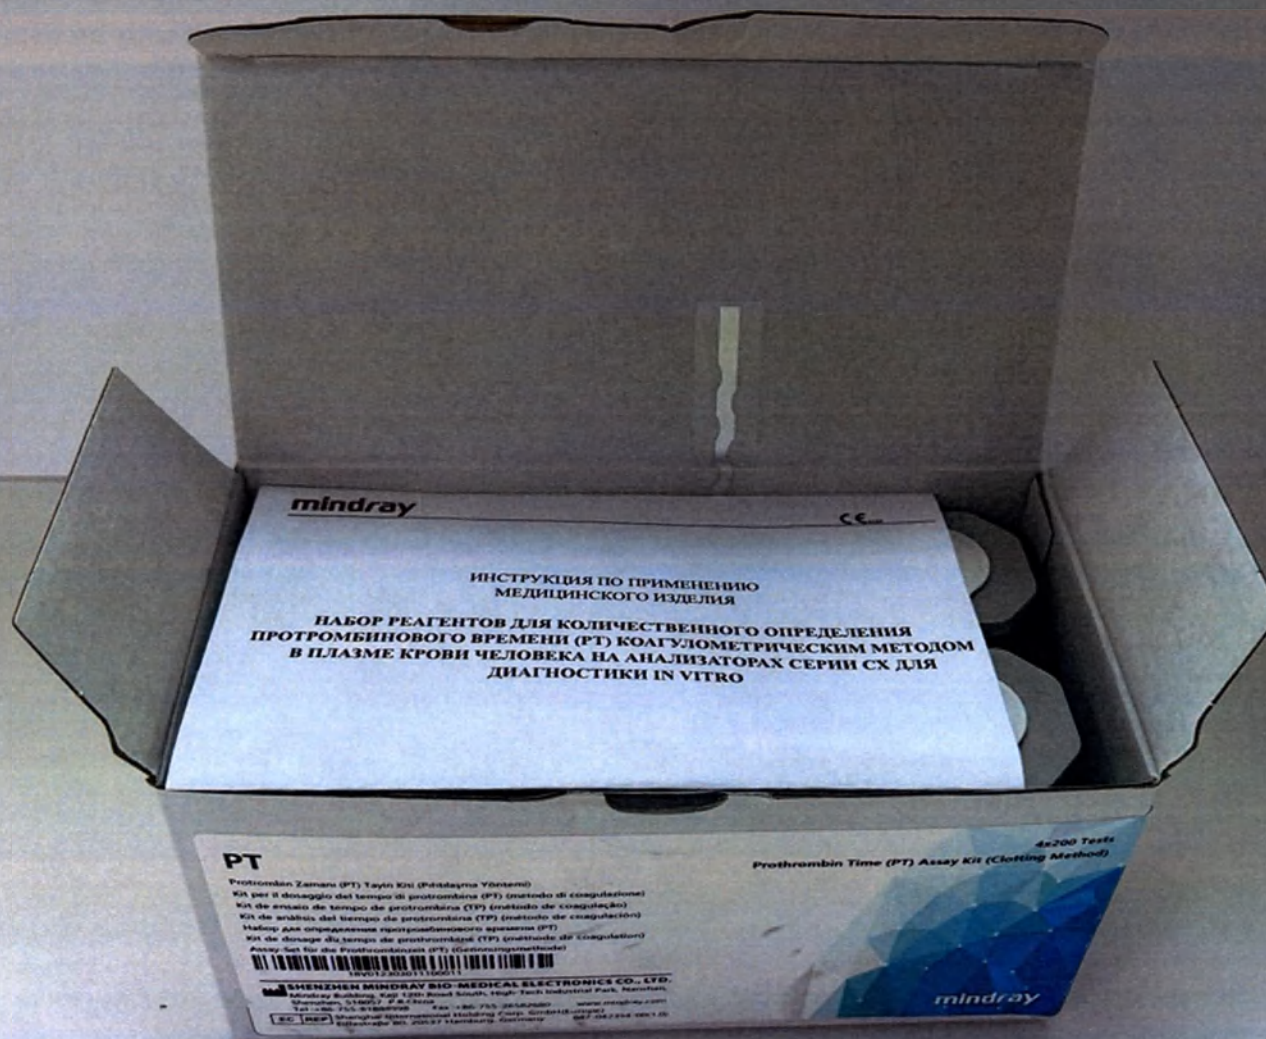


Рисунок 14 Вскрытая упаковка Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (PT) коагулометрическим методом в плазме крови



Рисунок 15 Общий вид Набор реагентов для количественного определения протромбинового времени (PT) коагулометрическим методом в плазме крови человека на анализаторах серии CX для диагностики in vitro, 4 x 200 тестов



Рисунок 16 Кассета с реагентом для определения протромбинового времени (PT) на 200 тестов (вид 1)

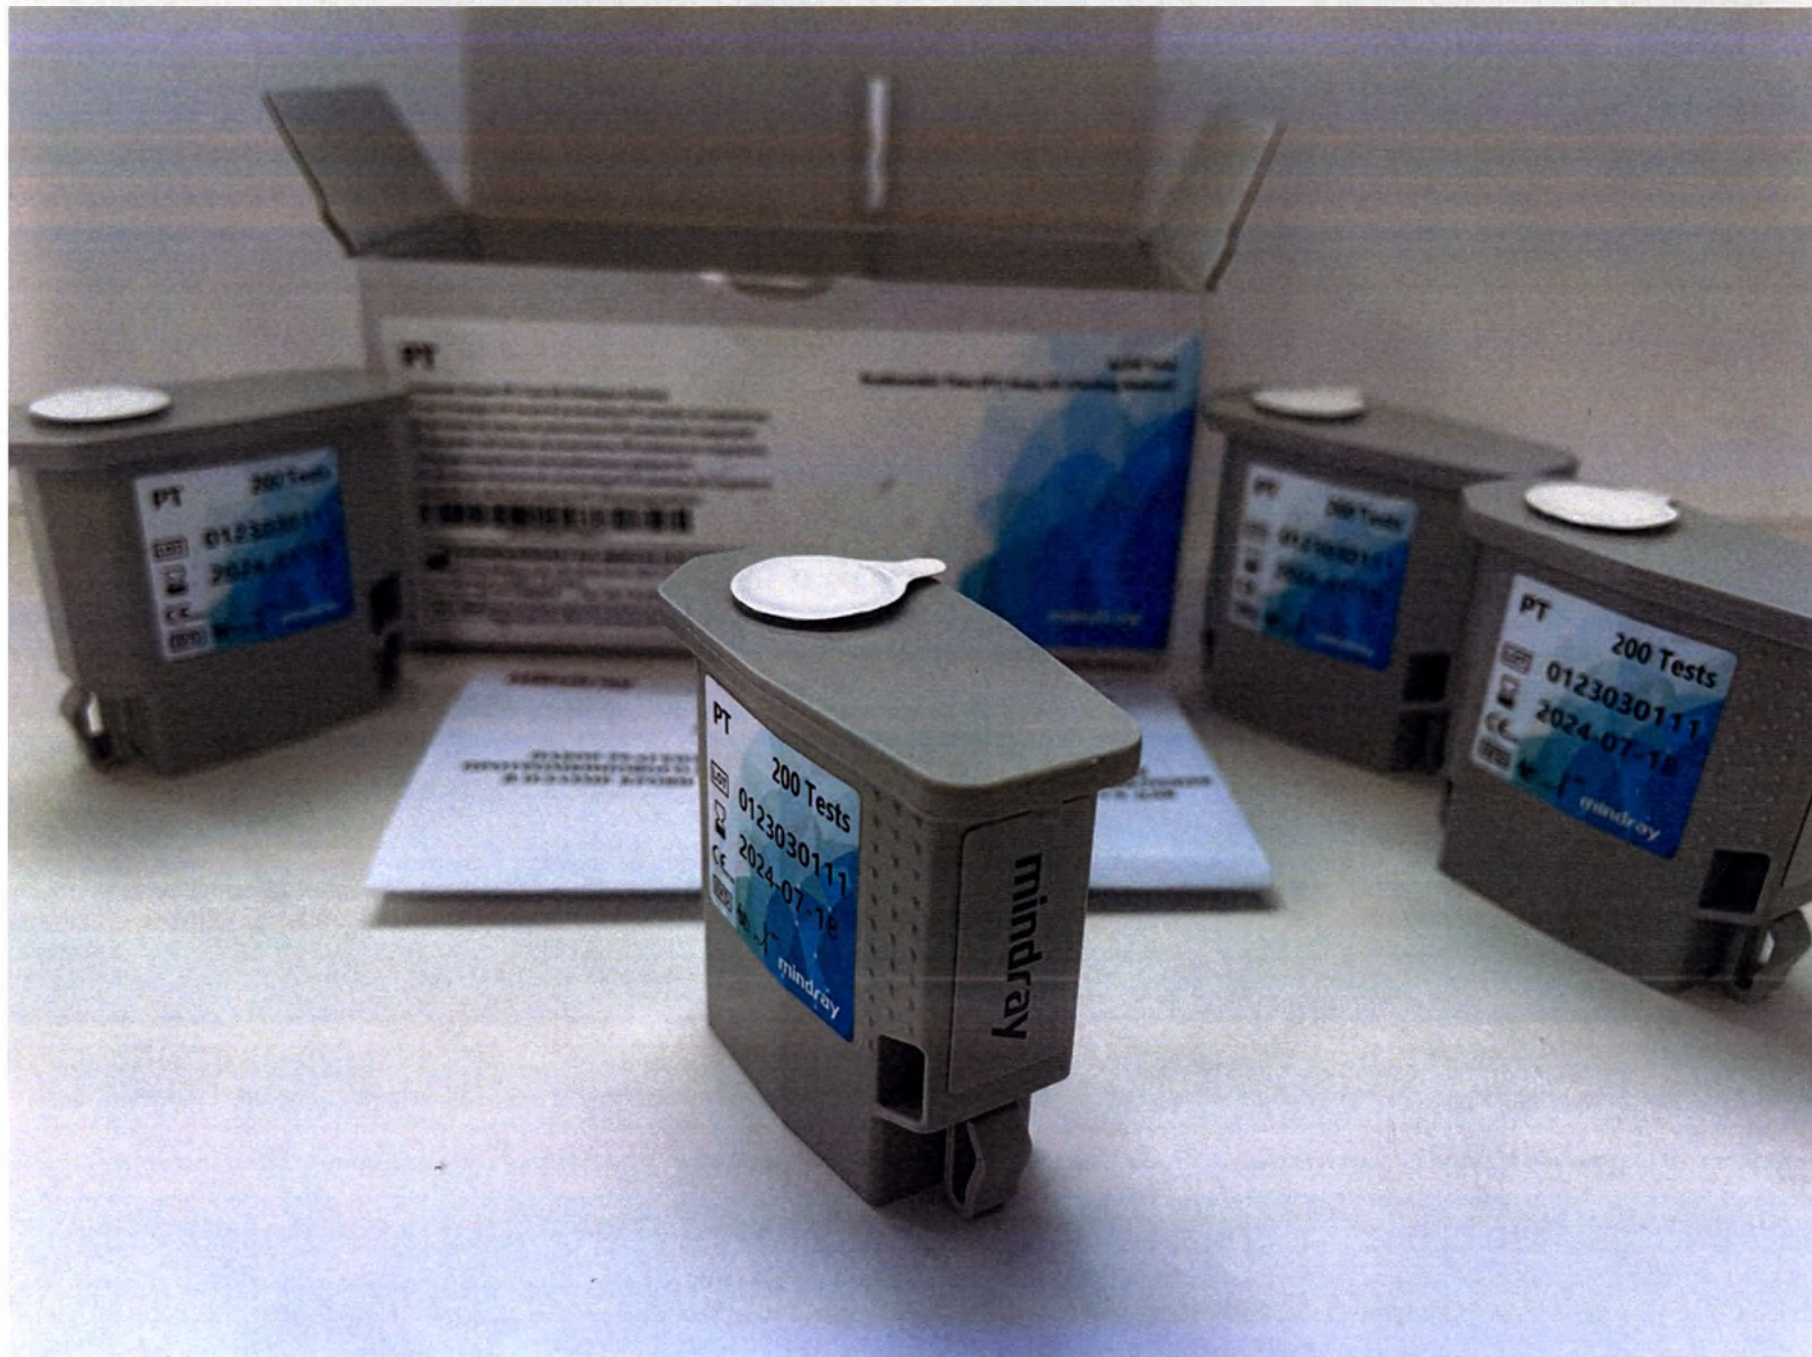


Рисунок 17 Кассета с реагентом для определения протромбинового времени (PT) на 200 тестов (вид 2)

Сысоева 18

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г

СЫСОЕВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

