

ПОДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Сюн Вэй.
2024 г.

«Миндрей Медикал Рус»
Limited Liability Company
Mindrui Medical Rus

по доверенности от 13.12.23г
Сысоева Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор кювет реакционных для автоматических анализаторов коагуляции серии СХ
для диагностики in vitro



OR-202306160001



香港发俄罗斯

CAMEX AIRLINES LLC



207 0501 9711 0 0021

AIR WAYBILL NO.

207 0501 9711

DESTINATION

KGF

TOTAL PIECES

40

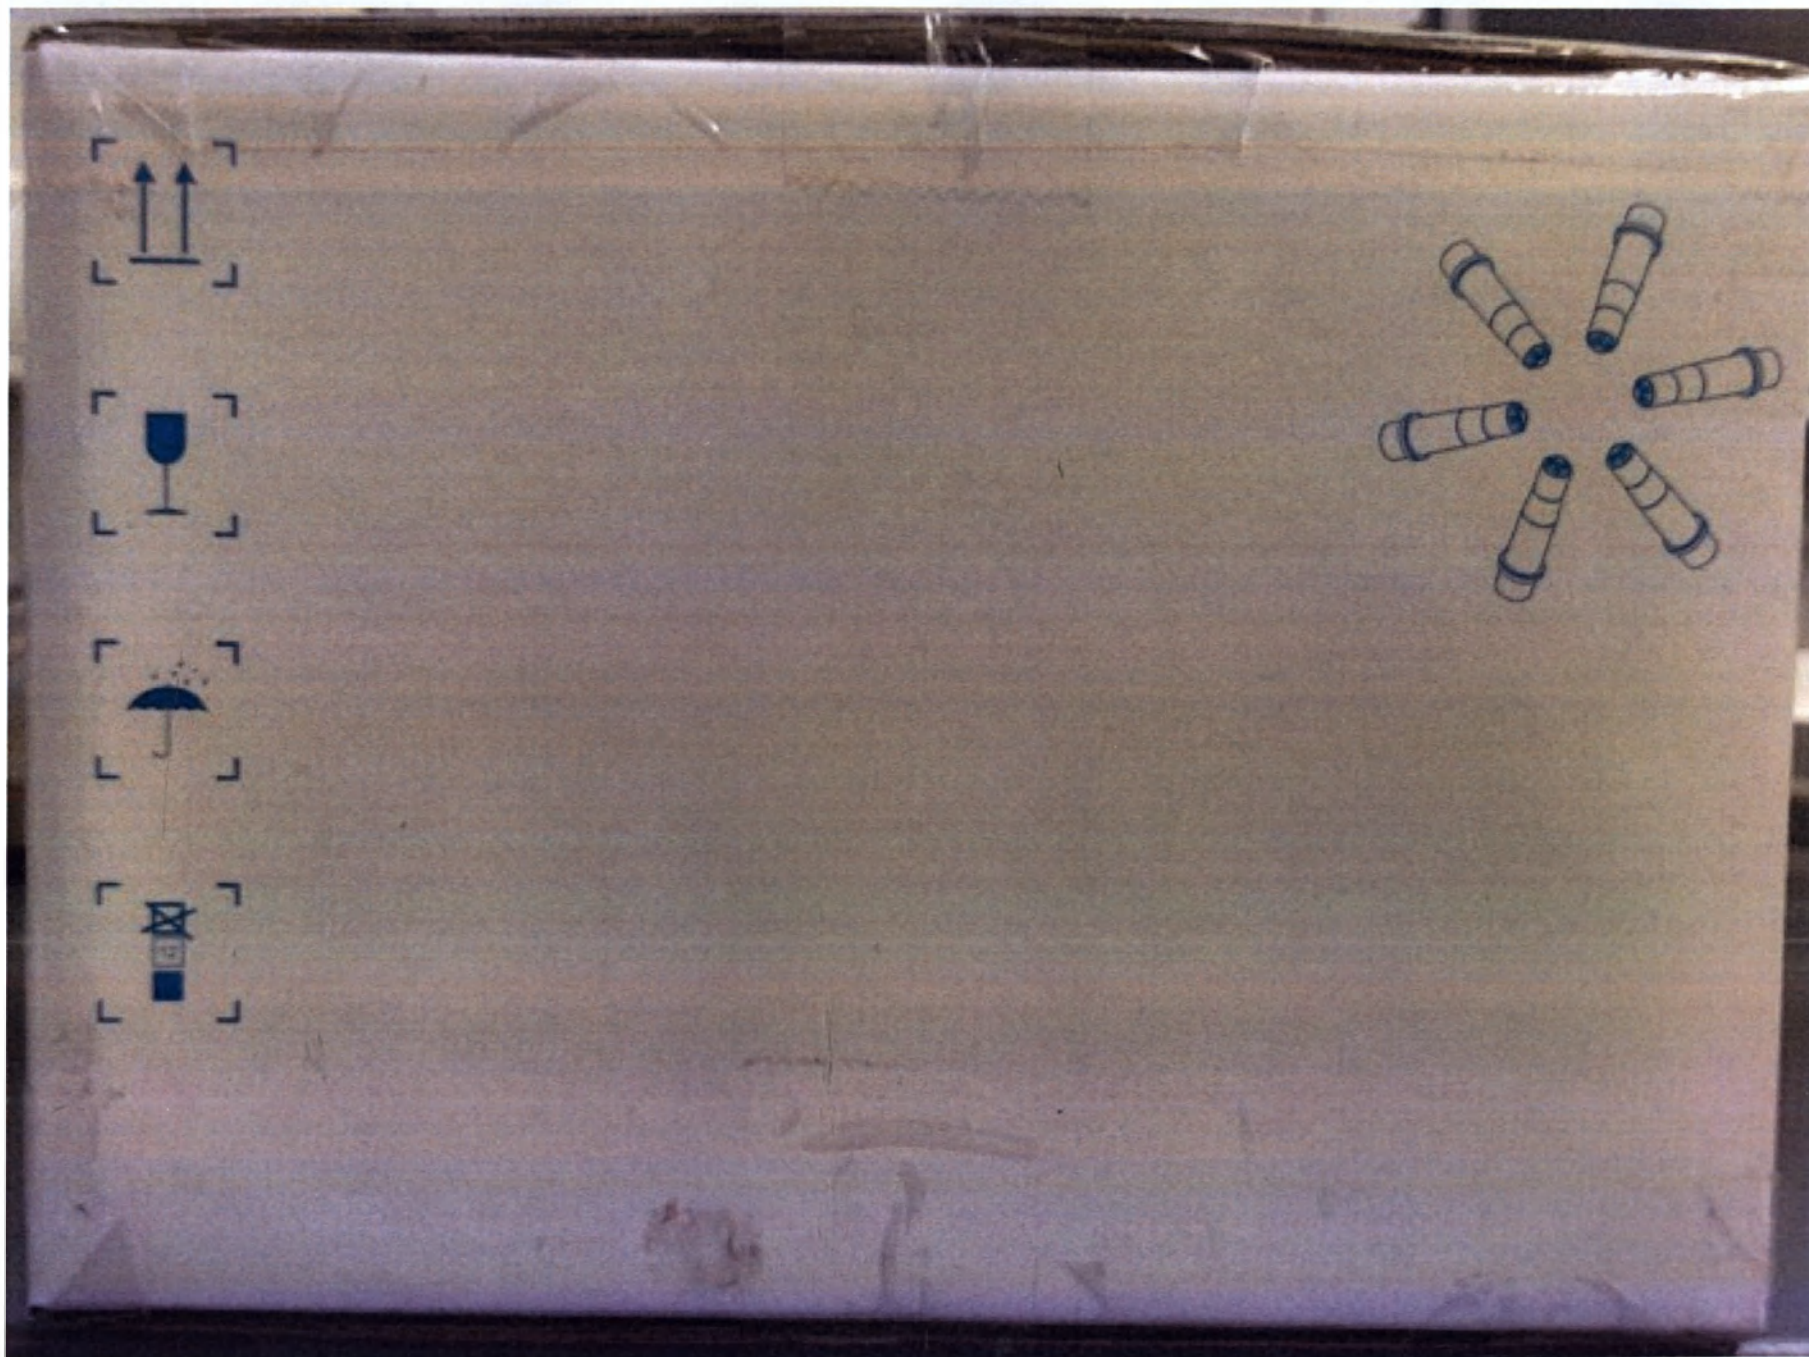


Рисунок 2. Внешняя упаковка Набор кювет реакционных для автоматических анализаторов коагуляции серии CX для диагностики in vitro, (вид 2)

产品符合: 国家标准环境保护总局、卫生部发布的(HJ421-2008)
医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准。

医疗废物包装袋



内置废物种类:

A: 感染性废物 ☐

B: 病理性废物 ☐

C: 损伤性废物 ☐

D: 感染性废物 ☐

重量: _____ KG 科室: _____ 日期: _____ 月 _____ 日



Рисунок 5. Кювета реакционная – 3000 шт. (6 пакетов по 500 шт.) во вскрытой упаковке



Рисунок 6. Кювета реакционная – 3000 шт. (6 пакетов по 500 шт.)

注意: 先刷卡再丢弃!
Note: Scan RFID First!

产品名称

Product Name

生产批号/Batch No.

批号/LOT

产品编码/SN

数量/Quantity

全自动凝血分析仪反应杯


Cuvettes for Auto Coagulation Analyzers

20230609001

G2306

2001010458

500 pcs

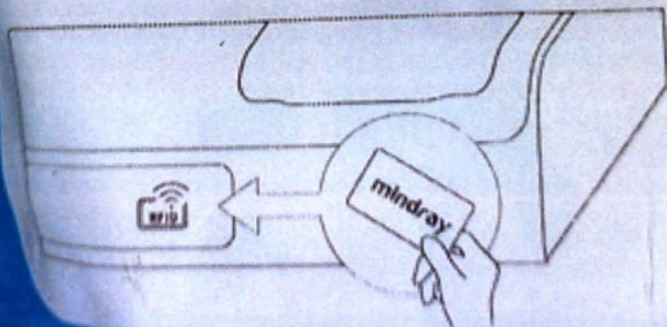

mindray

注意: 先刷卡再丢弃!
Note: Scan RFID First!

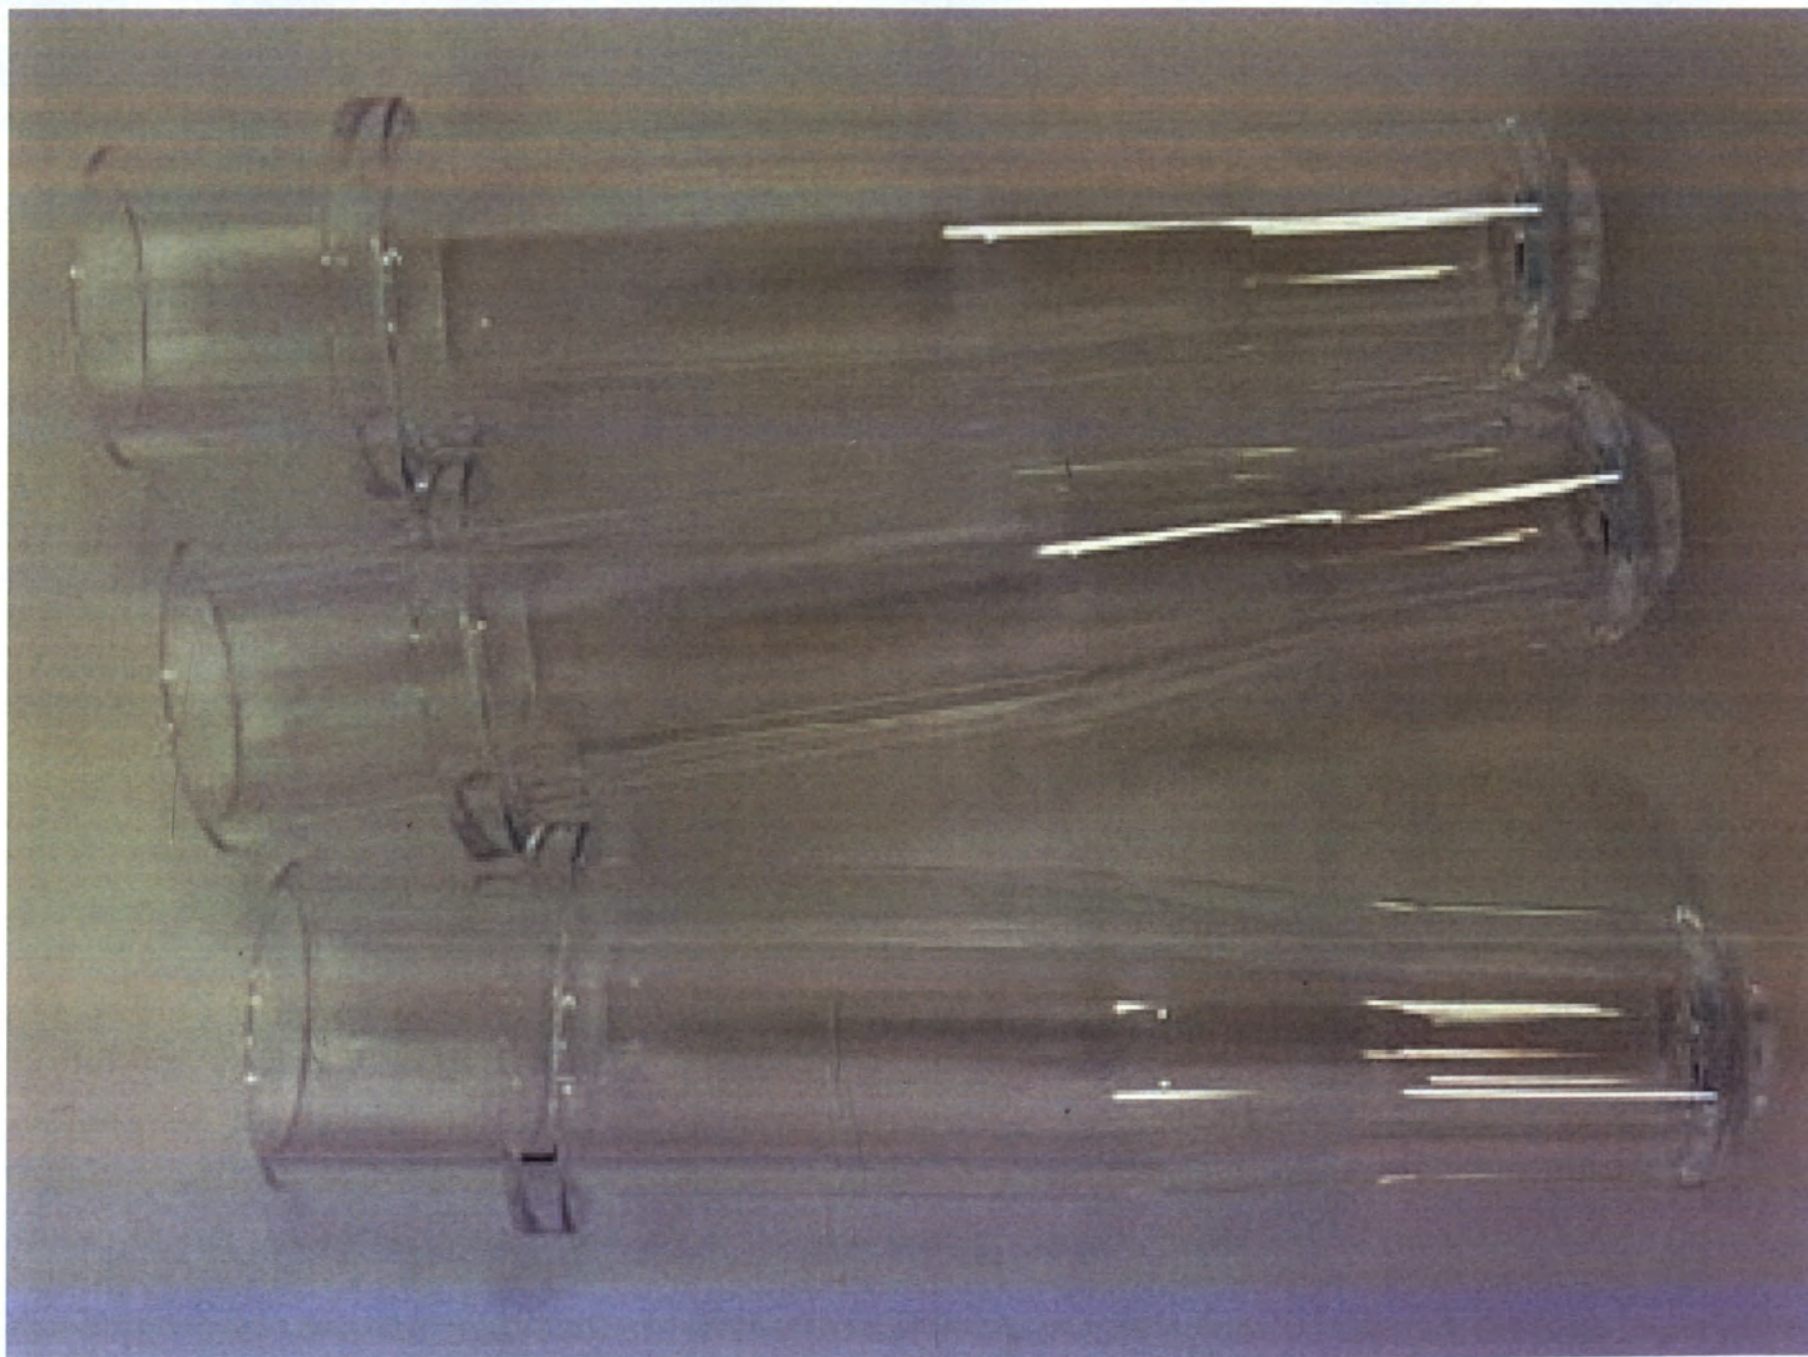


Рисунок 8. Кювета

mindray

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China.
Tel: +86 755 81888998,
fax: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>


Mr. Liu Jiguang

Deputy Manager of Technical Regulation Department
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd

INSTRUCTION FOR USE IN RUSSIAN LANGUAGE MEDICAL DEVICES

Reaction Cuvette Set for CX Series Automatic Coagulation Analyzers for in vitro
diagnostics

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Набор кювет реакционных для автоматических анализаторов коагуляции серии
CX для диагностики in vitro

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China.
Tel: +86 755 81888998,
fax: +86 755 26582680
<http://www.mindray.com>

Рисунок 9. Инструкция по применению – 1 шт.

