


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов

**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech
Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**

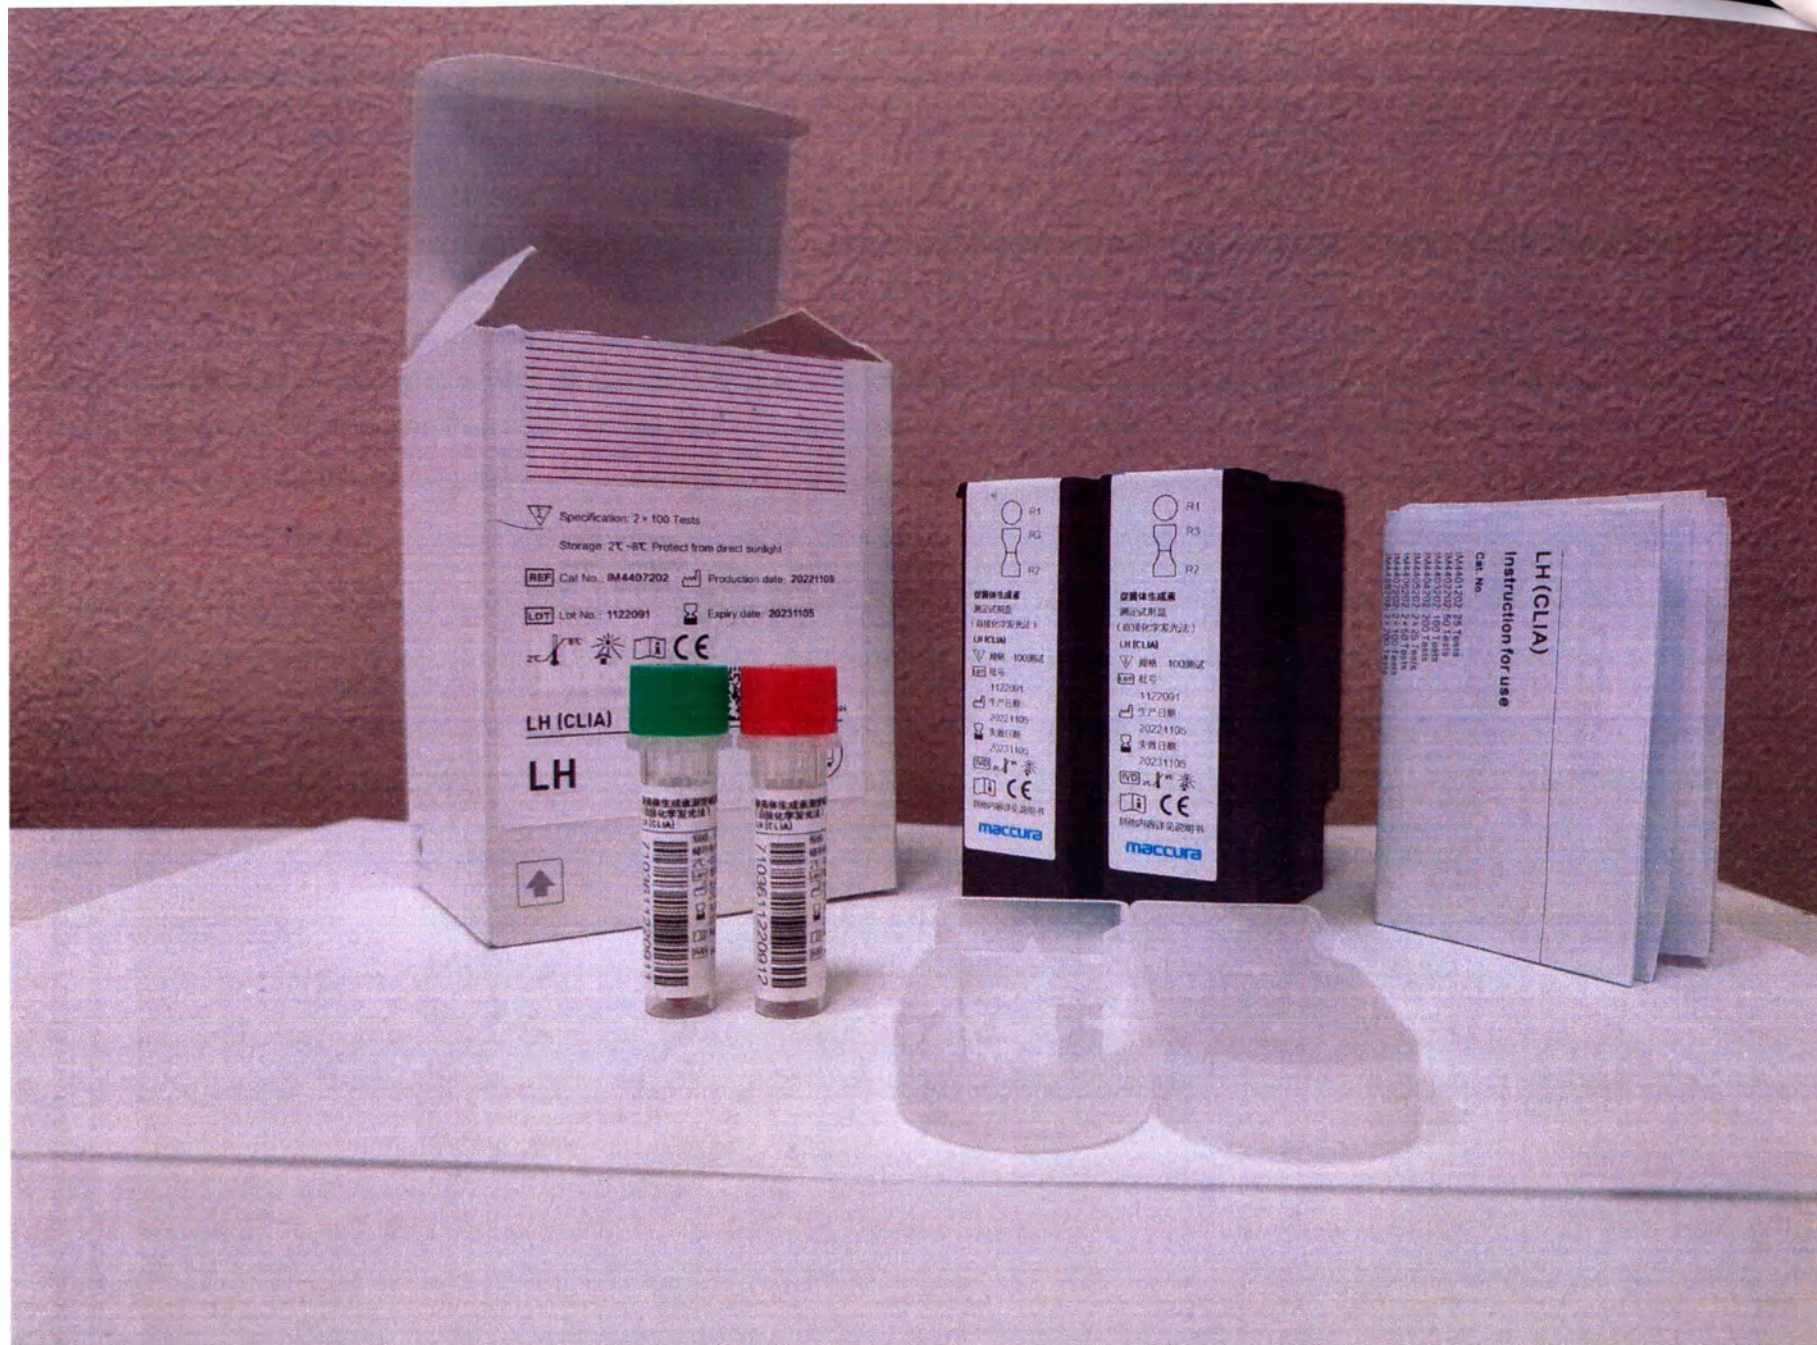

Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом и анализаторах Masscura i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов»



Specification: 2 × 100 Tests

Storage: 2°C ~ 8°C Protect from direct sunlight



Cat No.: IM4407202




Production date: 20221105



Lot No.: 1122091



Expiry date: 20231105



(01) 06950617424079

(10) 1122091

(11) 221105

(17) 231105


(21) SW2209300381000624

LH (CLIA)


LH



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом и а анализаторах Массуга і (LH (CLIA)), набор на 200 тестов»

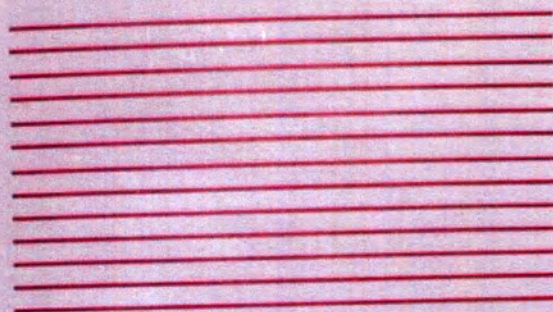

maccura

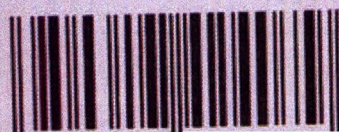

IVD

6 950617 424079

生产许可证编号: 川食药监械生产许20150064号

医疗器械注册证编号/产品技术要求编号:

川械注准20202400098

注意事项: 其他内容详见说明书

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH
(Europe) Eiffestrasse 80, 20537
Hamburg, Germany

LH



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилуминесцентным методом и а анализаторах Массура i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司

住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号

电话: + 86 28 8782 6777

传真: + 86 28 8782 5783

邮编: 611731

邮箱: maccura@maccura.com



Maccura Biotechnology Co., Ltd.

Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731

Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel : +86 28 8782 6777


Fax: +86 28 8782 5783

E-mail: maccura@maccura.com

www.maccura.com



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов»

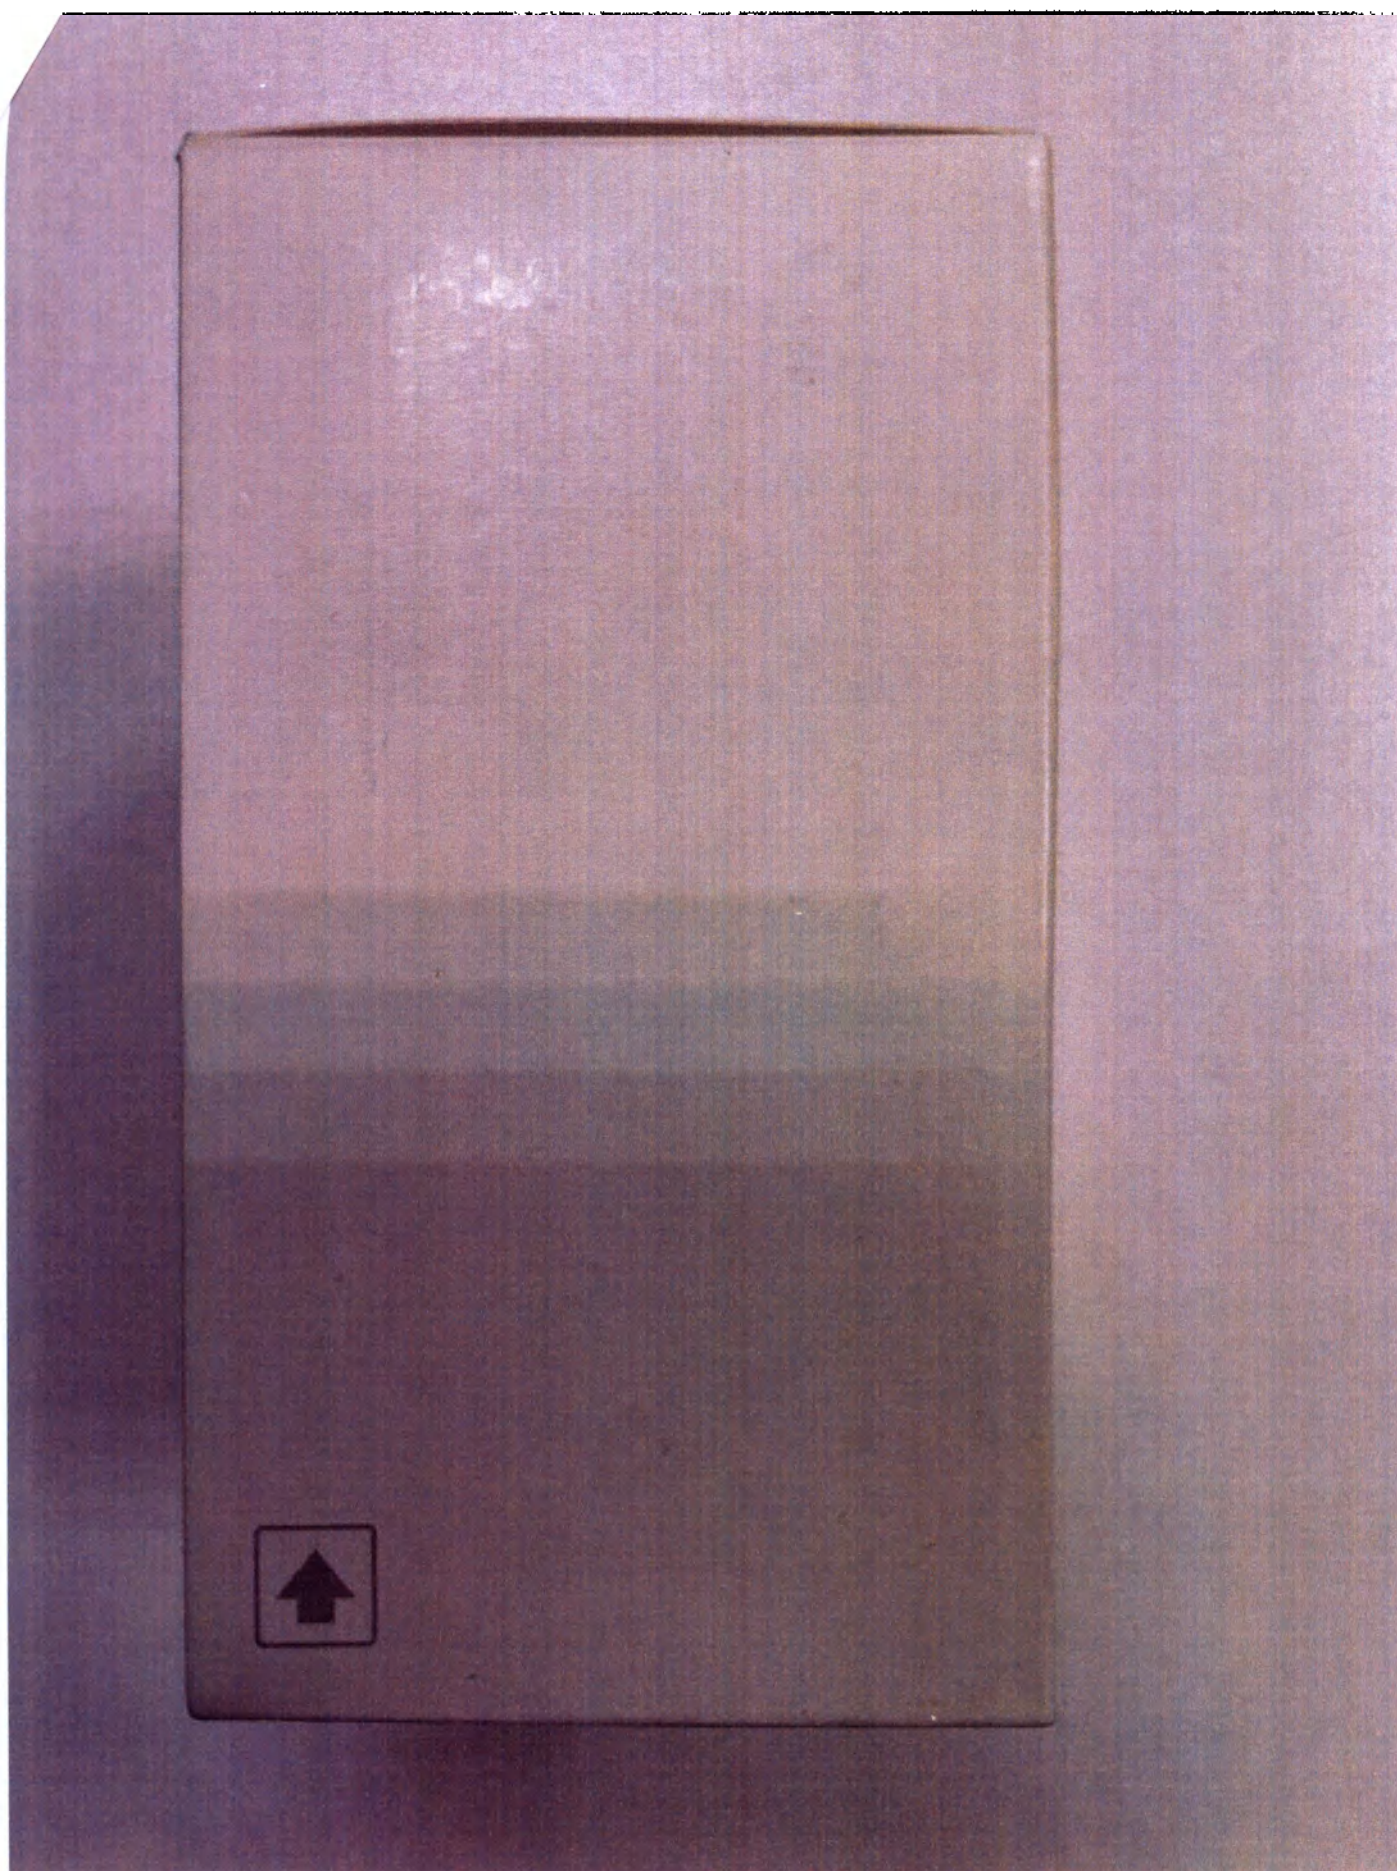

Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом и в анализаторах Массига i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов»

TOP


促黄体生成素

测定试剂盒 (直接化学发光法)

LH (CLIA)

maccura


LH




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом и а анализаторах Массура і (LH (CLIA)), набор на 200 тестов»




Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2, R3 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов»

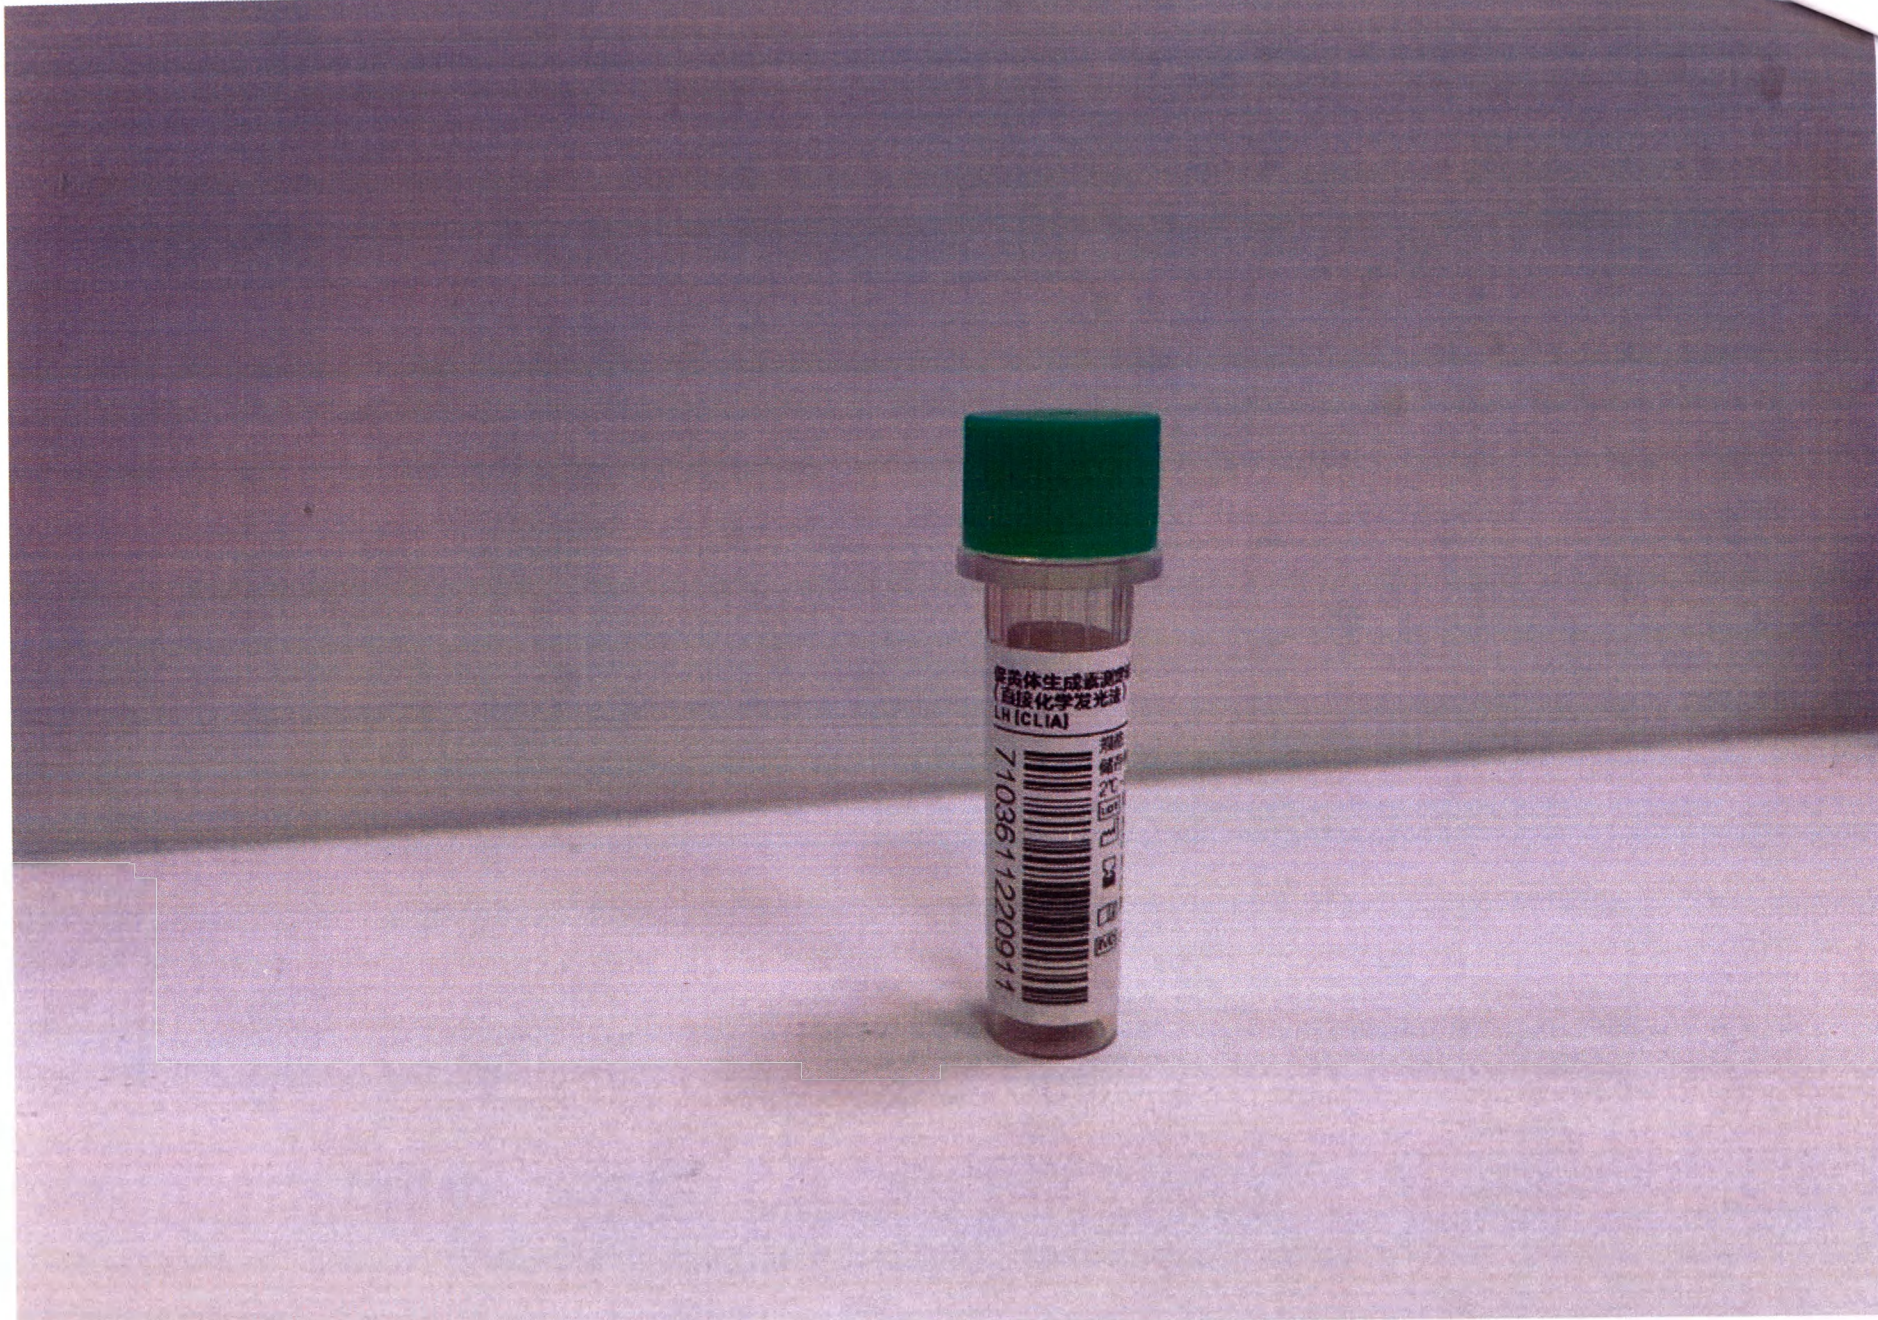


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

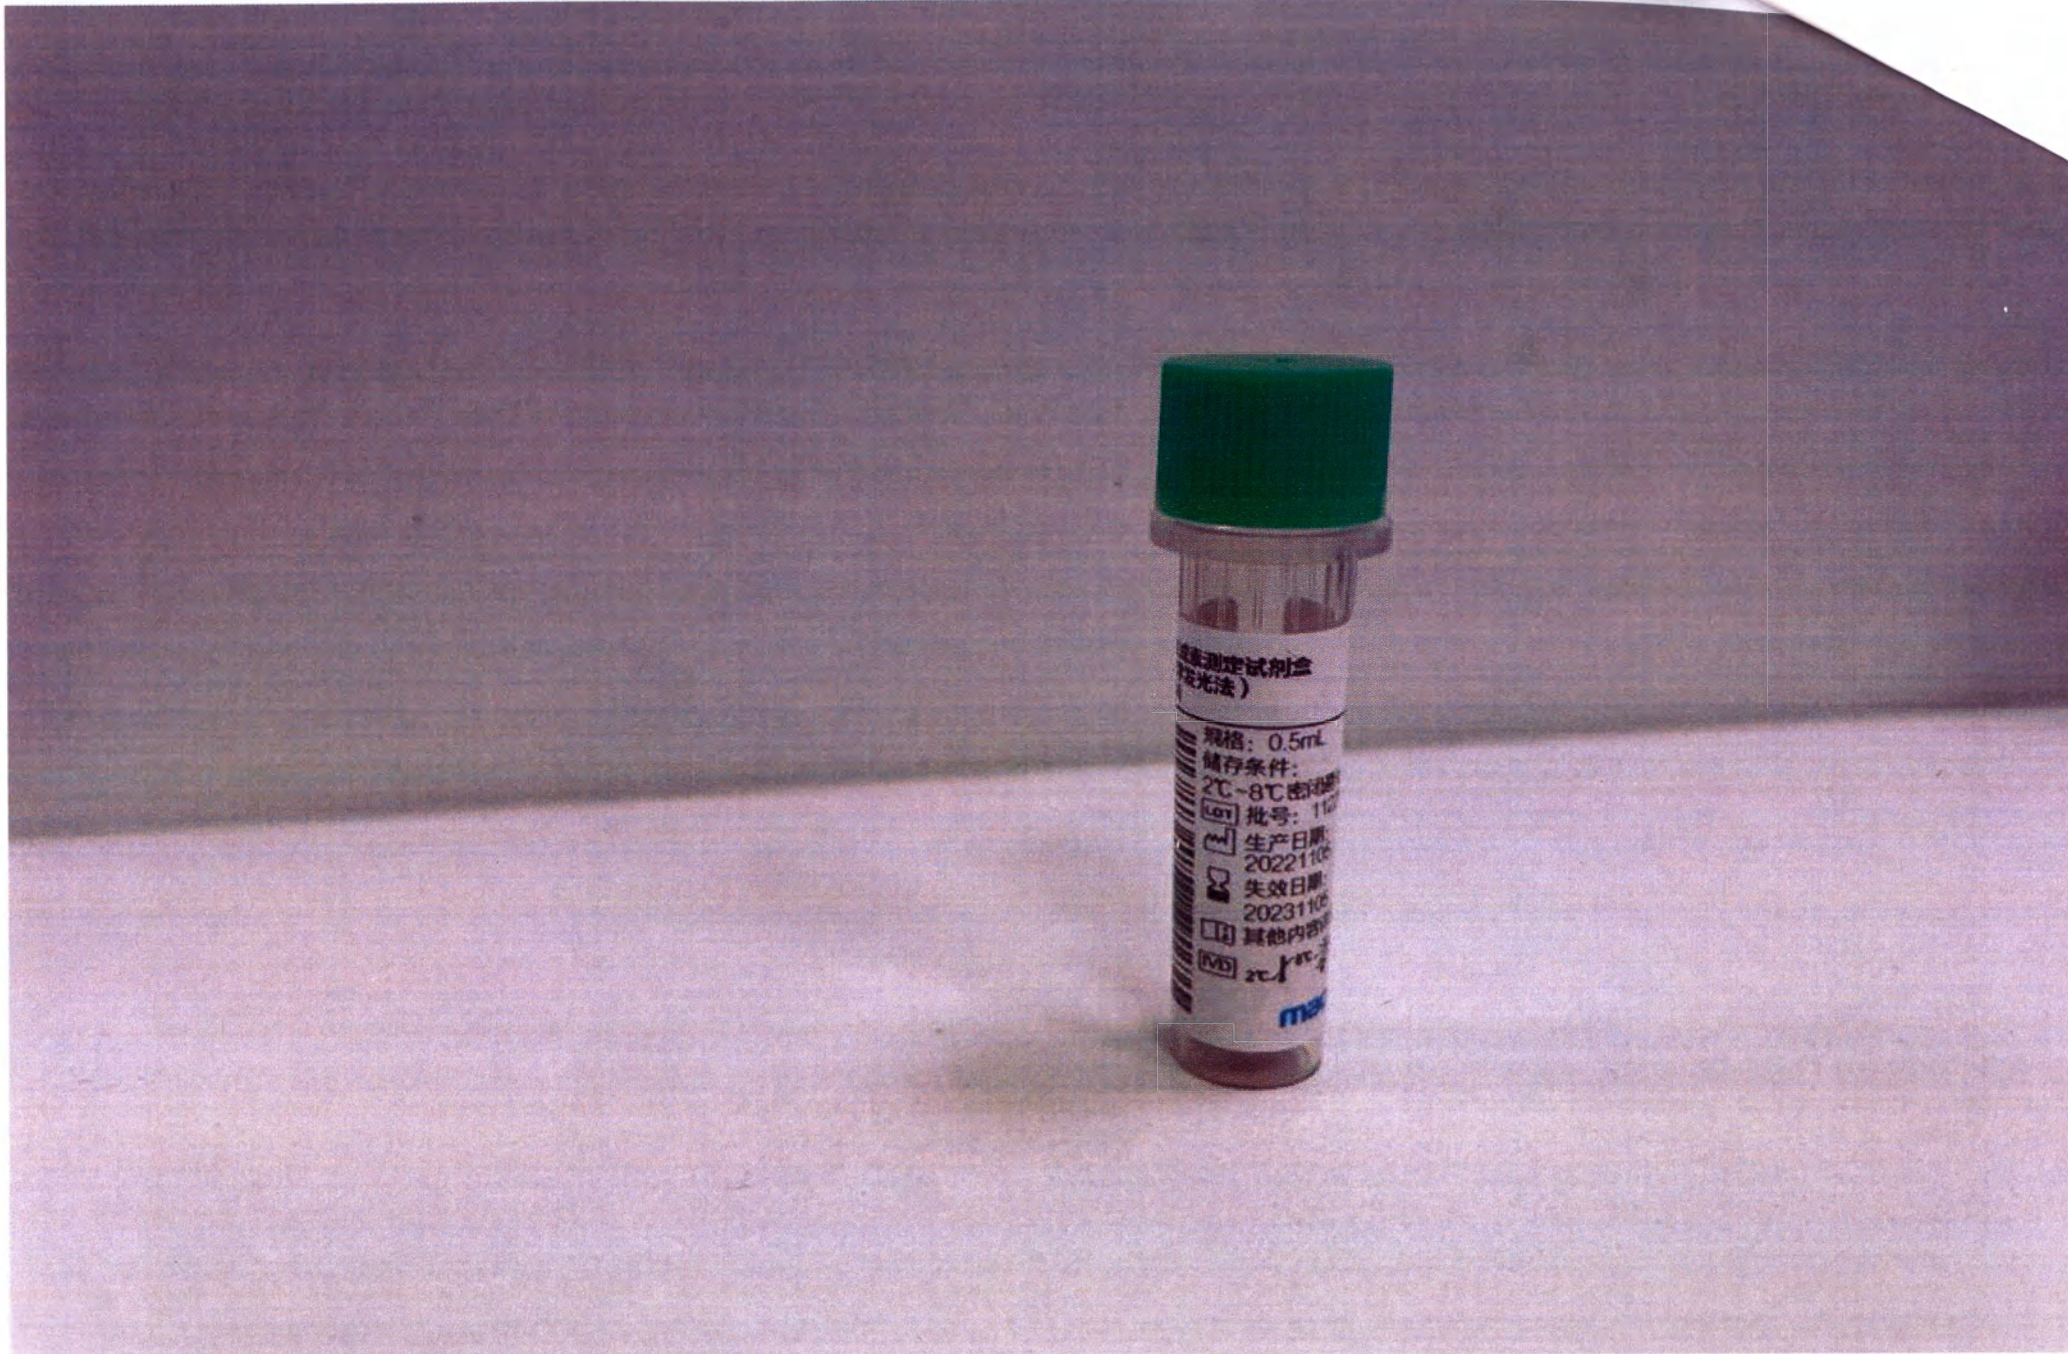


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом и анализаторах Массуга i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

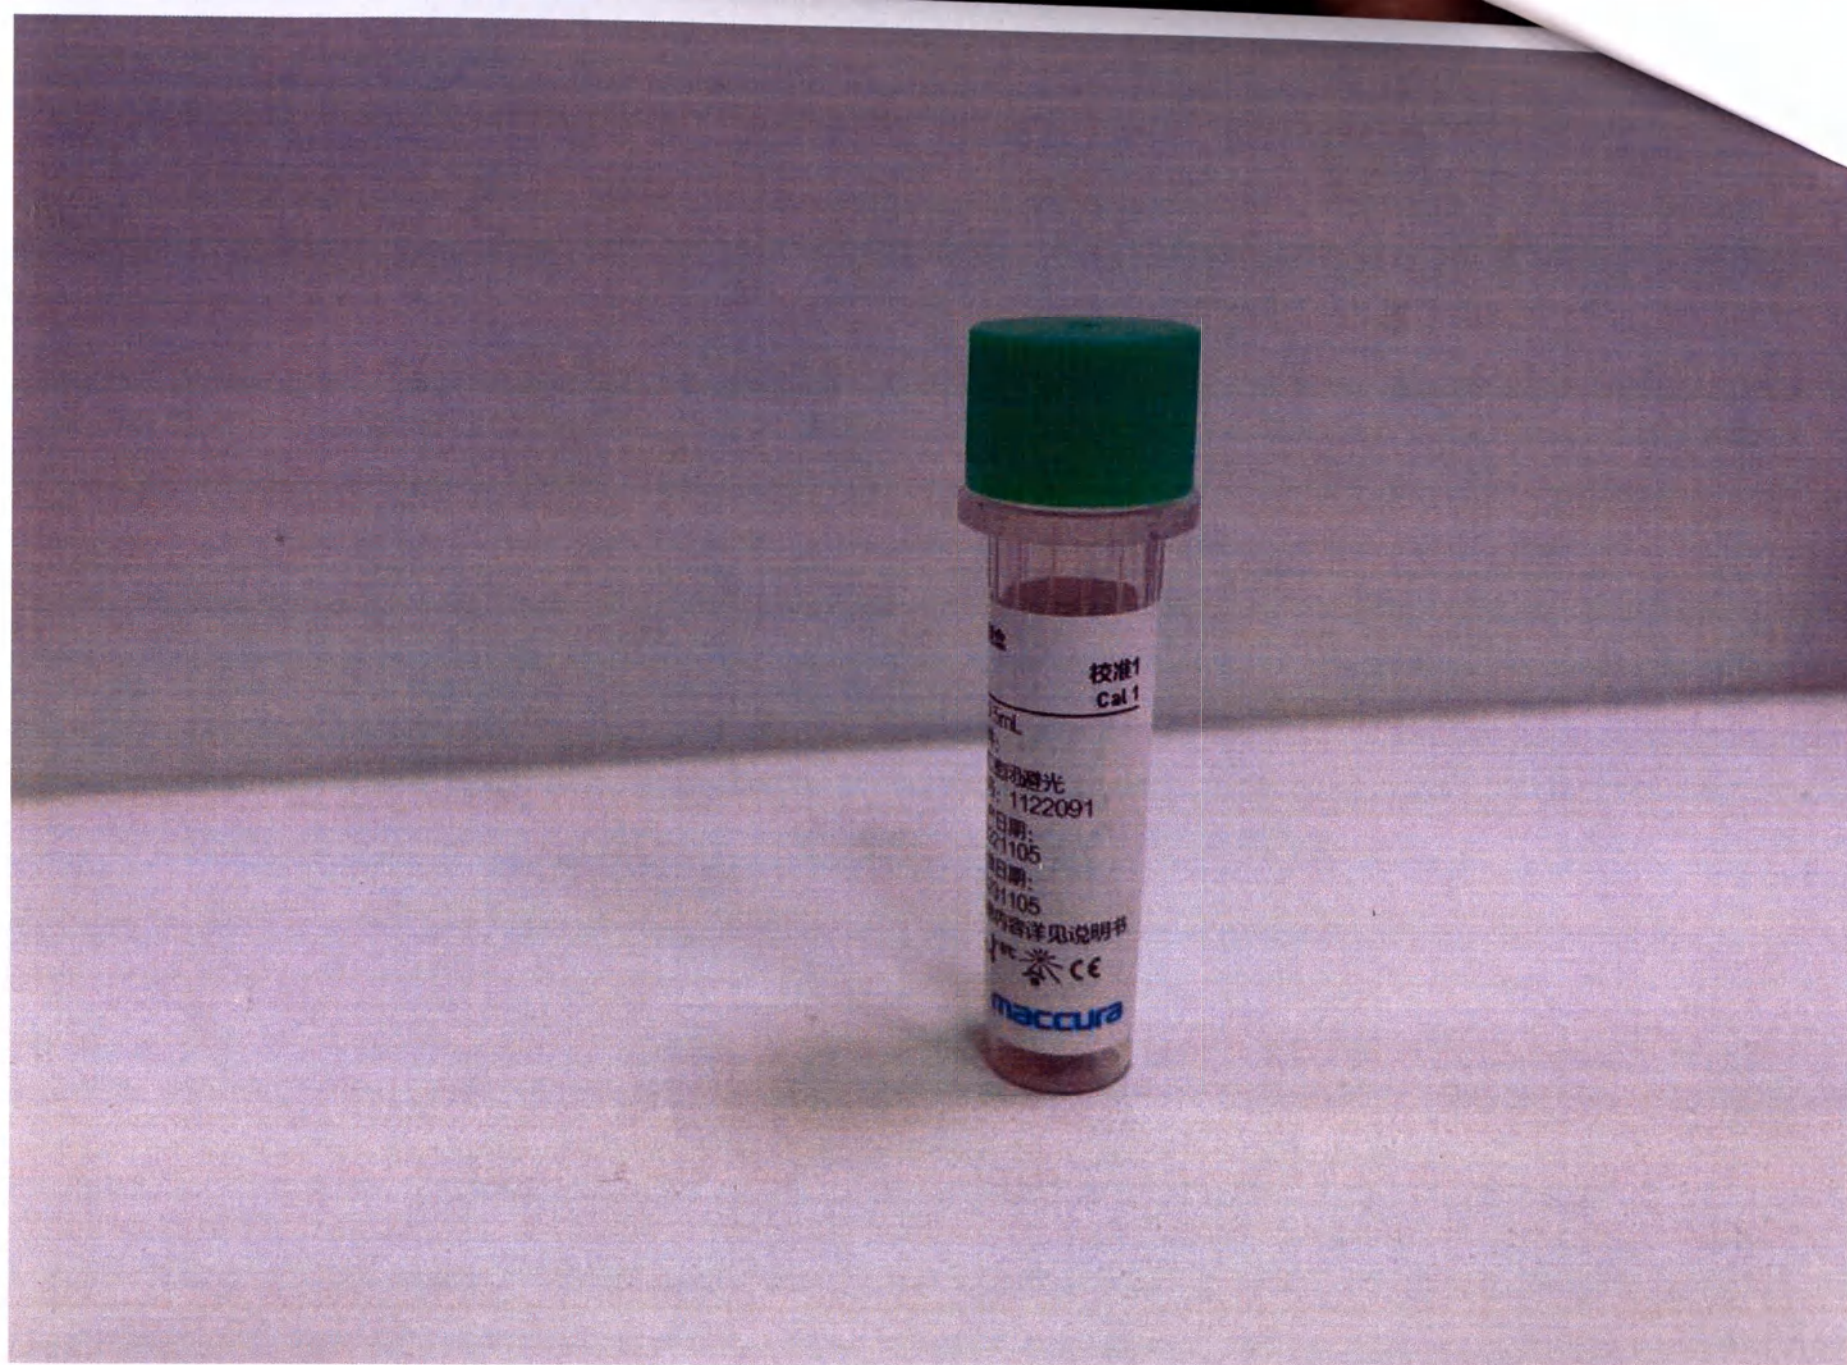


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массюра i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

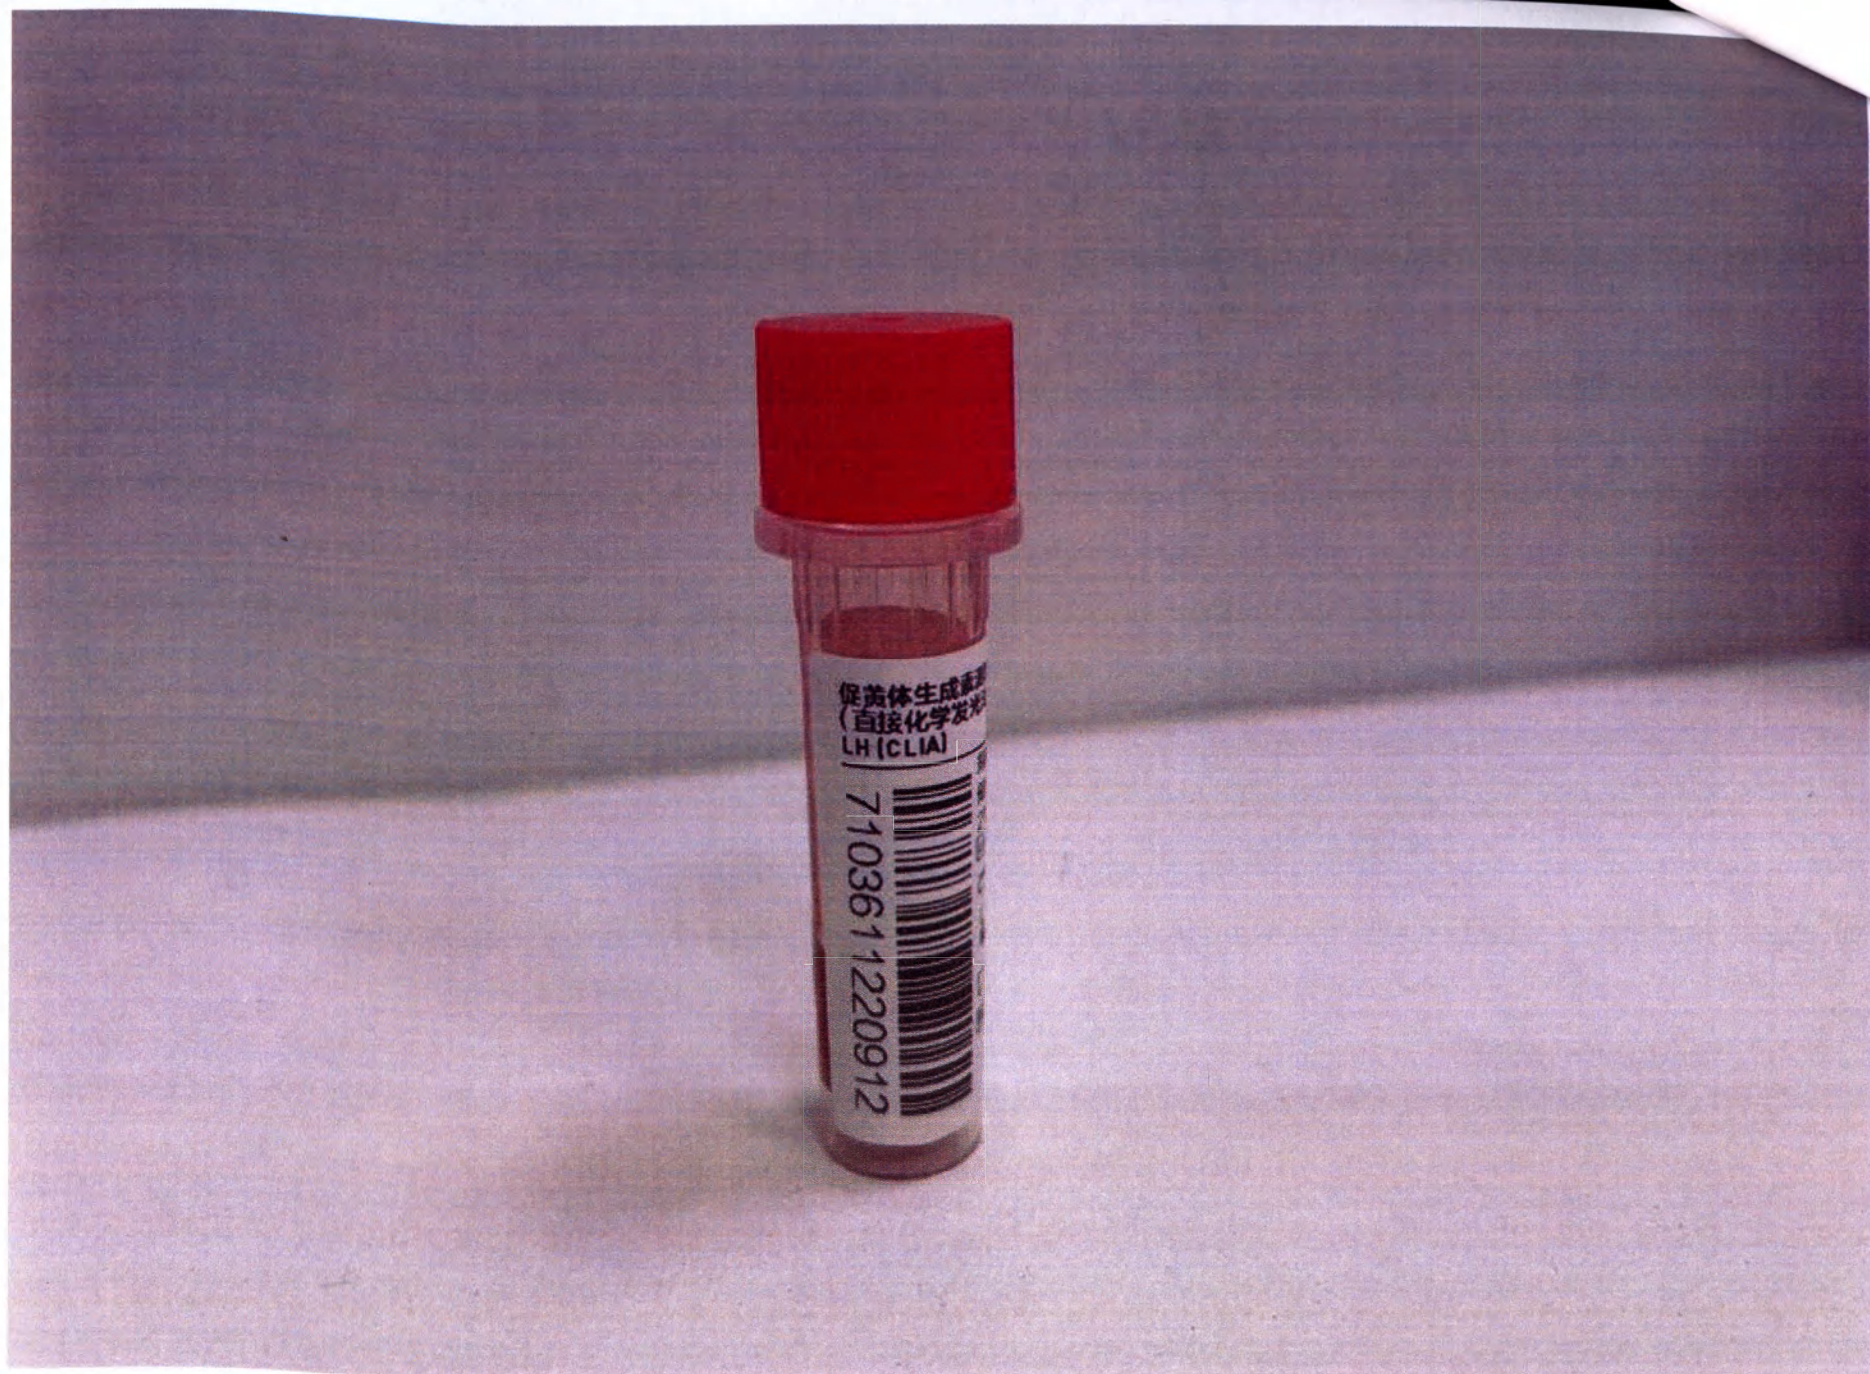


Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массуга i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

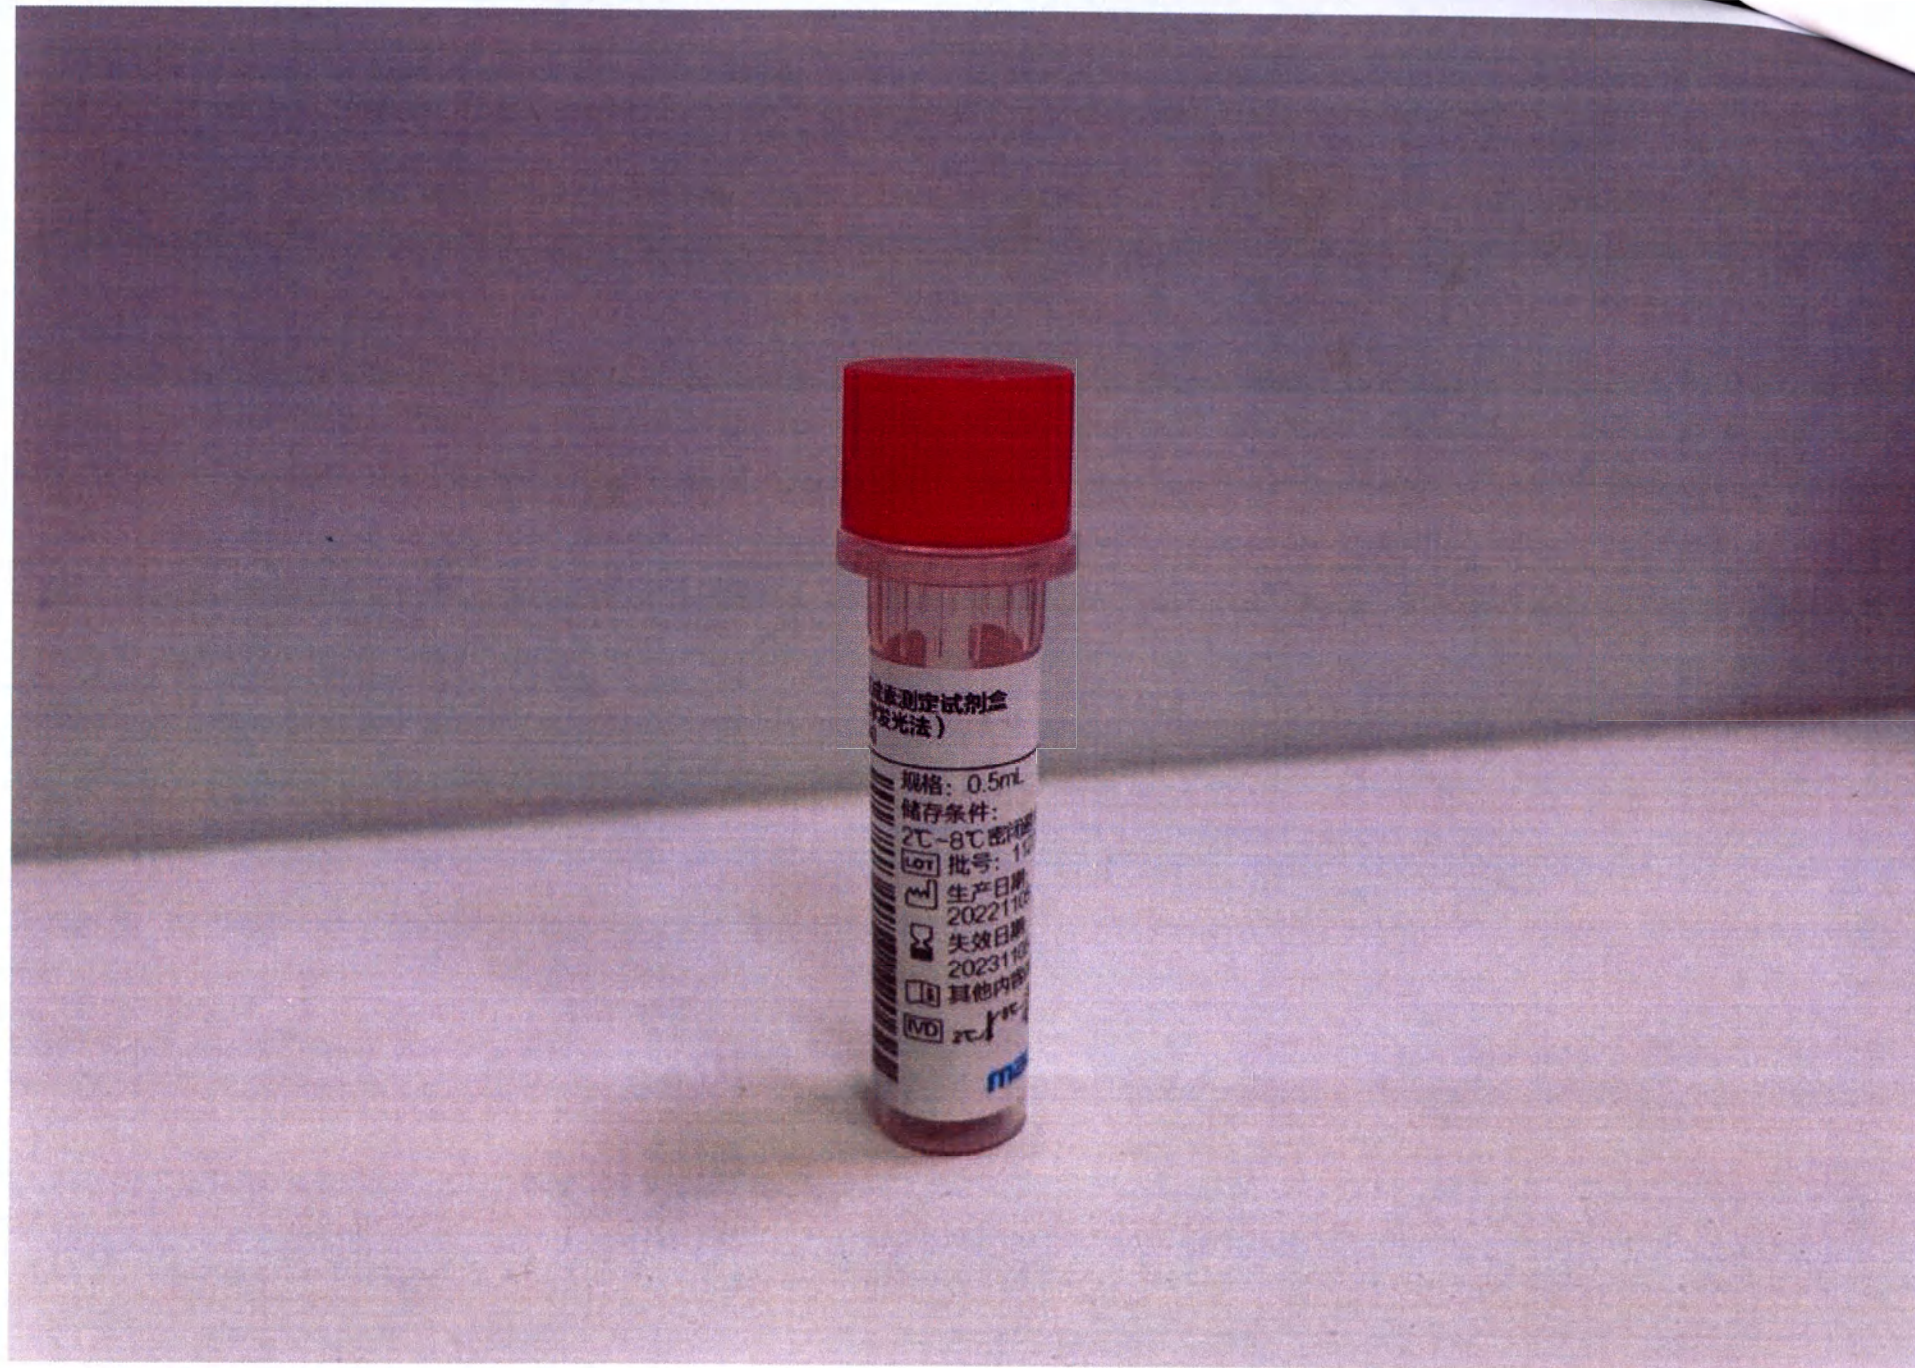

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

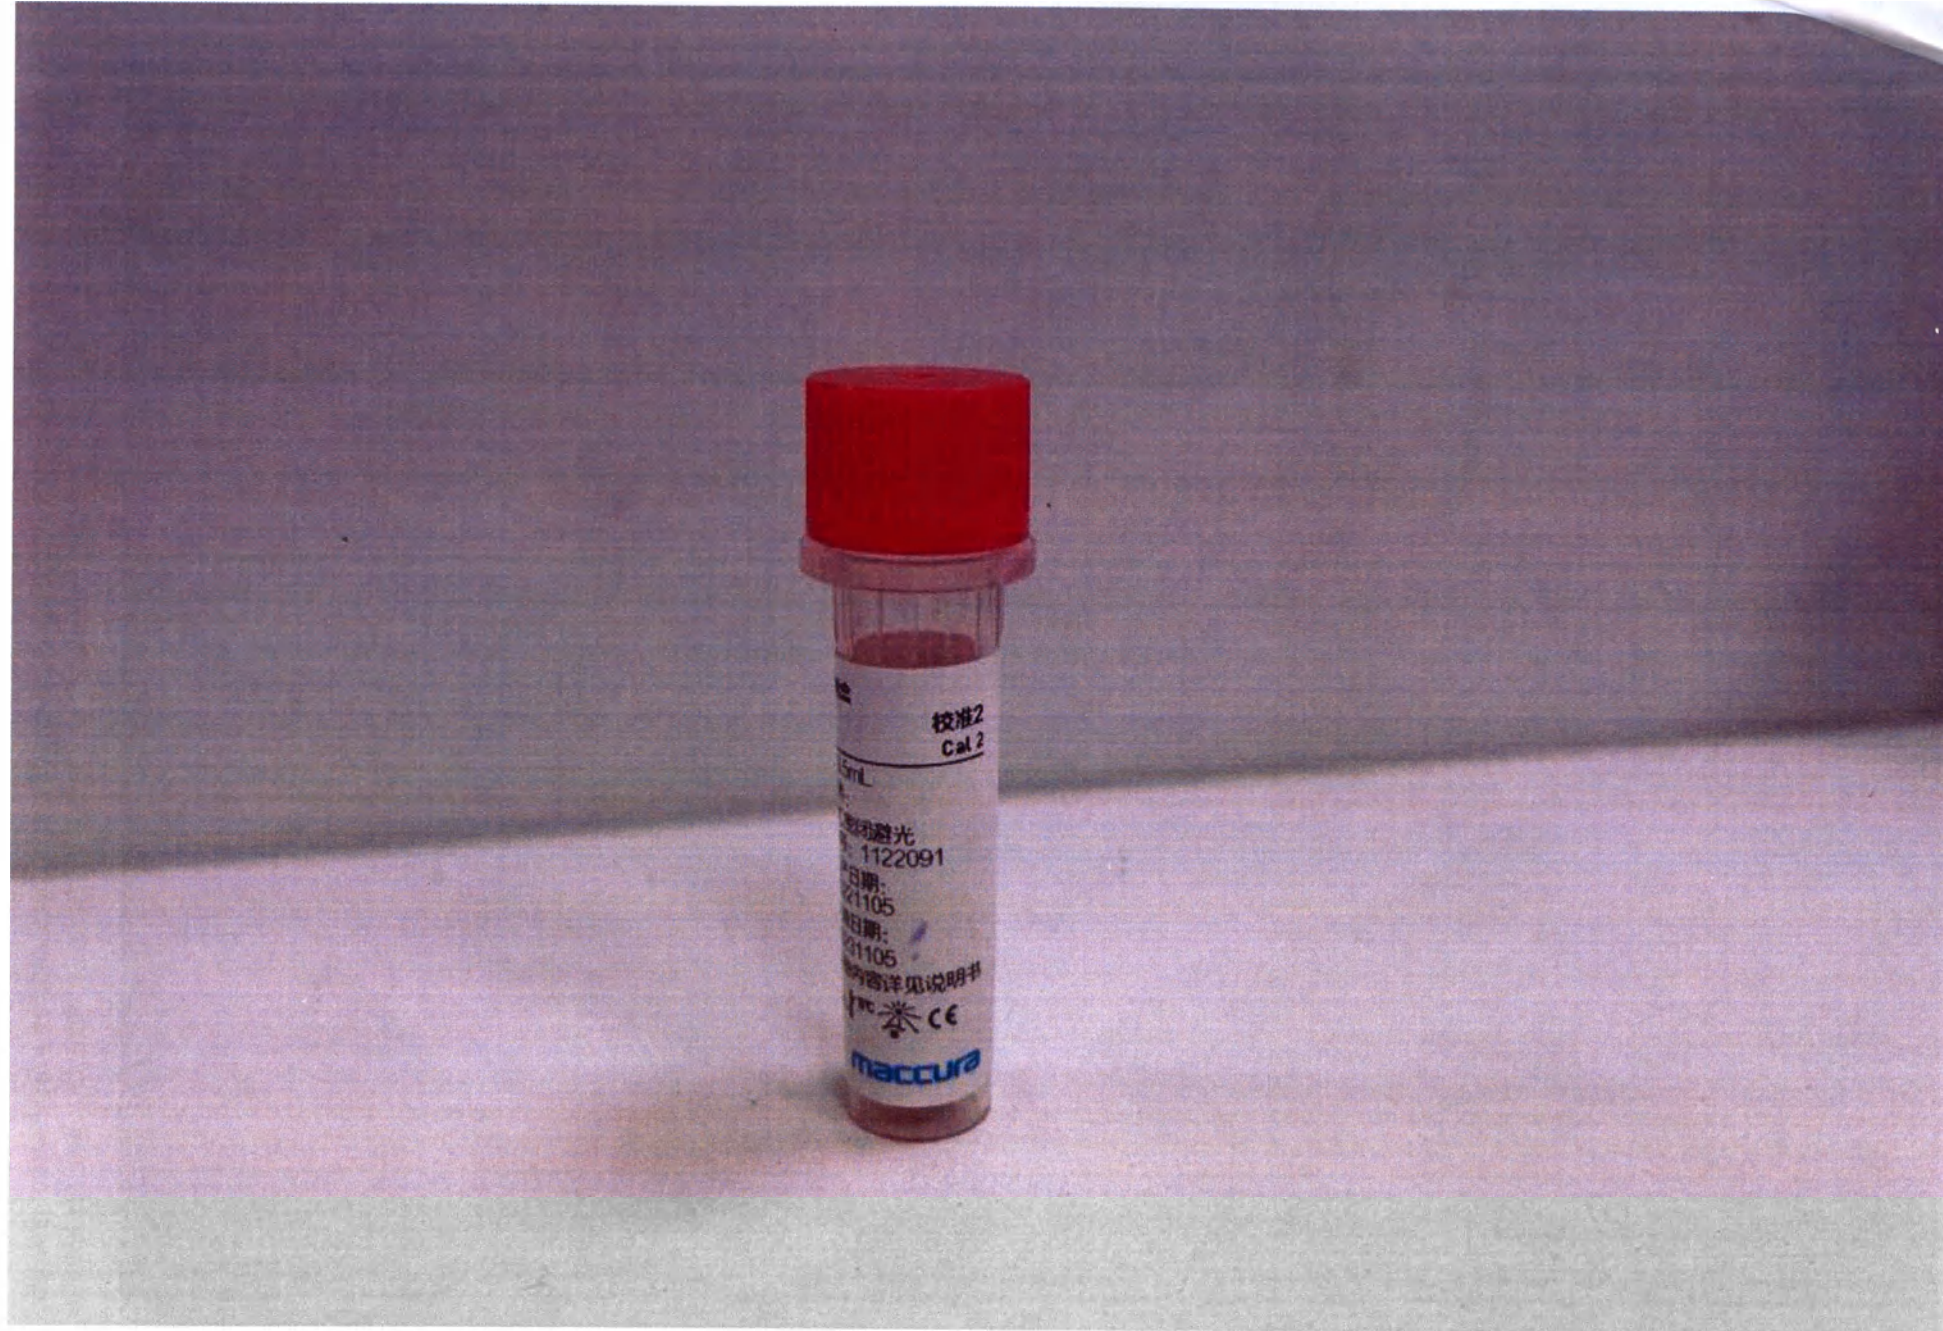

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

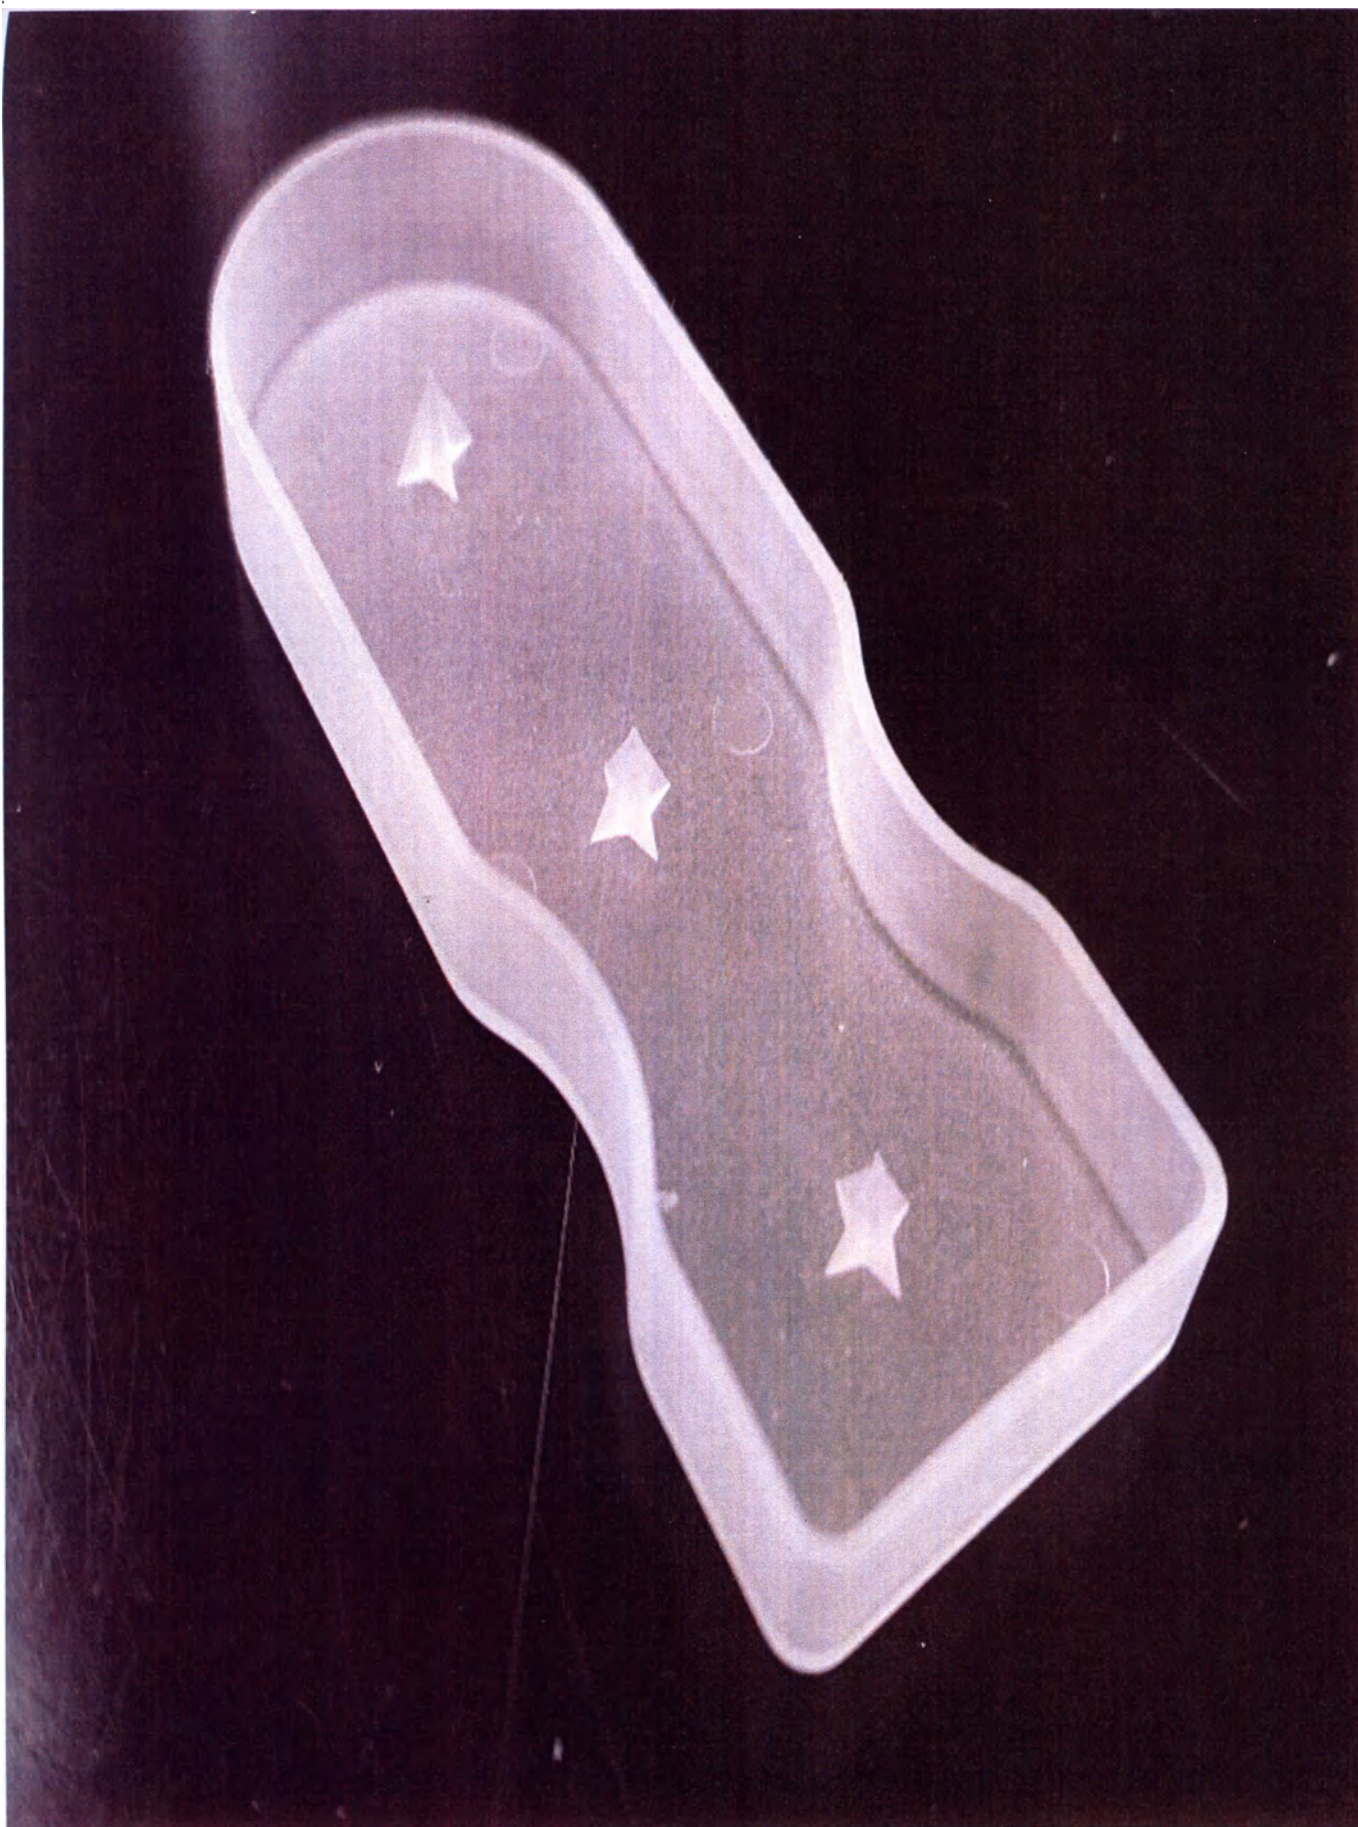

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом и в анализаторах Массура i (LH (CLIA)), набор на 200 тестов»

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 16 листов
Р.К. Мелконьянц
Директор ООО «Эвопром»

