

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на
анализаторах Maccura i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов**

**производства Maccura Biotechnology Co., Ltd., 16#, Baichuan Road, Hi-tech
Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**



Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号
电话: + 86 28 8782 6777
传真: + 86 28 8782 5783
邮编: 611731
邮箱: maccura@maccura.com




Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel : +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com




Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»

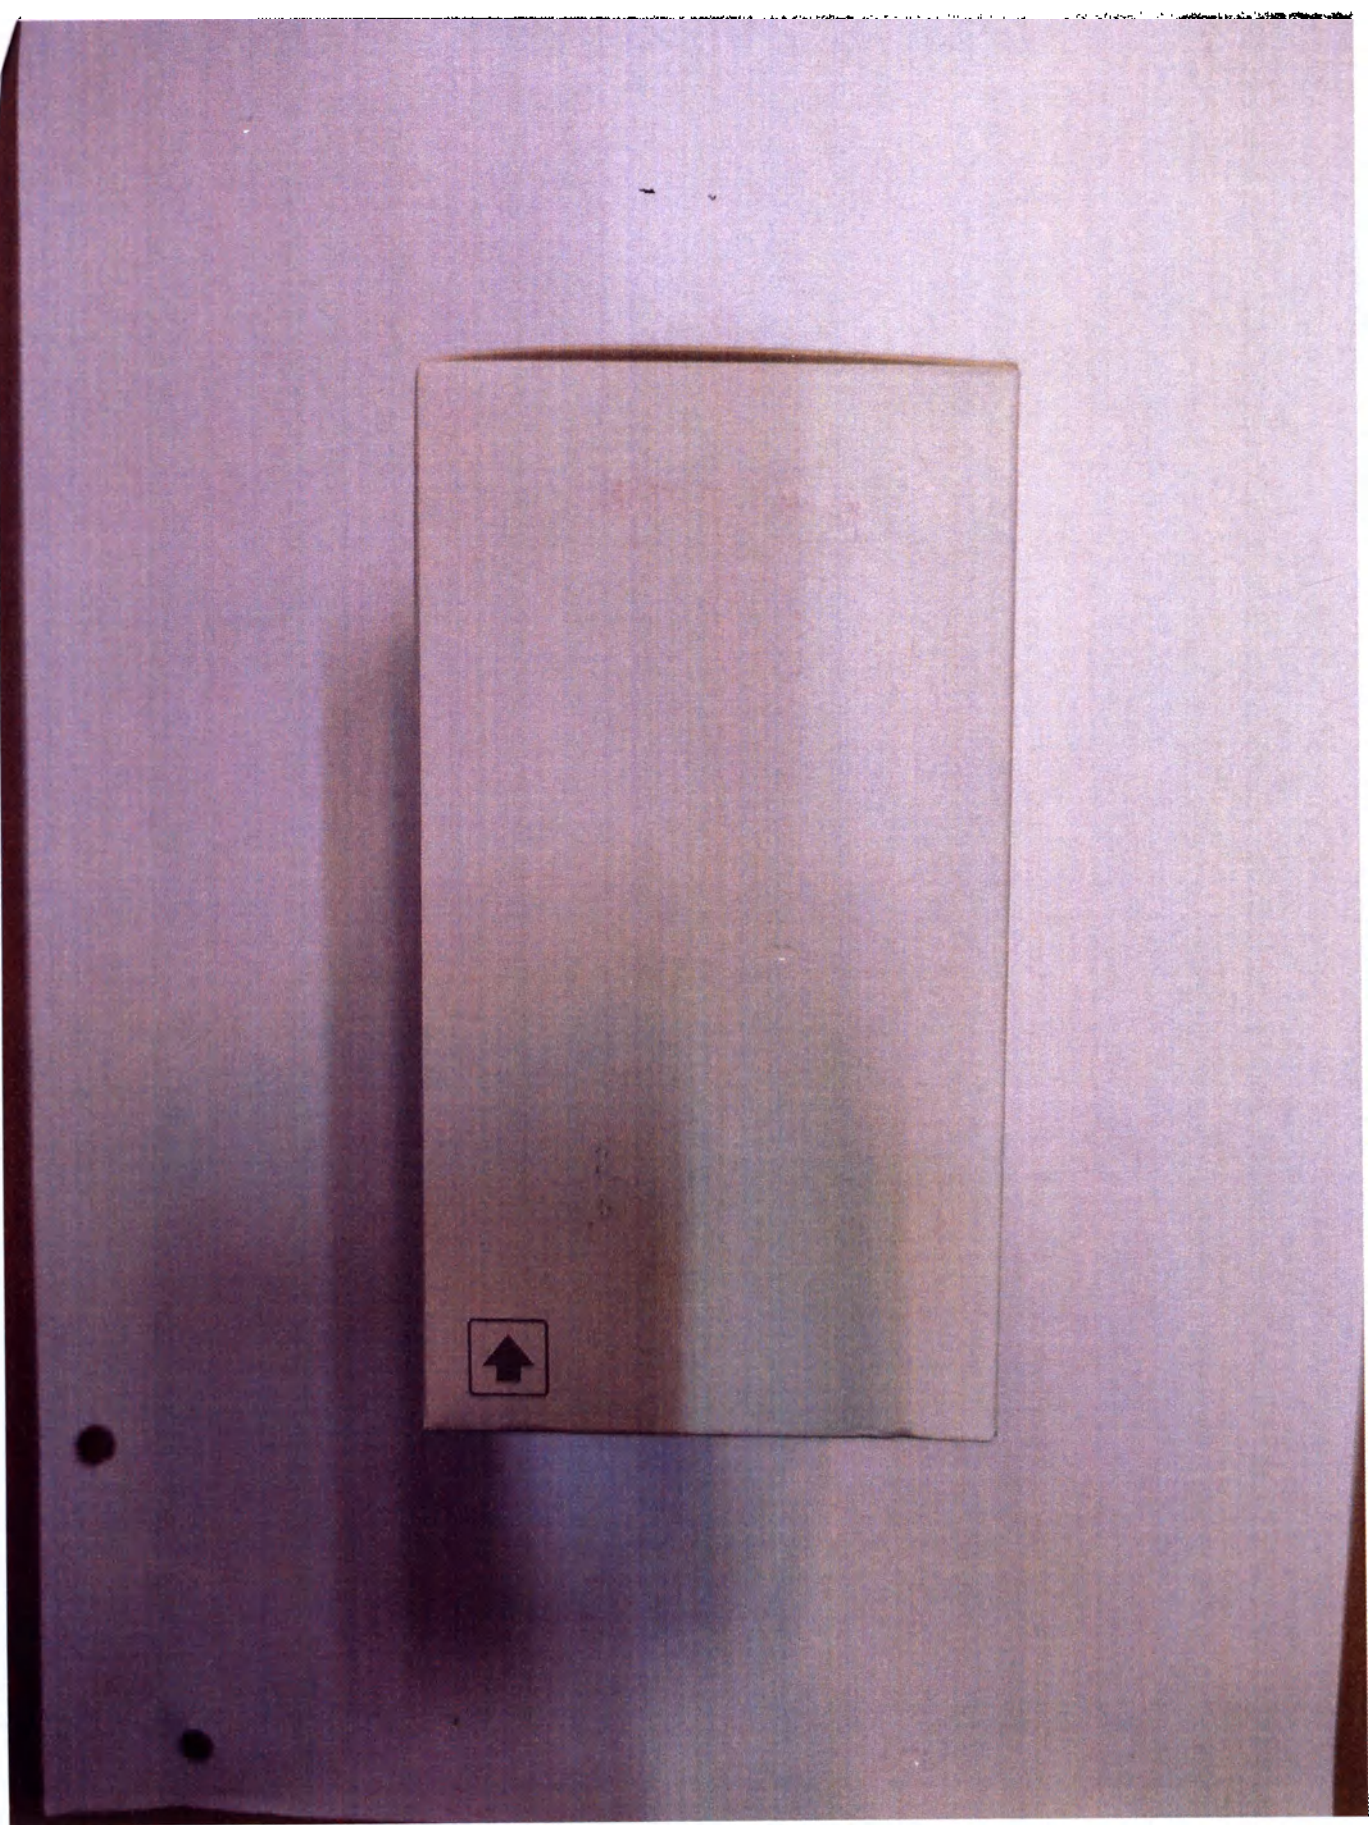

Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массира i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»

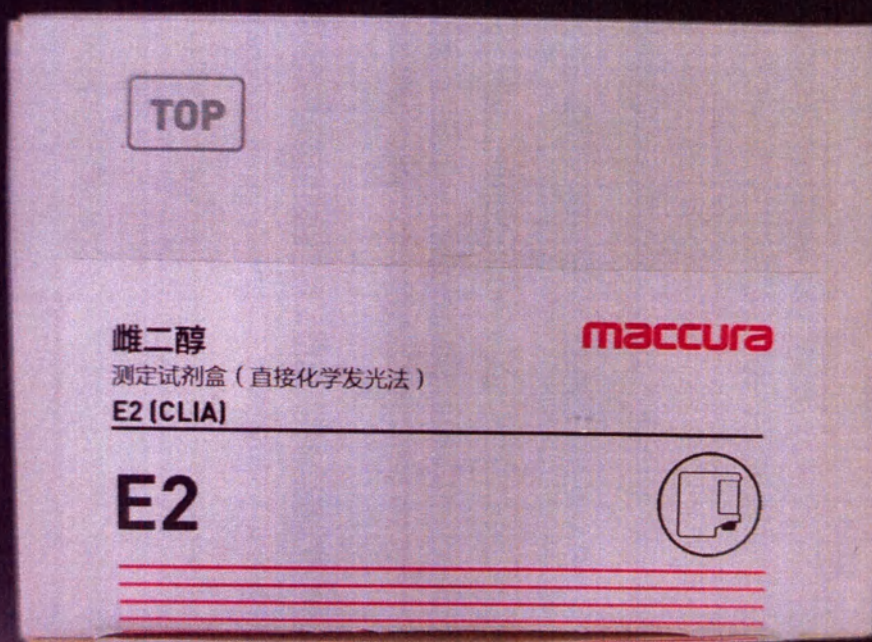


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»

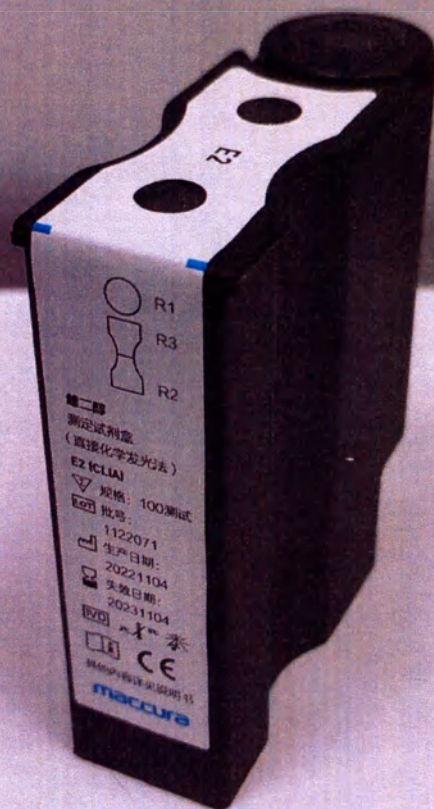


Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2, R3 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Maccura i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»



Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массига i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

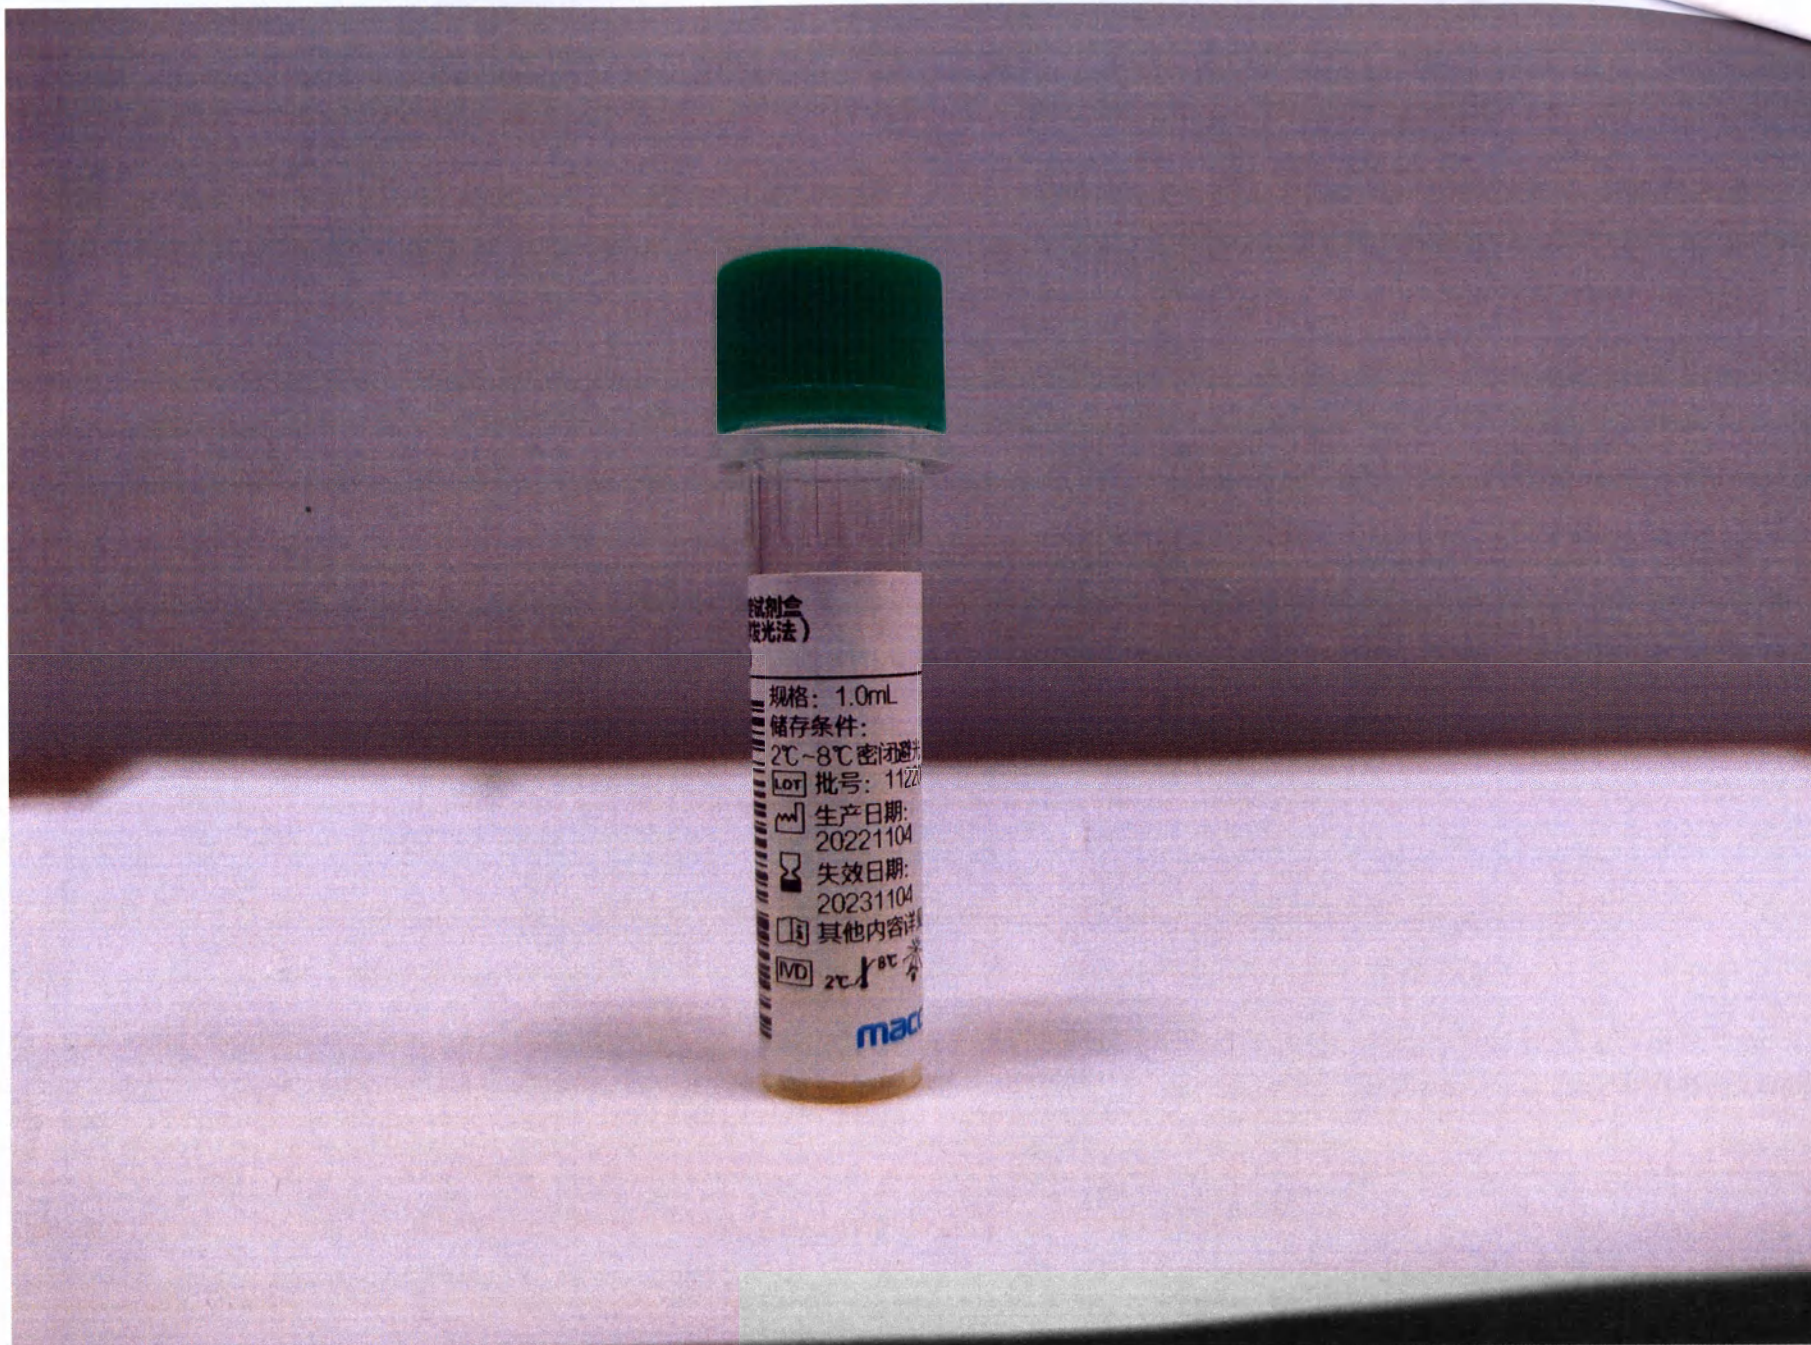

Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2

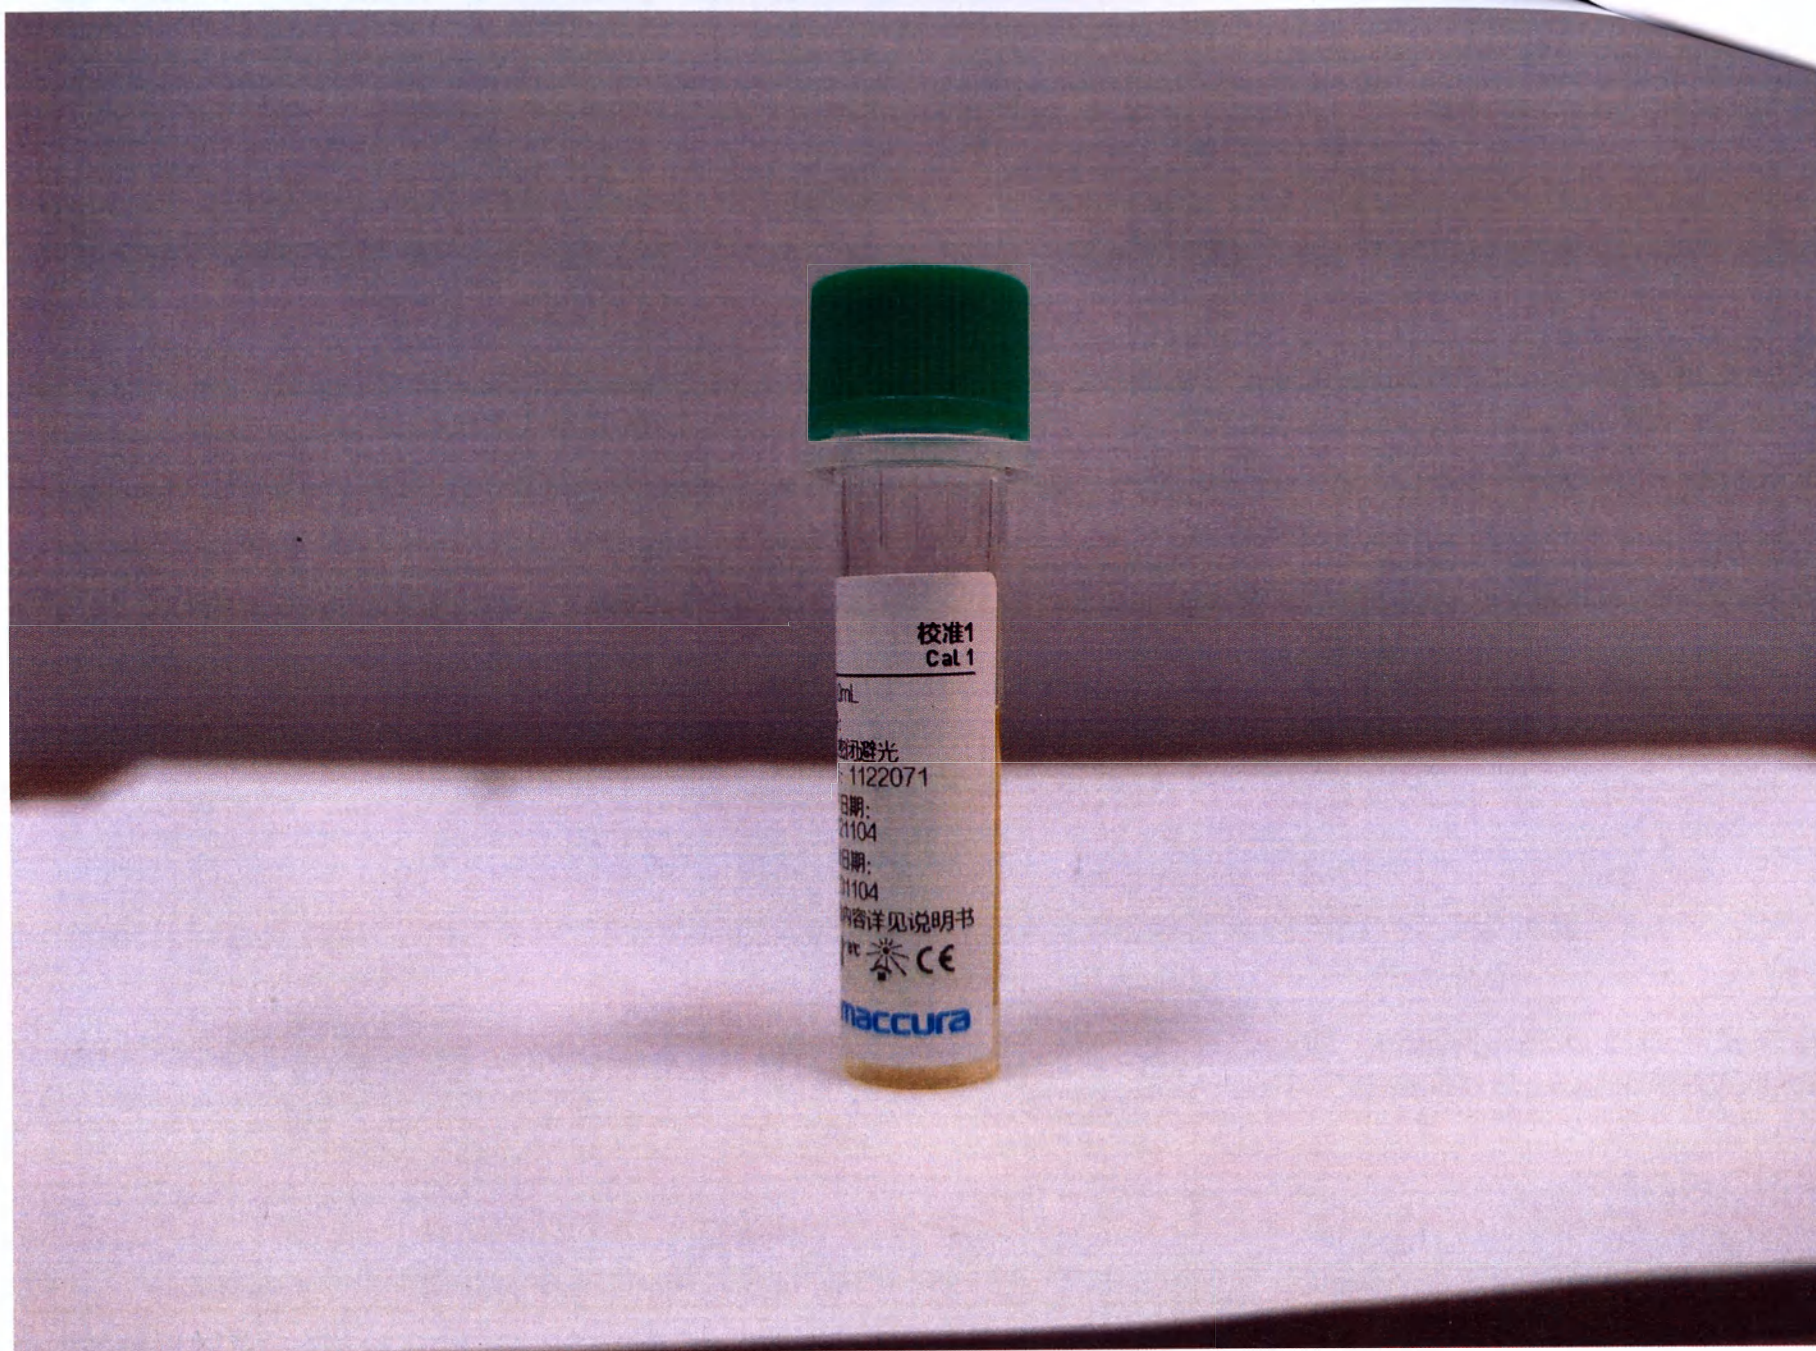

Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3




Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массуга i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»,сторона 3

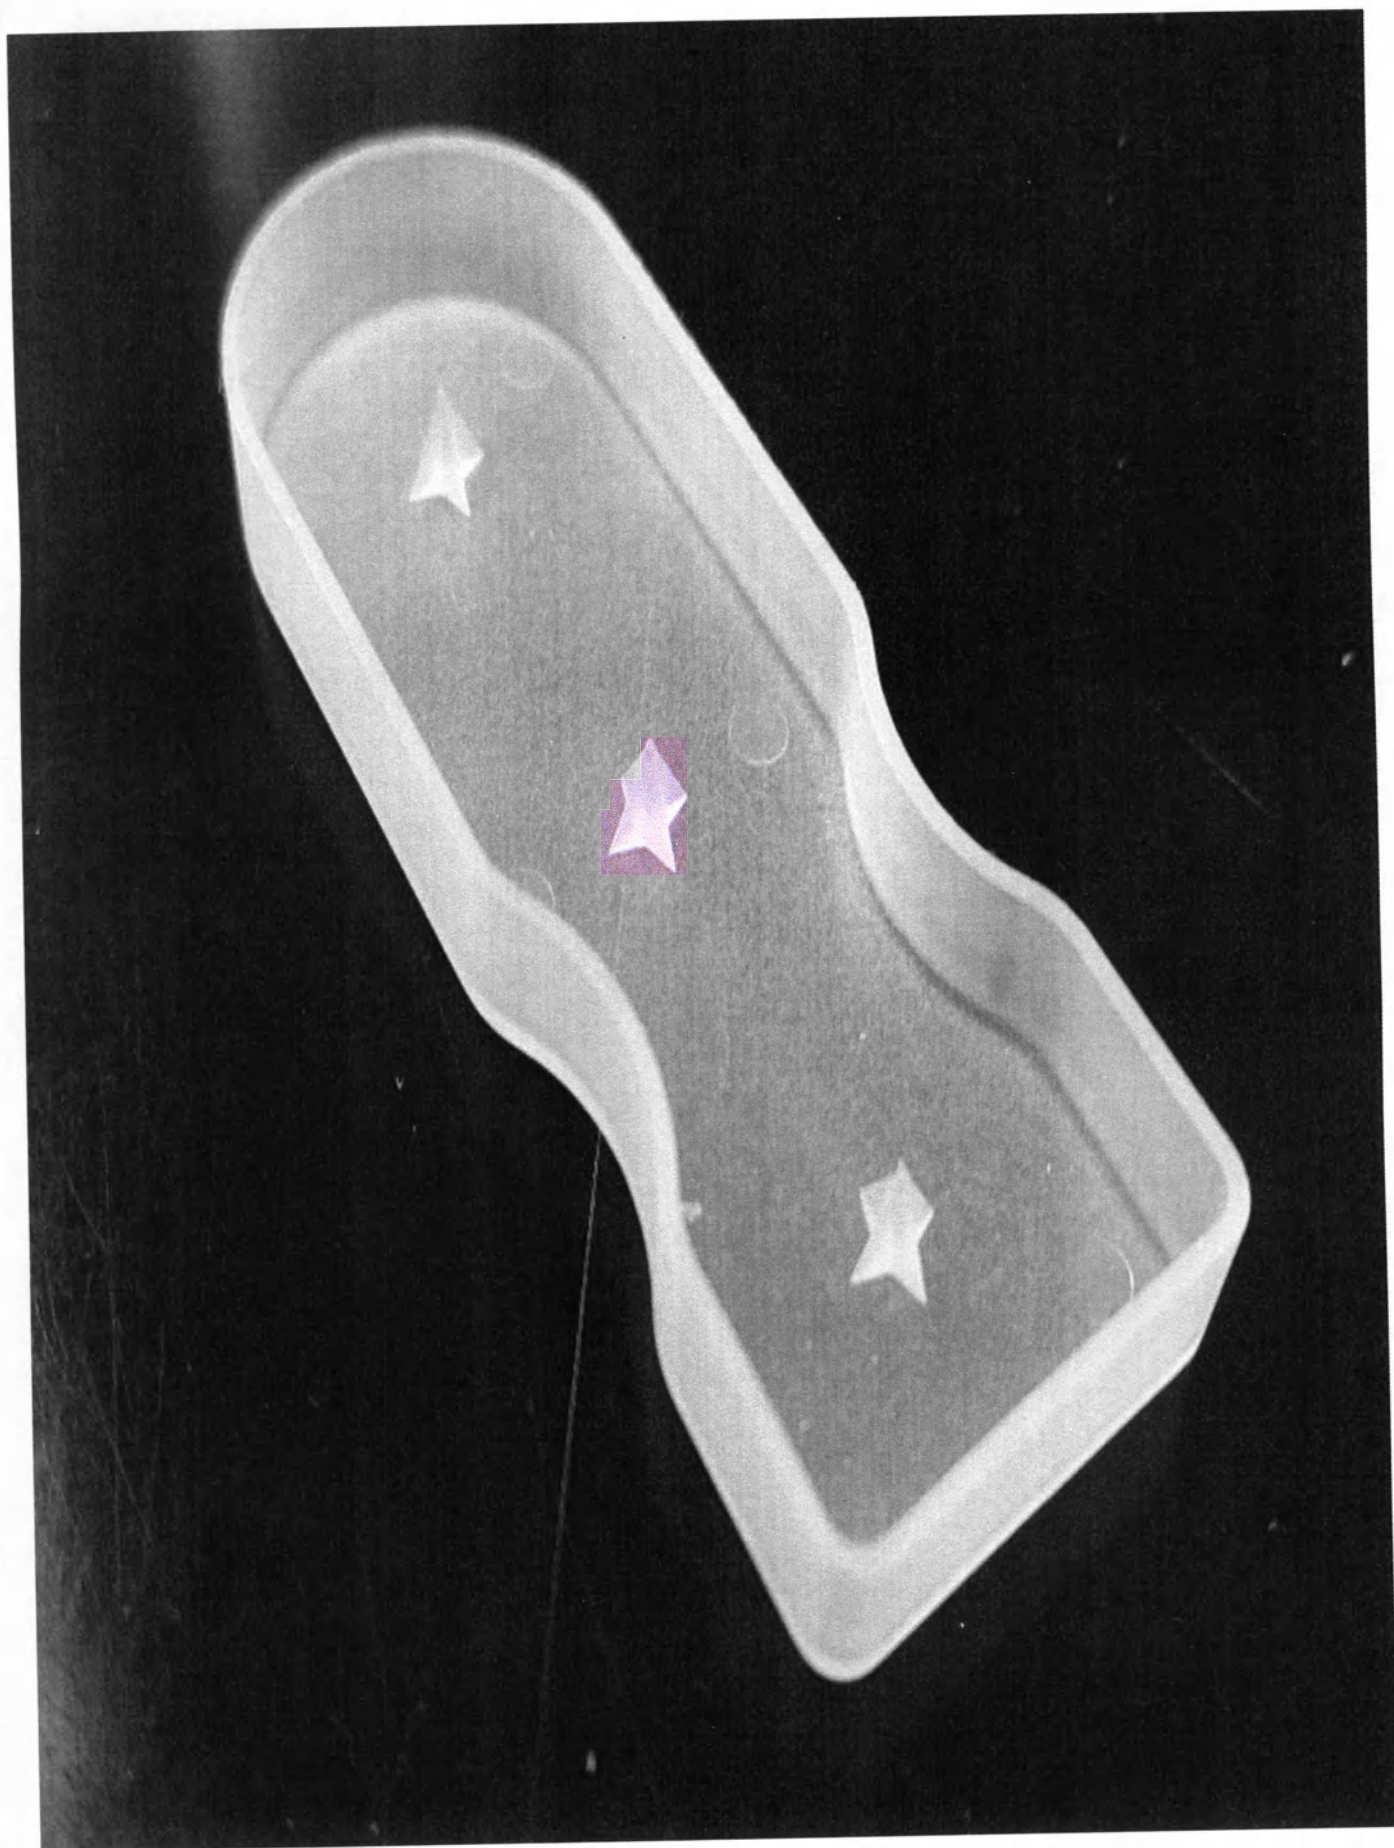

Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения эстрадиола иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах Массура i (E2 (CLIA)), набор на 200 тестов»



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью

Директор ООО «Аэвопром»
Сергей Лид

