

Консультация
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ЭВЕРС»
Хорунжин И.О.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ЭВЕРС»

Хорунжин И.О.



«27» июля 2023 г

Фотографические изображения и маркировка медицинского изделия:

«Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные
по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»

Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»


Вариант исполнения I. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра универсальные».

Фото 1.




Вариант исполнения I. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра универсальные».

Фото 2.

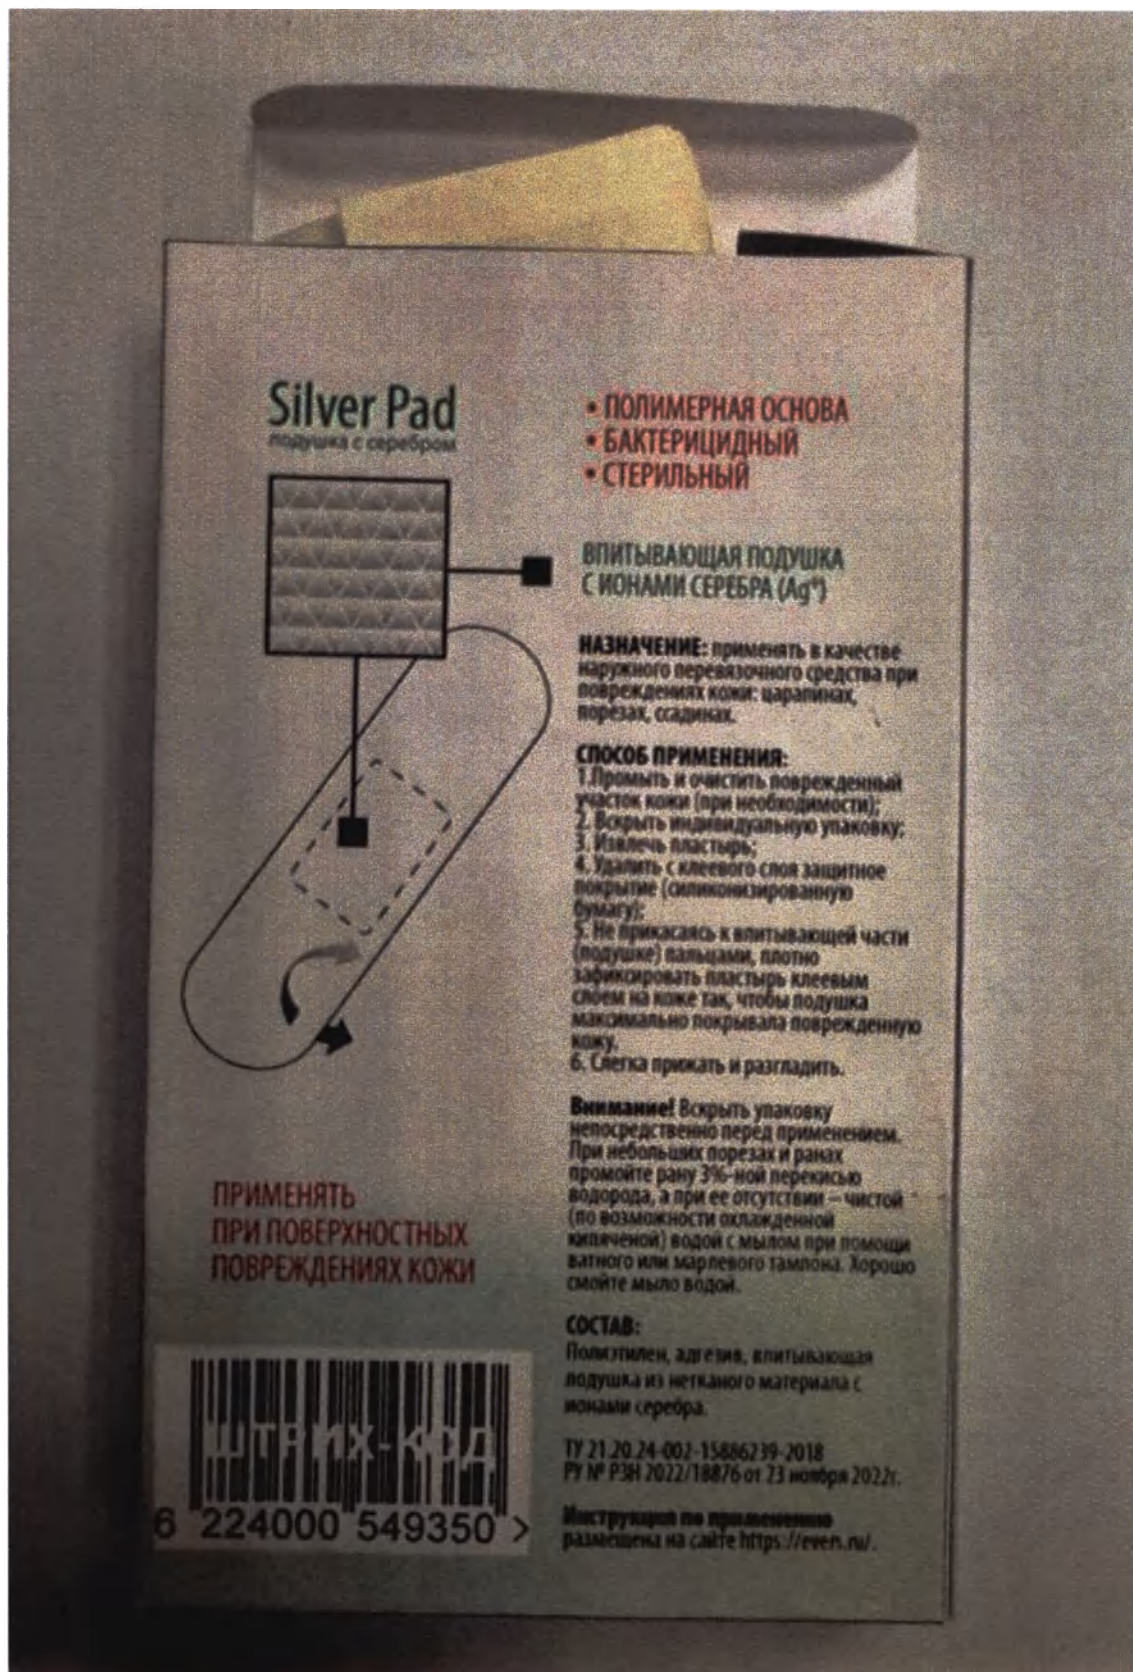

Вариант исполнения I. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра универсальные».

Фото 3.

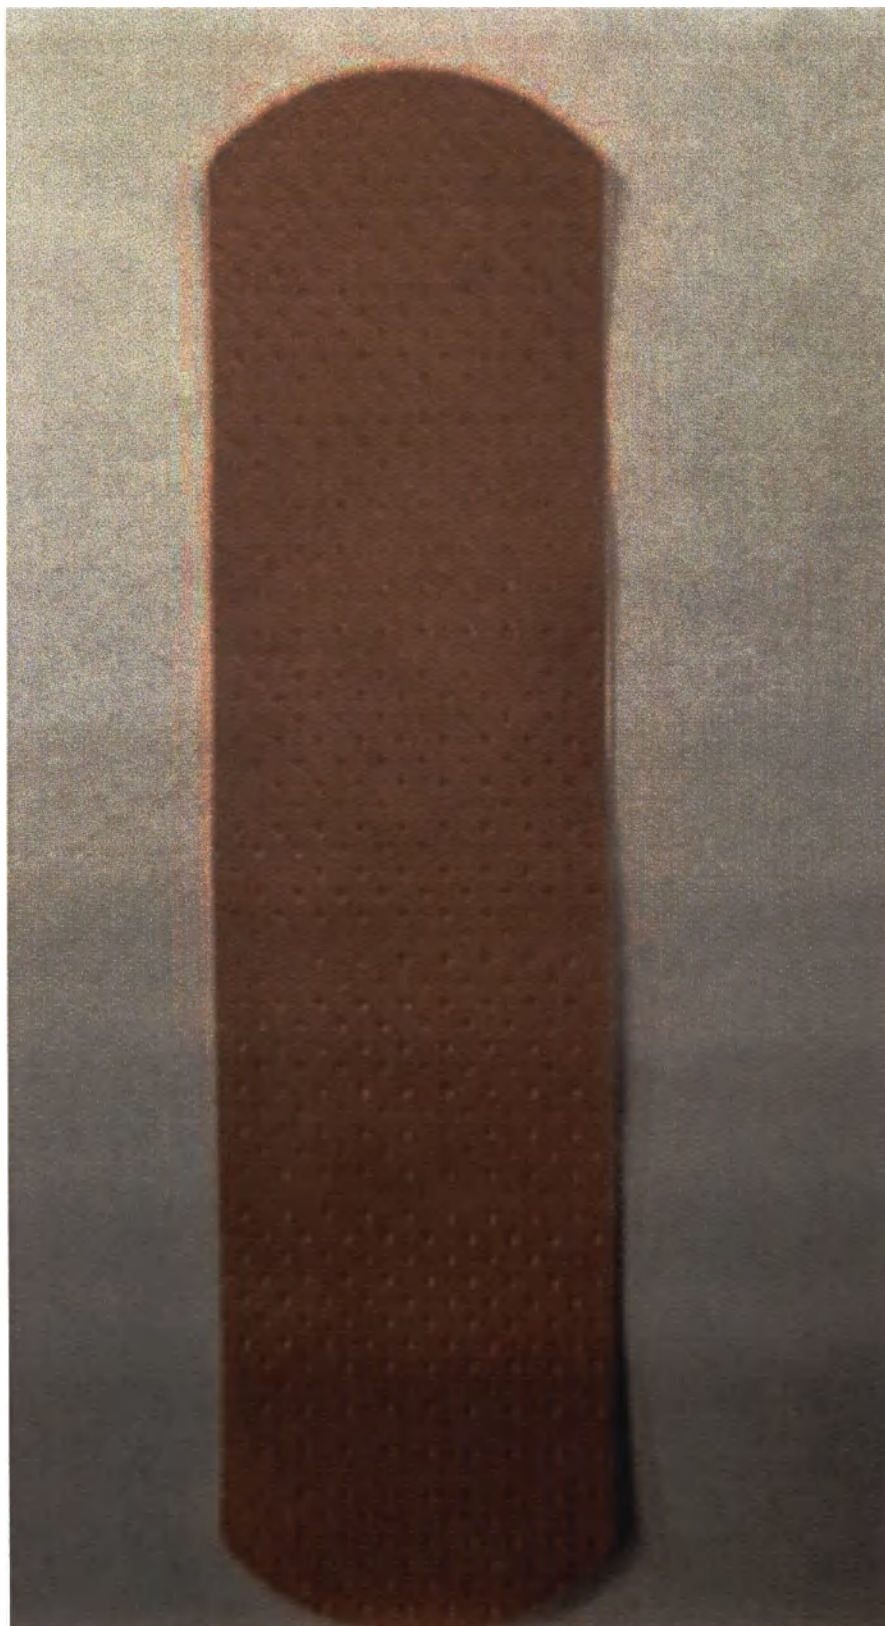

Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»

Вариант исполнения II. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра эластичные».

Фото 1.




Вариант исполнения II. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра эластичные».

Фото 2.



Вариант исполнения II. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра эластичные».

Фото 3.

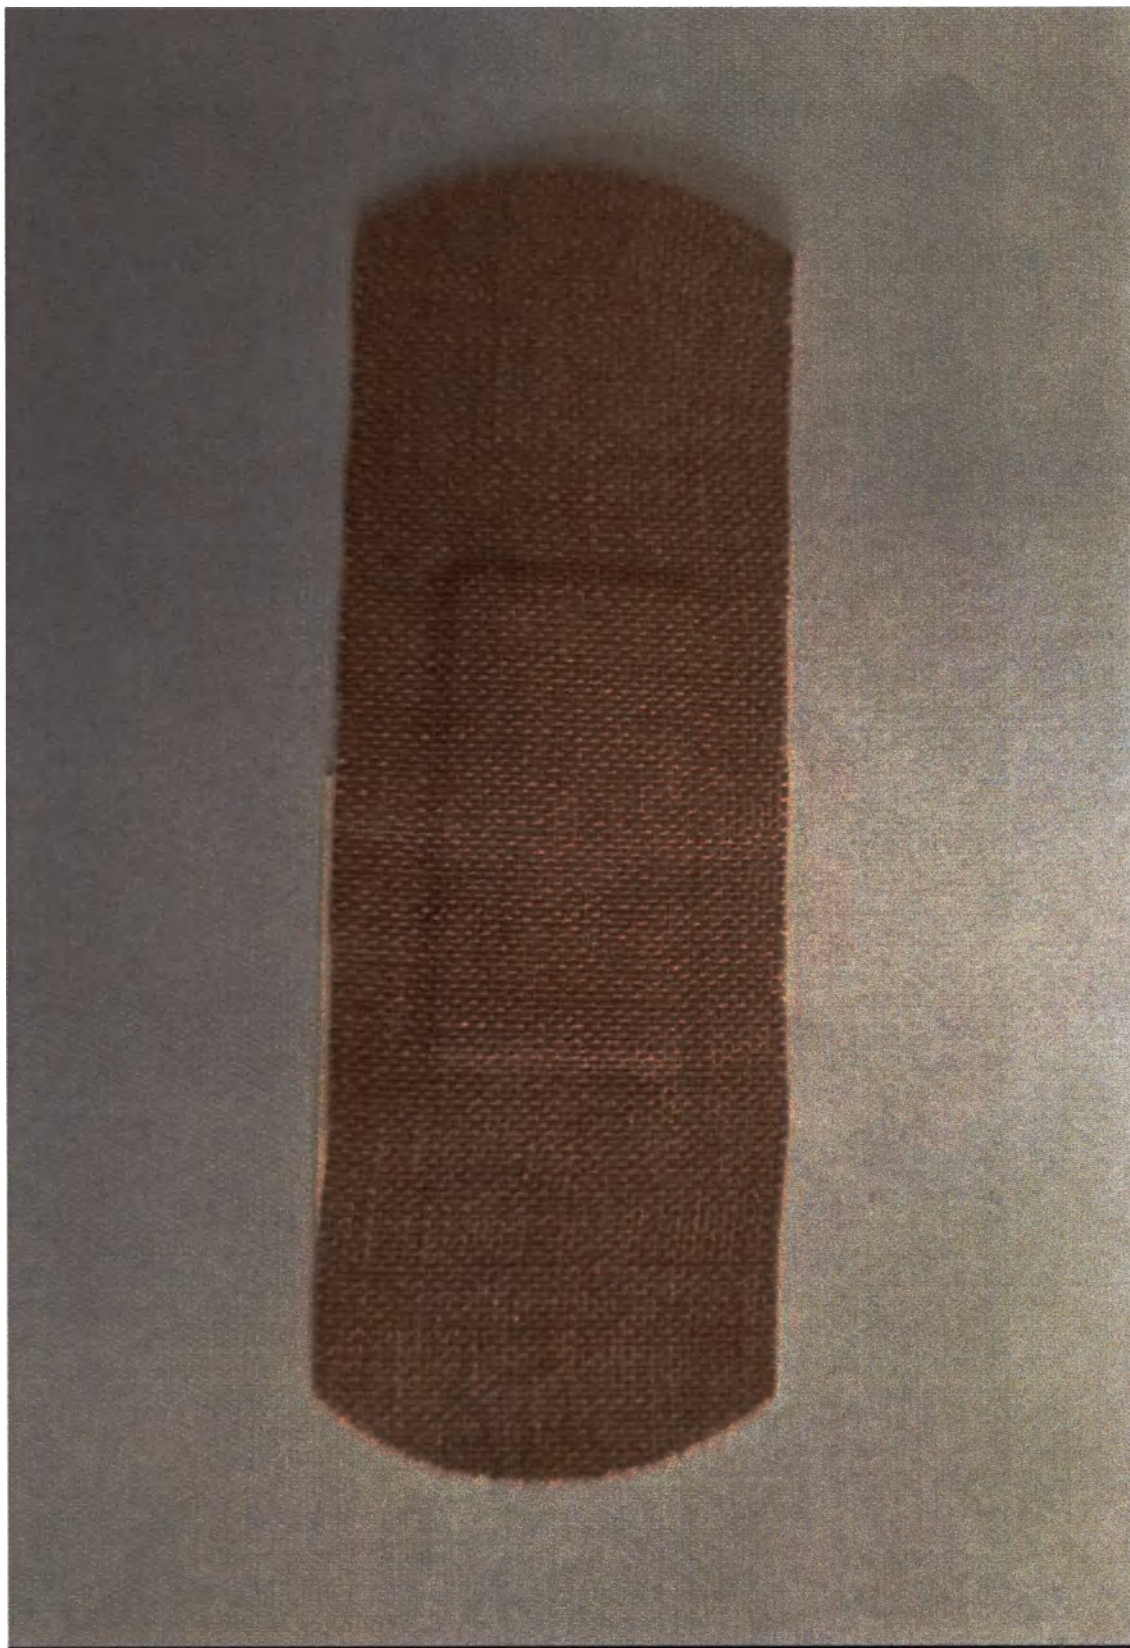

Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»


Вариант исполнения III. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра для чувствительной кожи».

Фото 1.




Вариант исполнения III. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра для чувствительной кожи».

Фото 2.

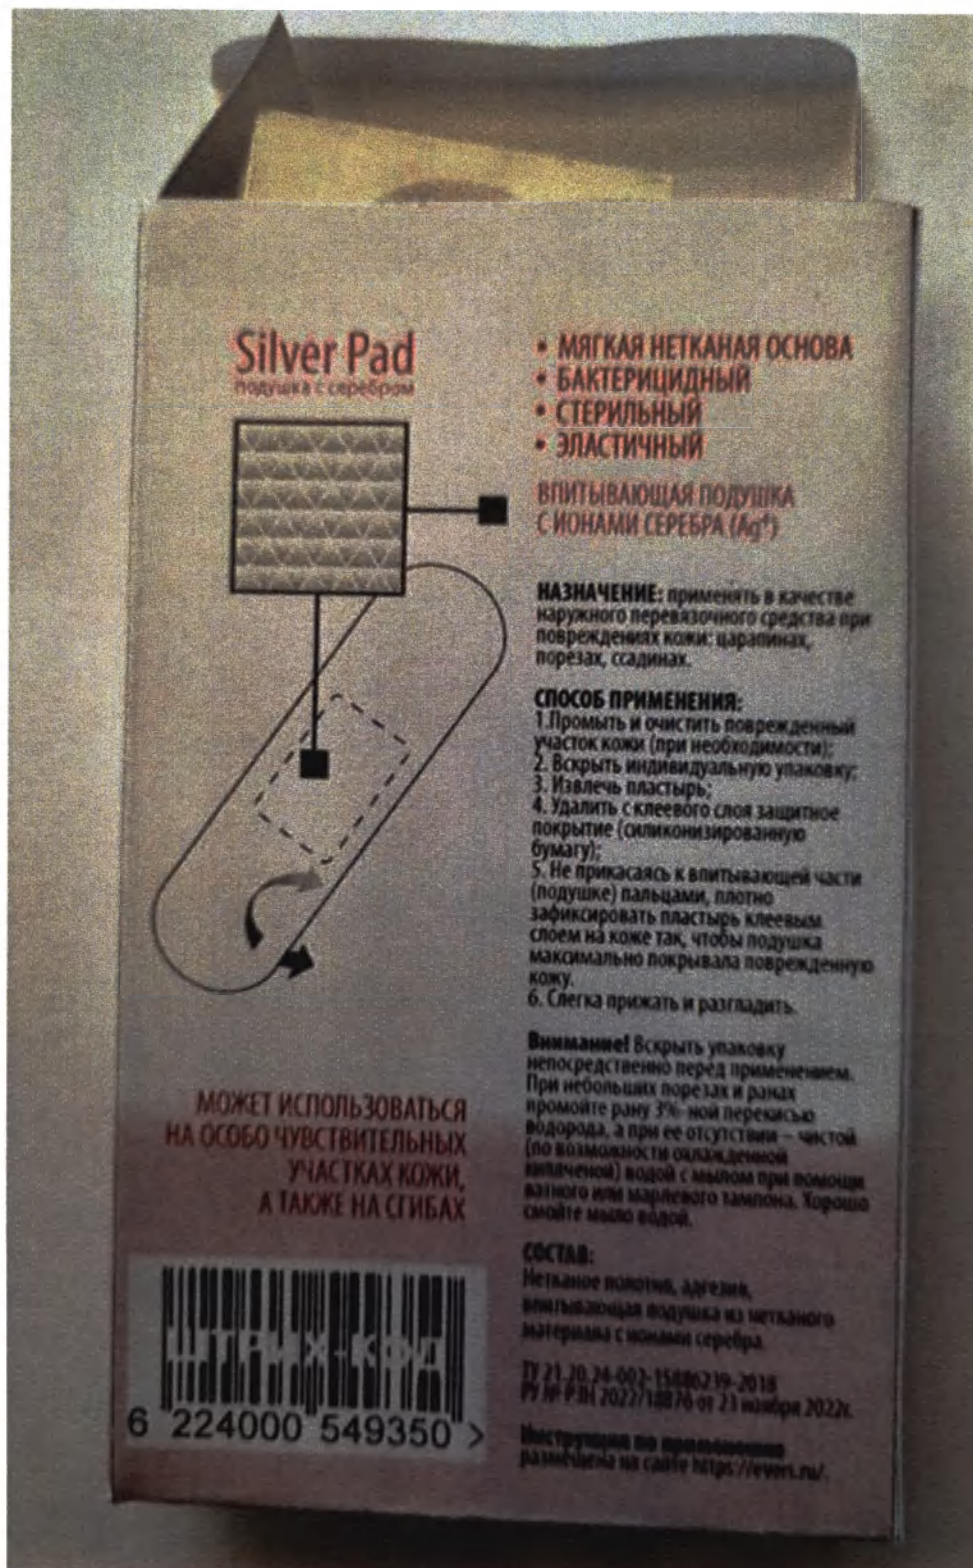

Вариант исполнения III. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра для чувствительной кожи».

Фото 3.

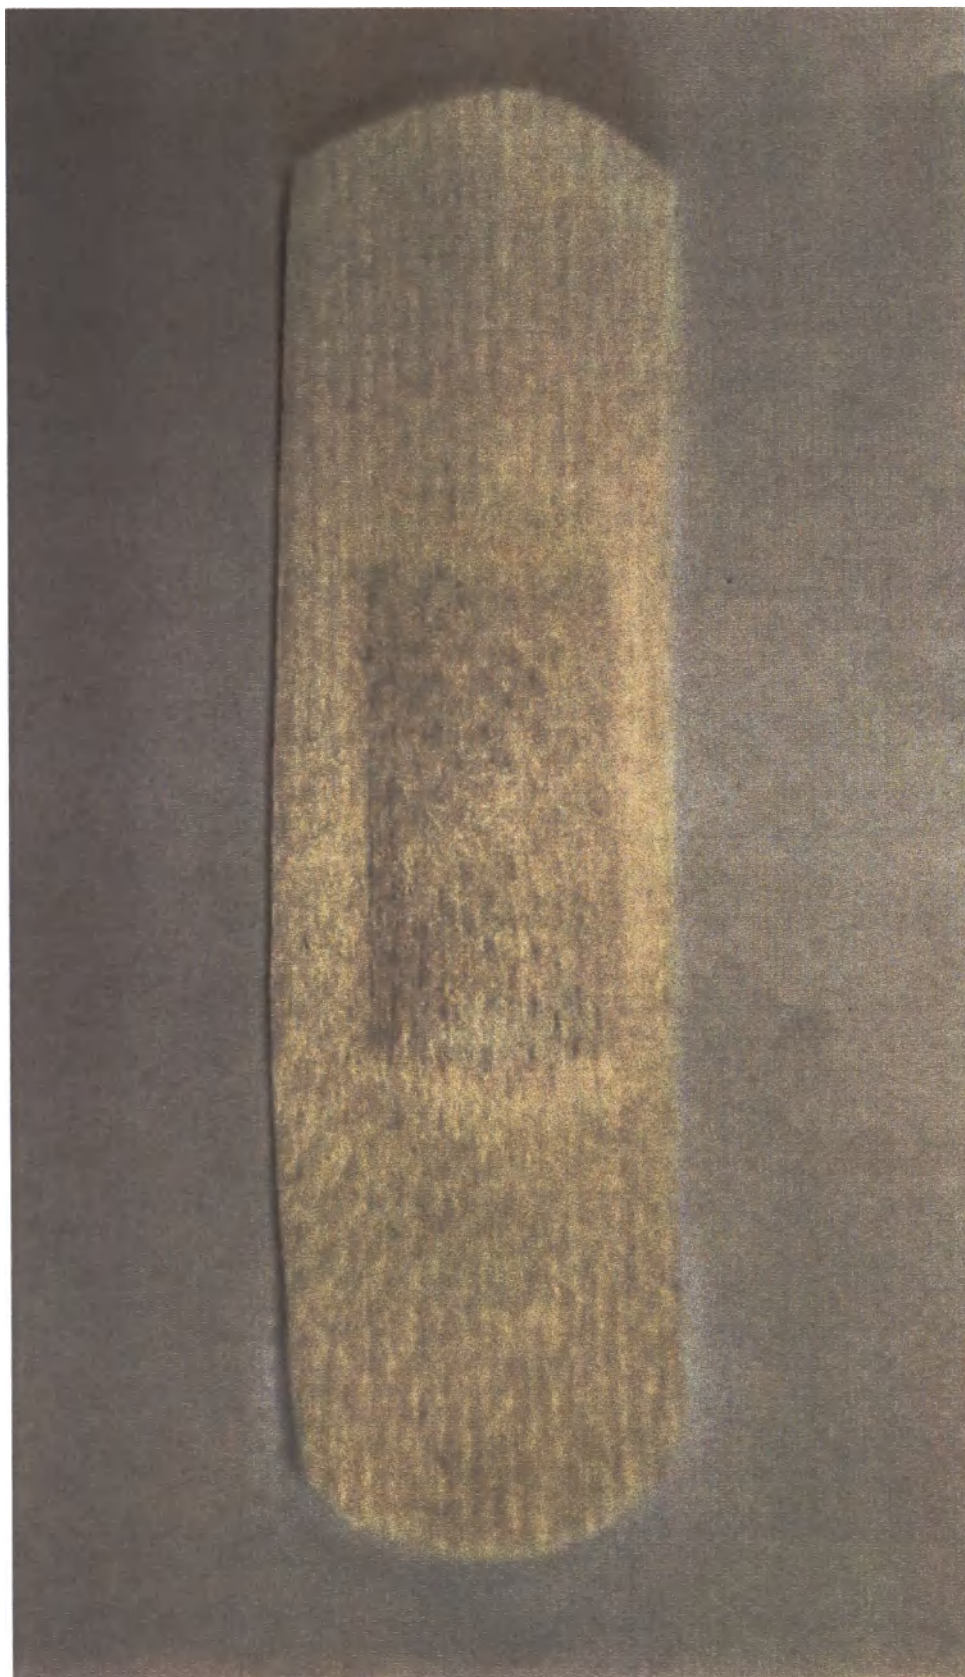

Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»


Вариант исполнения IV. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра водонепроницаемые».

Фото 1.




Вариант исполнения IV. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра водонепроницаемые».

Фото 2.

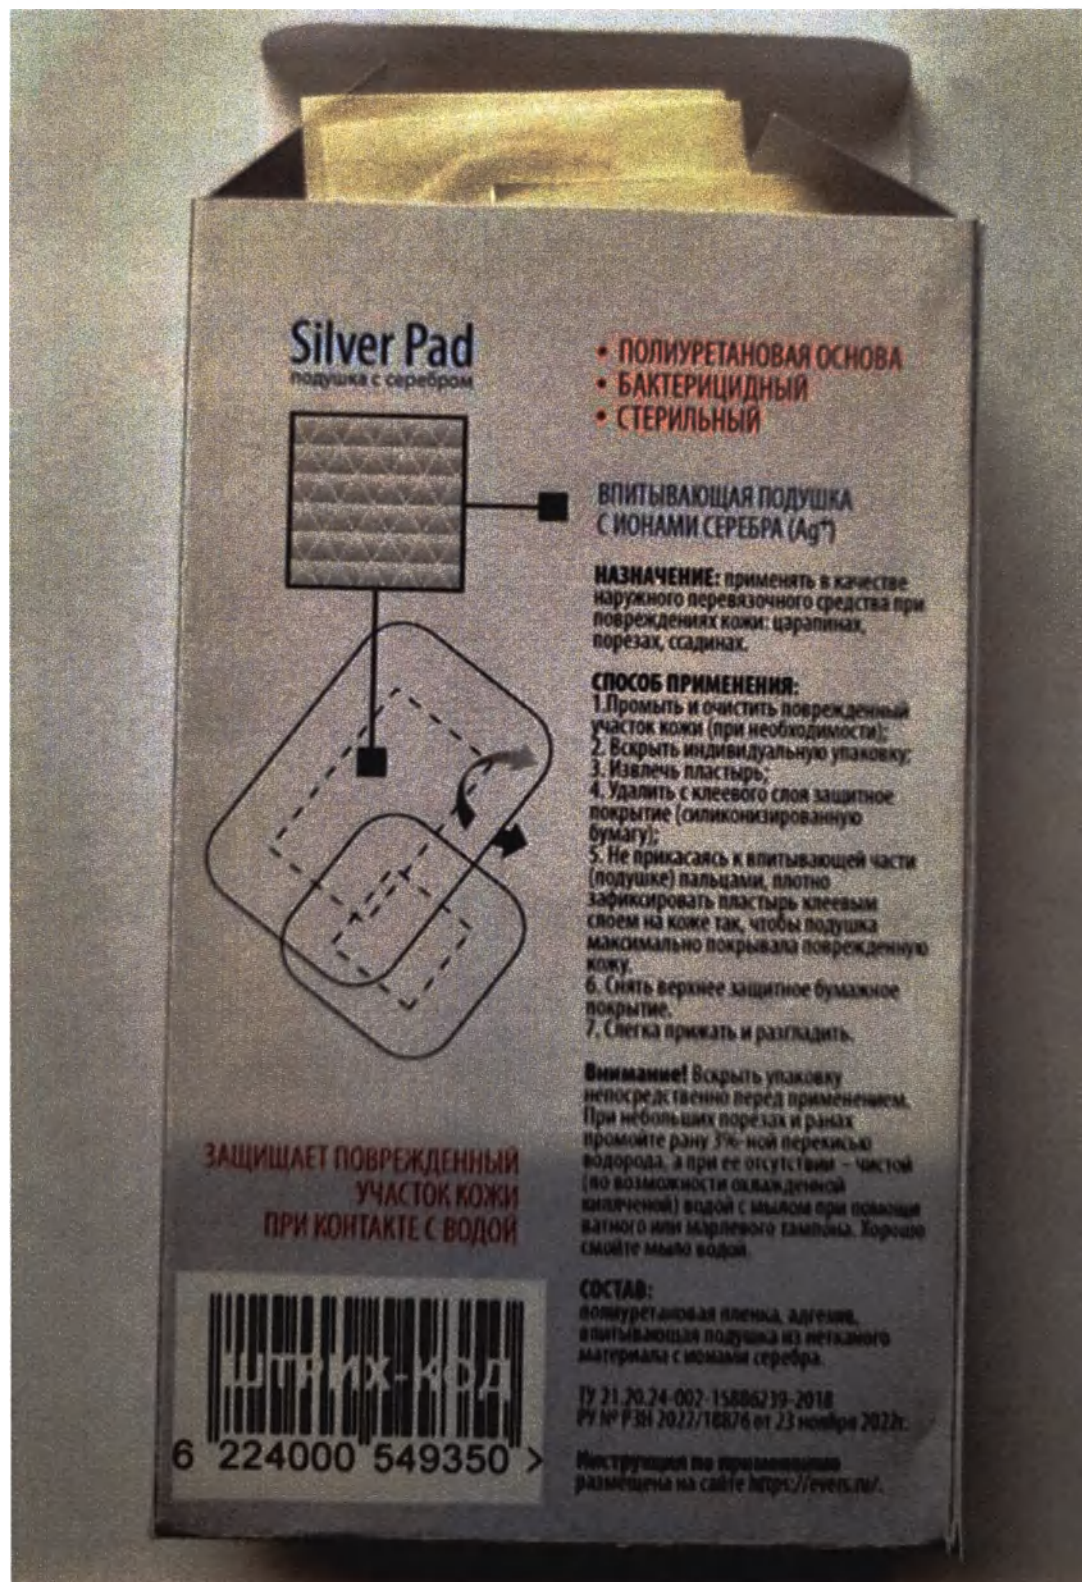

Вариант исполнения IV. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра водонепроницаемые».

Фото 3.

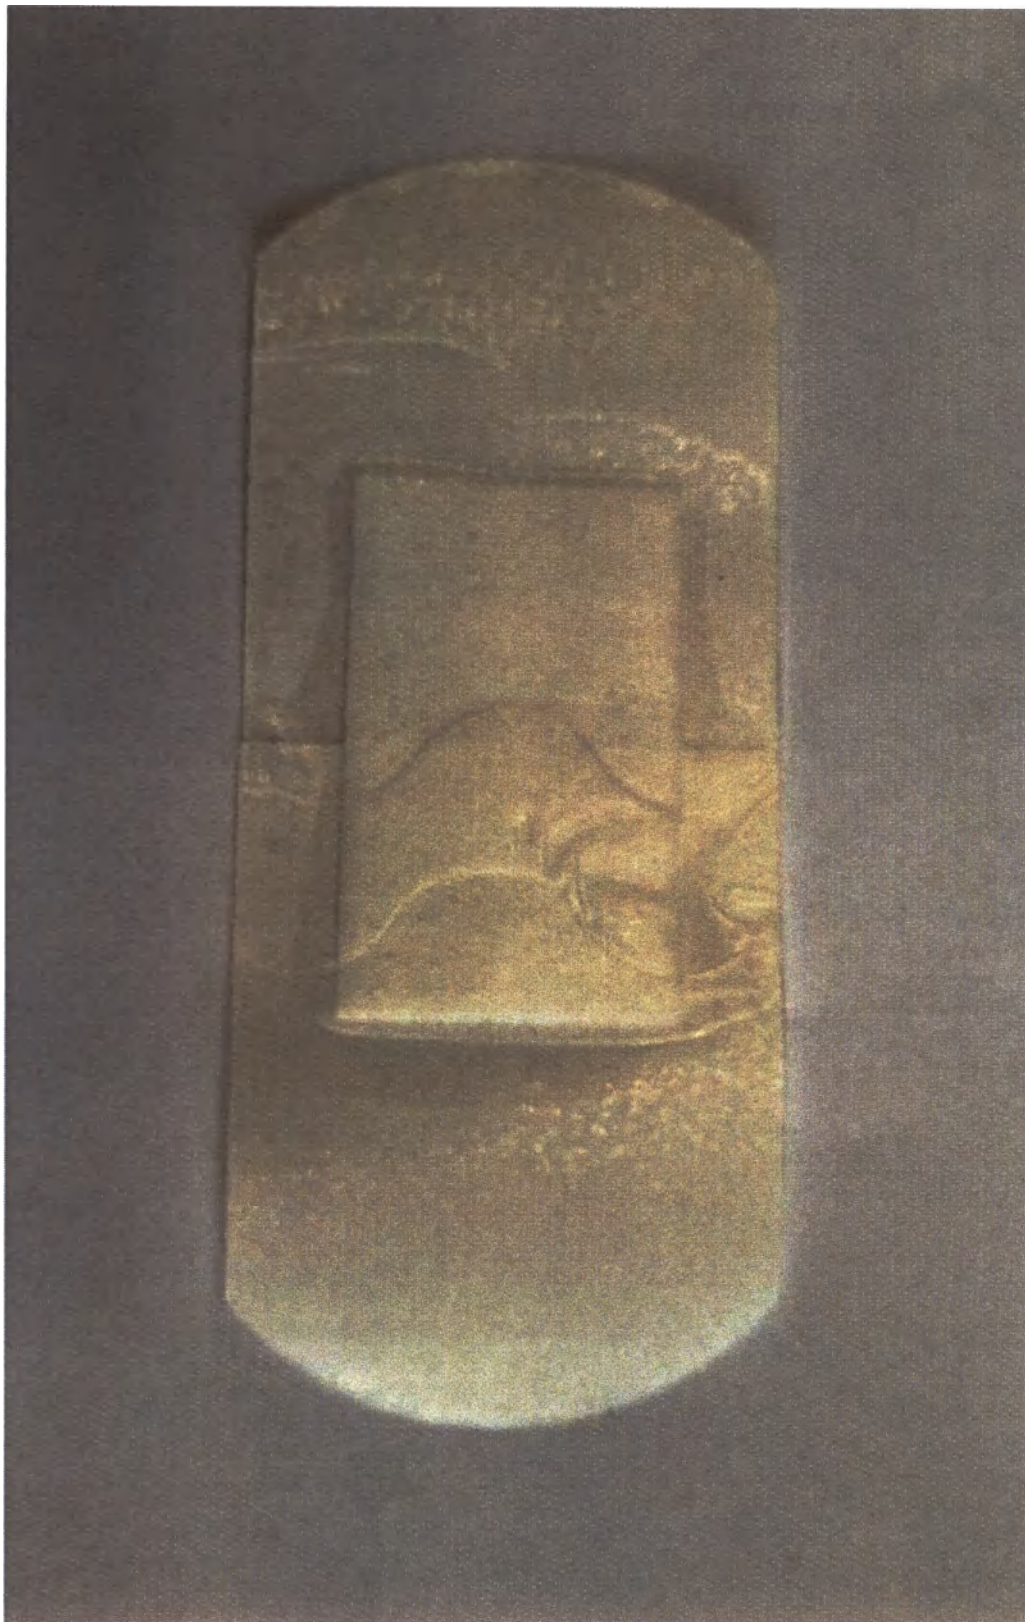

Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»


Вариант исполнения V. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра детские».

Фото 1.



Вариант исполнения V. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра детские».

Фото 2.

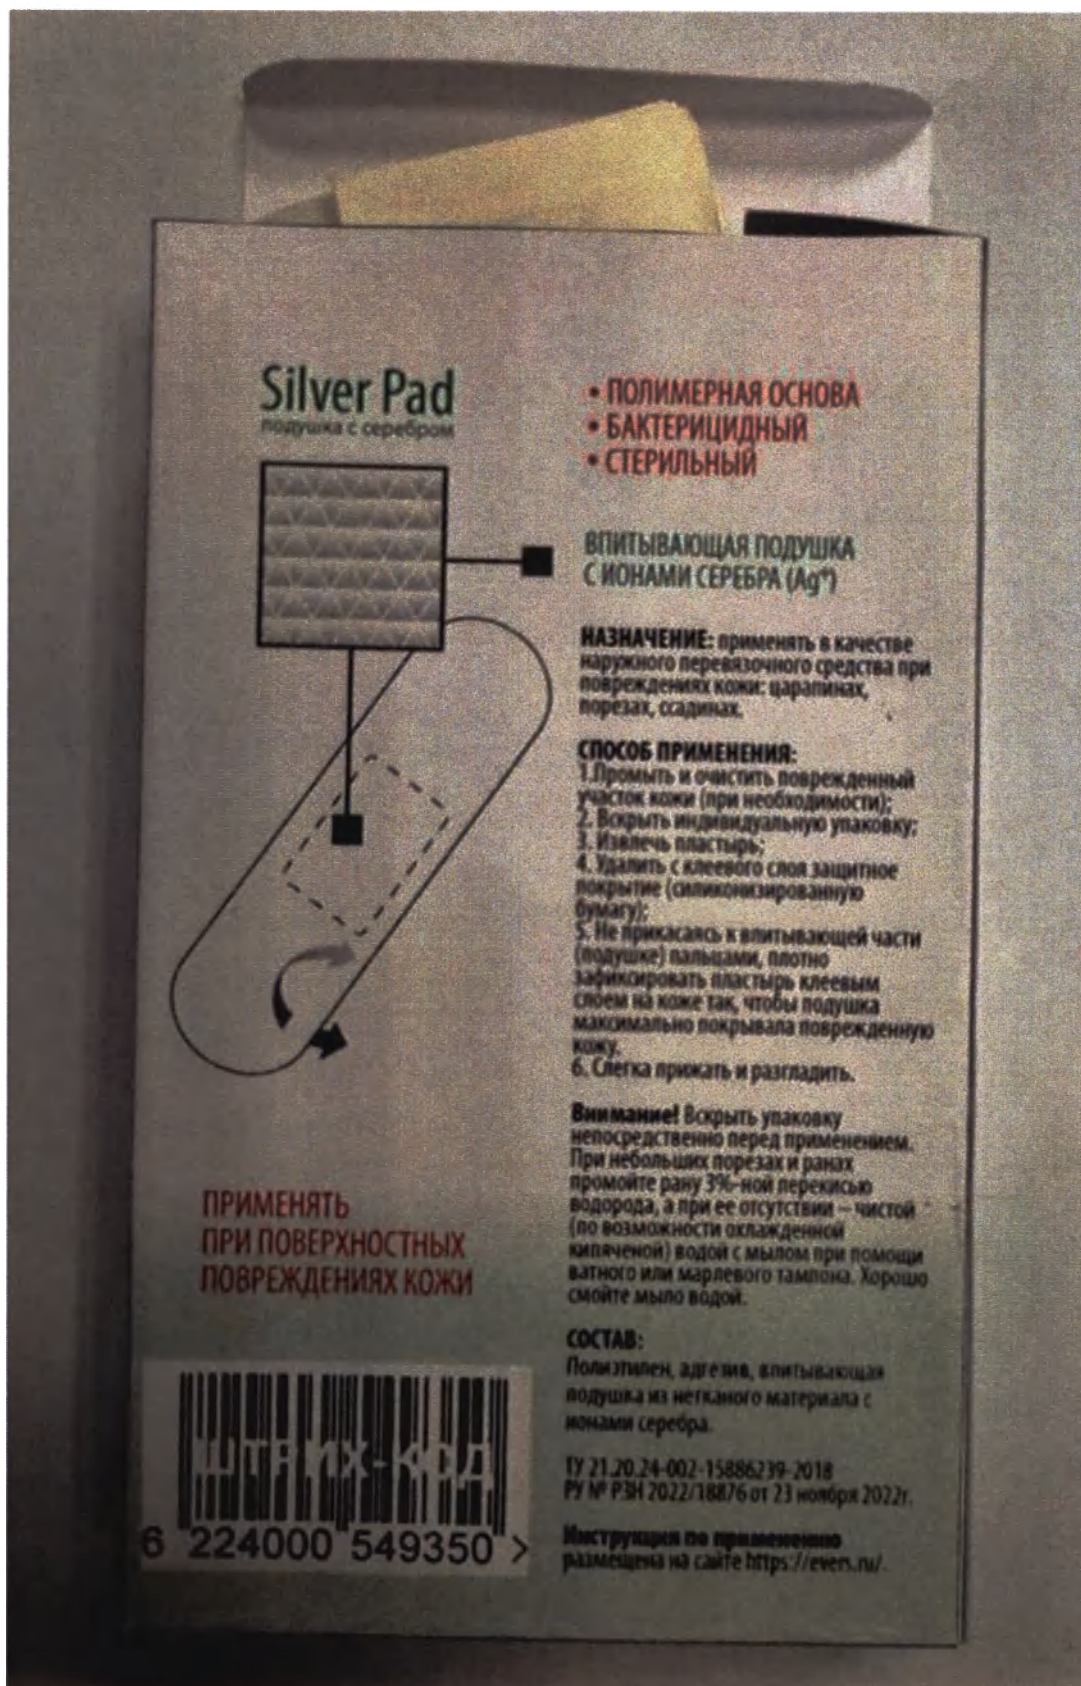

Вариант исполнения V. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра детские».

Фото 3.



Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»

Вариант исполнения VI. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра кровоостанавливающие».

Фото 1.




Вариант исполнения VI. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра кровоостанавливающие».

Фото 2.



Вариант исполнения VI. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра кровоостанавливающие».

Фото 3.

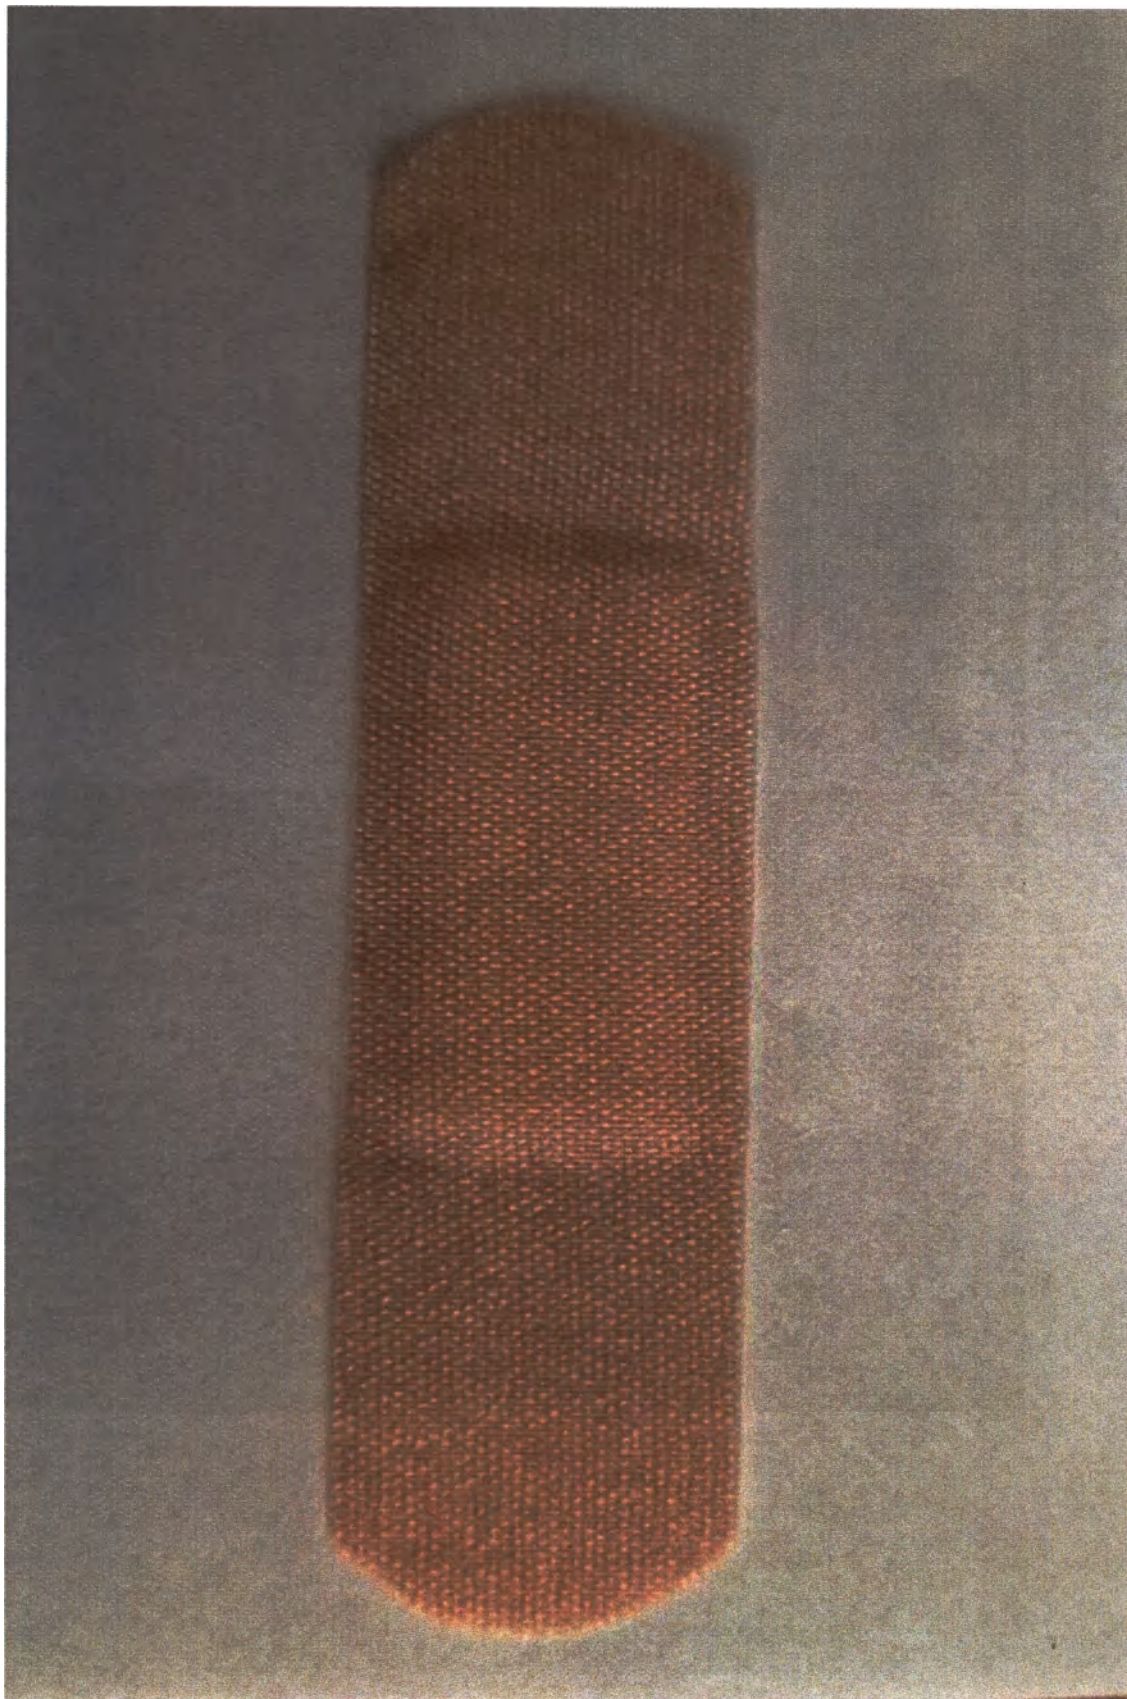

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018» в индивидуальной упаковке




ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
ПЛАСТЫРЕЙ, ВХОДЯЩИХ В НАБОР

ЛИЦО



ЗАДНИК

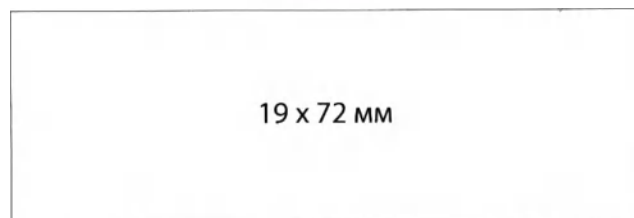

Дарданин, непереносимый и «защитный» белок, способствующий развитию универсальных».	65 mm	24 mm	65 mm	12 mm
универсальные».	24 mm			

Universal

универсальные

Пример маркировки медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра» по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018
 Вариант исполнения II. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра»

Эластичные 24 мм 65 мм 24 мм 65 мм 12 мм

- ЭЛАСТИЧНЫЙ
- БАКТЕРИЦИДНЫЙ
- СТЕРИЛЬНЫЙ
- ТКАНЕВАЯ ОСНОВА

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОДУШКА С ИОНАМИ СЕРЕБРА (Ag⁺)

НАЗНАЧЕНИЕ: применять в качестве наружного перевязочного средства при повреждениях кожи: царапинах, порезах, ссадинах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Промыть и очистить поврежденный участок кожи (при необходимости);
2. Вскрыть индивидуальную упаковку;
3. Извлечь пластырь;
4. Удалить с клеевого слоя защитное покрытие (силиконизированную бумагу);
5. Не прикасаясь к впитывающей части (подушке) пальцами, плотно зафиксировать пластырь клеевым слоем на коже так, чтобы подушка максимально покрывала поврежденную кожу;
6. Слегка прижать и разгладить.

Внимание! Вскрыть упаковку непосредственно перед применением. При небольших порезах и ранах промойте рану 3%-ной перекисью водорода, а при ее отсутствии – чистой (по возможности охлажденной кипяченой) водой с мылом при помощи ватного или марлевого тампона. Хорошо смойте мыло водой.


СОСТАВ:

Эластичная ткань, адгезив, впитывающая подушка из нетканого материала с ионами серебра.

ТУ 21.20.24-002-15886239-2018
 РУ № РЗН 2022/18876 от 23 ноября 2022г.

Инструкция по применению размещена на сайте <https://evers.ru/>.

Silver Pad
 подушка с серебром

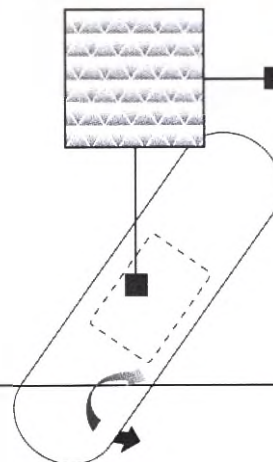

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СГИБАХ И НА ПОДВИЖНЫХ УЧАСТКАХ ТЕЛА: ПАЛЬЦЫ, ЛОКТИ, КОЛЕНИ, ПЯТКИ



6 224000 549350 >

Elastic
 эластичные
 Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра
 ТУ 21.20.24-002-15886239-2018




Противопоказания к применению и меры предосторожности:
 Индивидуальная непереносимость компонентов изделия. Изделие однократного пользования, повторному применению не подлежит. Не использовать при повреждении упаковки изделия. Не использовать после окончания срока годности. Изделие рекомендуется менять ежедневно.

Silver Pad
 подушка с серебром



Elastic
 эластичные

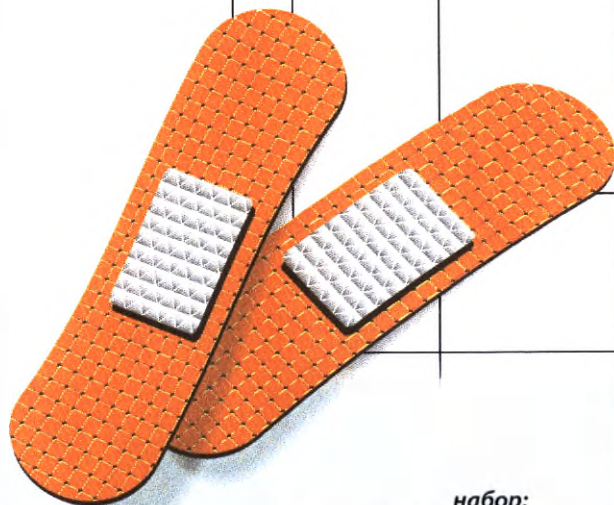

набор:
ПЛАСТЫРИ
 МЕДИЦИНСКИЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
 СТЕРИЛЬНЫЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА
 ЭЛАСТИЧНЫЕ

20 шт

Elastic
 эластичные

Состав №3:
 размер
 19 мм x 72 мм
 20 штук

STERILE R



Условия хранения: по группе I (II) по ГОСТ 15150, но при температуре от +5°C до +30°C. Хранить в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Нетоксично.
 Условия утилизации: В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 использованное Изделие утилизировать как отходы класса Б; неиспользованное Изделие или пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истекшим сроком годности утилизировать как отходы класса А.

20 шт

Производитель/Уполномоченный принимать претензии:
 Общество с ограниченной ответственностью «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г.о.Дубна, г.Дубна, пр-кт Науки, д.13., тел. +7(499)707-10-09, www.evers.ru, e-mail: evers@evers.ru.
Адрес производства: 141983, Московская область, г.о.Дубна, г.Дубна, пр-кт Науки, д.13.
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Дата изготовления/стерилизации (месяц, год): XX-XXXX
Номер серии: XX

Вариант исполнения III. «Набор: пластины медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра для чувствительной кожи».



Aqua-Stop

водонепроницаемые

Состав №1:

размер
38 мм x 38 мм - 5шт.
30 мм x 55 мм - 5шт.

STERILE R



Условия хранения: по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150, но при температуре от +5°C до +30°C. Хранить в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Нетоксично.

Условия утилизации: В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 использованное изделие утилизировать как отходы класса Б; неиспользованное изделие или пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истекшим сроком годности утилизировать как отходы класса А.


10 ШТ

Aqua-Stop

Aqua-Stop

водонепроницаемые

Silver Pad
подушка с серебром

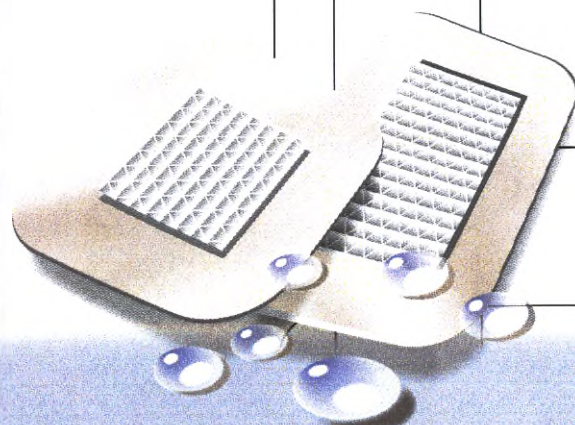

набор:

ПЛАСТЫРИ

МЕДИЦИНСКИЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

10 ШТ



Aqua-Stop
водонепроницаемые

Набор: пластыри медицинские
бактерицидные стерильные по
ТУ 21.20.24-002-15886239-2018



Противопоказания к применению и меры предосторожности:
Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.
Изделие однократного пользования, повторному применению не подлежит.
Не использовать при повреждении упаковки изделия.
Не использовать после окончания срока годности.
Изделие рекомендуется менять ежедневно.

Silver Pad
подушка с серебром

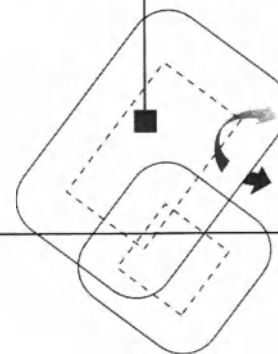

- ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ОСНОВА
- БАКТЕРИЦИДНЫМ
- СТЕРИЛЬНЫМ

ВЛИТЫВАЮЩАЯ ПОДУШКА
С ИОНАМИ СЕРЕБРА (Ag⁺)

НАЗНАЧЕНИЕ: применять в качестве наружного перевязочного средства при повреждениях кожи: царапинах, порезах, ссадинах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Промыть и очистить поврежденный участок кожи (при необходимости);
2. Вскрыть индивидуальную упаковку;
3. Извлечь пластырь;
4. Удалить с клеевого слоя защитное покрытие (силиконизированную бумагу);
5. Не прикасаясь к впитывающей части (подушке) пальцами, плотно зафиксировать пластырь крестовым слесом на коже так, чтобы подушка максимально покрывала поврежденную кожу;
6. Снять верхнее защитное бумажное покрытие;
7. Легко прижать и разгладить.

Внимание! Вскрыть упаковку непосредственно перед применением. При небольших порезах и ранах промойте рану 3%-ной перекисью водорода, а при ее отсутствии – чистой (по возможности охлажденной кипяченой) водой с мылом при помощи ватного или марлевого тампона. Хорошо смойте мыло водой.

СОСТАВ: полиуретановая пленка, адгезив, впитывающая подушка из нетканого материала с ионами серебра.

ТУ 21.20.24-002-15886239-2018
РУ № РЗН 2022/18876 от 23 ноября 2022г.

Инструкция по применению размещена на сайте <https://evers.ru/>.

**ЗАЩИЩАЕТ ПОВРЕЖДЕННЫЙ
УЧАСТОК КОЖИ
ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ**



6 224000 549350 >

Производитель/Уполномоченный принимать претензии:
Общество с ограниченной ответственностью «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13, тел. +7(499)707-10-09, www.evers.ru, e-mail: evers@evers.ru.

Адрес производства: 141983, Московская область, г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки, д.13.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Дата изготовления / стерилизации (месяц, год): XX-XXXX

Номер серии: XX

Пример маркировки медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»
Вариант исполнения IV. «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра водонепроницаемые».

65 мм

24 мм

65 мм

12 мм



Kid's

Kid's
детские

Состав №1:
размер
19 мм x 63 мм
20 штук

STERILE R



Условия хранения: по группе 1 (Л) по ГОСТ 15150, но при температуре от +5°C до +30°C. Хранить в сухом месте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей. Нетоксично.

Условия утилизации: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 использованное Изделие утилизировать как отходы класса Б; неиспользованное Изделие или пришедшее в непригодность, в том числе в связи с истекшим сроком годности утилизировать как отходы класса А.

20 шт

Kid's
детские



20 шт

Silver Pad
подушка с серебром




Kid's
детские



набор:
ПЛАСТЫРИ
МЕДИЦИНСКИЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА
ДЕТСКИЕ

Противопоказания к применению и меры предосторожности:
Индивидуальная непереносимость компонентов изделия. Изделие однократного пользования, повторному применению не подлежит. Не использовать при повреждении упаковки изделия. Не использовать после окончания срока годности. Изделие рекомендуется менять ежедневно.

Silver Pad
подушка с серебром

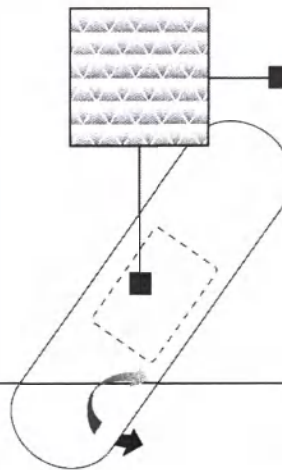

ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОЖИ



• ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА
• БАКТЕРИЦИДНЫЙ
• СТЕРИЛЬНЫЙ

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОДУШКА С ИОНАМИ СЕРЕБРА (Ag⁺)

НАЗНАЧЕНИЕ: применять в качестве наружного перевязочного средства при повреждениях кожи: царапинах, порезах, ссадинах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Промыть и очистить поврежденный участок кожи (при необходимости);
2. Вскрыть индивидуальную упаковку;
3. Извлечь пластырь;
4. Удалить с клеевого слоя защитное покрытие (силиконизированную бумагу);
5. Не прикасаясь к впитывающей части (подушке) пальцами, плотно зафиксировать пластырь клеевым слоем на коже так, чтобы подушка максимально покрывала поврежденную кожу;
6. Слегка прижать и разгладить.

Внимание! Вскрыть упаковку непосредственно перед применением. При небольших порезах и ранах промойте рану 3%-ной перекисью водорода, а при ее отсутствии – чистой (по возможности охлажденной кипяченой) водой с мылом при помощи ватного или марлевого тампона. Хорошо смойте мыло водой.

СОСТАВ:

Полиэтилен, адгезив, впитывающая подушка из нетканого материала с ионами серебра.

ТУ 21.20.24-002-15886239-2018
РУ № РЗН 2022/18876 от 23 ноября 2022г.

Инструкция по применению размещена на сайте <https://evers.ru/>.

Производитель/Уполномоченный принимать претензии:
Общество с ограниченной ответственностью «Эверс», Россия, 141983, Московская область, г.о.Дубна, г.Дубна, пр-кт Науки, д.13., тел. +7(499)707-10-09, www.evers.ru, e-mail: evers@evers.ru.
Адрес производства: 141983, Московская область, г.о.Дубна, г.Дубна, пр-кт Науки, д.13.
Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Дата изготовления / стерилизации (месяц, год): XX-XXXX
Номер серии: XX

24 мм

65 мм

24 мм

65 мм

12 мм

Пример маркировки медицинского изделия «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные по ТУ 21.20.24-002-15886239-2018»

Вариант исполнения УЛ: «Набор: пластыри медицинские бактерицидные стерильные с ионами серебра кровоостанавливающие».

65 мм

24 мм

65 мм

12 мм

• ЭЛАСТИЧНЫЙ
• БАКТЕРИЦИДНЫЙ
• СТЕРИЛЬНЫЙ

ВПИТЫВАЮЩАЯ ПОДУШКА
С АЛЬГИНАТОМ КАЛЬЦИЯ И
ИОНАМИ СЕРЕБРА (Ag⁺)

НАЗНАЧЕНИЕ: применять в качестве
наружного перевязочного средства при
повреждениях кожи: царапинах,
порезах, ссадинах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Промыть и очистить поврежденный
участок кожи (при необходимости);
2. Вскрыть индивидуальную упаковку;
3. Извлечь пластырь;
4. Удалить с клеевого поля защитное
покрытие (силиконизированную
пленку);
5. Не прикасаясь к впитывающей части
(подушке) пальцами, плотно
зафиксировать пластырь клеевым
полем на коже так, чтобы подушка
максимально покрывала поврежденную
кожу.
6. Слегка прижать и разгладить.

Внимание! Вскрыть упаковку
непосредственно перед применением.
При небольших порезах и ранах
промойте рану 3%-ной перекисью
водорода, а при ее отсутствии – чистой
(по возможности охлажденной
кипяченой) водой с мылом при помощи
ватного или марлевого тампона. Хорошо
смойте мыло водой.


СОСТАВ:

Эластичная ткань, адгезив,
впитывающая подушка с альгинатом
кальция и ионами серебра.

ТУ 21.20.24-002-15886239-2018
РУ № РЗН 2022/18876 от 23 ноября 2022г.

Инструкция по применению
размещена на сайте <https://evers.ru/>.

Hemostatic pad
гемостатическая
подушка



**ПРИМЕНЯТЬ
ПРИ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ КОЖИ**



Hemostatic
кровоостанавливающие

Набор: пластыри медицинские
бактерицидные стерильные по
ТУ 21.20.24-002-15886239-2018

Останавливает
кровь




**Противопоказания к
применению и меры
предосторожности:**
Индивидуальная
непереносимость
компонентов изделия.
Изделие однократного
пользования, повторному
применению не подлежит.
Не использовать при
повреждении упаковки
изделия.
Не использовать после
окончания срока годности.
Изделие рекомендуется
менять ежедневно.

Останавливает
кровь



Hemostatic
кровоостанавливающие

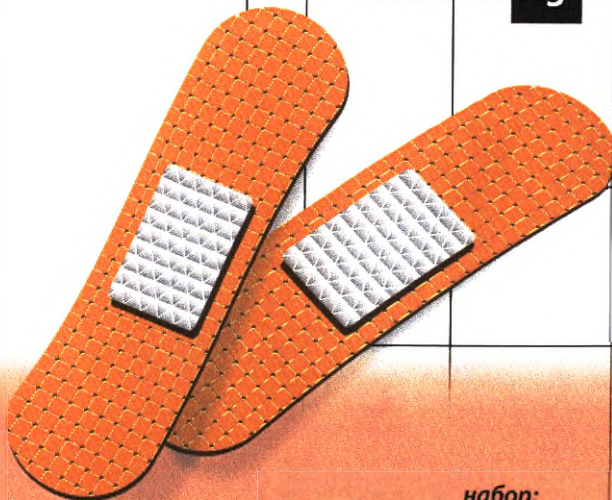

набор:
ПЛАСТЫРИ
МЕДИЦИНСКИЕ БАКТЕРИЦИДНЫЕ
СТЕРИЛЬНЫЕ С ИОНАМИ СЕРЕБРА
КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

20 шт

Hemostatic
кровоостанавливающие

Состав №3:
размер
19 мм x 72 мм
20 штук

STERILE R



Условия хранения: по группе 1
(Л) по ГОСТ 15150, но при
температуре от +5°C до
+30°C. Хранить в сухом
месте, на расстоянии не
менее 1 м от отопительных
приборов и в отсутствии
воздействия прямых
солнечных лучей.
Нетоксично.

Условия утилизации: В
соответствии с СанПиН
2.1.3684-21 использованное
Изделие утилизировать как
отходы класса Б;
неиспользованное Изделие
или пришедшее в
непригодность, в том числе в
связи с истекшим сроком
годности утилизировать как
отходы класса А.

20 шт


Производитель/Уполномоченный принимать претензии:
Общество с ограниченной ответственностью «Эверс», Россия, 141983, Московская
область, г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт Науки, д. 13., тел. +7(499)707-10-09,
www.evers.ru; e-mail: evers@evers.ru.
Адрес производства: 141983, Московская область, г.о. Дубна, г. Дубна, пр-кт
Науки, д. 13.

Срок годности: 3 года с даты стерилизации.
Дата изготовления/стерилизации (месяц, год): XX-XXXX
Номер серии: XX

Прошито, пронумеровано и заверено печатью

27 (Федотъ сель) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Эверс»



Хорунжин И.О.

