

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный предприниматель

Перминова Я.Г.

«16» ноября 2021 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Приборы для измерения артериального давления и частоты
пульса серии Watch BP

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса Watch BP Home A
Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса



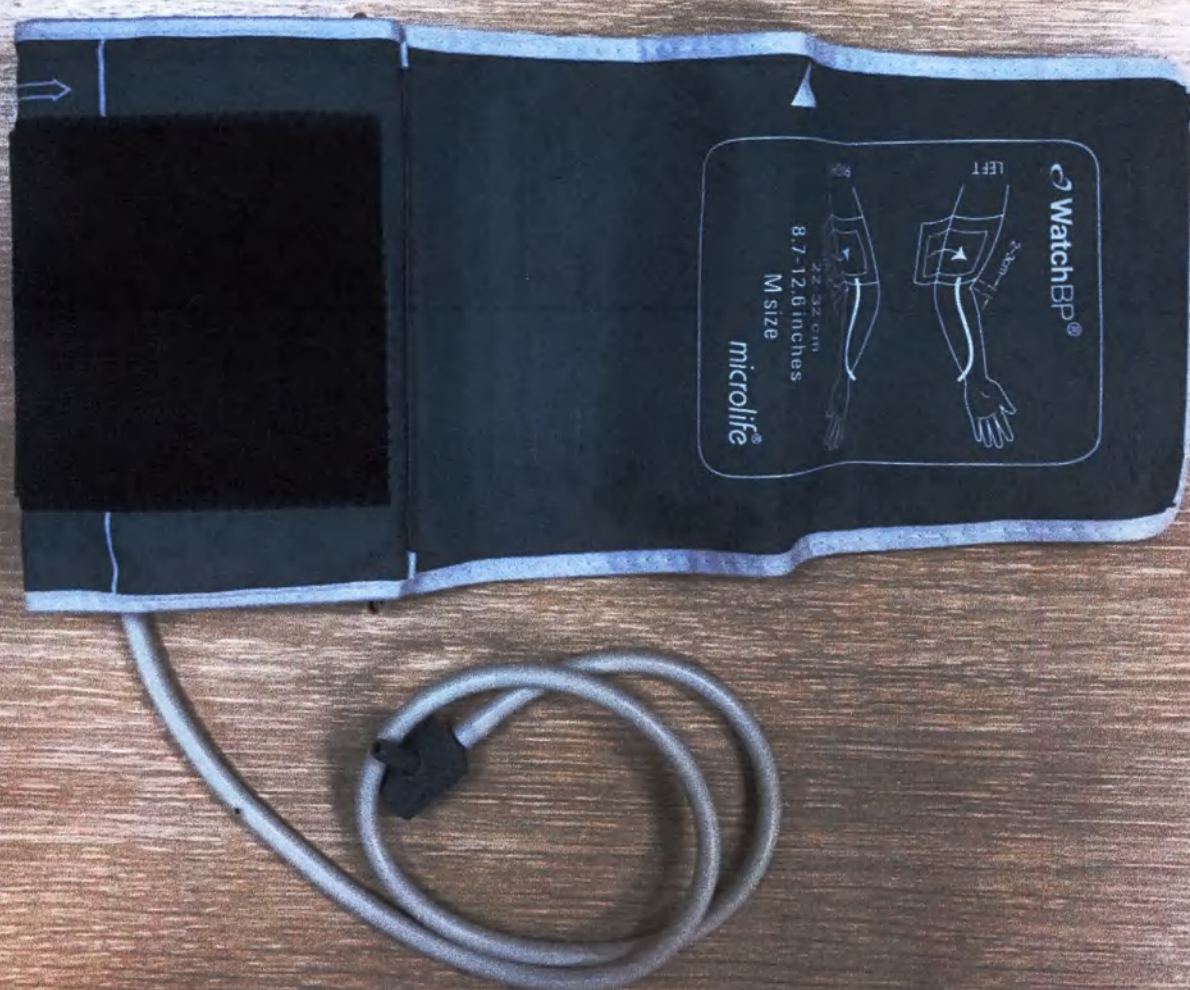




Download our new
WatchBP
E-Catalogue

www.microlife.com/catalogue-watchbp



Элементы питания типа АА

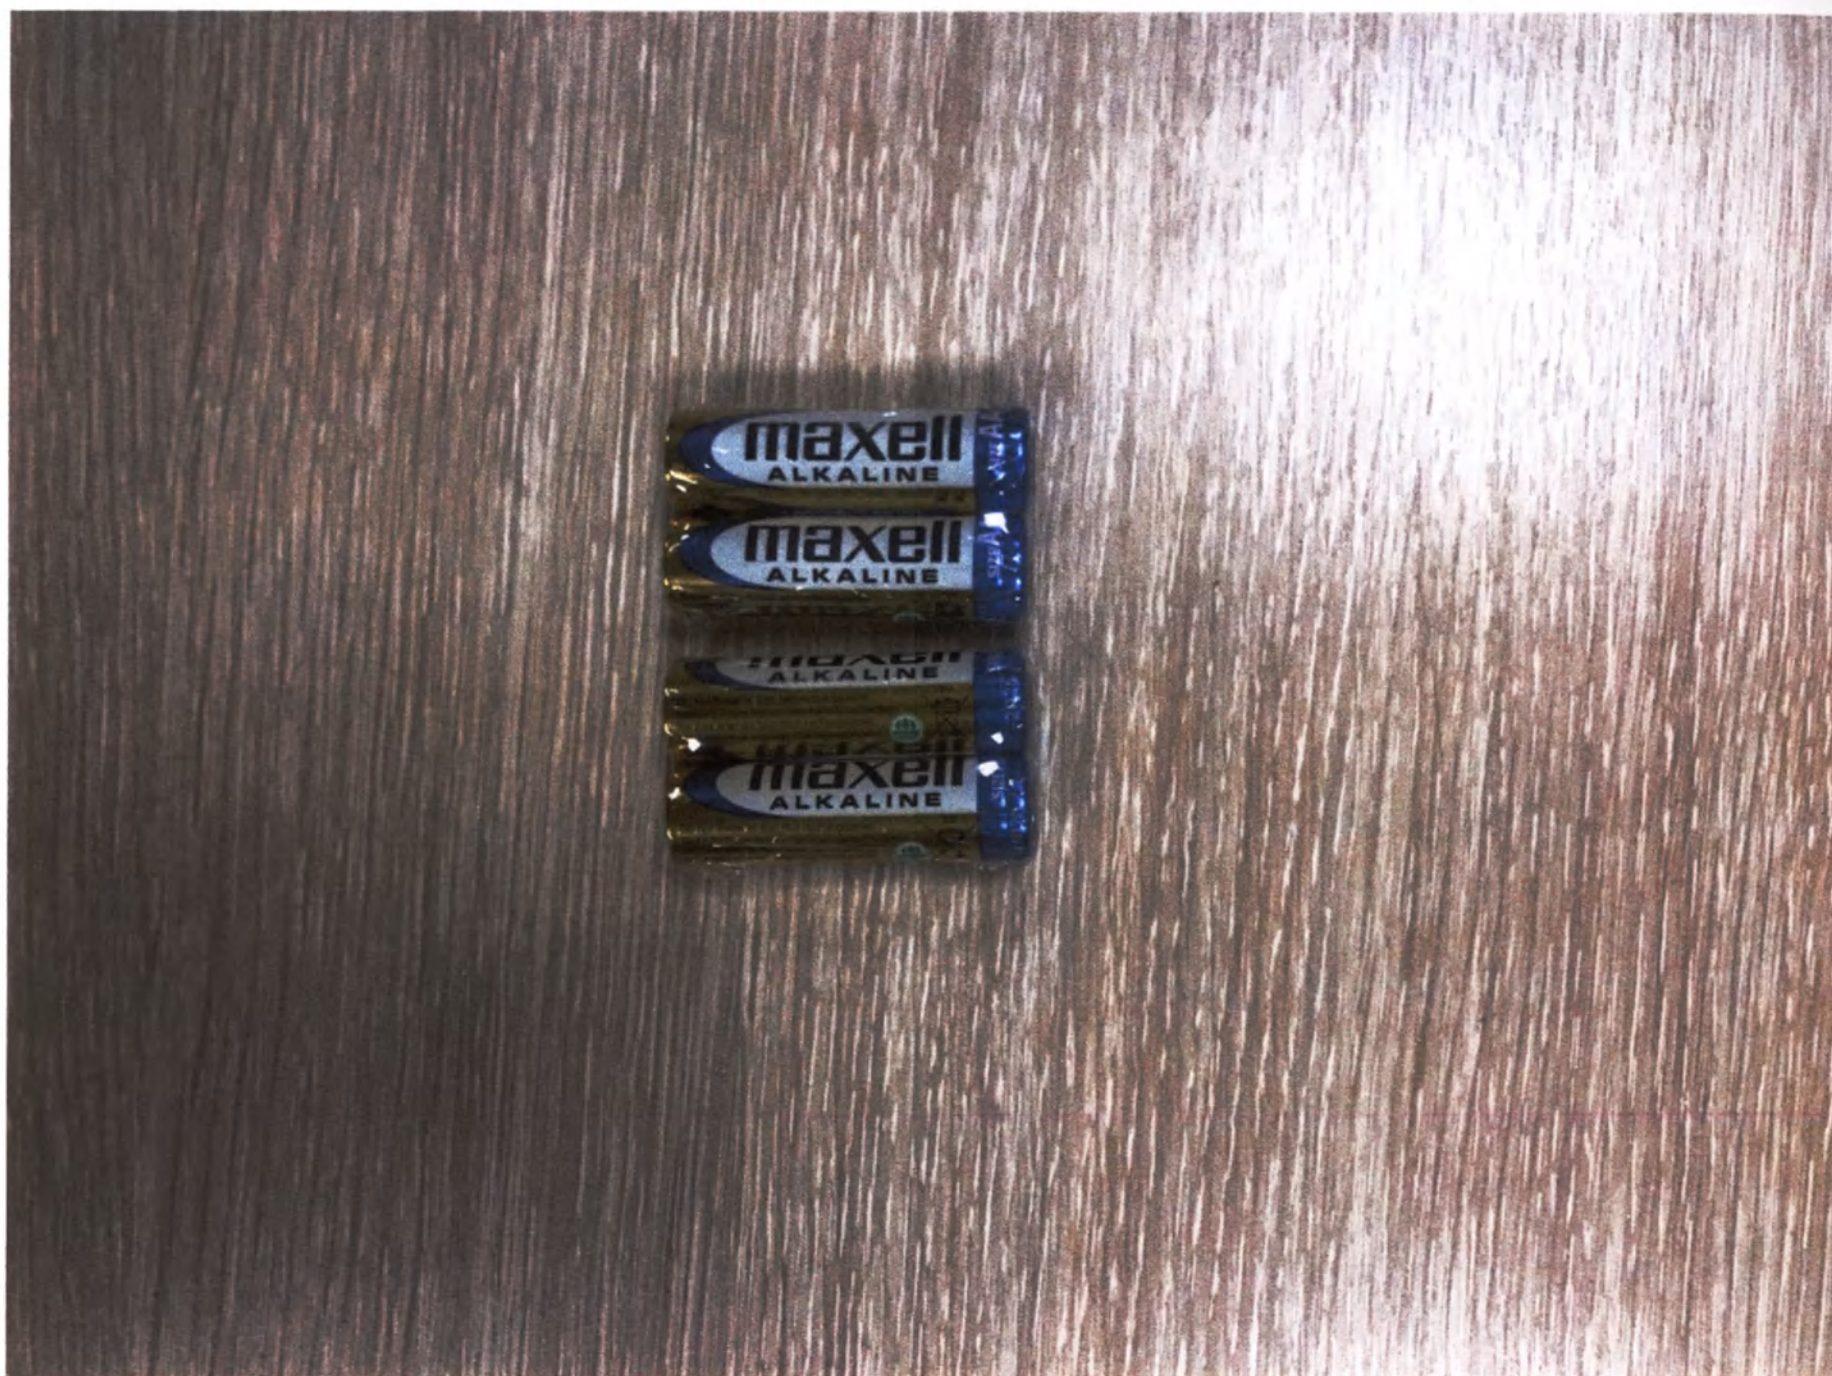

Блок питания постоянного тока (сетевой адаптер)







Watch BP home

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 101–109

Watch **GP** home.

For further information, contact:



Dispositivos que não Afiliados, não são necessários para a utilização dos produtos e serviços da Afiliada. A Afiliada não é responsável por danos materiais ou morais decorrentes do uso dos produtos e serviços da Afiliada. A Afiliada não é responsável por danos materiais ou morais decorrentes do uso dos produtos e serviços da Afiliada.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



1. Polipromer sadrži grupu reaktivnu funkcionalnu grupu (RFG) koja reagira s reaktivnom funkcionalnom grupom (RFG) monomera.



Abstract



• **“The most important thing is to be a good person.”**



background information. The authors
specify that the data are from a
survey of 1,000 U.S. adults.

100

microLife



● (C) 2004 ●

WatchBP home.

These results suggest that the use of a single, standardized, and validated instrument to assess the prevalence of mental health problems in the community is a feasible and reliable method for conducting such research.



Background: We studied patients
with
ischemic stroke who were
admitted to the hospital within
48 hours of onset.



Efficiency of the process

microfita

microfita

Watch BP home

Точный доплериметрический мониторинг артериального давления с функцией выявления мерцательной аритмии.



microlife

Keywords: family therapy; marital status; divorce; remarriage; stepfamily

Watch 8P home.

3. SCHEDULE
Monthly Budget Report
Quarterly Report
Year-end presentation to the board
Group report




13

[illegible]

microdialysis

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса Watch BP Office ABI, в составе:

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса

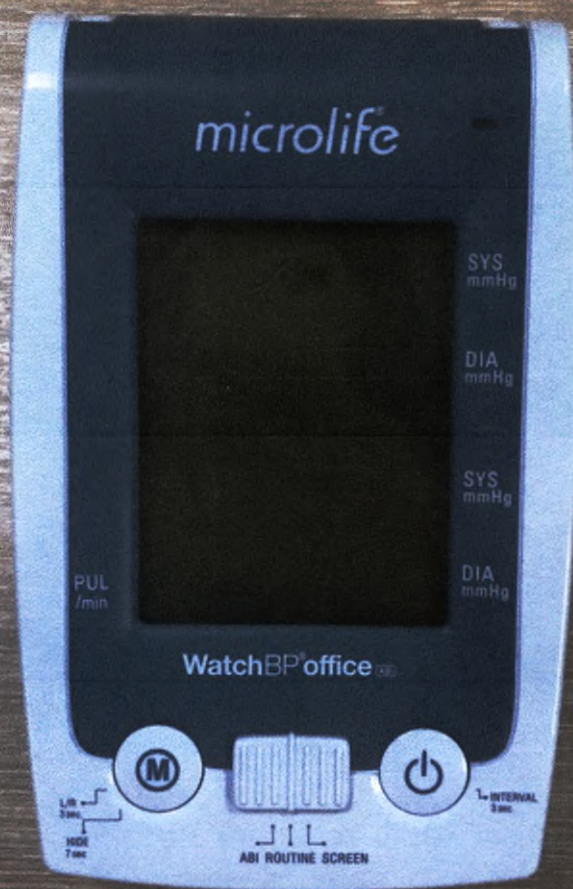



Манжета L – 1 шт., Трубка соединительная



Манжета на лодыжку М, Трубка соединительная



Кабель USB для подключения к компьютеру – 1 шт.



Аккумуляторная батарея – 1 шт.




Download our new
WatchBP
E-Catalogue

www.microlife.com/catalogue-watchbp






17. Коробка упаковочная картонная— 1 шт.

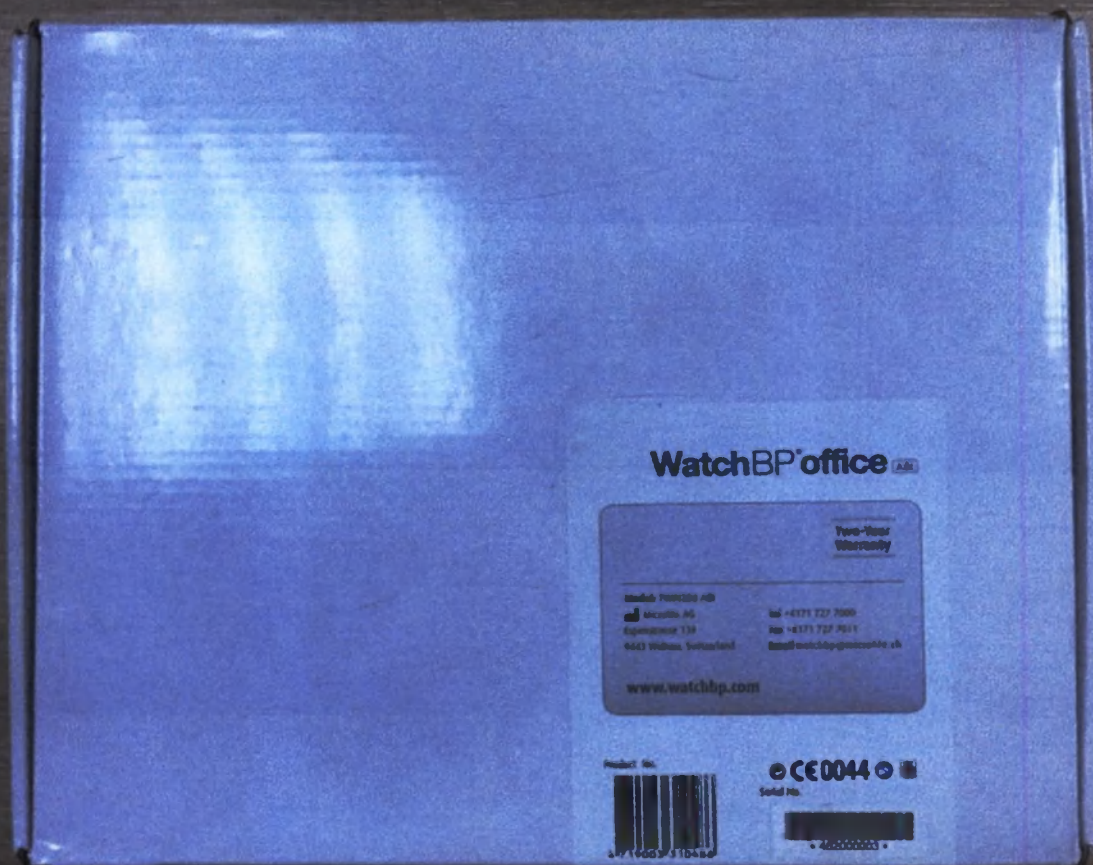


Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса Watch BP O3

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса



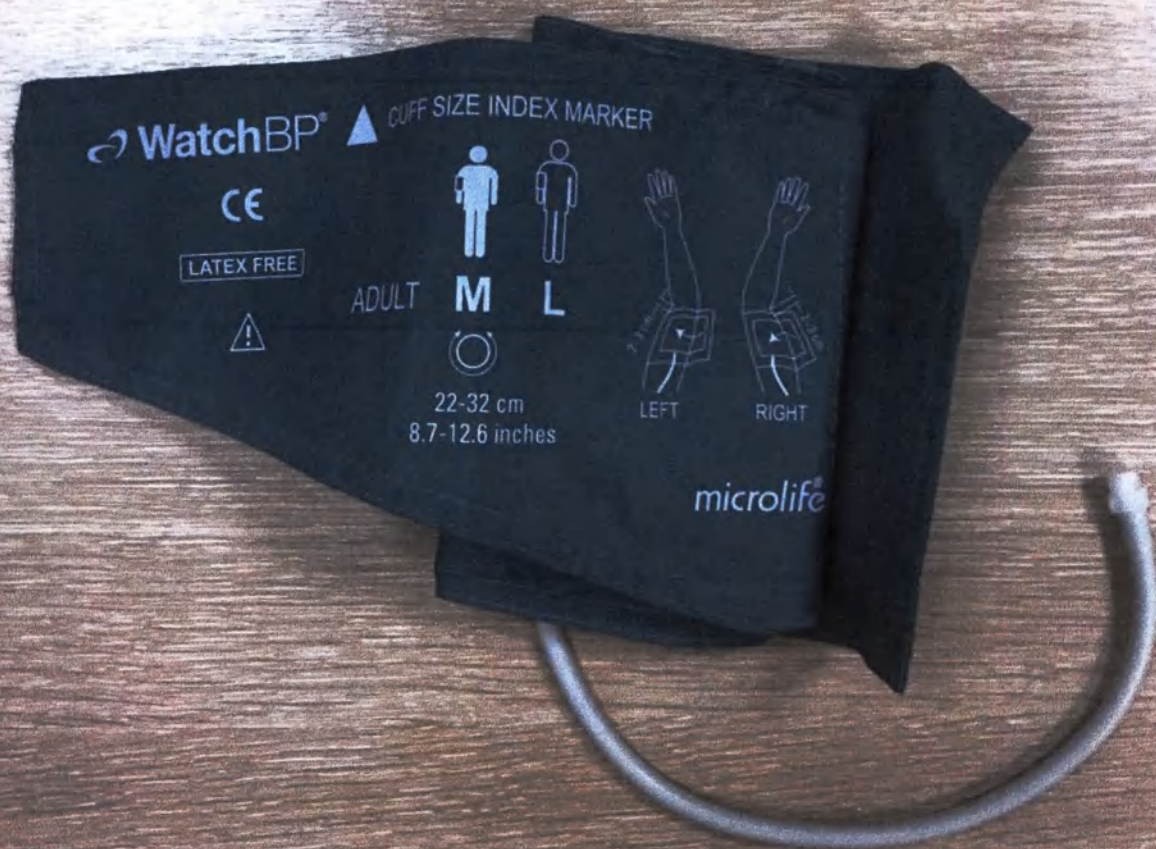

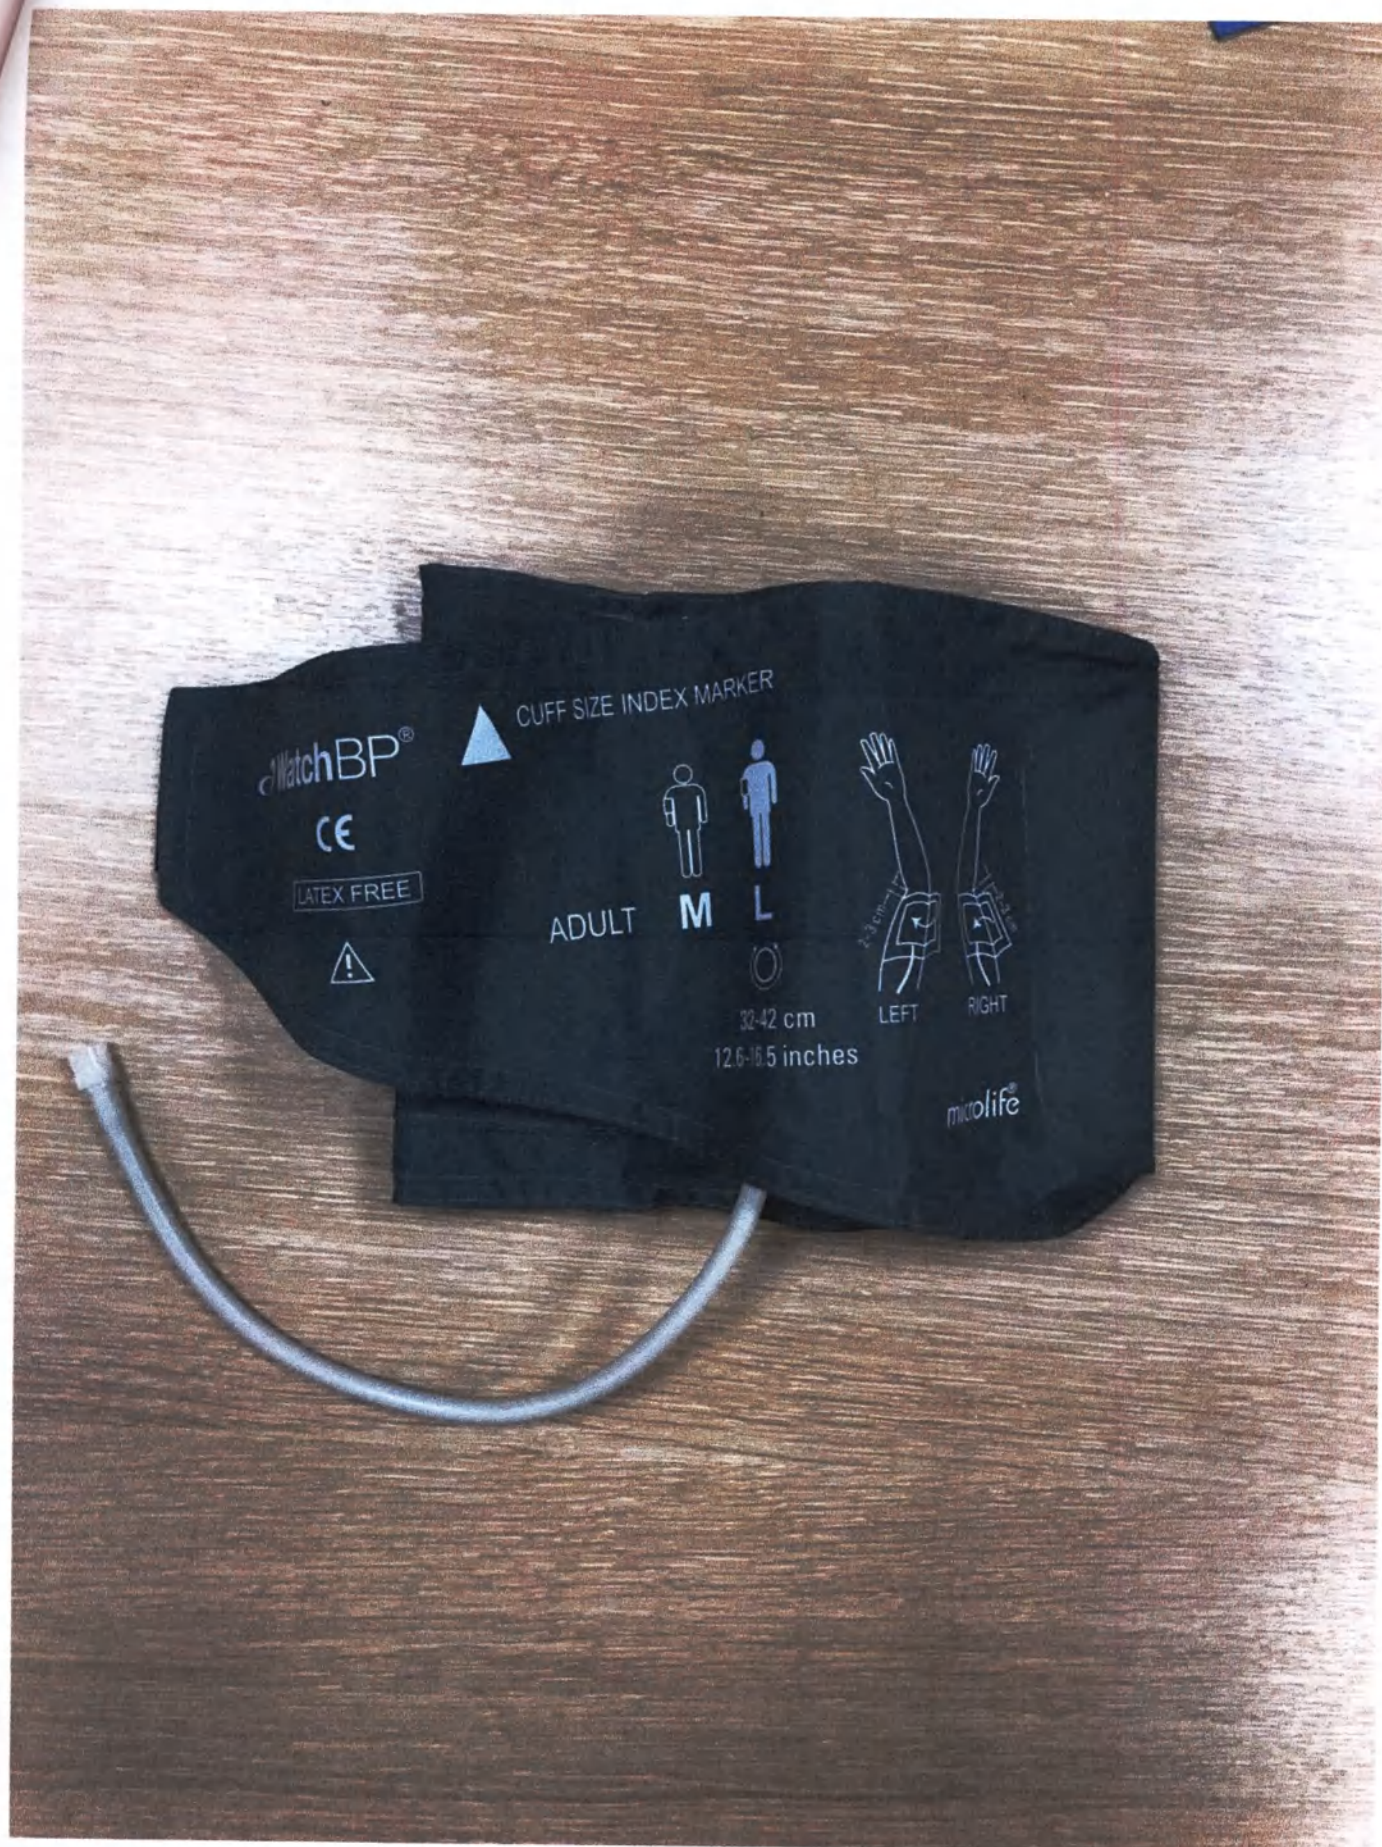

Держатель для трубки-4 шт.



Кабель USB для подключения к компьютеру – 1 шт.



Download our new
WatchBP
E-Catalogue

www.microlife.com/catalogue-watchbp



элементы питания типа ААА – 4 шт.



умка-чехол для хранения – 1 шт.



microlife

WatchEP 03

System Requirements for Software:
1GHz CPU, 128MB Memory, 4.5GB free hard disk space, Microsoft Windows 7 SP1 / 8 / 10

Advanced
APR
Control

2 year
warranty

Product No. 890221-1

Barcode 1 90221 117347

Barcode 4 52000004

CE 0044

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на 27

сем листах

