ПОЛИГЕМ

СДЕЛАНО В РОССИИ

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»

_____ Г.В. Урсу
«__» _____ 2022 г.
М.П.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

**МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Система транспортная со средой Эймса**

**по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

**г. Дубна, 2022**

1.1. «Система транспортная R00070 со средой Эймса жидкой, материал тампона нейлон».

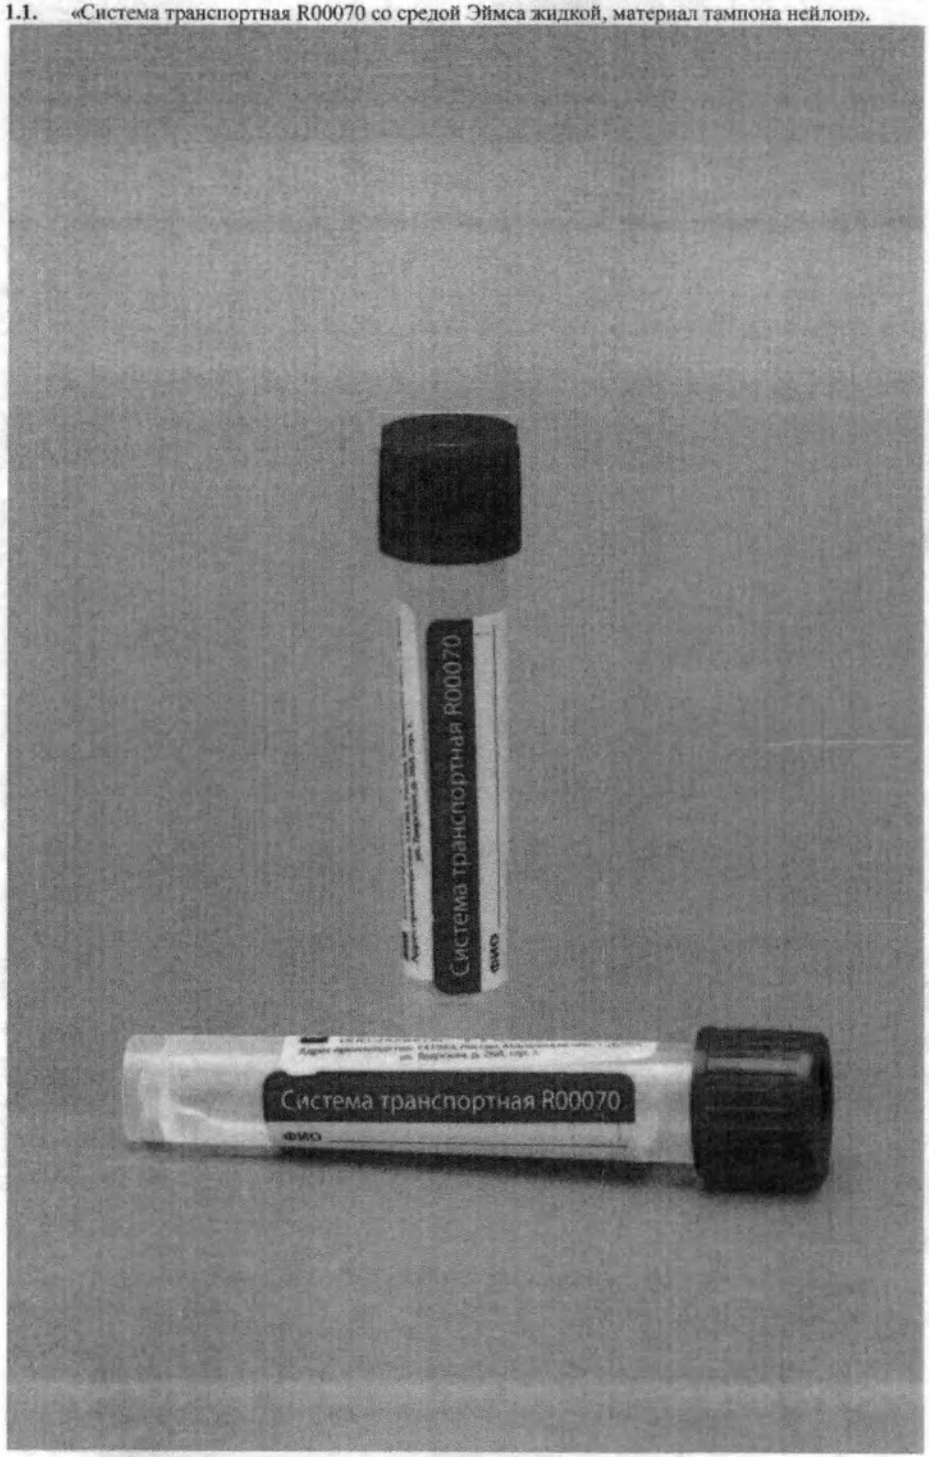


ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

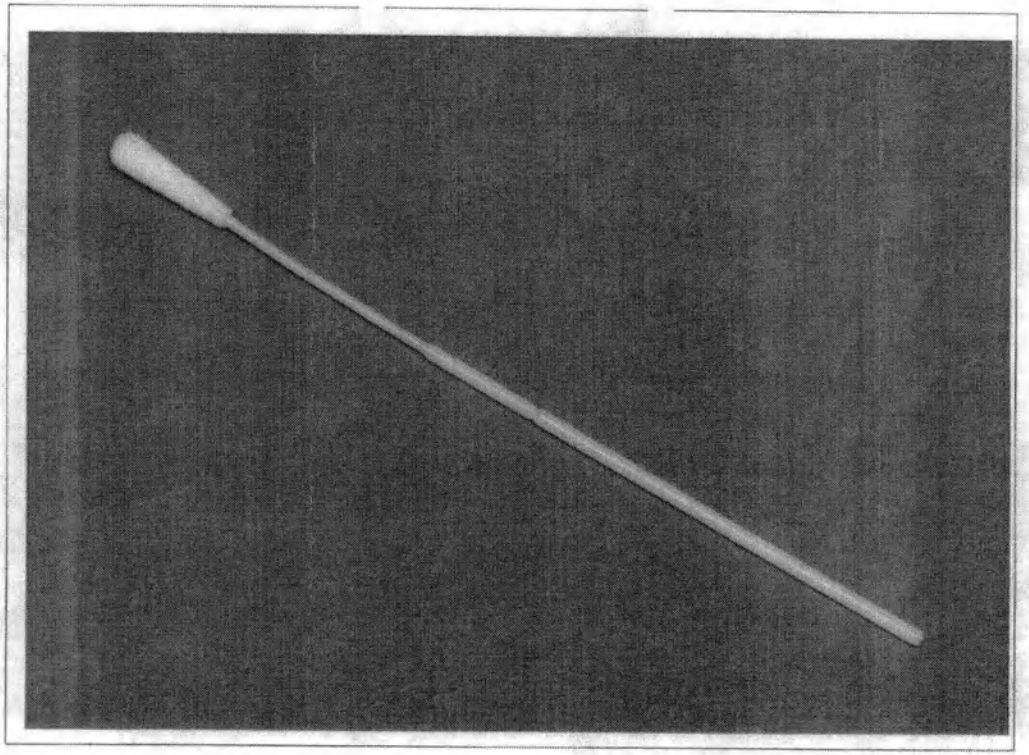

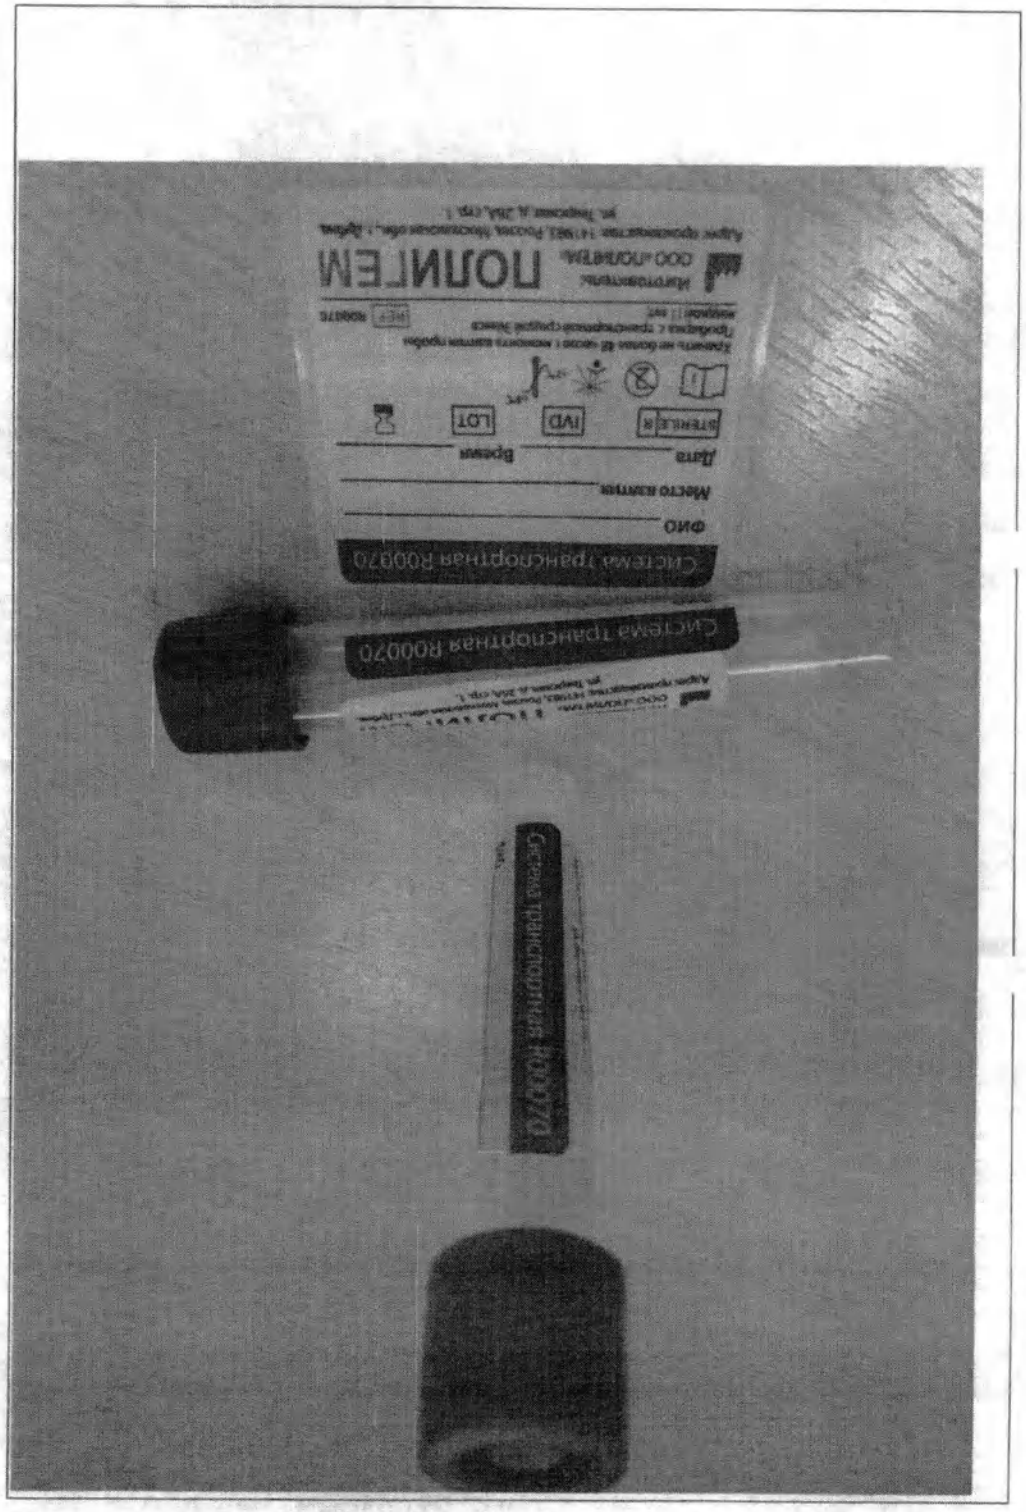


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

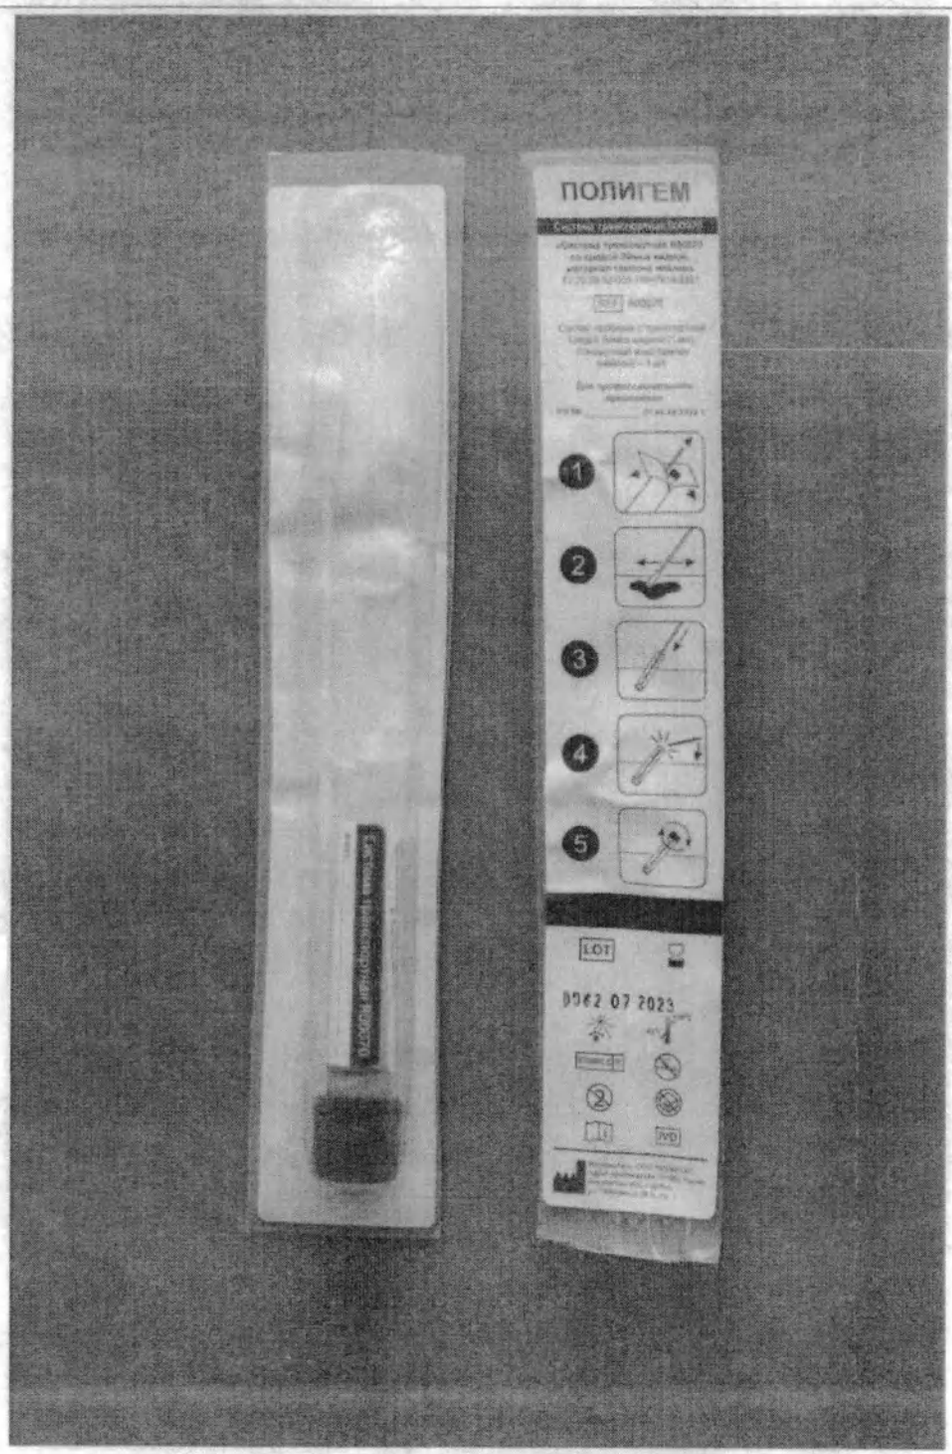


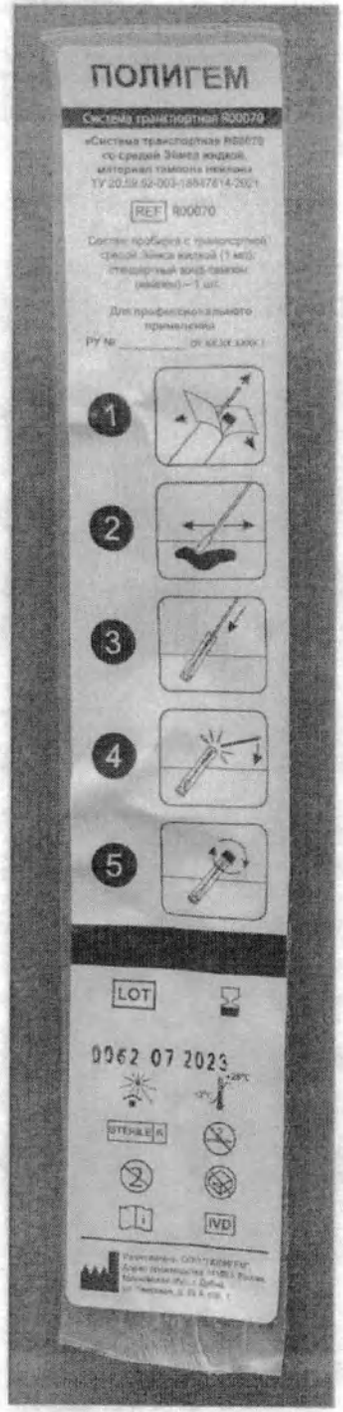

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА НЕЙЛОН»
ТУ 20.59.52-003-16847814-2021

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно- анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

**Способ применения:**




ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

РУ № _____ от хх.хх.хххх г.

**Состав изделия:**
Пробирка с транспортной средой Эймса, жидкой (1 мл); стандартный зонд-тампон (нейлон) – 1 шт.

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):**
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**Состав изделия в потребительской упаковке:** 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости*).
*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

**Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

ПОЛИГЕМ

1.2. «Система транспортная R00071 со средой Эймса жидкой, материал тампона вискоза».

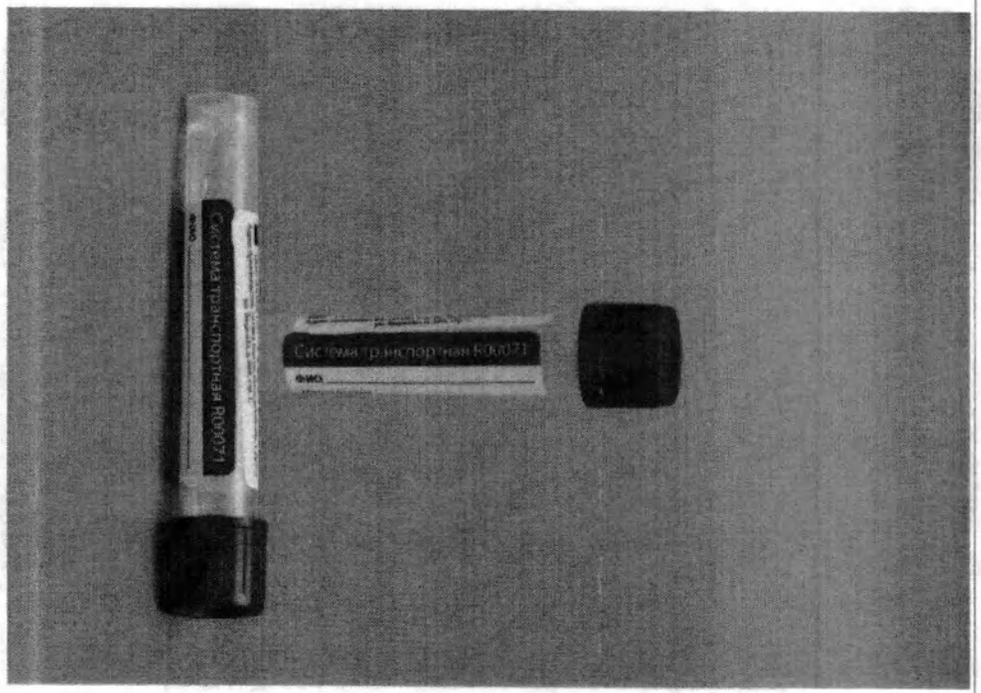


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

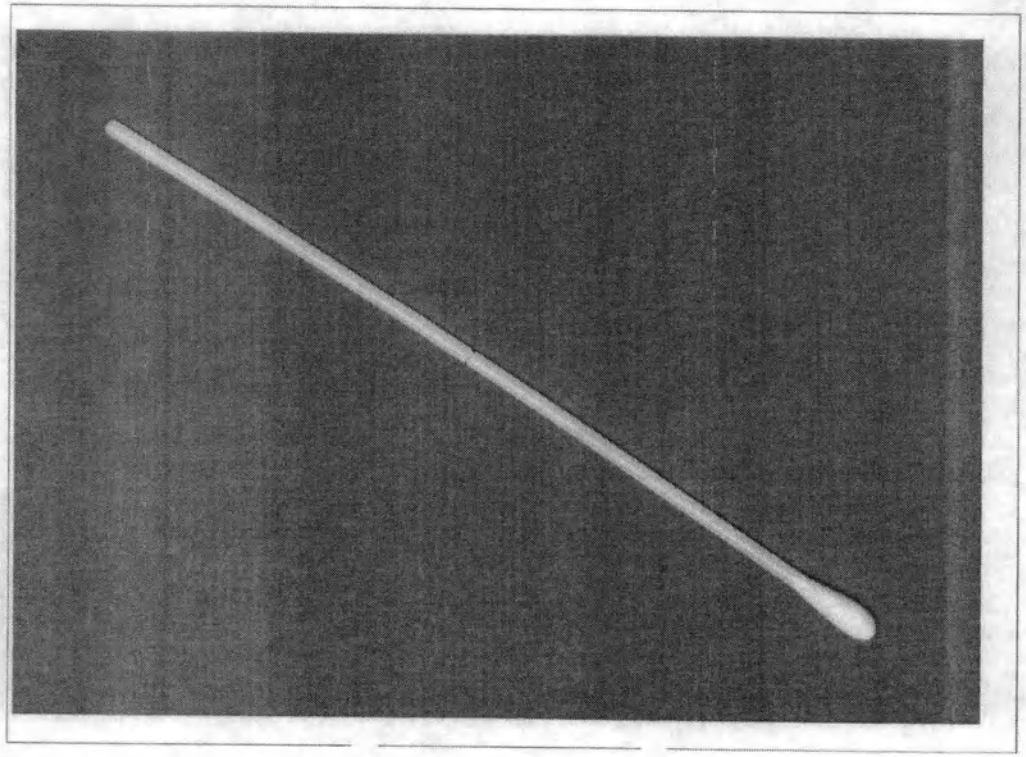

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

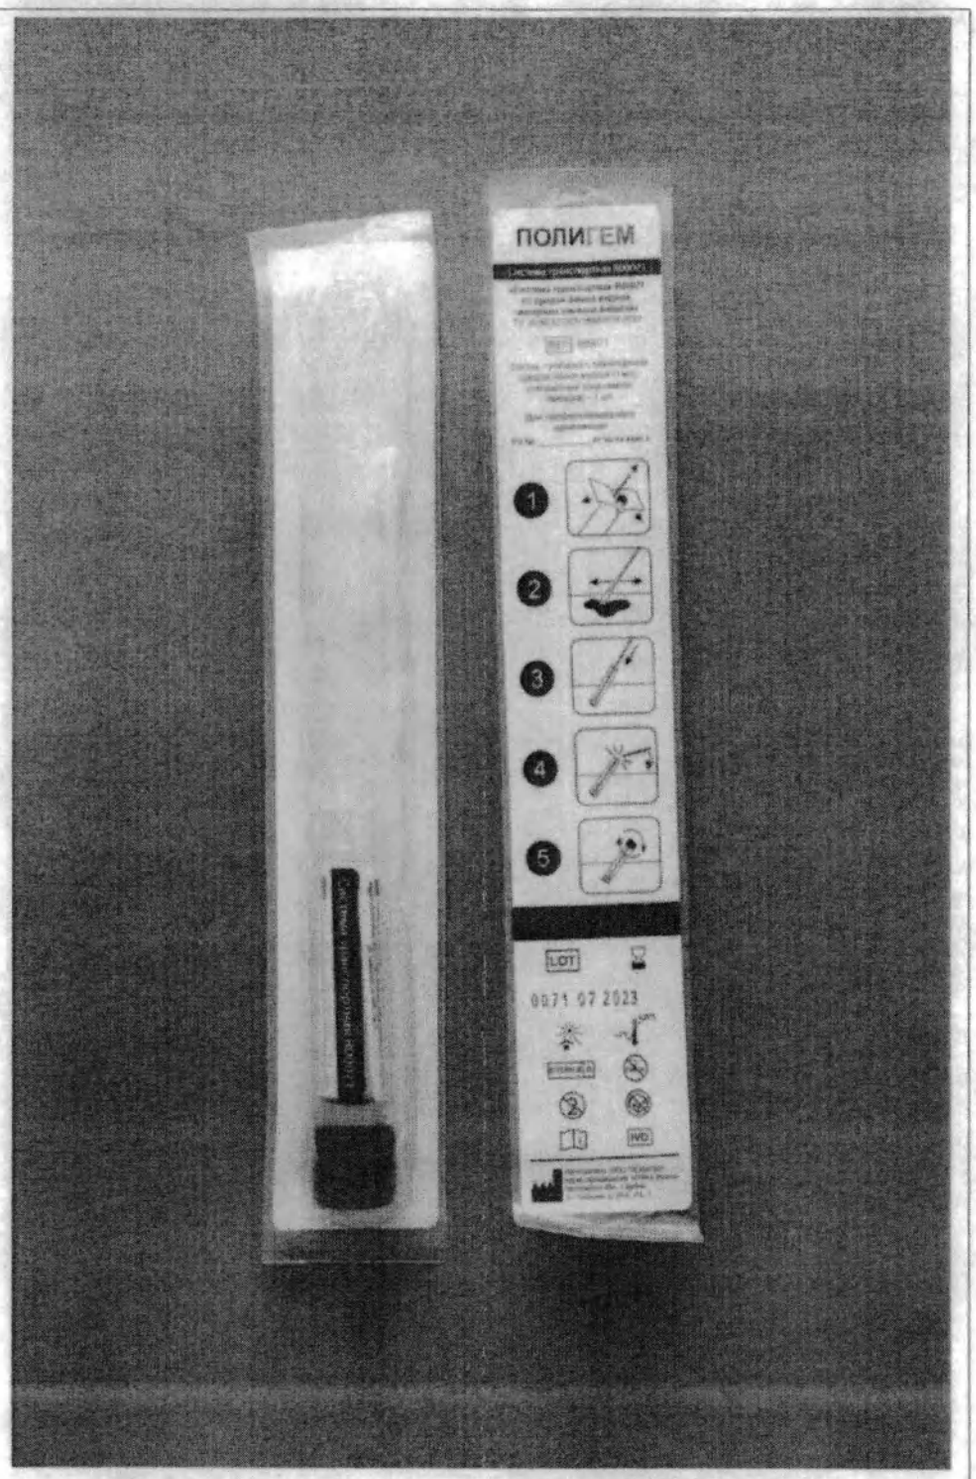


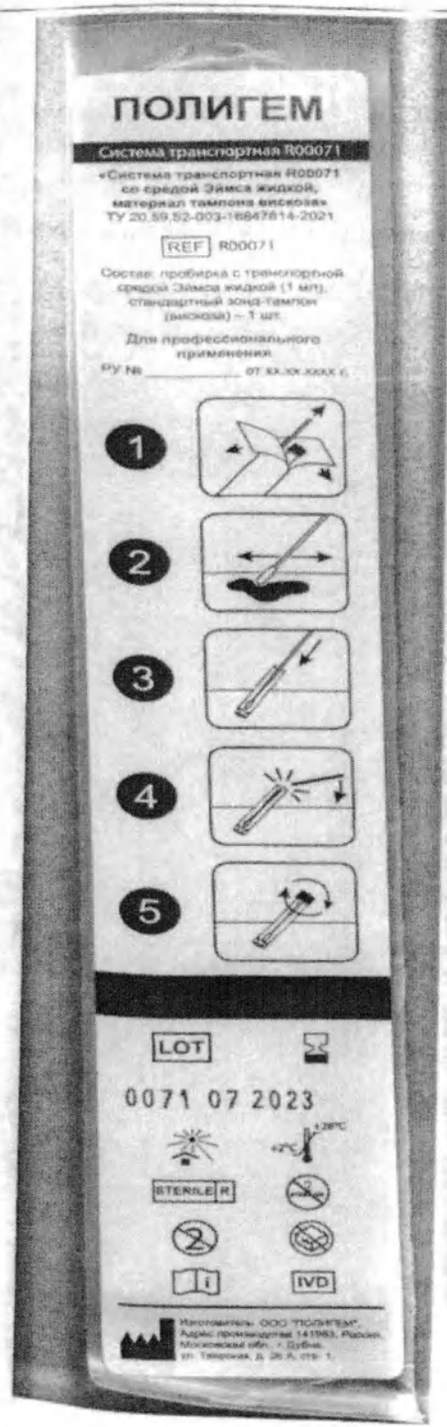

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно- анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

**Способ применения:**

1 2 3 4 5

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

**РУ № _____ от хх.хх.хххх г.**

**Состав изделия:**
Пробирка с транспортной Эймса, жидкой (1 мл); стандартный конд-тампон (вискоза) – 1 шт.

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):**
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**Состав изделия в потребительской упаковке:** 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости*).
*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

**Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.**

LOT STERILE R IVD

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

**ПОЛИГЕМ**

**1.3.** «Система транспортная R00076 со средой Эймса агаризованной, материал тампона вискоза».

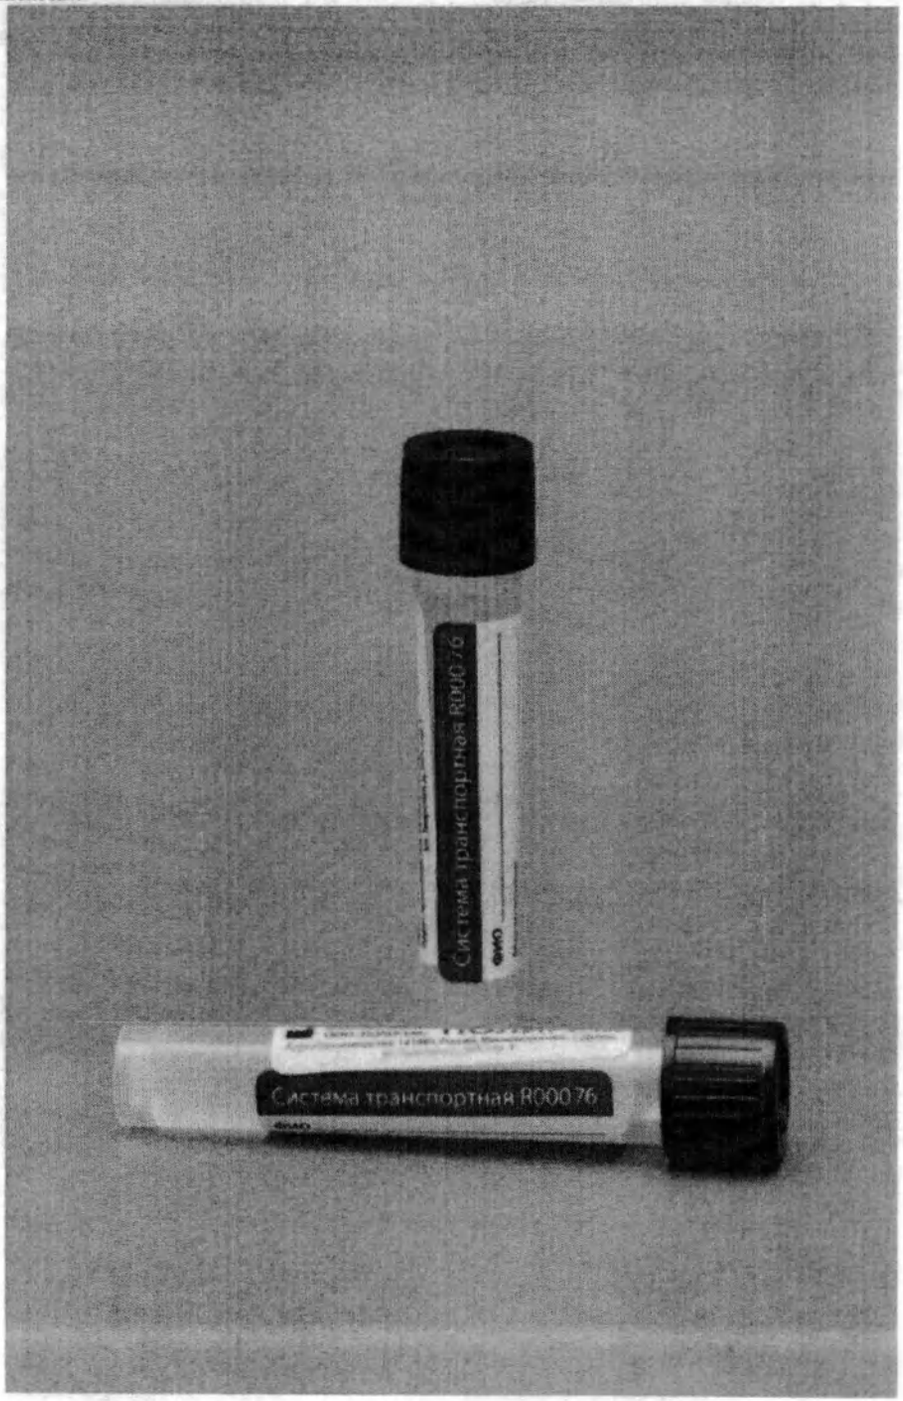


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

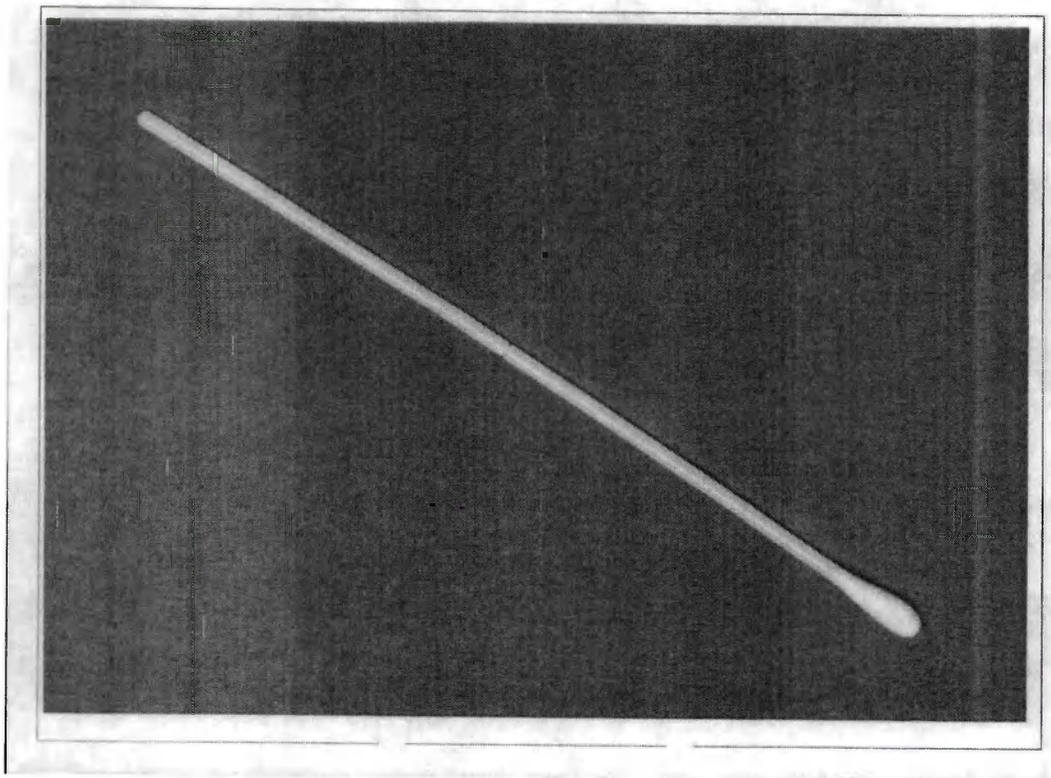

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

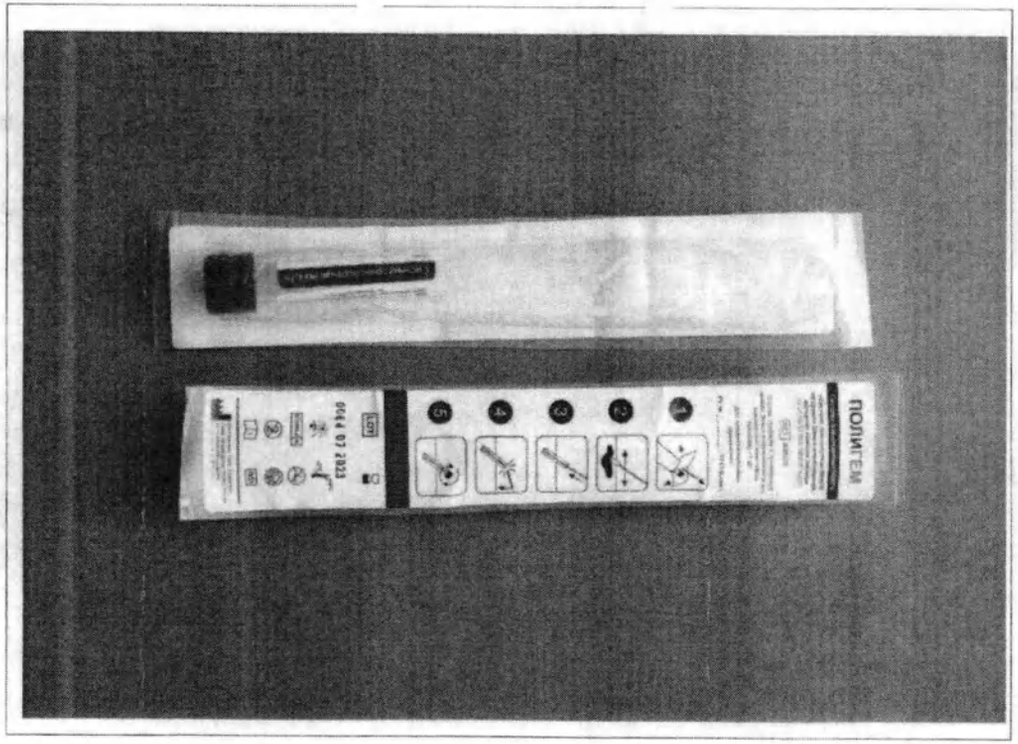


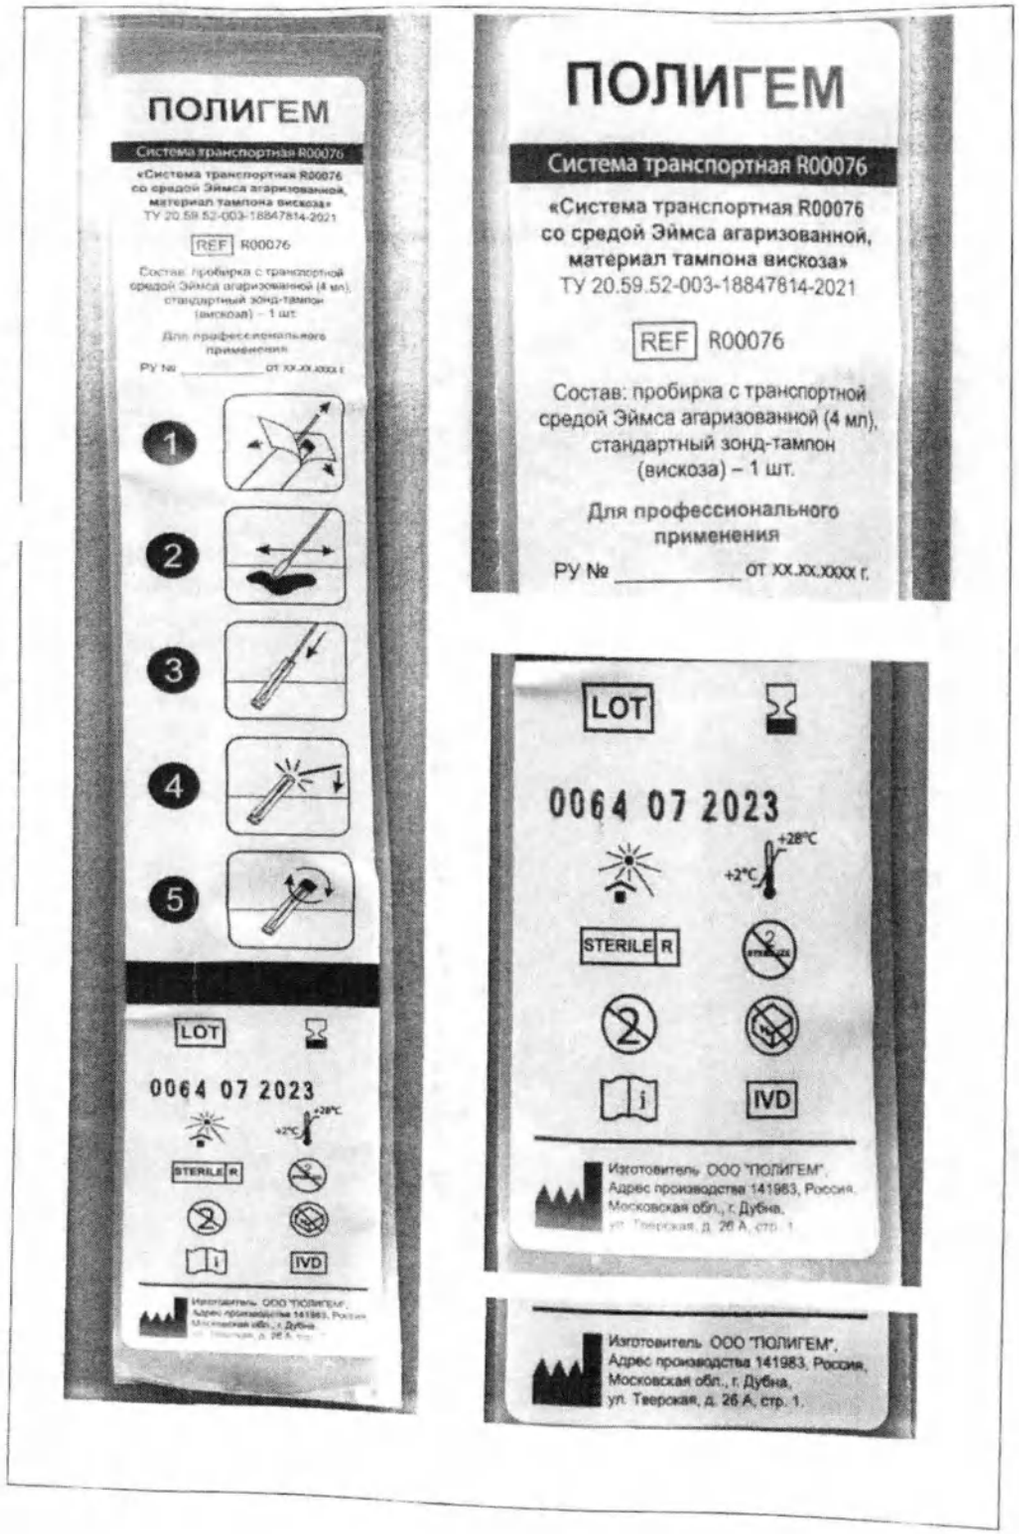


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00076
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00076 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА АГАРИЗОВАННОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно- анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

**Способ применения:**

1 2 3 4 5

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

**РУ № _____ от xx.xx.xxxx г.**

**Состав изделия:**
Пробирка с транспортной средой Эймса, агаризованной (4 мл); стандартный зонд-тампон (вискоза) – 1 шт.

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):**
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**Состав изделия в потребительской упаковке:** 40 шт, адвенц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости*).
*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

**Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.**

LOT STERILE IVD

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 28 А, стр. 1

**ПОЛИГЕМ**

**1.4.** Эймса агаризованной с углём, материал тампона вискоза».

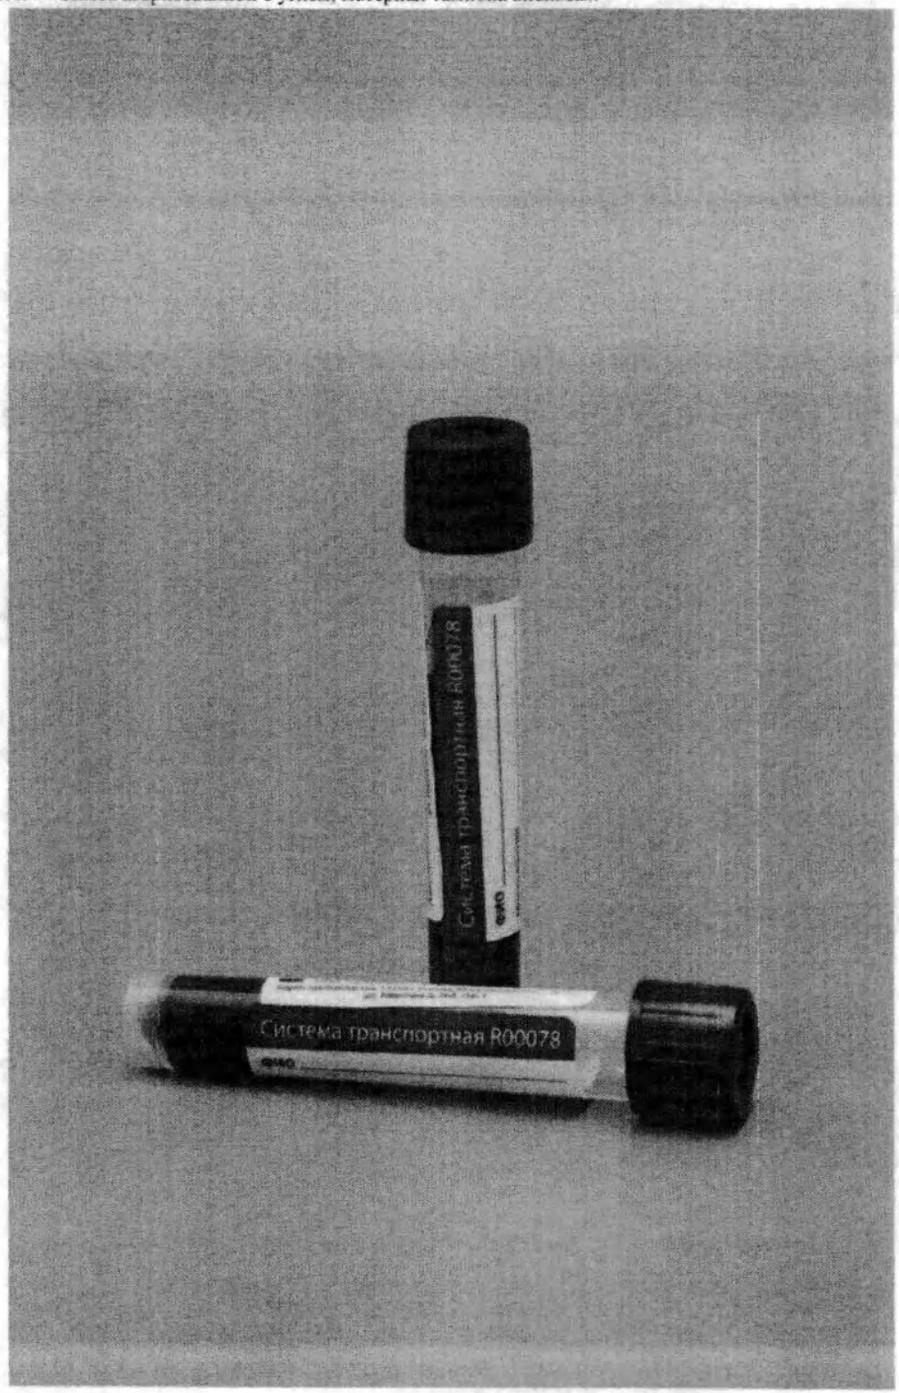


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

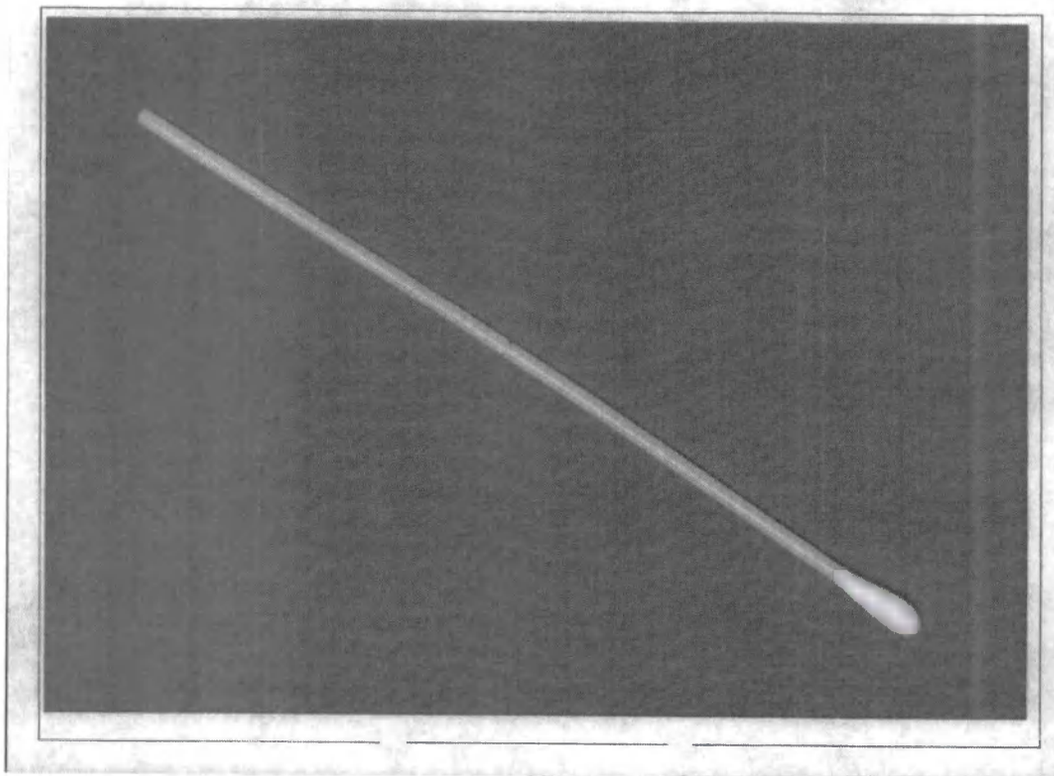

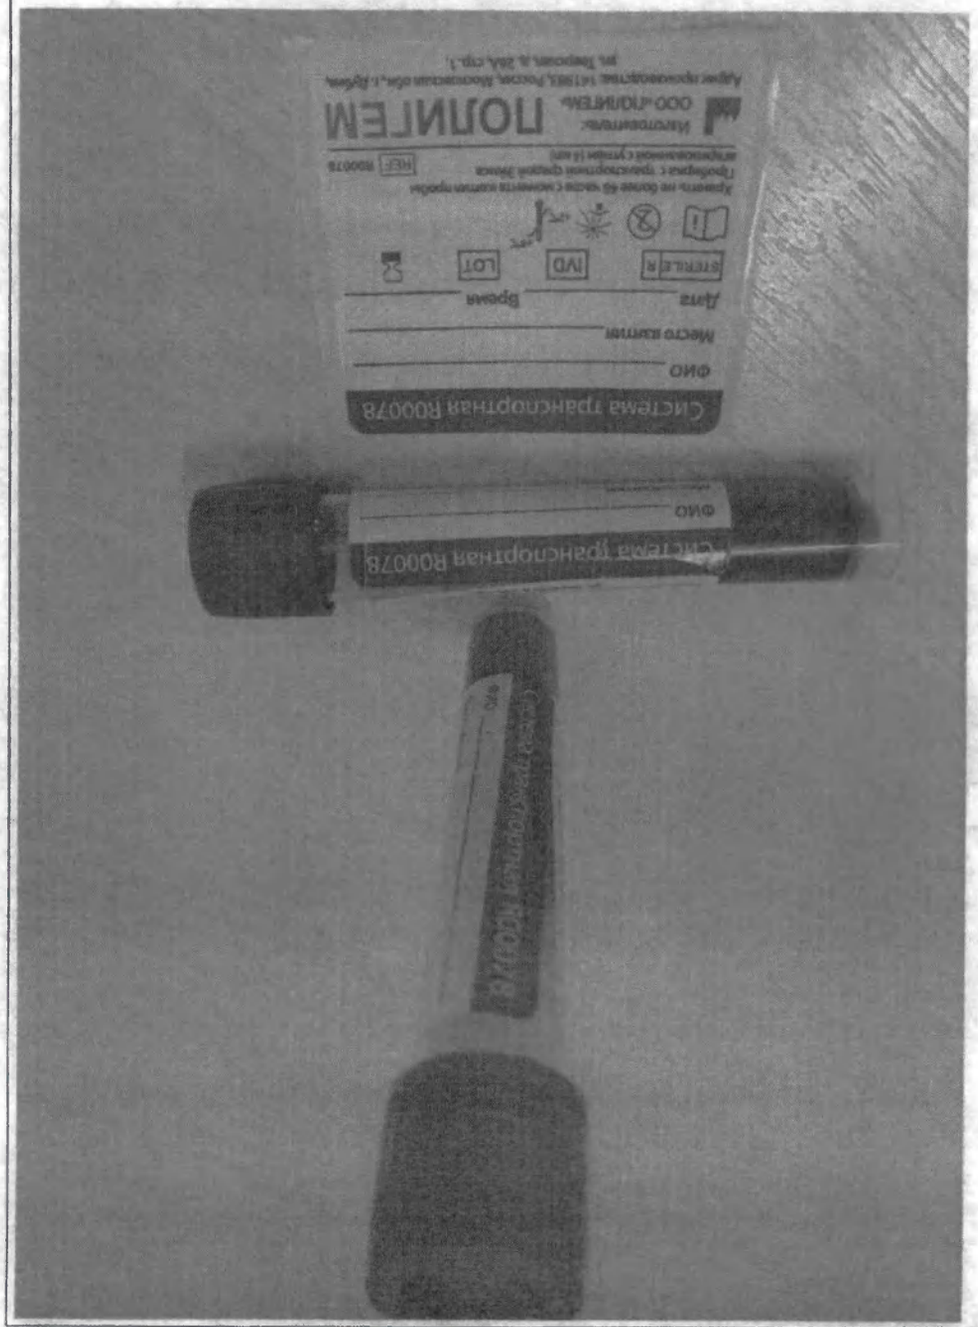


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

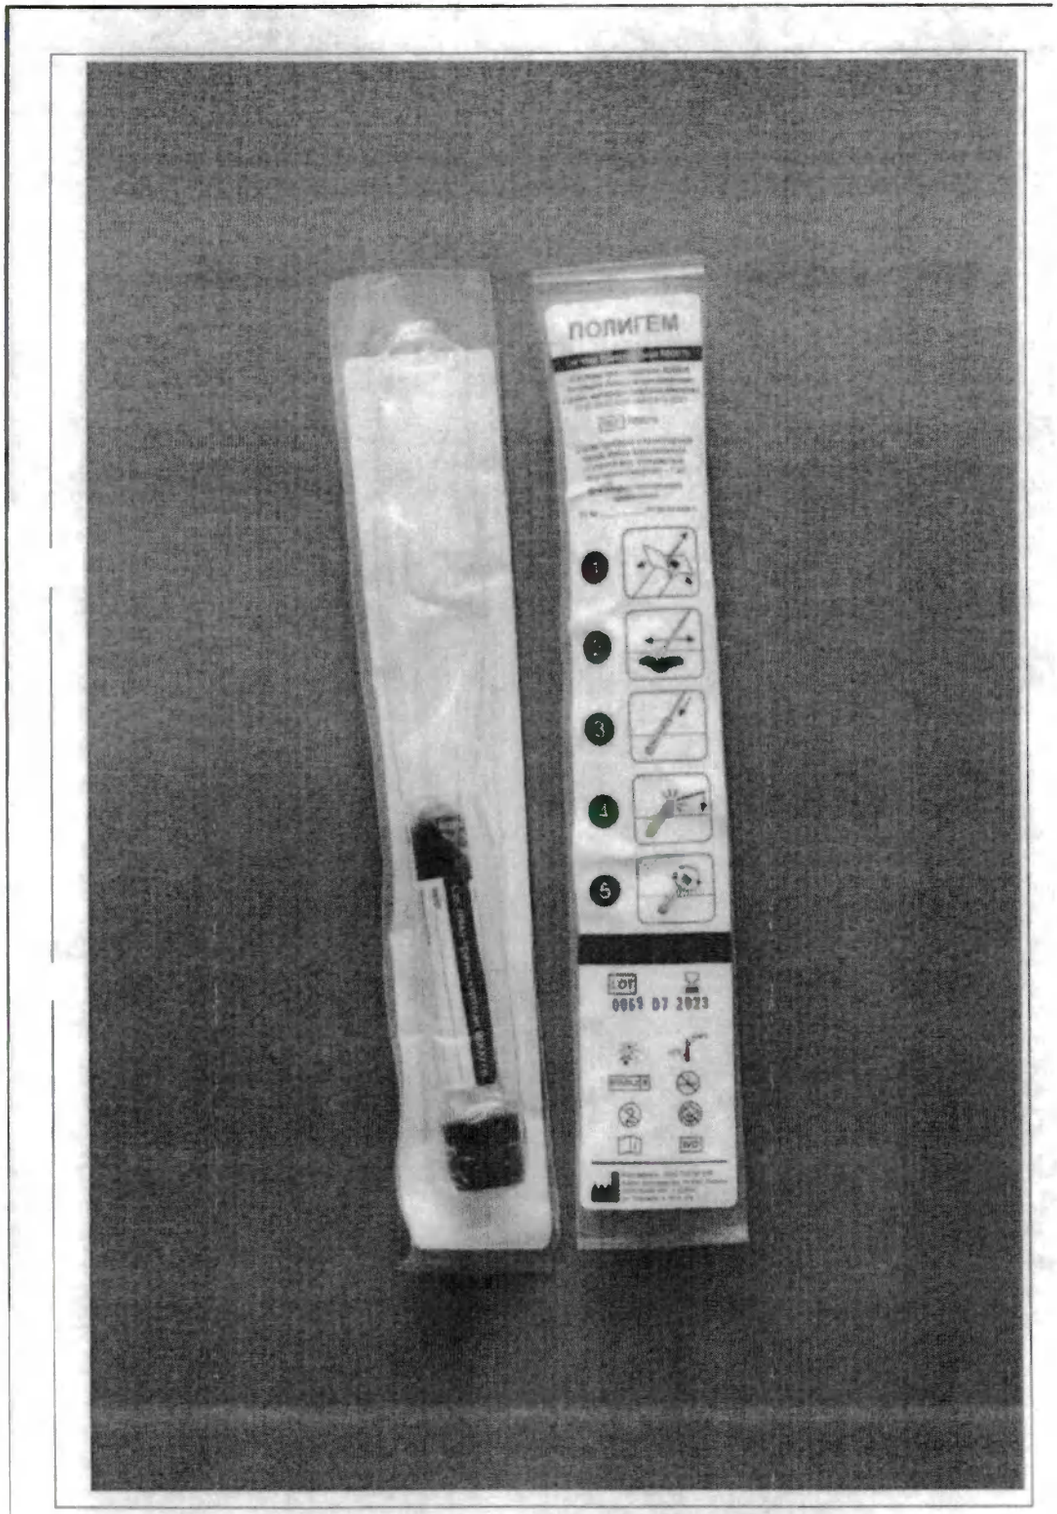


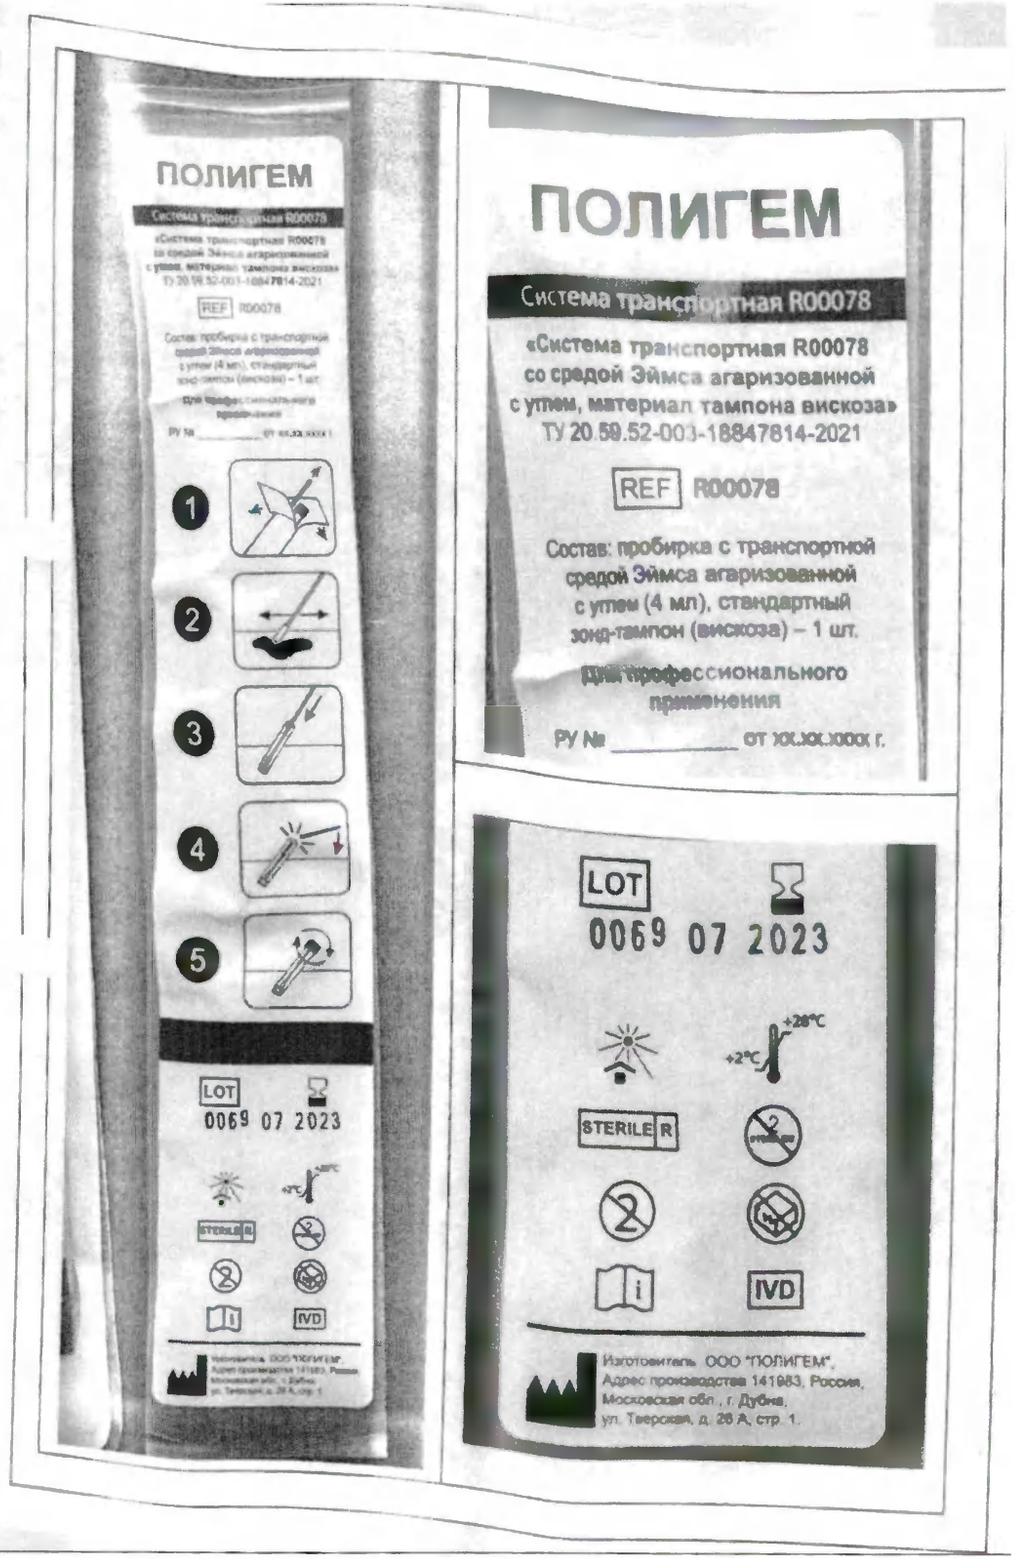


ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078 СО СРЕДНЕЙ ЗИМСА АРМИРОВАННОЙ С УГЛЕМ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Назначение: предназначено для отбора, транспортировки и хранения отпечатков ран, ран, отпечатков оболочек роговой полости и зева, полости носа, носоглотки, церебральной жидкости, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно- анаэробные, двухэтапно-анаэробные и прихотливые бактерии, дрожжеподобные изменения • естественное средство гигиены и диагностика инфицированных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

**Способ применения:**

1 2 3 4 5

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

**РУ №** _____ **от XX.XX.XXXX г.**

**Состав изделия:**
Пробирка с транспортной средой Эймса, армированной с углем (4 мл); стандартный зонд-тампон (вискоза) – 1 шт.

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биотермоза):**
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, разделительной ленты, солнечного света, огня, кислородсодержащих дезинфицирующих растворов и транспортировке изделия – см. в инструкции по применению.

**Состав изделия в потребительской упаковке:** 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости), возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

**Срок годности (не ттт) – см. на упаковке.**

LOT

Изготовитель: ООО «ПОЛИТЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

ПОЛИТЕМ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

# ПОЛИГЕМ

СДЕЛАНО В РОССИИ

РАЗРАБОТАНО
Генеральный директор
ООО «Полипак»

_____ Н.В. Жомова
«__» _____ 2022 г.
МП

УТВЕРЖДАЮ
ВРИО Генерального директора
ООО «ПОЛИГЕМ»

_____ Н.В. Урсу
«__» _____ 2022 г.
МП

**ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ**

**МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИ**

**Система транспортная со средой Эймса**

**по ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

**г. Дубна, 2022**

## 1. Маркировка этикетки пробирки со средой

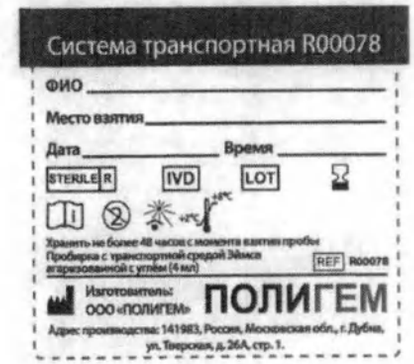




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 2. Маркировка инд идуальной (блистерной) упаковк едицинского изделия






## 2. Маркировка индивидуа ой (блистерной) упаковки медиц ского изделия (продолжение)






ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

**2. Маркировка индивидуа ой (блистерной) упаковки медиц ского изделия (продолжение)**




5

**2. Маркировка индивидуал ой (блистерной) упаковки медиц кого изделия (продолжение)**




6

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 3. Маркировка потребительской упаковки медицинского изделия

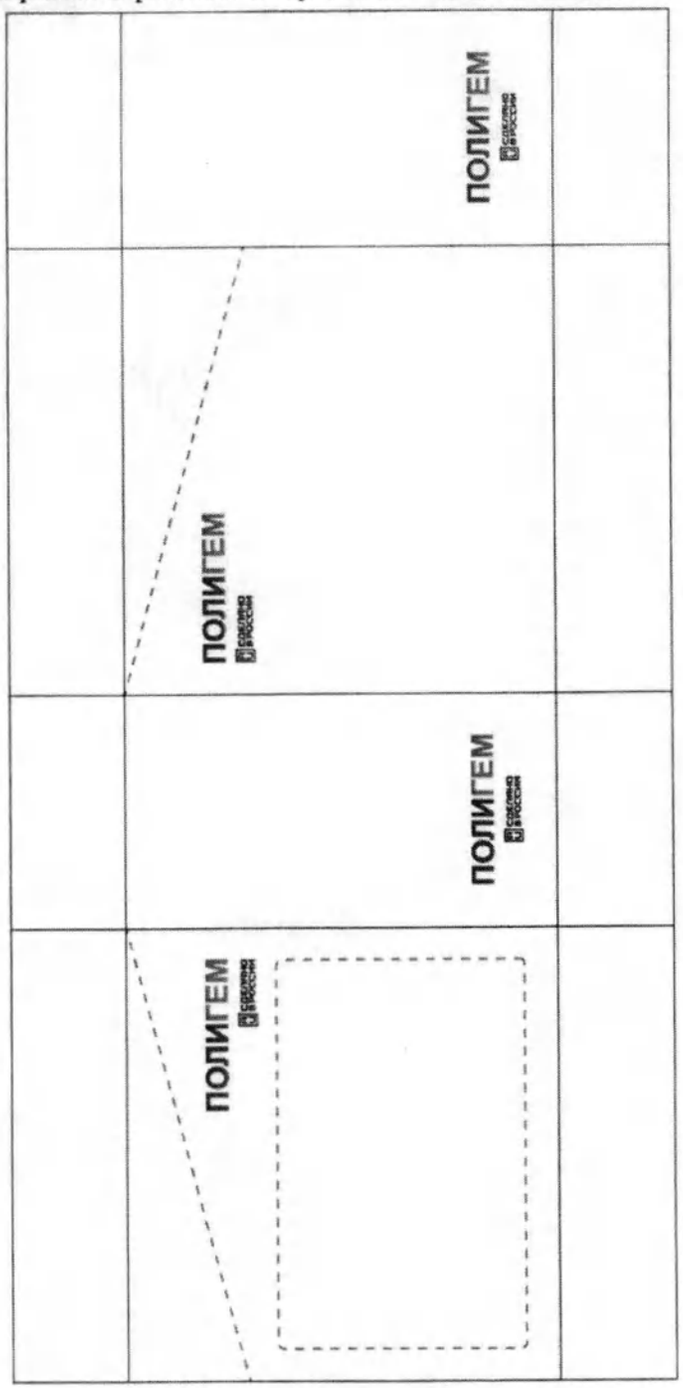




СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА НЕЙЛОН»
**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно- анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

**Способ применения:**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

**РУ № _____ от xx.xx.xxxx г.**

**Состав изделия:**
Пробирка с транспортной средой Эймса, жидкой (1 мл); стандартный зонд-тампон (нейлон) – 1 шт.

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):**
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**Состав изделия в потребительской упаковке:** 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости*).
*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

**Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

**ПОЛИГЕМ**

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071
«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА ЖИДКОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»
**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно- анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

**Способ применения:**




ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

**РУ № _____ от xx.xx.xxxx г.**

**Состав изделия:**
Пробирка с транспортной Эймса, жидкой (1 мл); стандартный зонд-тампон (вискоза) – 1 шт.

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):**
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**Состав изделия в потребительской упаковке:** 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости*).
*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

**Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

**ПОЛИГЕМ**



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078

**«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА АГАРИЗОВАННОЙ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»**

**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно- анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

**Способ применения:**



ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

**РУ № _____ от хх.хх.хххх г.**

**Состав изделия:**
Пробирка с транспортной средой Эймса, агаризованной (4 мл); стандартный зонд-тампон (вискоза) – 1 шт.

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):**
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**Состав изделия в потребительской упаковке:** 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости*).
*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

**Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

**ПОЛИГЕМ**

СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078

**«СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078 СО СРЕДОЙ ЭЙМСА АГАРИЗОВАННОЙ С УГЛЁМ, МАТЕРИАЛ ТАМПОНА ВИСКОЗА»**

**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изделие предназначено для отбора, транспортировки и хранения отделяемых ран, уха, слизистых оболочек ротовой полости и зева, полости носа, носоглотки, цервикального канала, влагалища, наружных половых органов, кожи и подкожной ткани, потенциально содержащих аэробные, облигатно- анаэробные, факультативно-анаэробные и прихотливые бактерии. Функциональное назначение - вспомогательное средство в диагностике инфекционных заболеваний. Более подробную информацию об изделии – см. в инструкции по применению.

**Способ применения:**

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

**РУ № _____ от хх.хх.хххх г.**

**Состав изделия:**
Пробирка с транспортной средой Эймса, агаризованной с углём (4 мл); стандартный зонд-тампон (вискоза) – 1 шт.

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):**
Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**Состав изделия в потребительской упаковке:** 40 шт. единиц изделия, инструкция по применению, паспорт на серию (при необходимости*).
*возможно получение в электронном виде по запросу от потребителя.

**Срок годности (мм гггг) – см. на упаковке.**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1

**ПОЛИГЕМ**



**4. Маркир[illegible] транспортной упаковки медици[illegible]кого изделия**

Фрагмент 1

| | |
|---|---|
| ПОЛИГЕМ | ПОЛИГЕМ |
| | |

Фрагмент 2

| | |
|---|---|
| ПОЛИГЕМ | ПОЛИГЕМ |
| | Фрагмент 3 |



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 1)

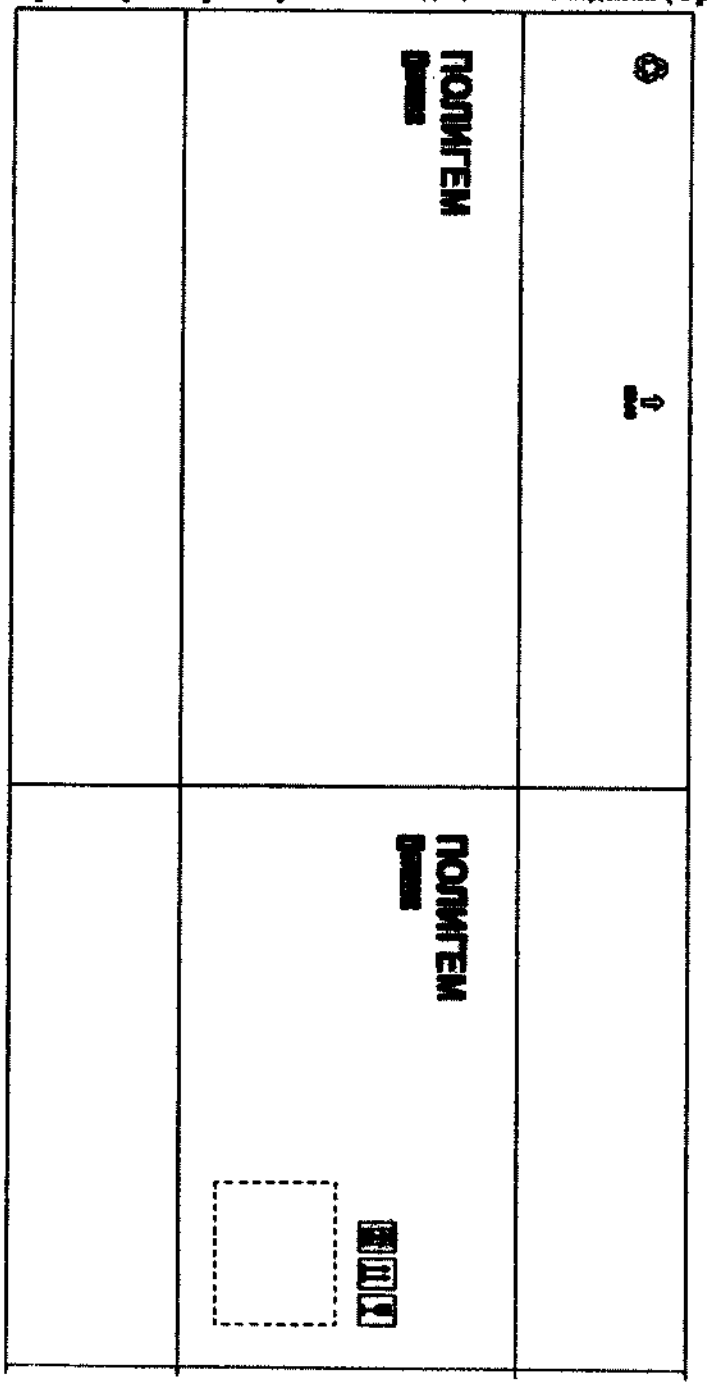




4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 2)

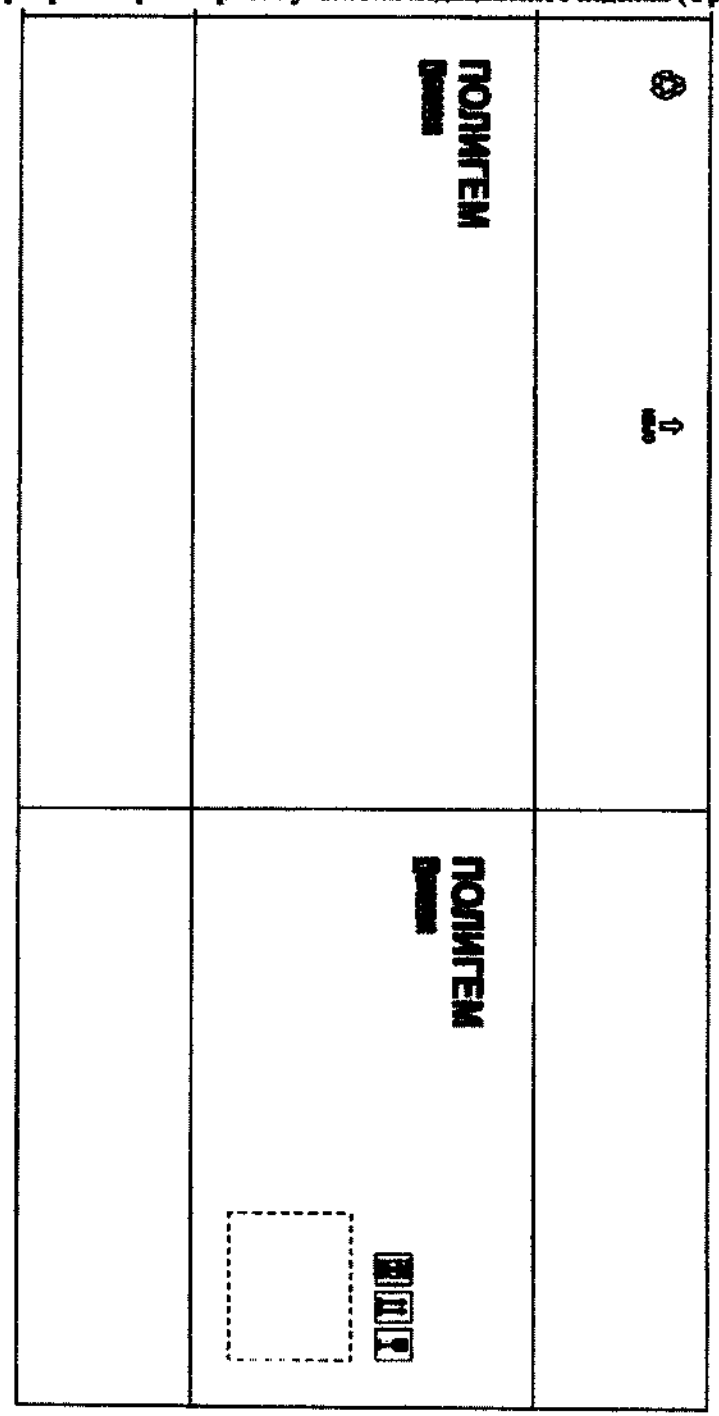




ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

## 4. Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия (Фрагмент 3)

**ПОЛИГЕМ**

СДЕЛАНО В РОССИИ

[Обозначение транспортной этикетки (расположение может отличаться)]



## 5. Маркировка этикетки транспортной упаковки медицинского изделия

**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00070**

**Система транспортная R00070 со средой Эймса жидкой, материал тампона нейлон**

**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

LOT

REF **R00070**

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):** Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**БРУТТО:** _____ кг
**НЕТТО:** _____ кг
**Кол-во:** 400 шт.
**НЕТТО потребительской упаковки:** _____ кг

STERILE R **Стерильно** IVD +28°C +2°C 70%

**СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00071**

**Система транспортная R00071 со средой Эймса жидкой, материал тампона вискоза**

**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл., г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

LOT

REF **R00071**

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):** Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**БРУТТО:** _____ кг
**НЕТТО:** _____ кг
**Кол-во:** 400 шт.
**НЕТТО потребительской упаковки:** _____ кг

STERILE R **Стерильно** IVD +28°C +2°C 70%



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

# СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00076

**Система транспортная R00076 со средой Эймса агаризованной, материал тампона вискоза**

**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

LOT

REF **R00076**

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):** Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**БРУТТО:** _____ кг
**НЕТТО:** _____ кг
**Кол-во:** 400 шт.
**НЕТТО потребительской упаковки:** _____ кг

STERILE R
IVD
Стерильно
+28°C
+2°C
70%

# СИСТЕМА ТРАНСПОРТНАЯ R00078

**Система транспортная R00078 со средой Эймса агаризованной с углём, материал тампона вискоза**

**ТУ 20.59.52-003-18847814-2021**

Изготовитель: ООО «ПОЛИГЕМ»
Адрес производства: 141983, Россия, Московская обл.,
г. Дубна, ул. Тверская, д. 26 А, стр. 1
тел.: +7 496 212-93-57 (доб. 213)

LOT

REF **R00078**

**Условия хранения и транспортировки изделия (без биоматериала):** Хранить и транспортировать изделие при температуре от +2 до +28°С и относительной влажности воздуха не более 70% в условиях, исключающих действие прямых солнечных лучей и влаги, на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействий влаги, солнечного света, огня, искрообразования. Дополнительные рекомендации по хранению и транспортировке изделия - см. в инструкции по применению.

**БРУТТО:** _____ кг
**НЕТТО:** _____ кг
**Кол-во:** 400 шт.
**НЕТТО потребительской упаковки:** _____ кг

STERILE R
IVD
Стерильно
+28°C
+2°C
70%



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU