



Образцы маркировки на Промывочный раствор А
для анализатора автоматического коагуляции крови "HEMATITE" (Гематит)
(Промывочный раствор А Hematite)

1. Образцы этикеток на компоненты набора "Промывочный раствор А Hematite"

Наименование	Этикетка
Промывочный раствор А	
Карта идентификационная	

2. Образцы этикеток на коробку набора "Промывочный раствор А Hematite"

2.1. Верхняя этикетка

"Промывочный раствор А Hematite"	
-------------------------------------	--

2.2. Боковая этикетка

"Промывочный раствор А Hematite"	
---	--

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:

1. АО «Вектор-Бест»
2. Россия, 630559, Новосибирская область, р.п.Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел/факс.: (383) 252-51-64, 252-51-67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«09» 01 2023 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.
"08" БЕЛ 20 22 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

Хусаинов М.Д.

«27» августа 2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР А ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА АВТОМАТИЧЕСКОГО
КОАГУЛЯЦИИ КРОВИ «НЕМАТИТЕ» (ГЕМАТИТ)
(ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР А НЕМАТИТЕ)**

фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Промывочный раствор А Hematite»
(серия 1)



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX


промывочный раствор А для
анализатора автоматического
коагуляции крови
«HEMATITE» (Гематит)


**Промывочный раствор А
Hematite**

Состав: А (2×500 мл)
Карта идентификационная

ТУ 21.20.23-207-23548172-2023
РУ №



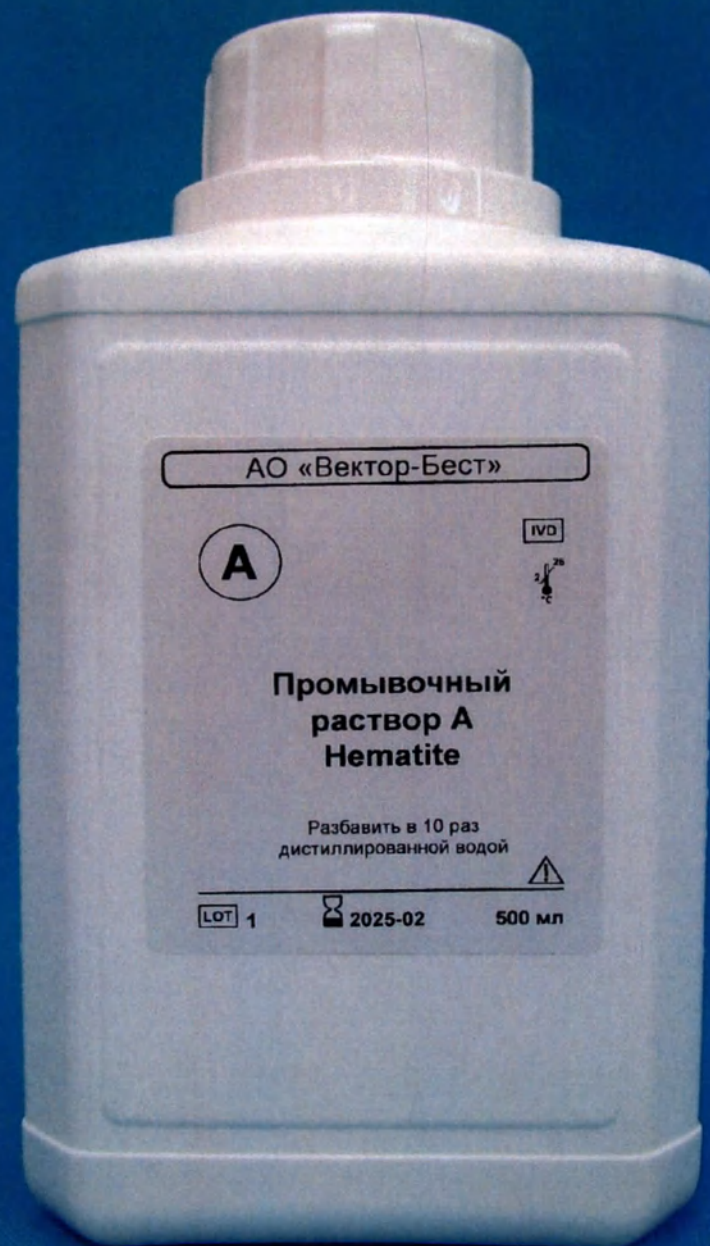

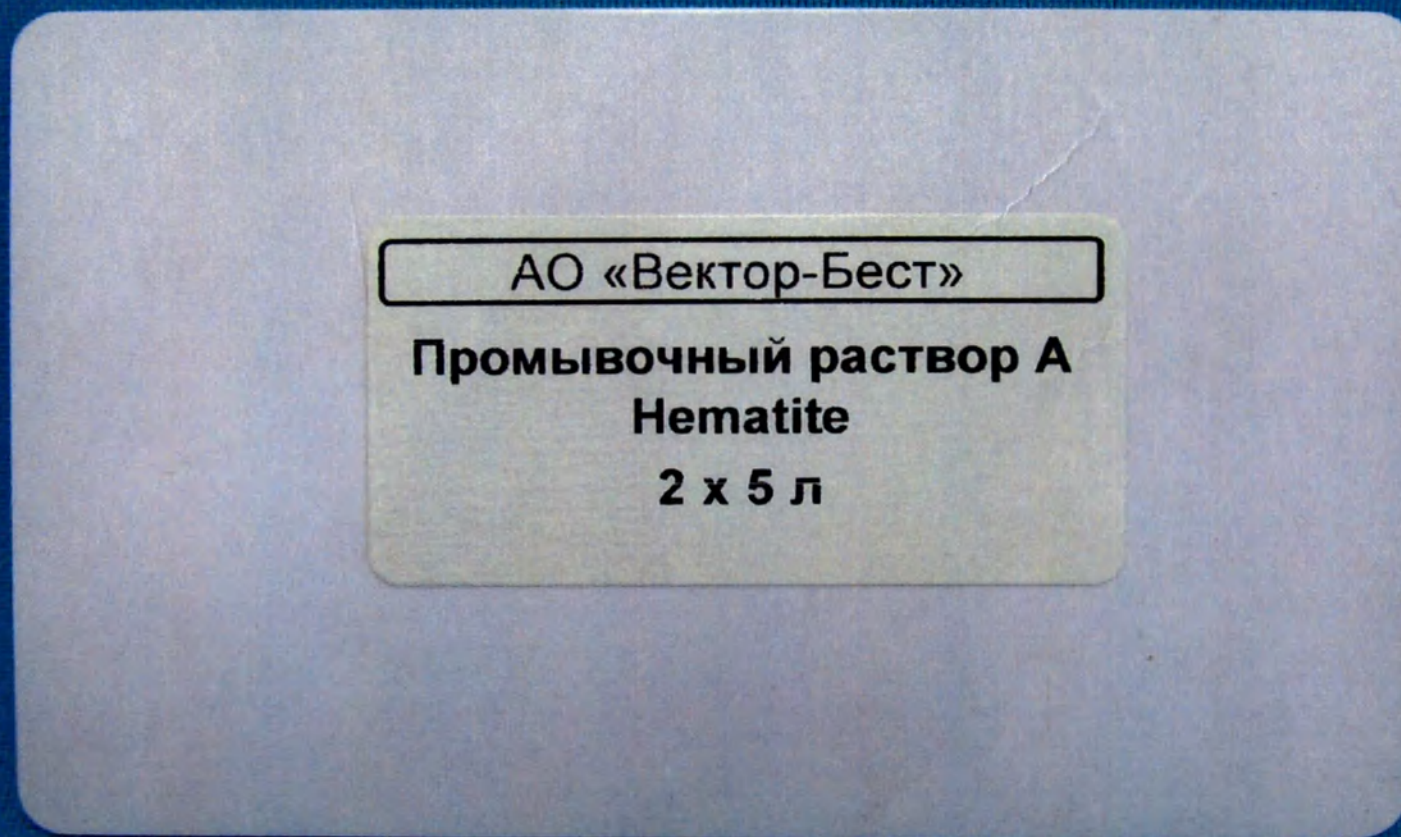

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Промывочный раствор А Hematite»
(серия 2)



фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

«Промывочный раствор А Hematite»

№ 1 (серия 2)

ВЕКТОР

БЕСТ



X-XXXX


промывочный раствор А для
анализатора автоматического
коагуляции крови
«HEMATITE» (Гематит)


**Промывочный раствор А
Hematite**

Состав: А (2×500 мл)
Карта идентификационная

ТУ 21 20 23-207-23548172-2023
РУ №



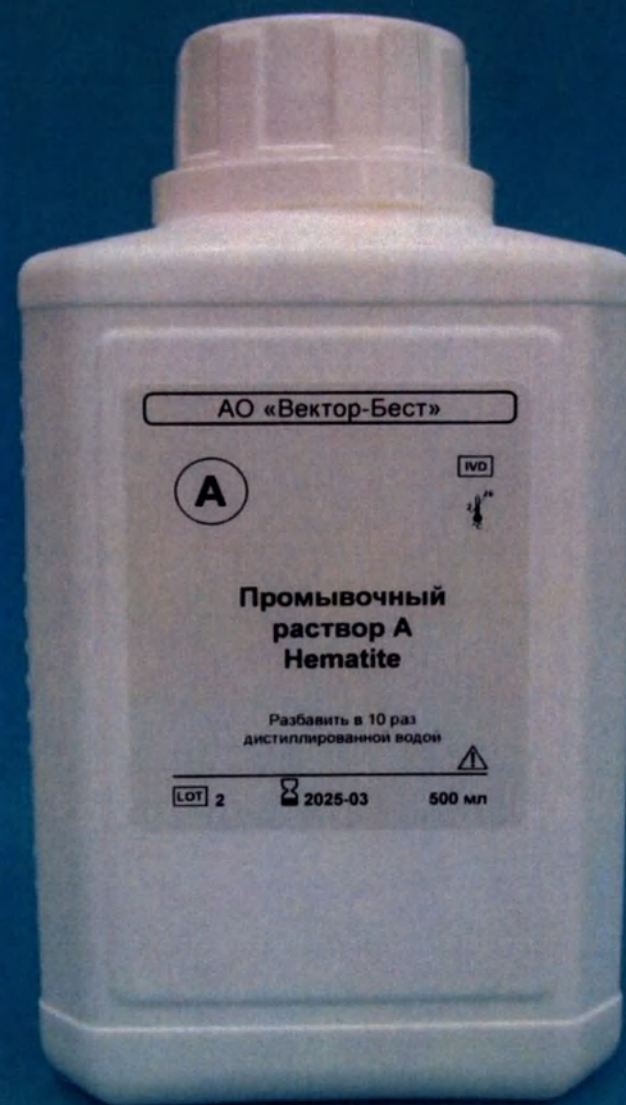

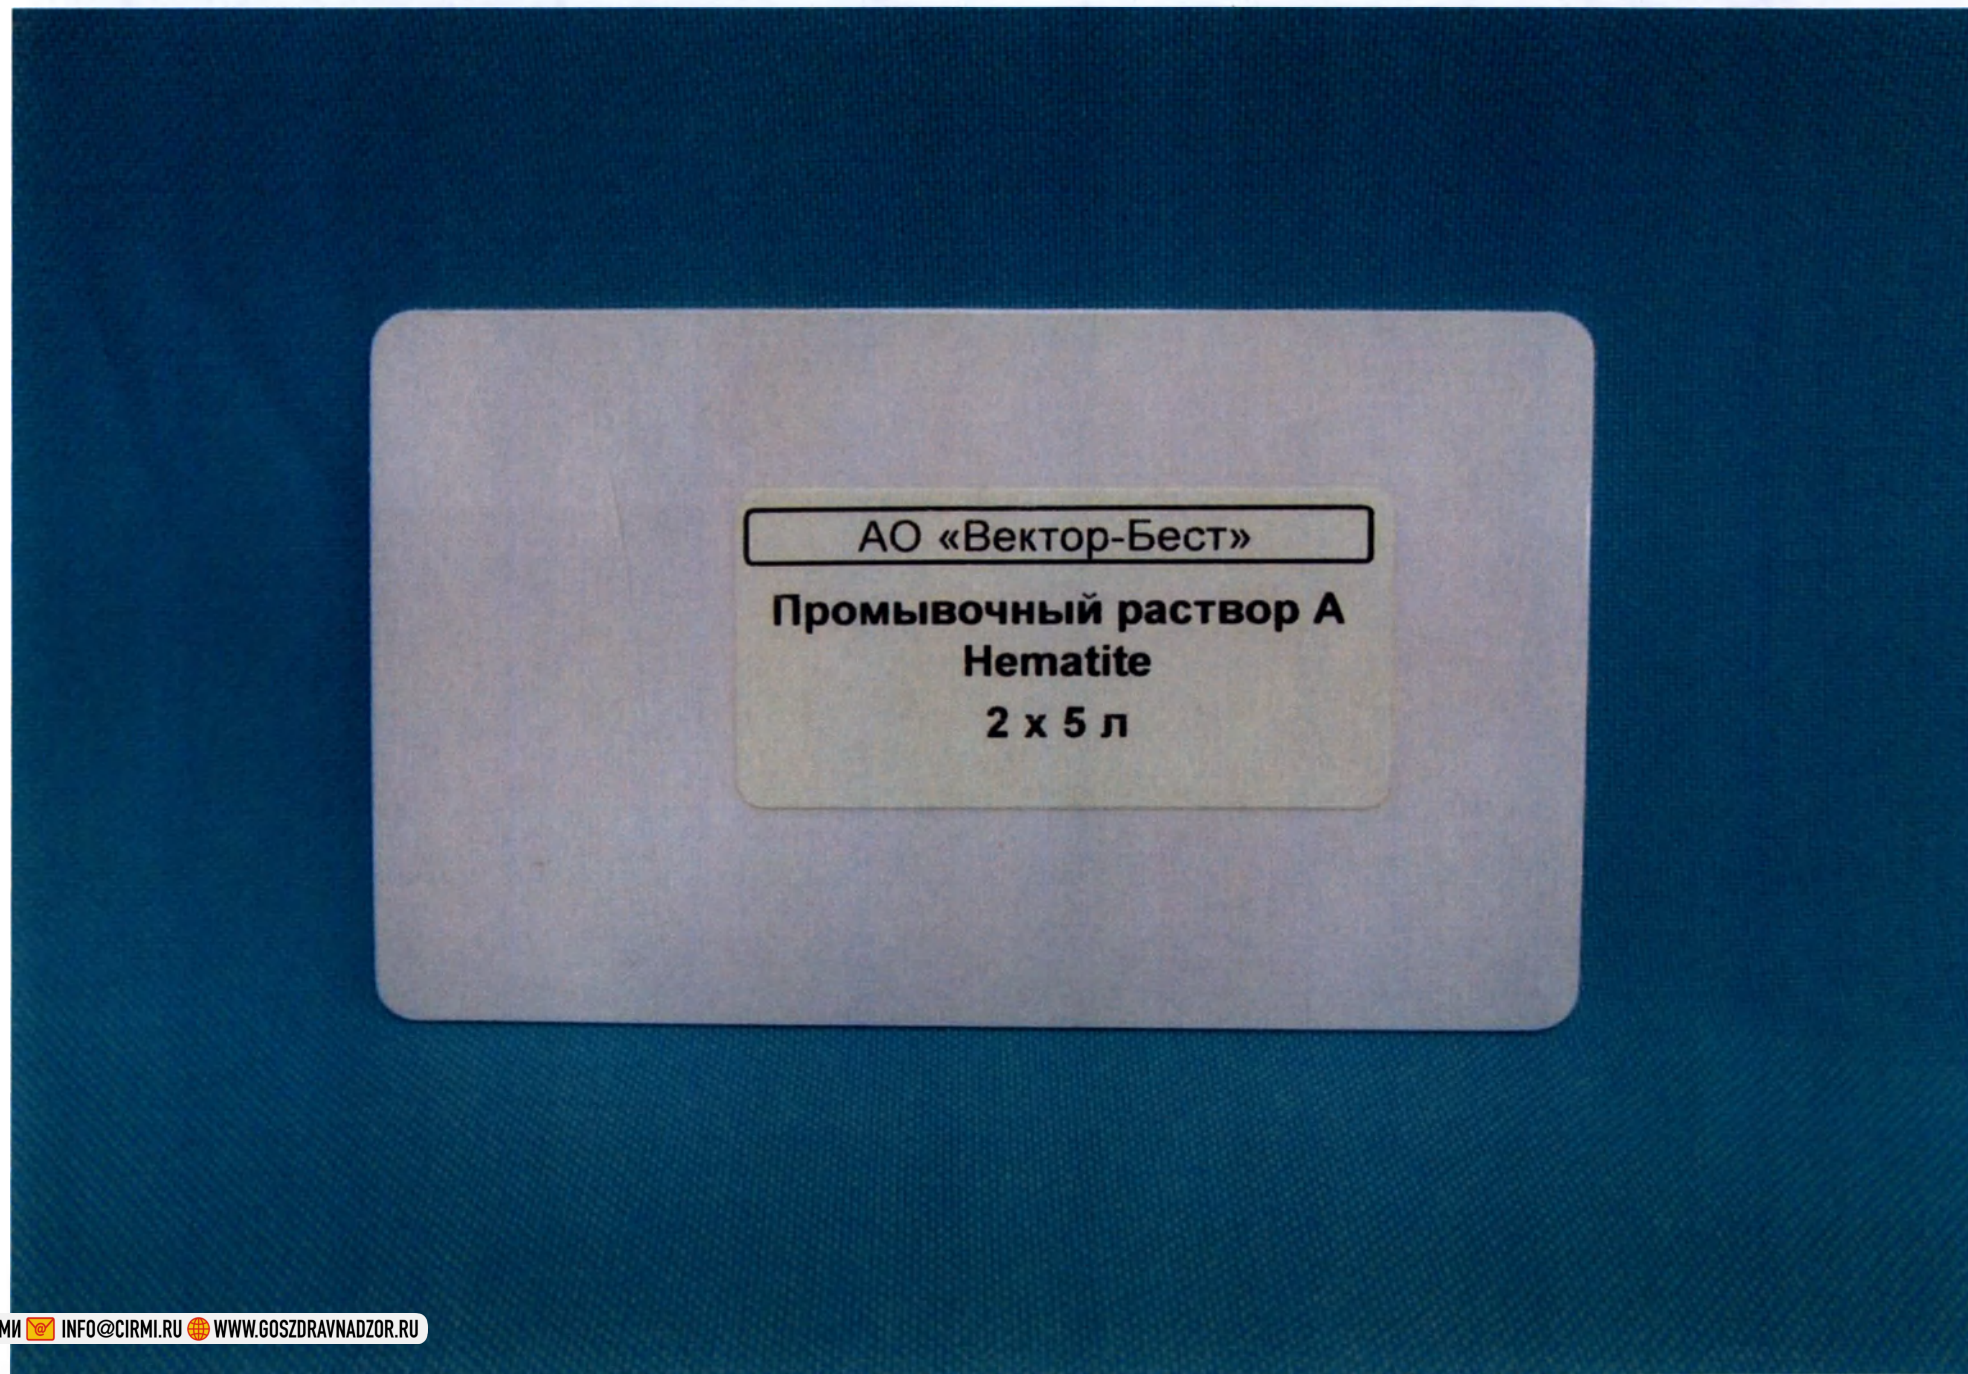

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



Масяго А.В.
20.09 г.