


## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT Control), в вариантах исполнения**


**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech  
Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**

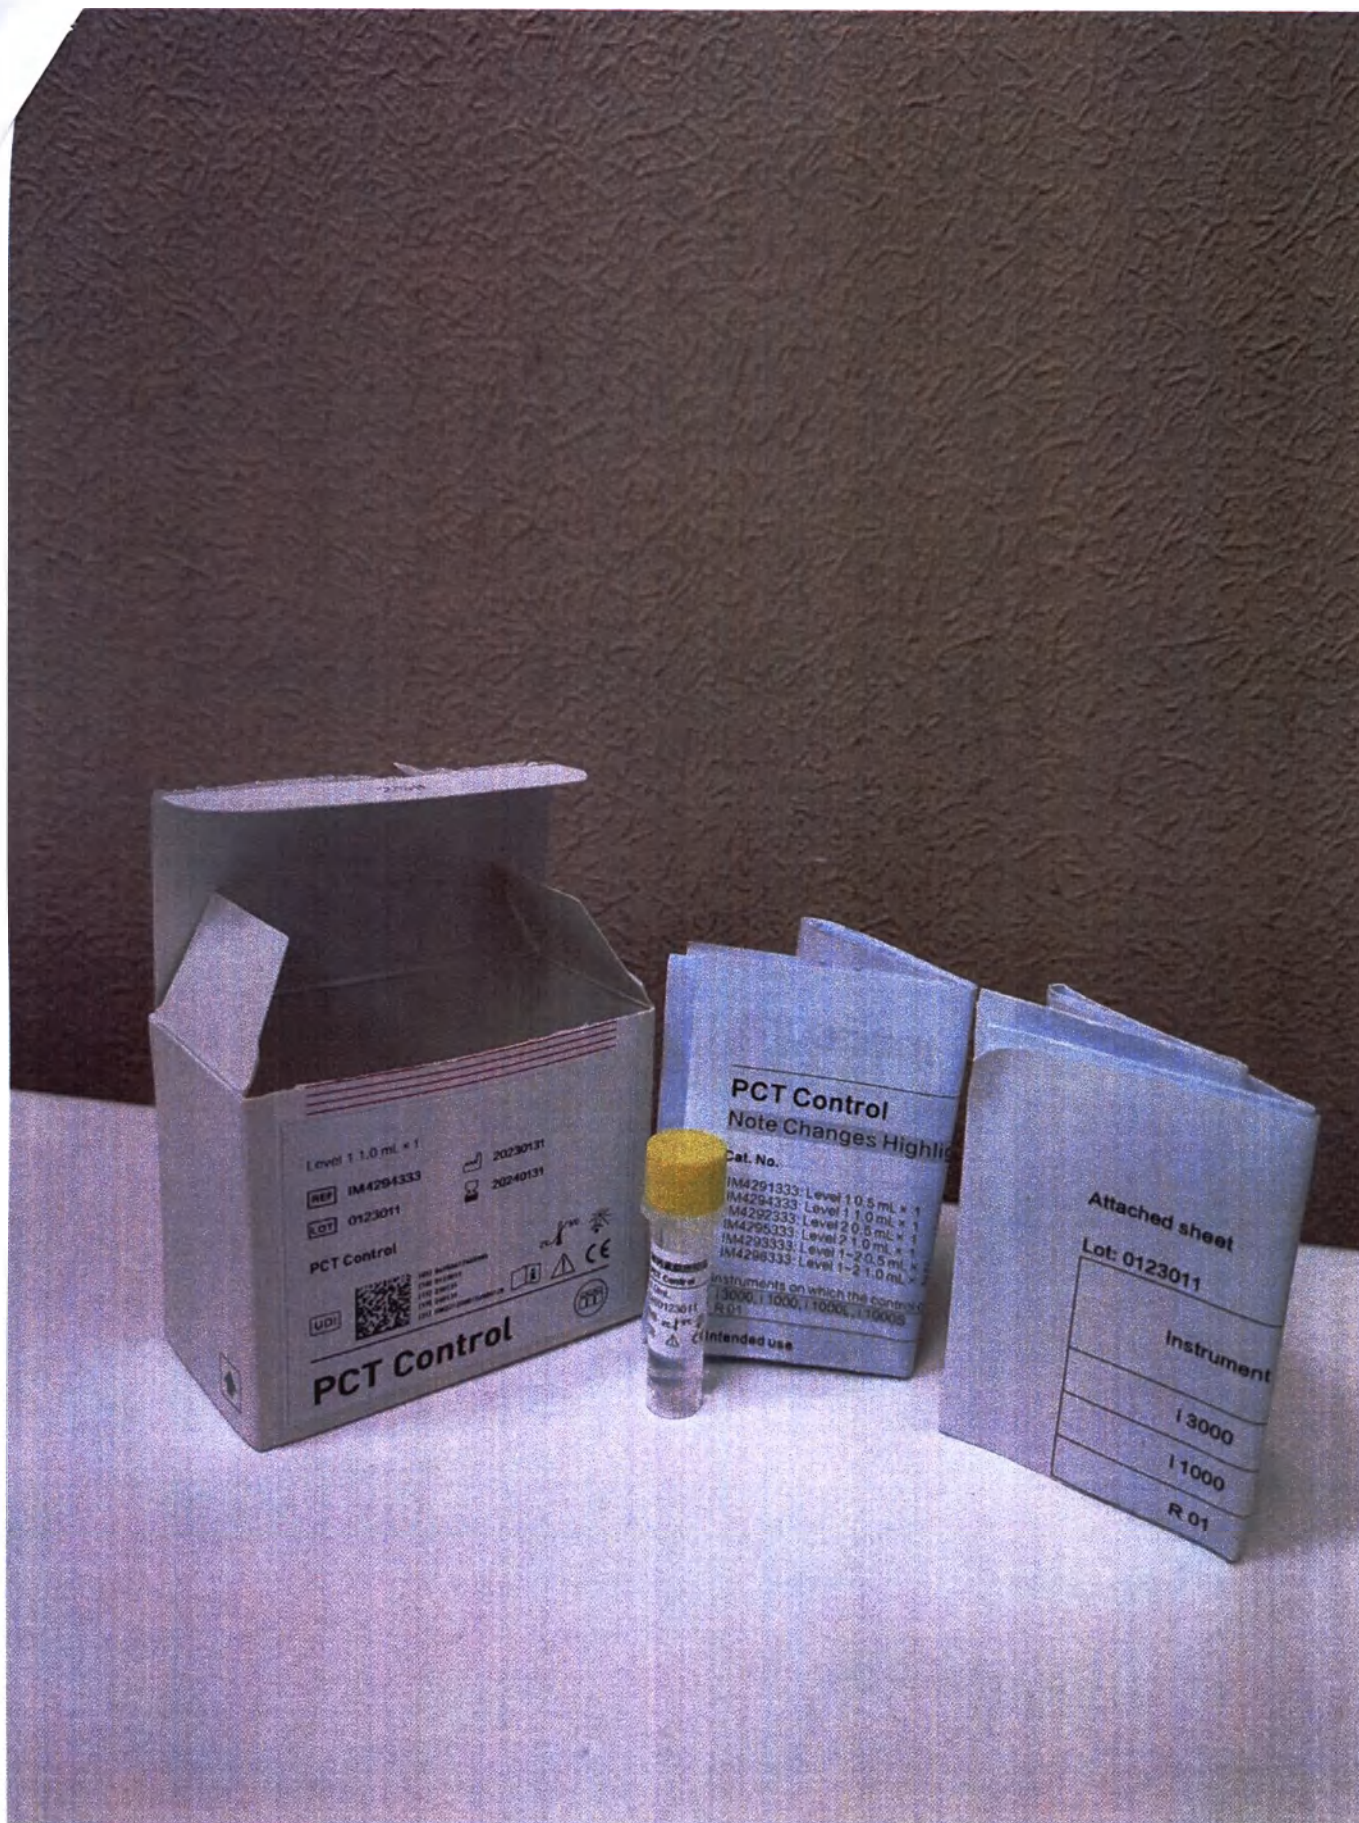

Общий вид МИ «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 1»




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Massura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид спереди.

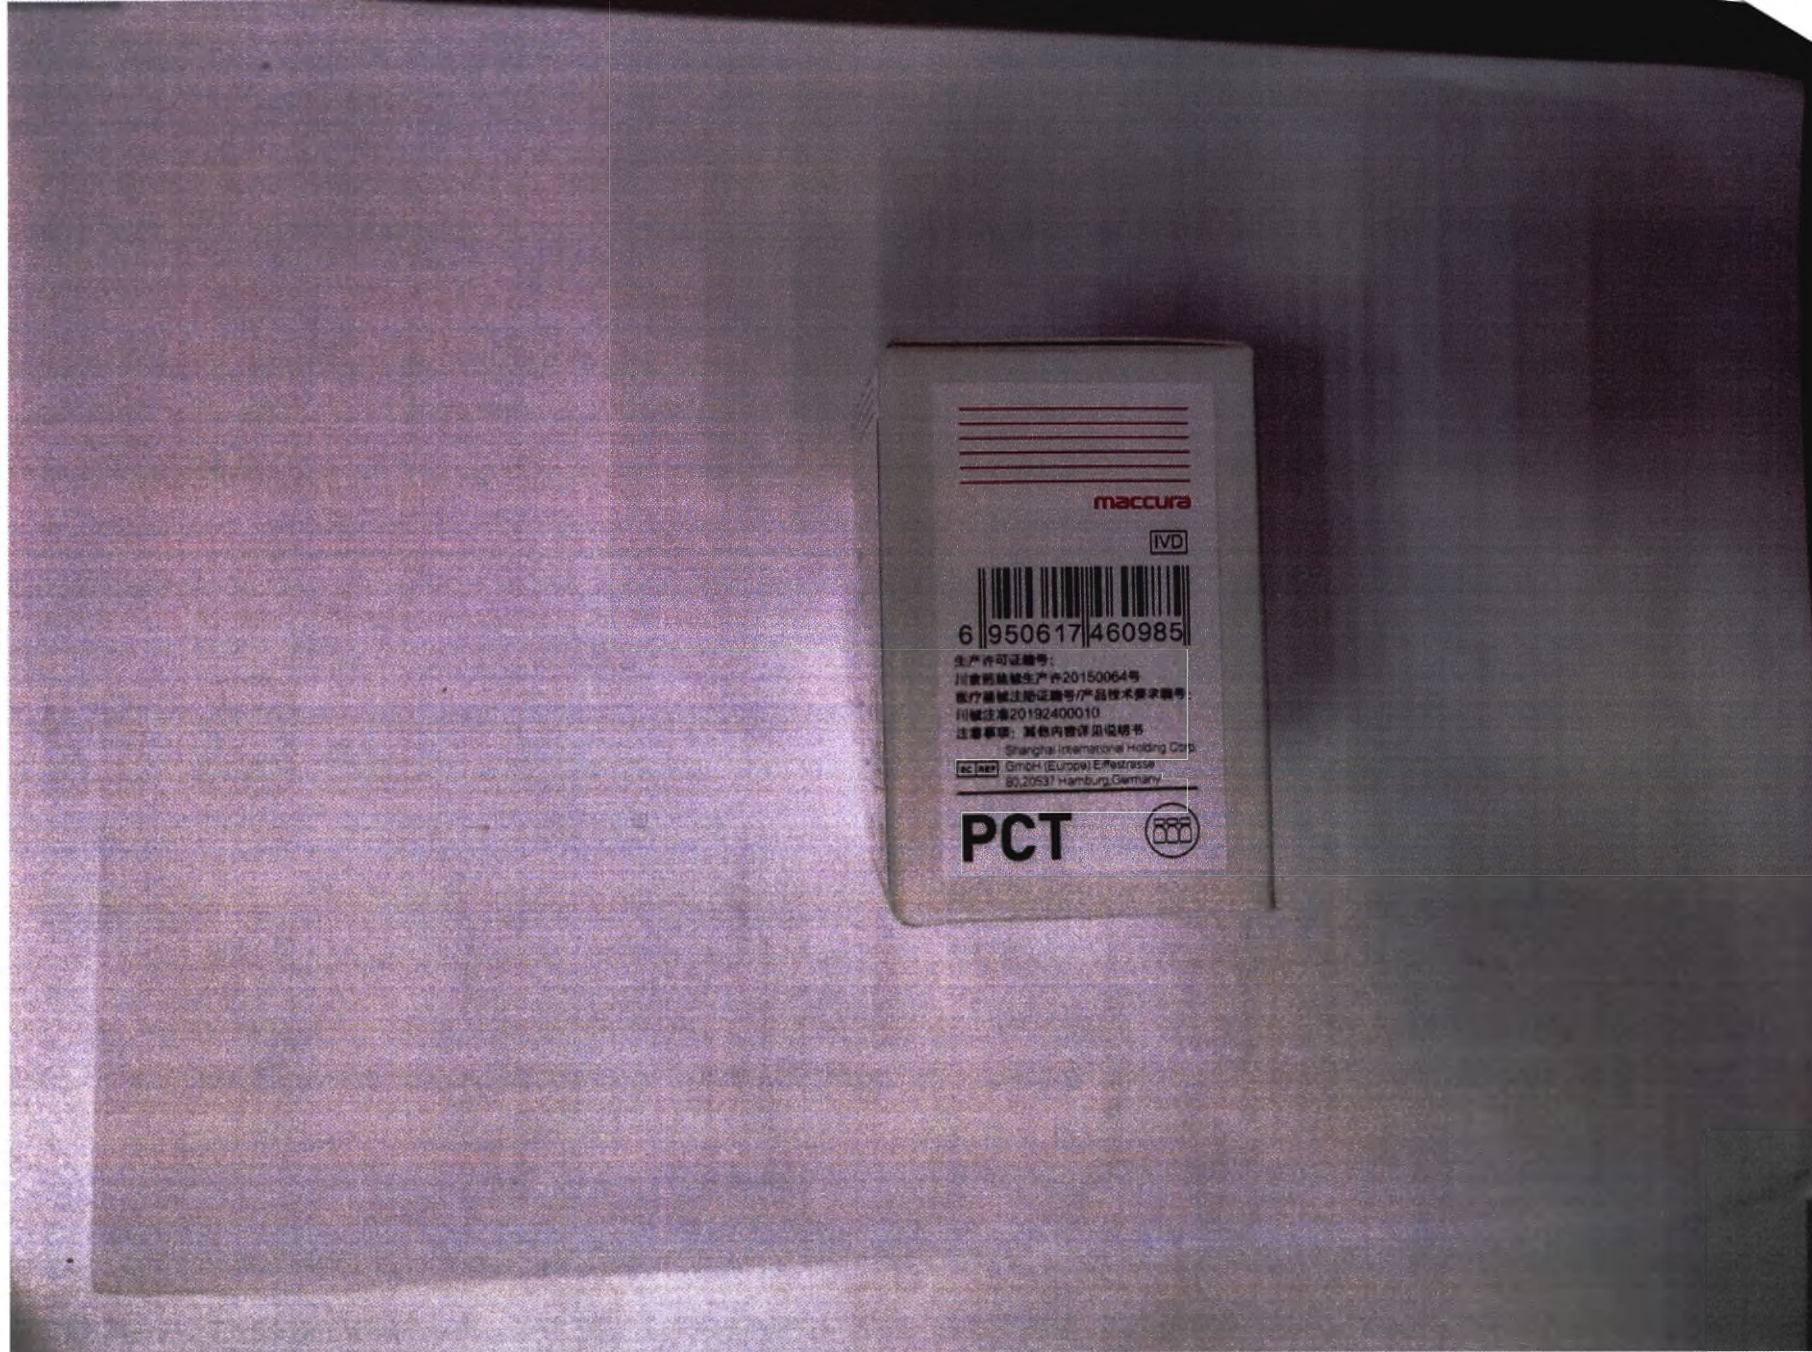

Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сбоку.




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сзади.

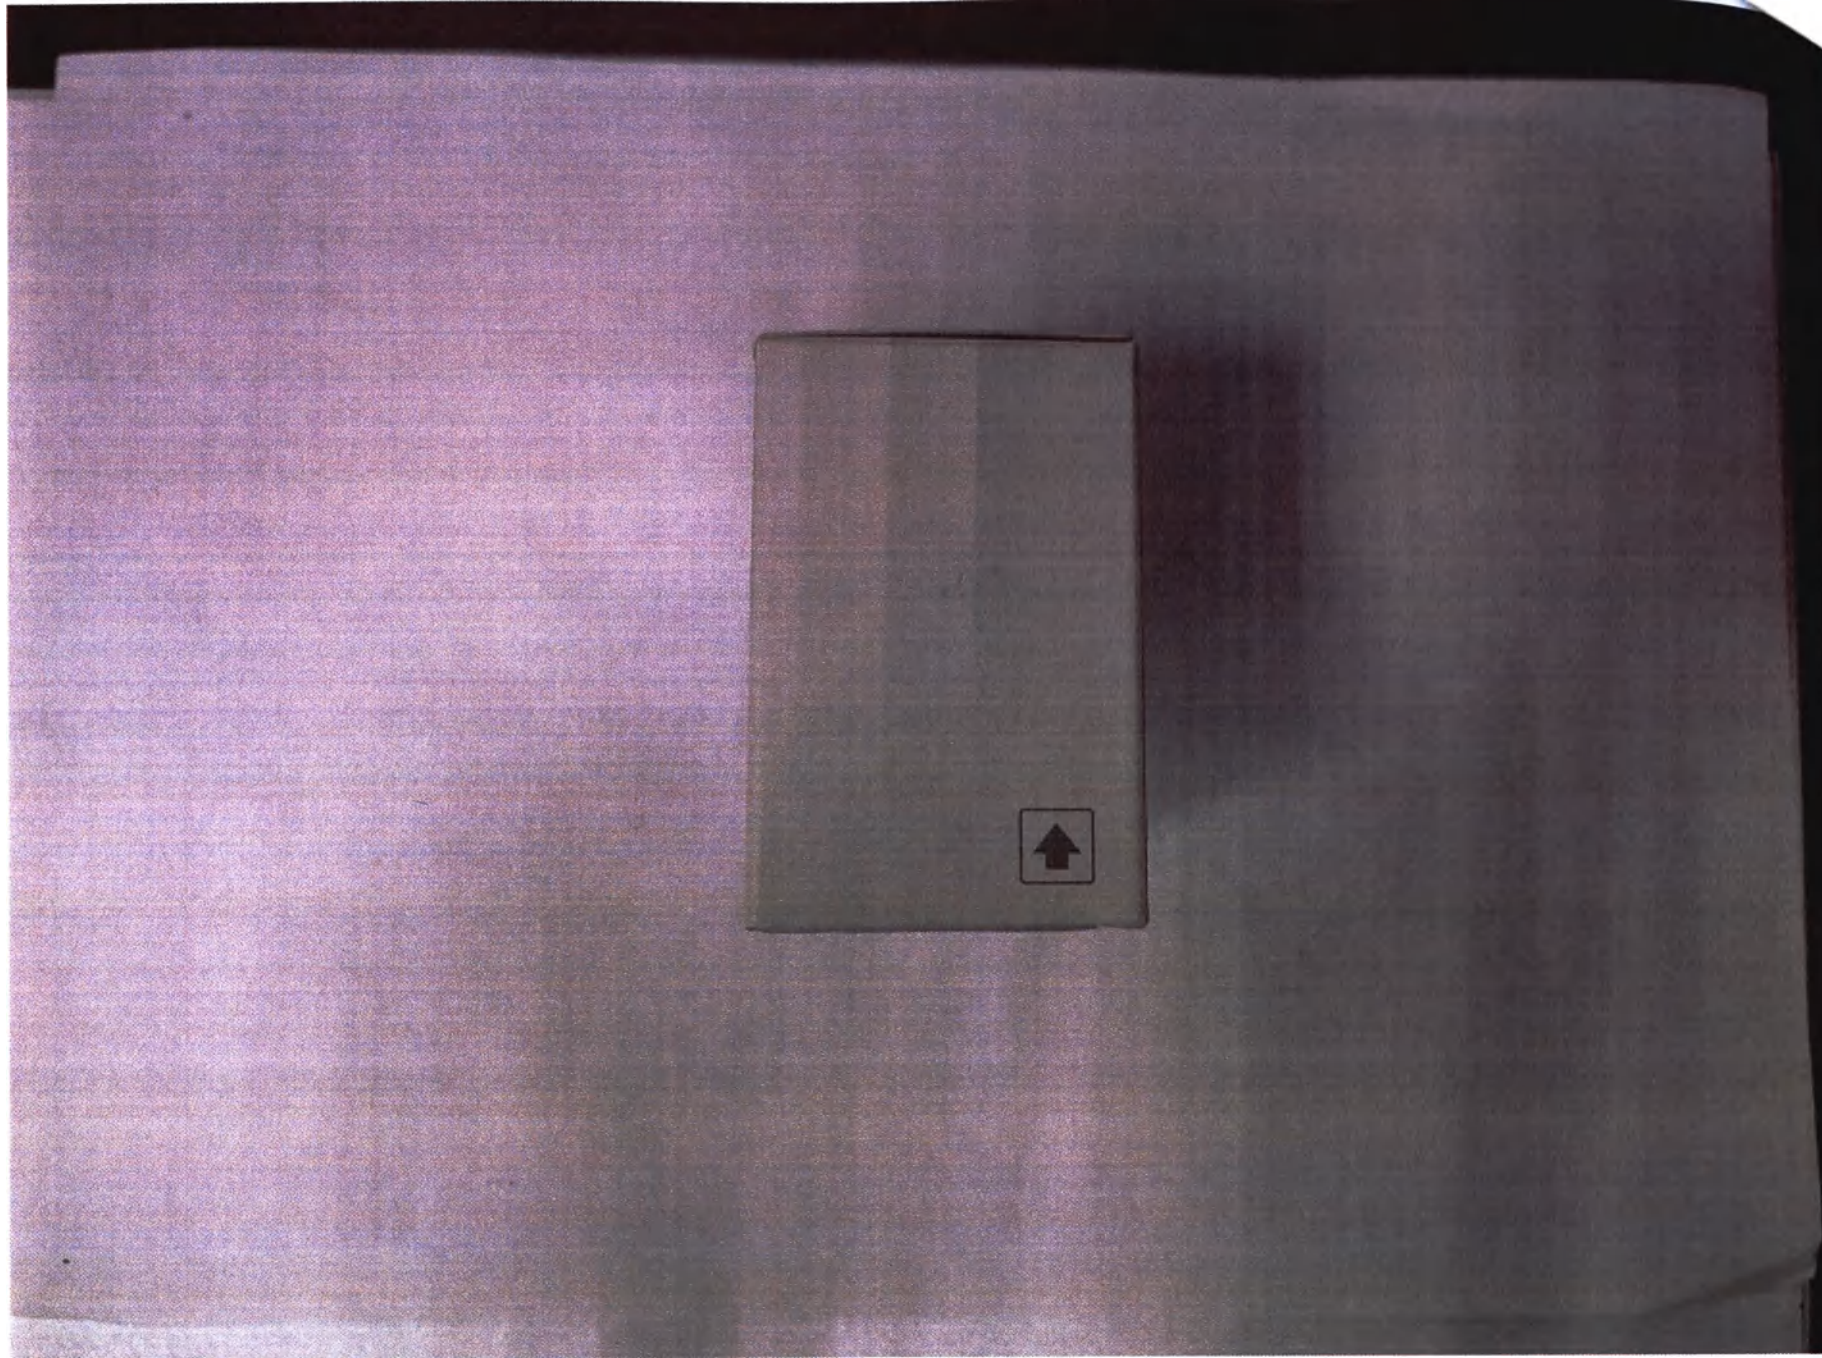


**Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массига i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 1»- вид сбоку.**




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Masscura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 1» - вид сверху.

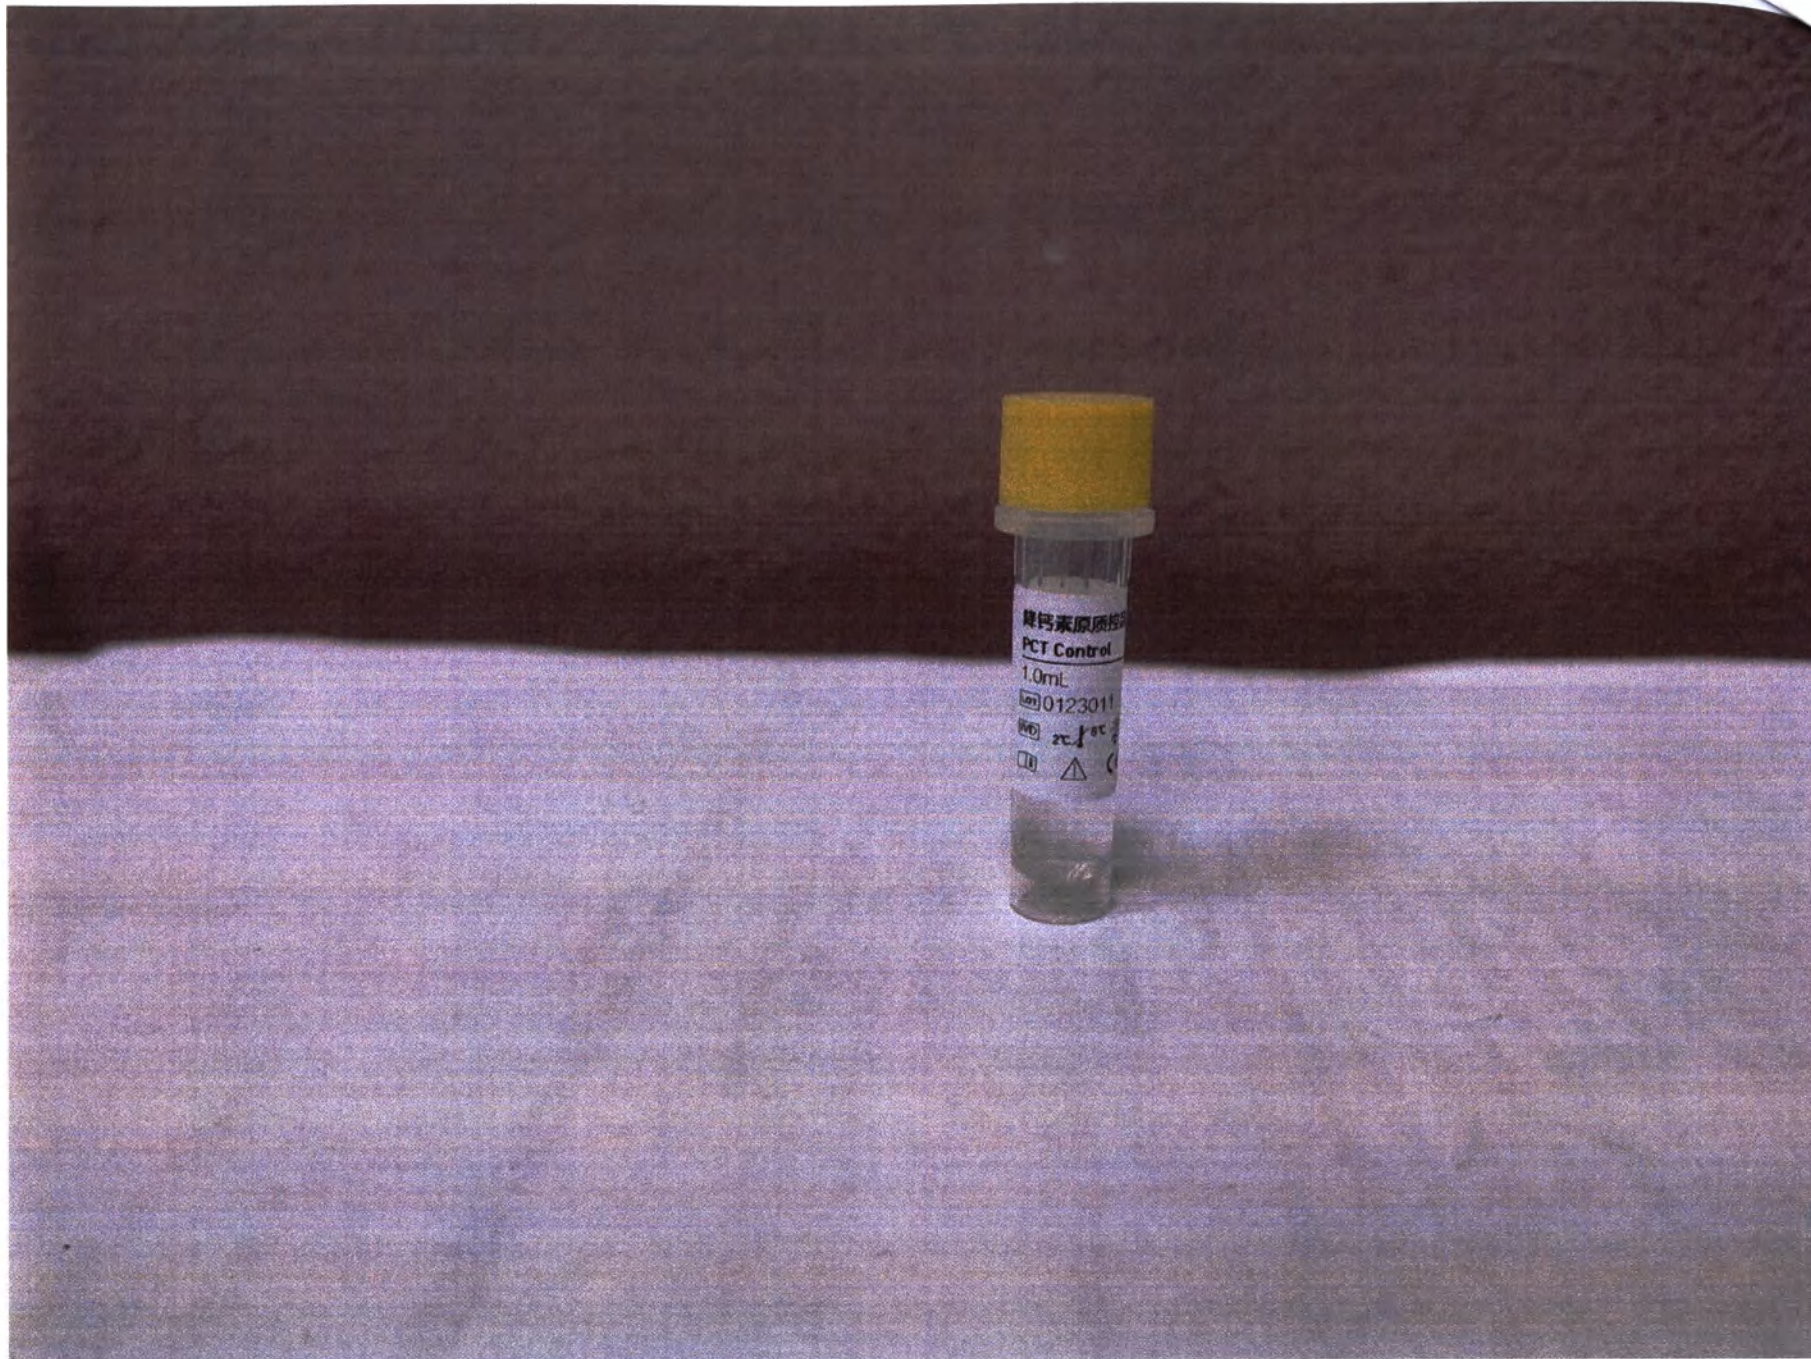


Пробирка содержащая «Материал контрольный 1 (Level 1)» - сторона 1.

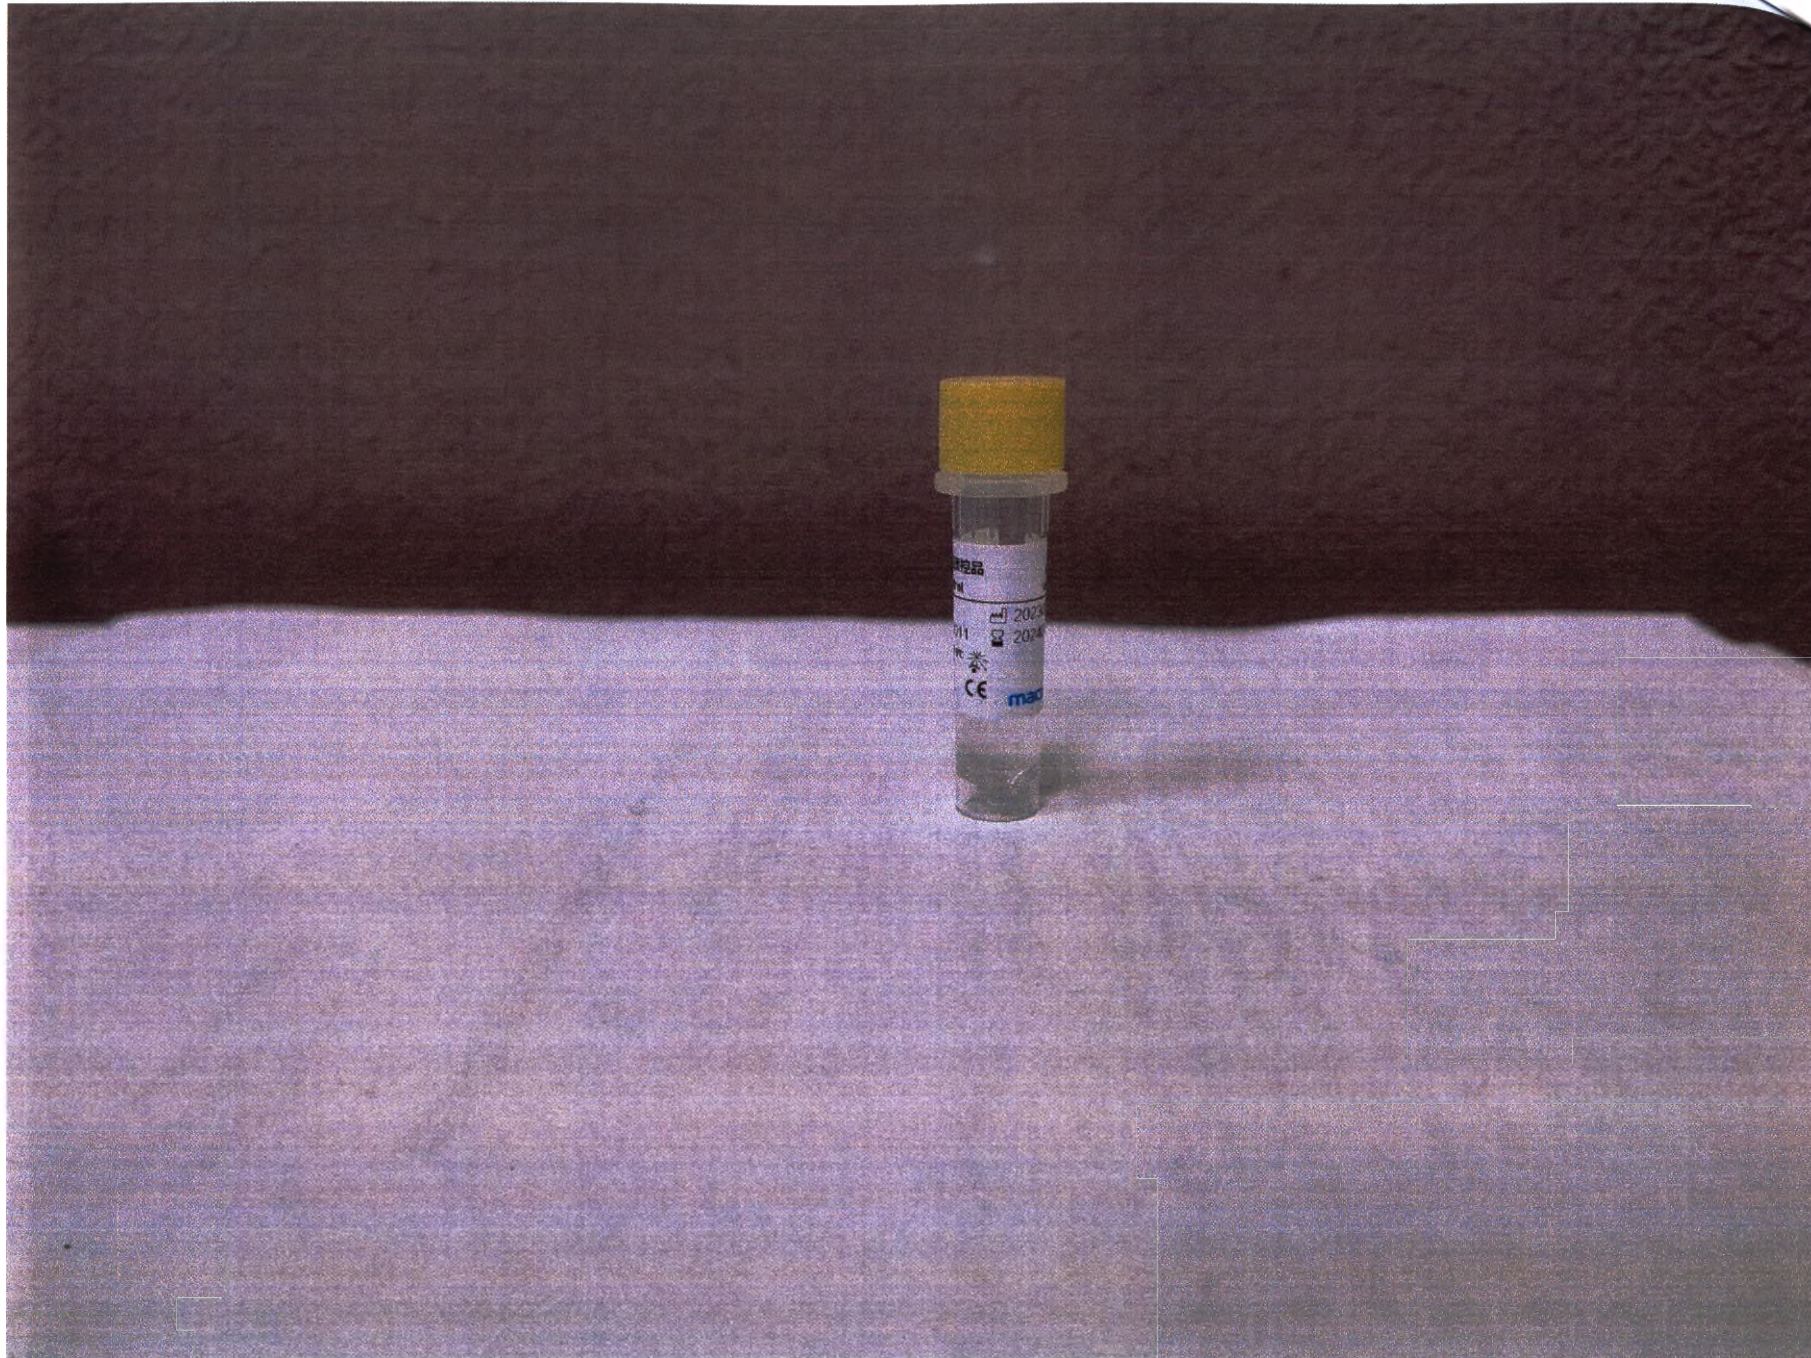

Пробирка содержащая «Материал контрольный 1 (Level 1)» - сторона 2.

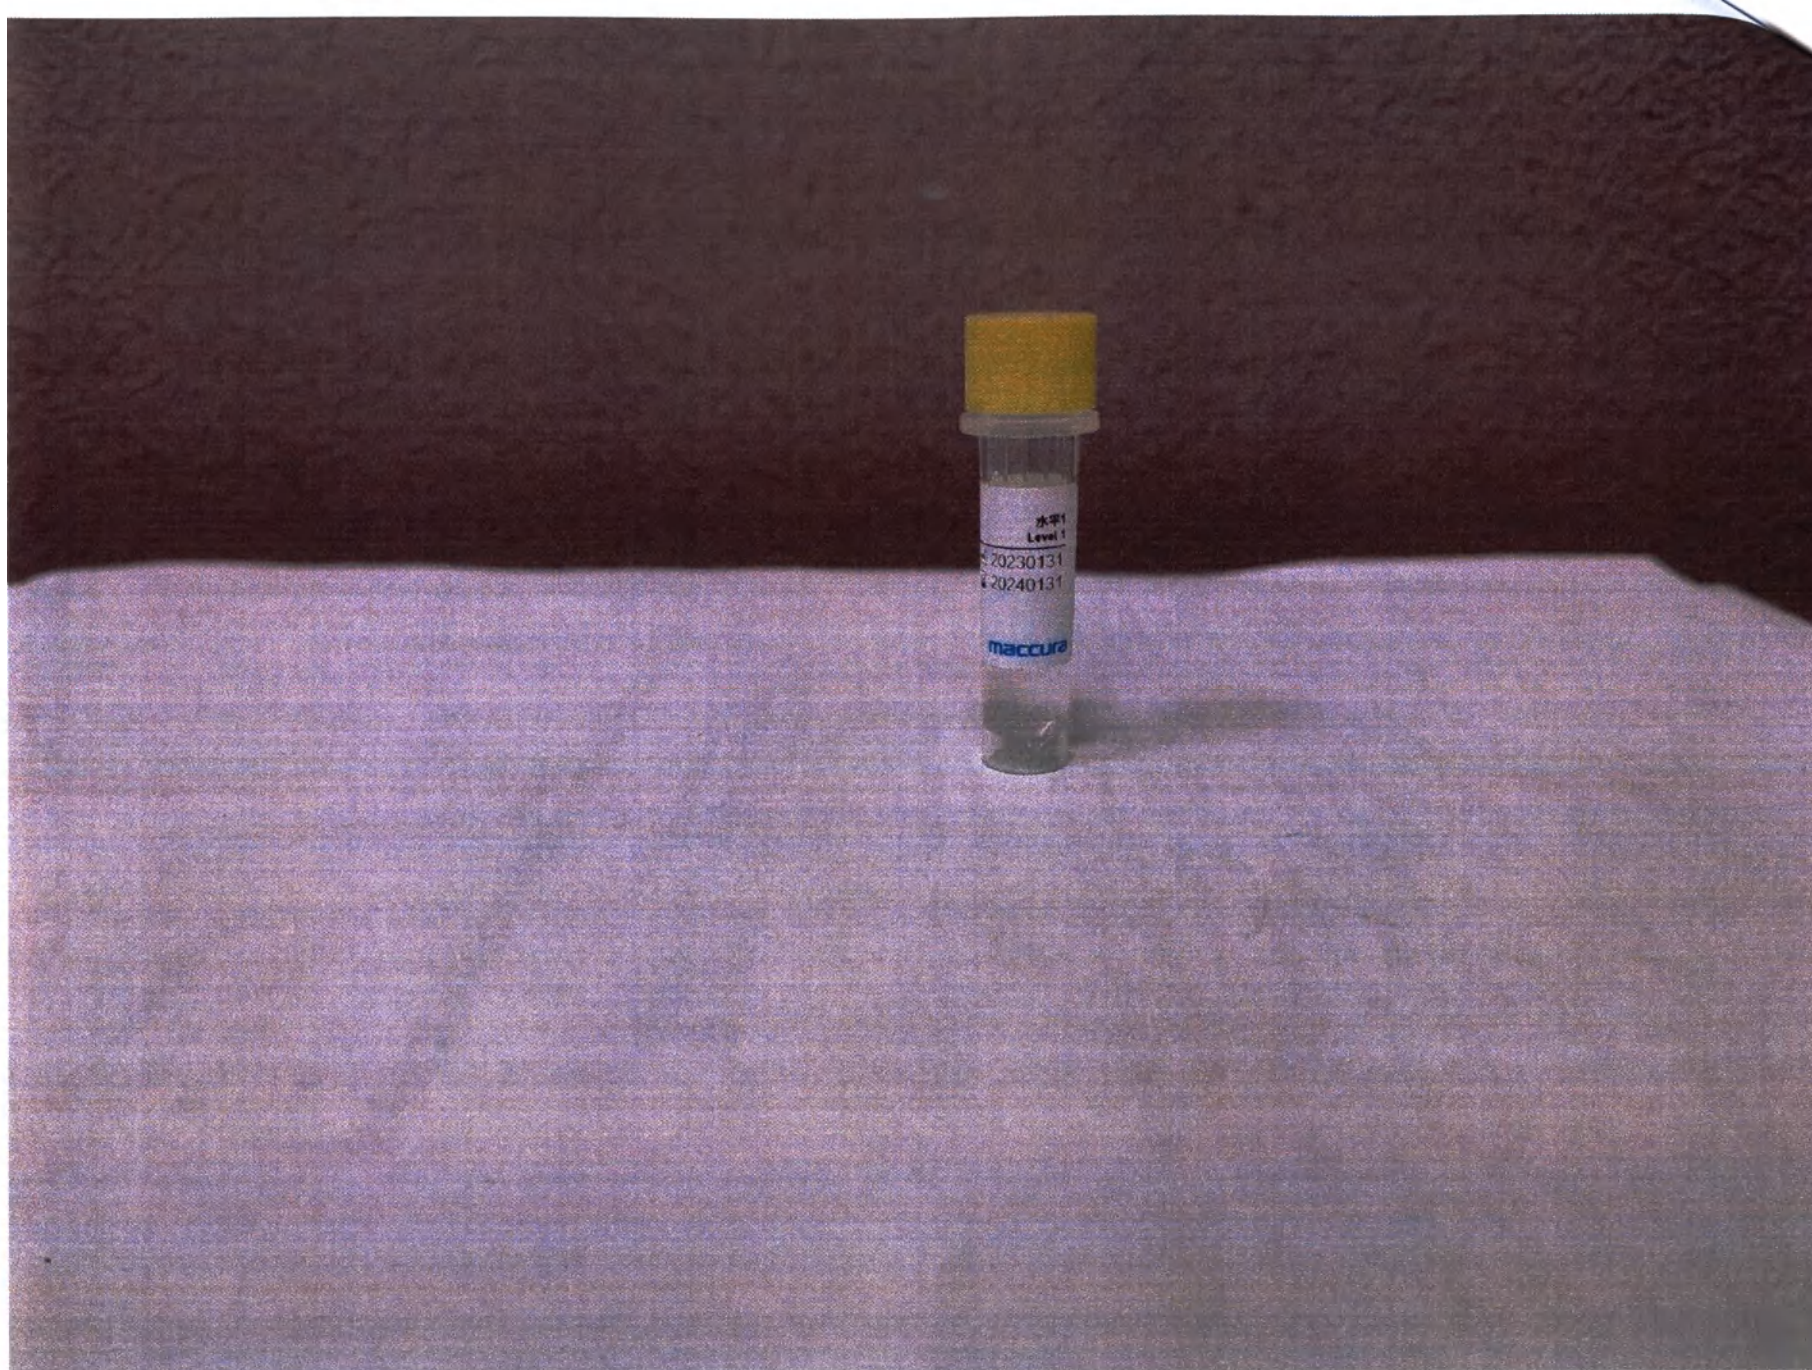

Пробирка содержащая «Материал контрольный 1 (Level 1)» - сторона 3.

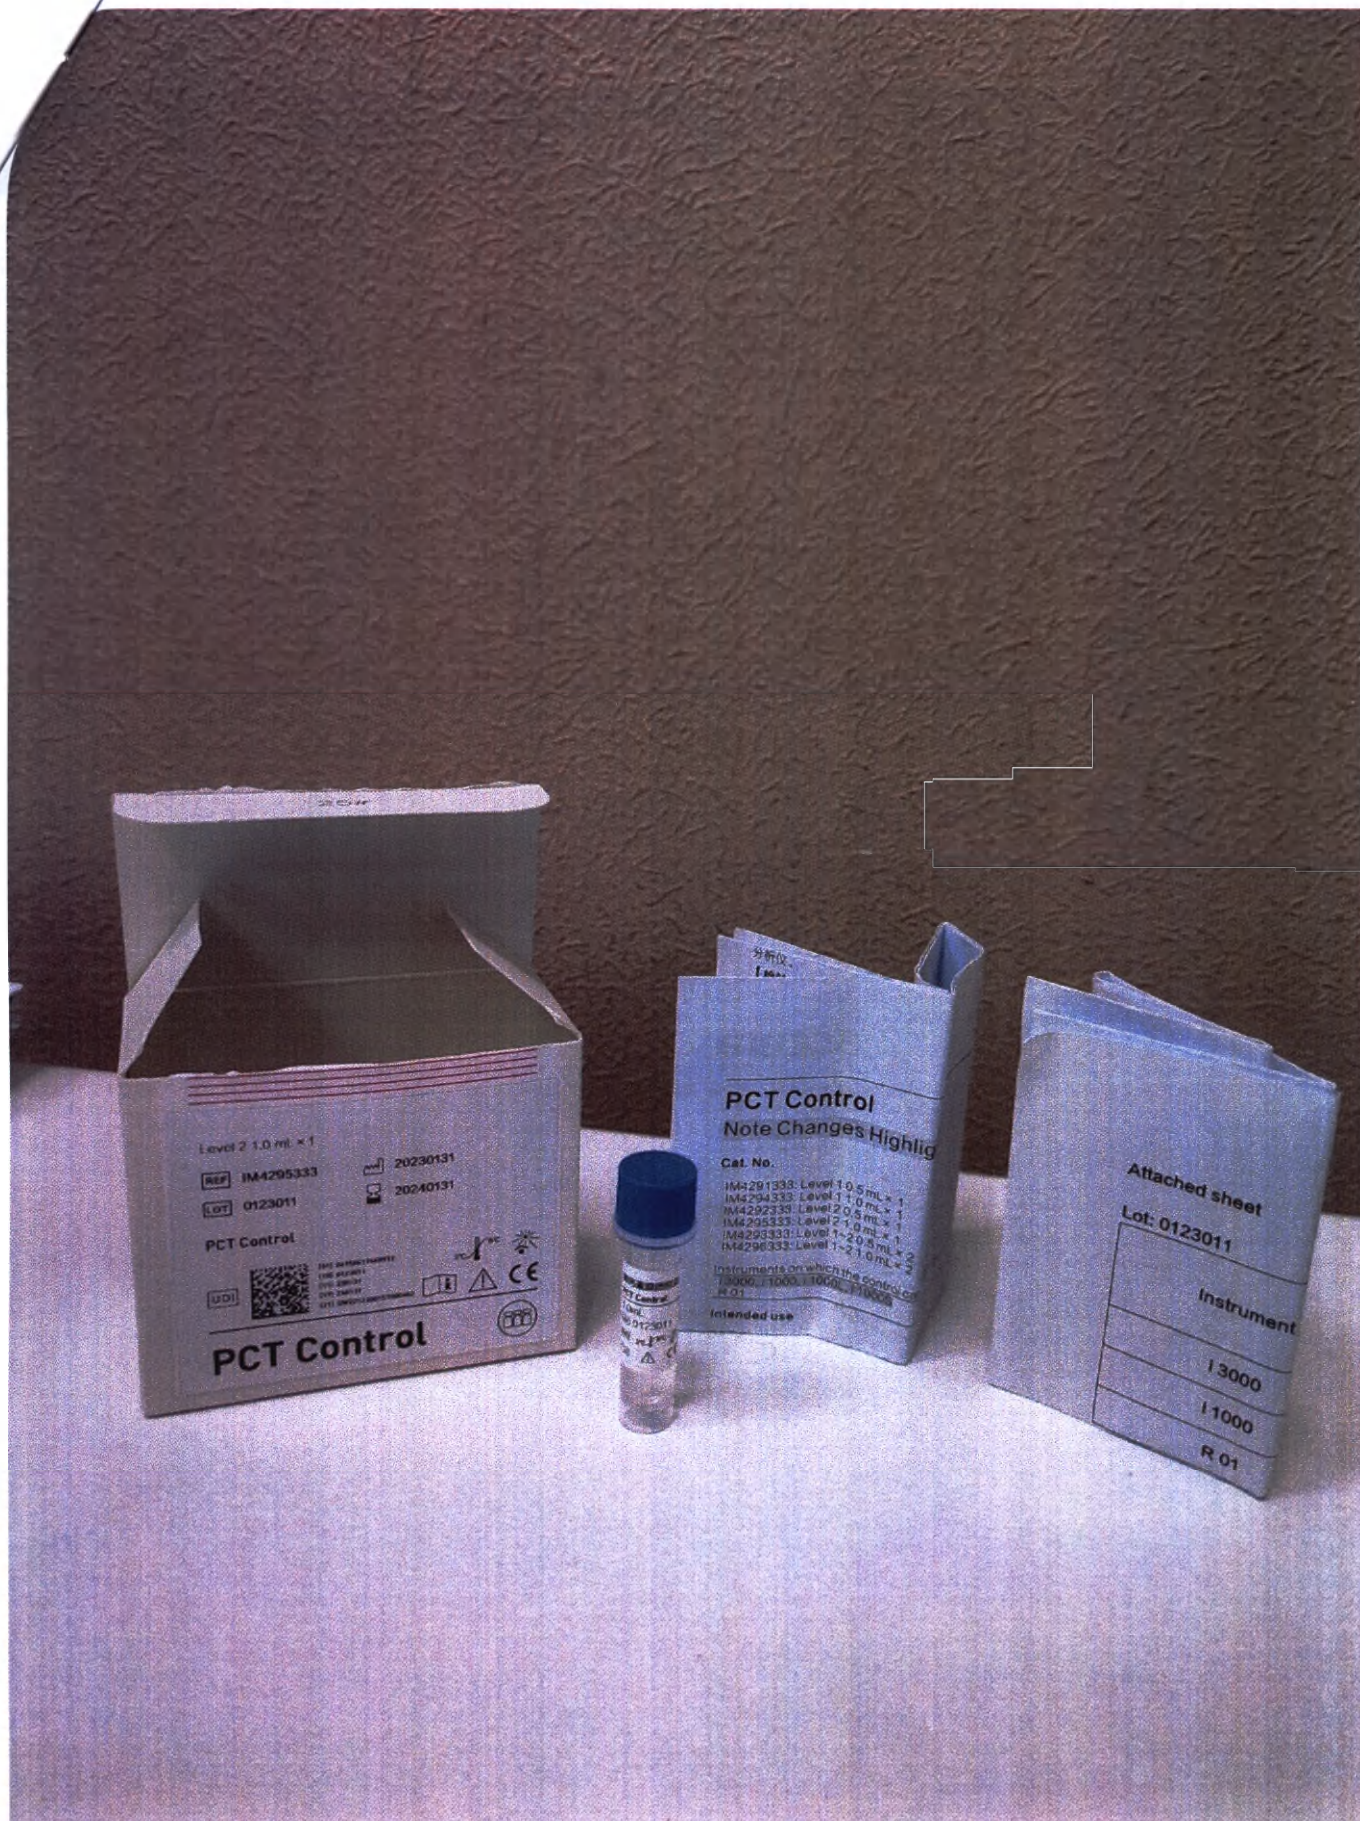

Общий вид МИ «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 2»




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Massura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 2» - вид спереди.




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 2»- вид сбоку.




Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 2»- вид сзади.

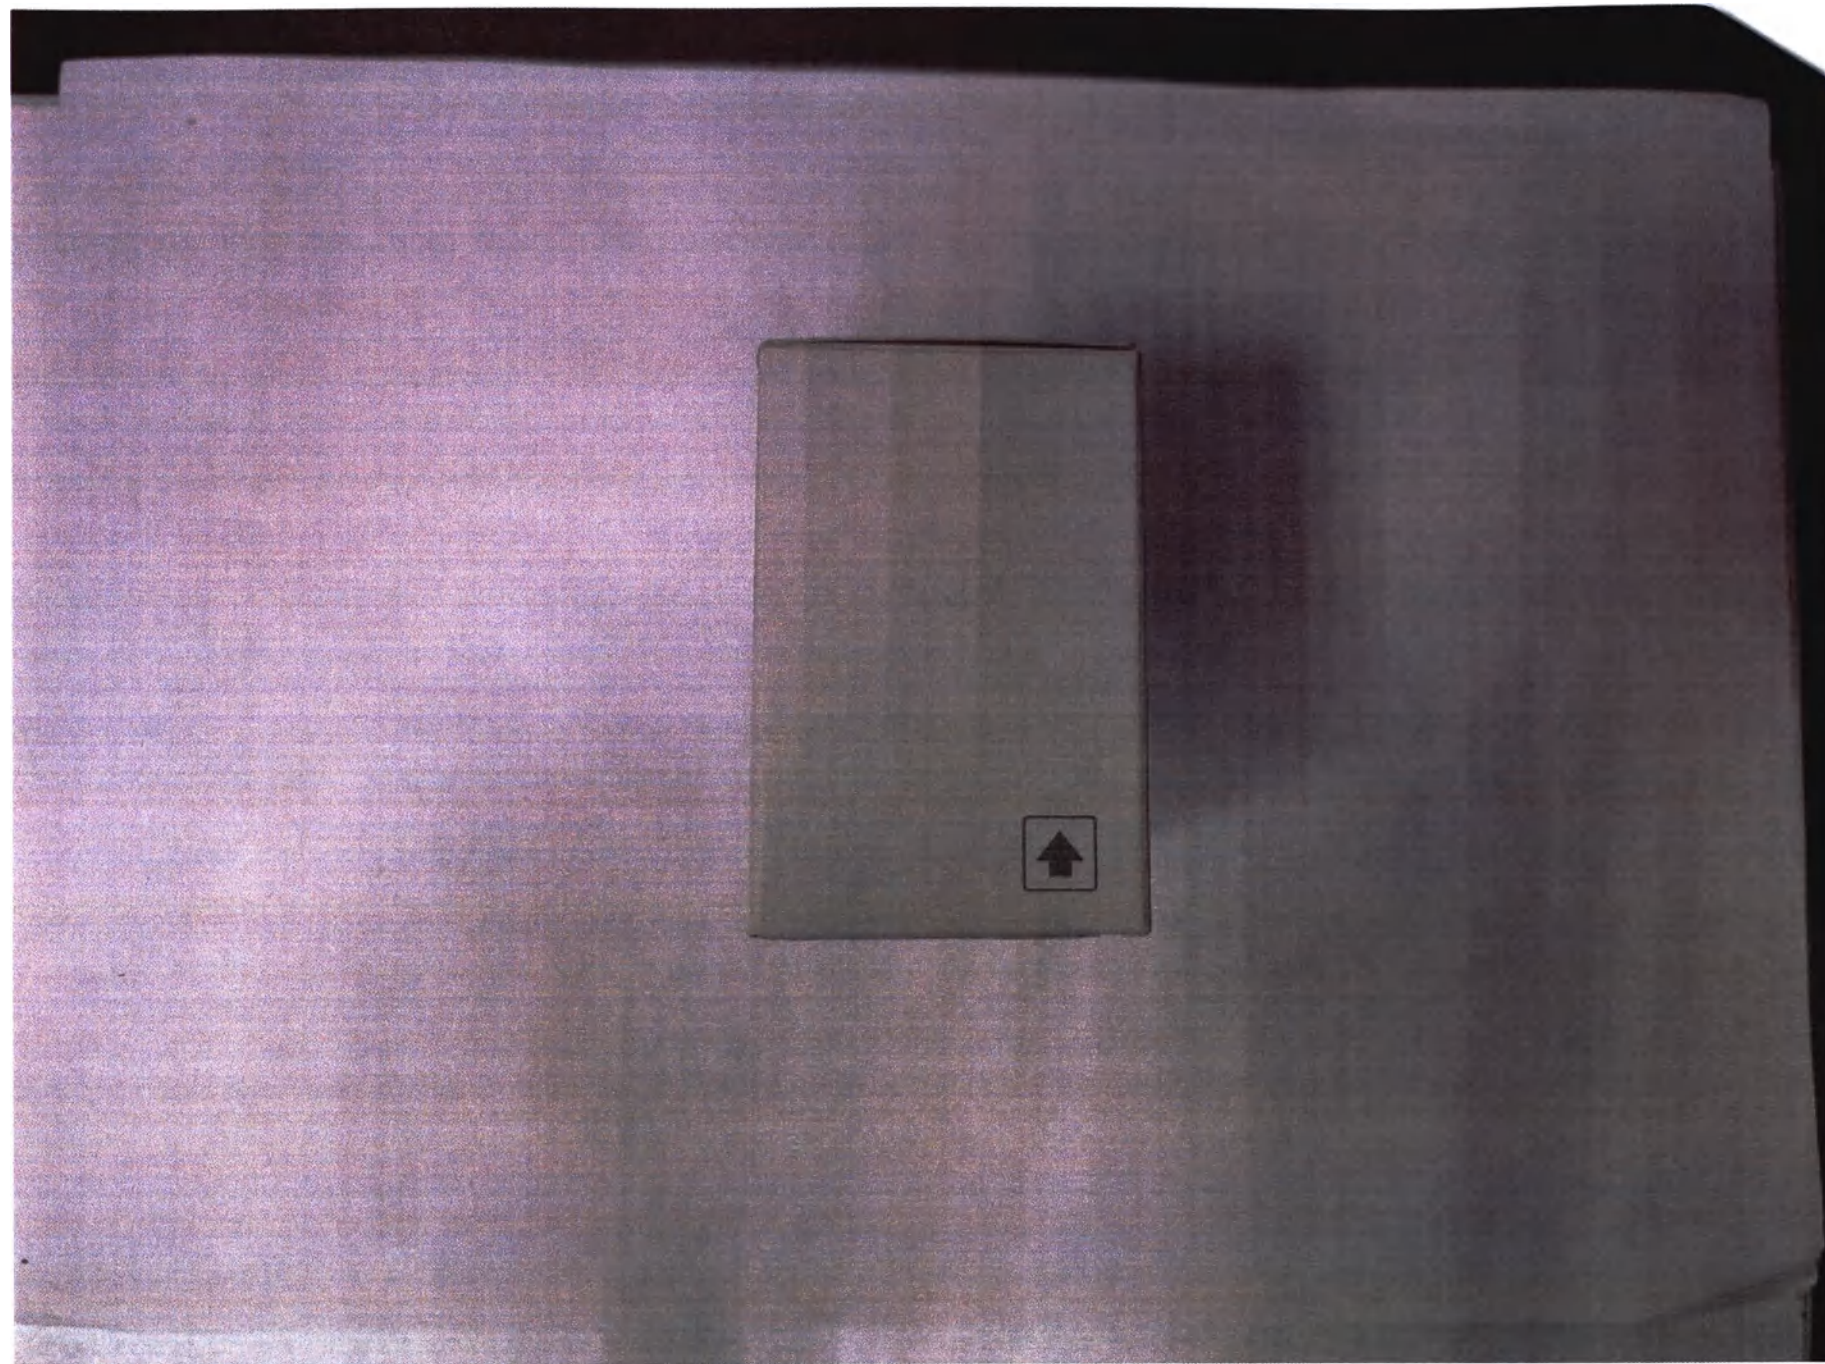


**Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массига i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 2»- вид сбоку.**

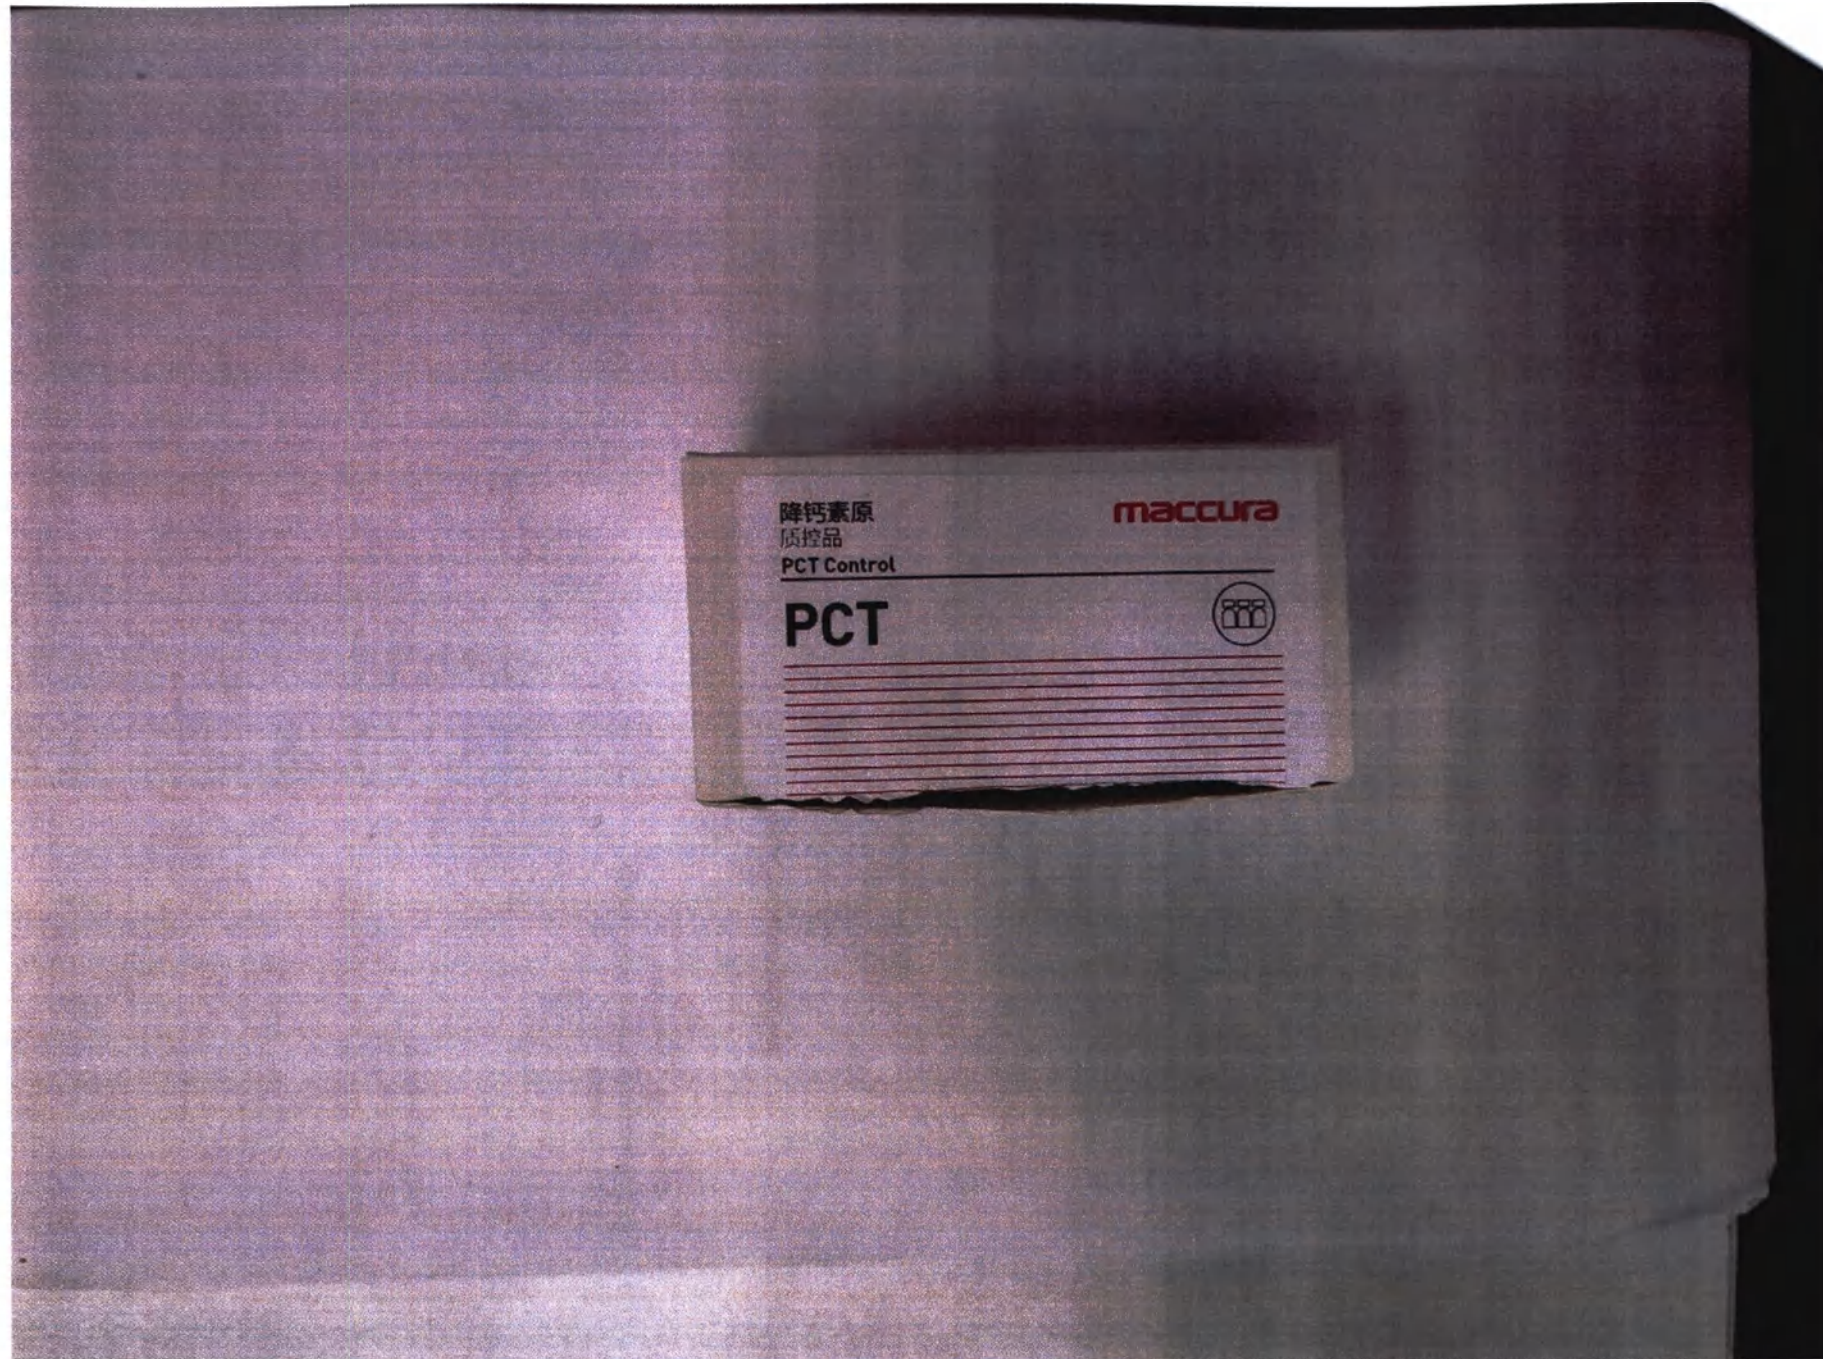


Вторичная упаковка (картонная коробка) медицинского изделия «Набор контрольных материалов для контроля качества определения прокальцитонина (ПКТ) сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (PCT Control), в вариантах исполнения: Вариант 2»- вид сверху.

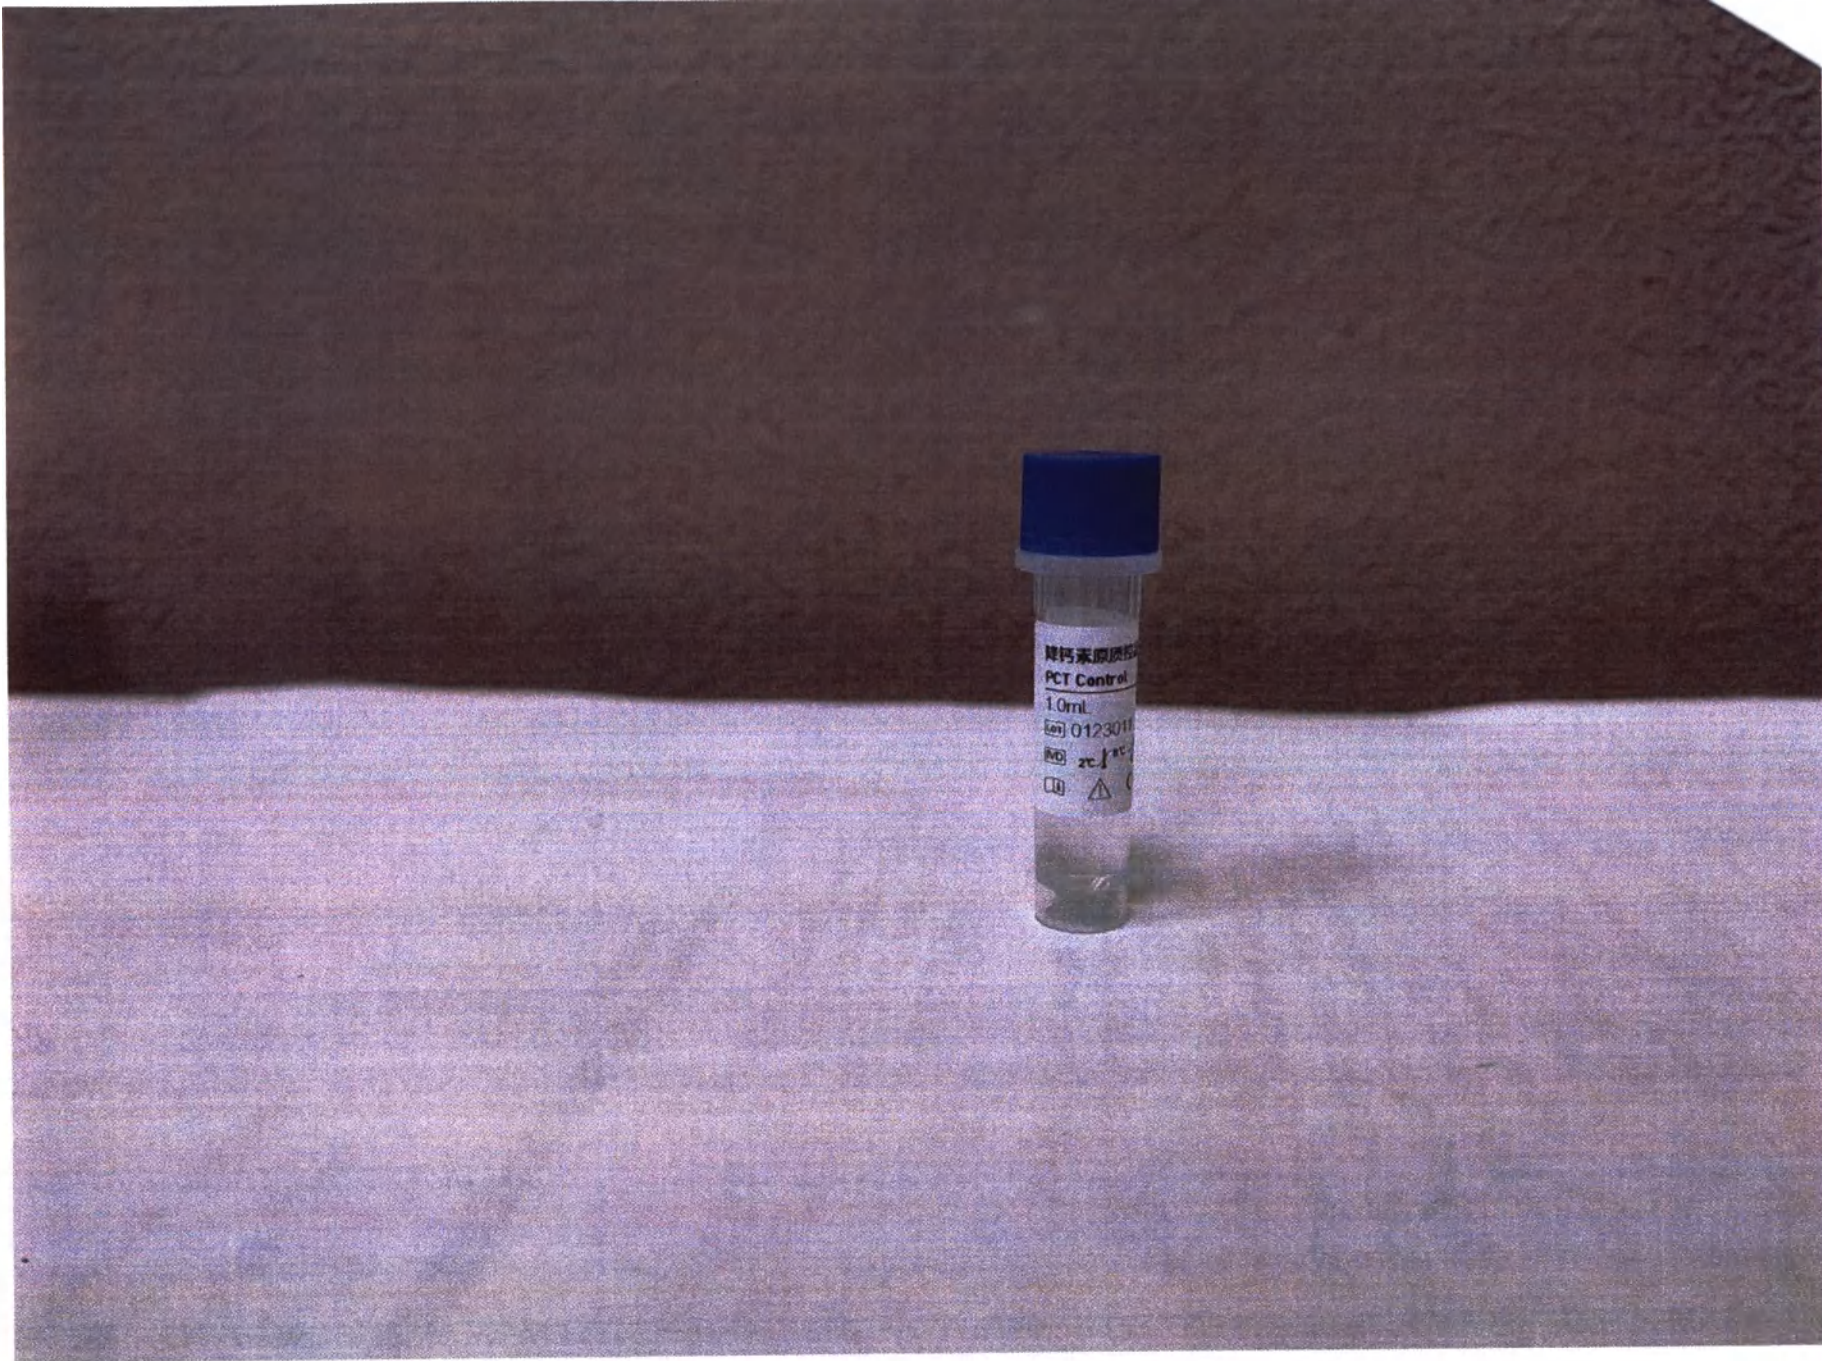

Пробирка, содержащая «Материал контрольный 2 (Level 2)» - сторона 1.

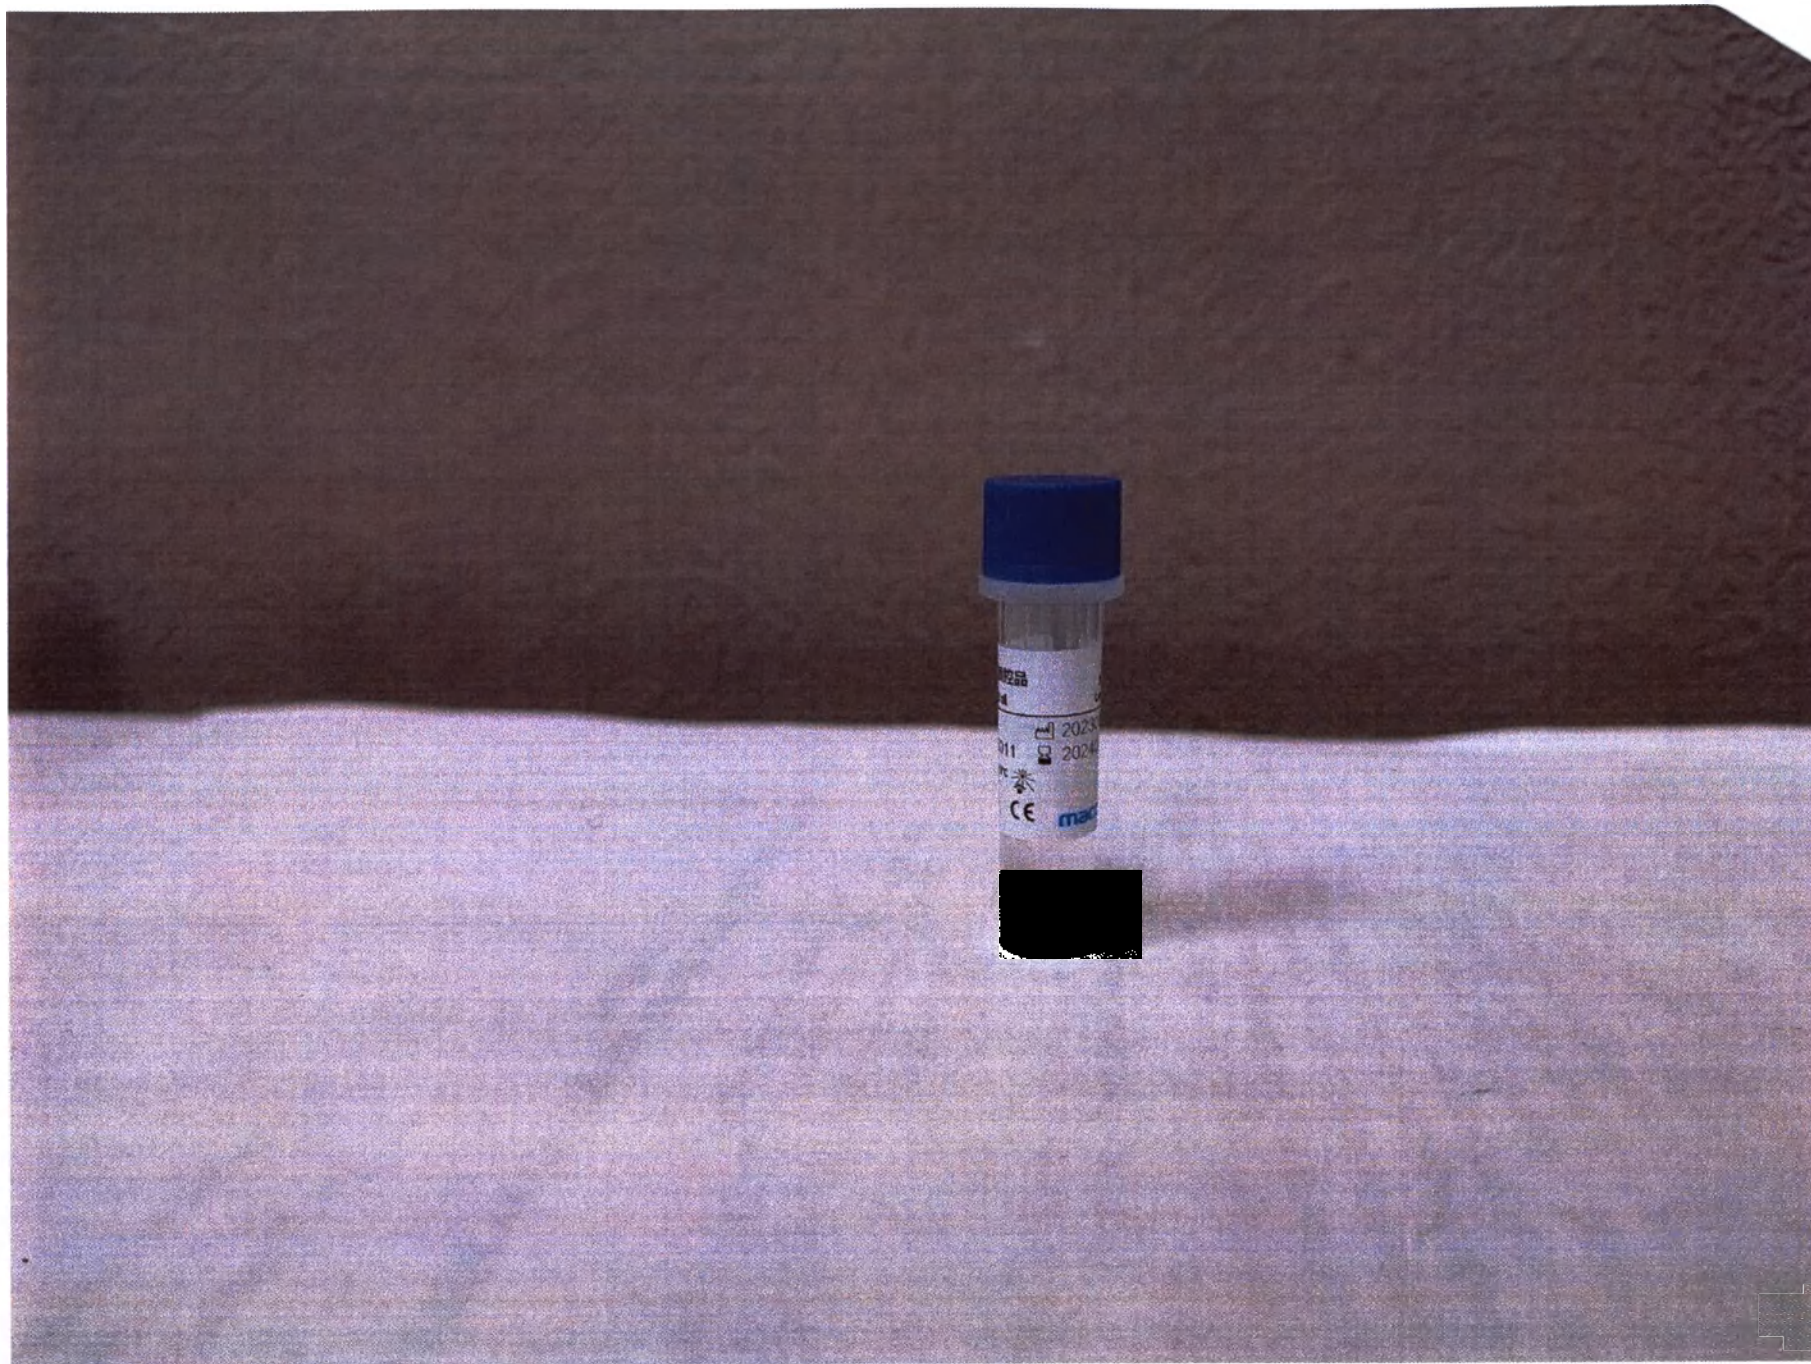

Пробирка, содержащая «Материал контрольный 2 (Level 2)» - сторона 2.

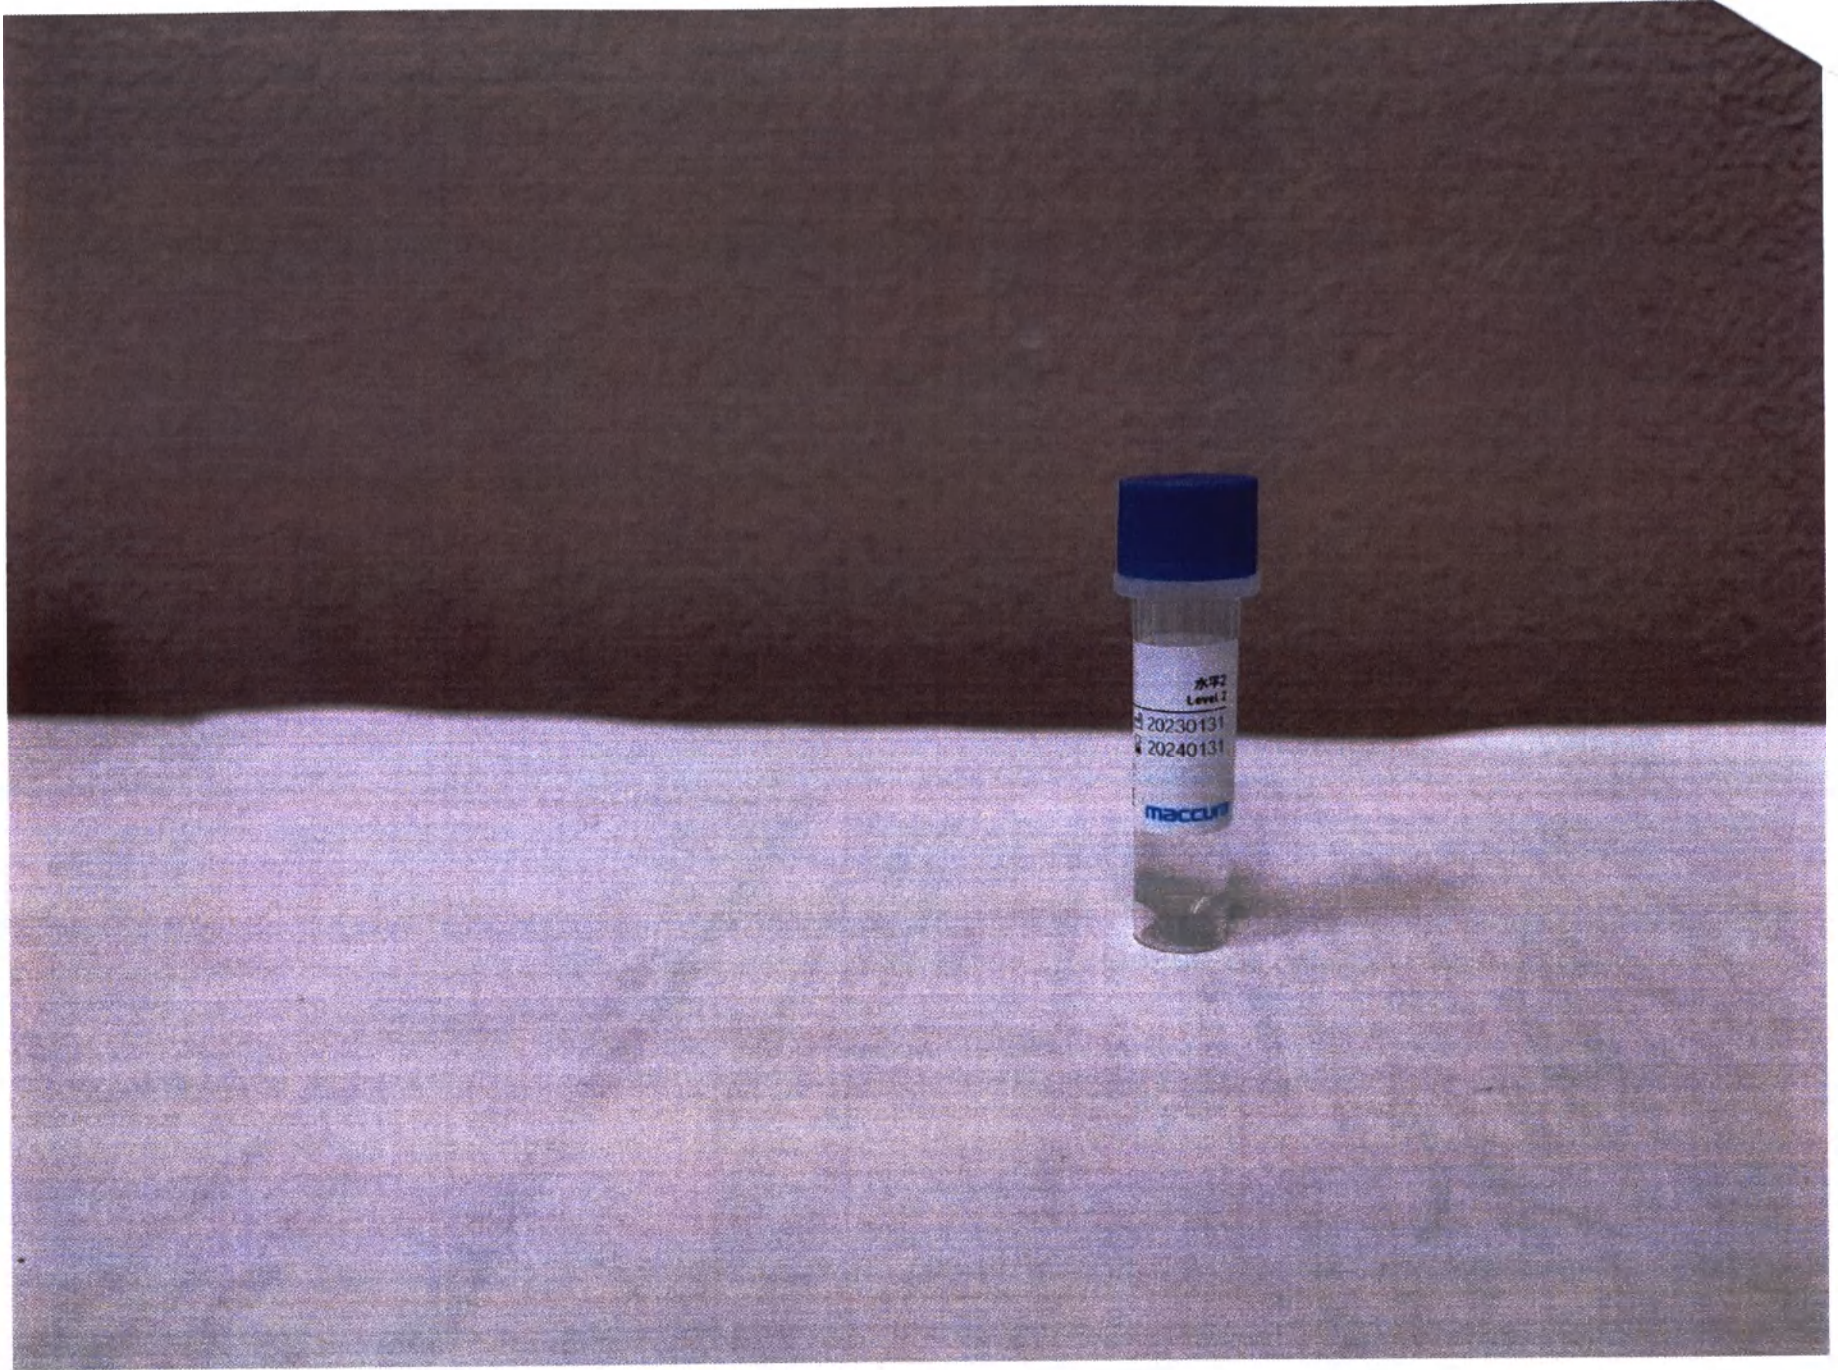

Пробирка, содержащая «Материал контрольный 2 (Level 2)» - сторона 3.



