


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов

**производства Maccura Biotechnology Co.,Ltd., 16#, Baichuan Road,Hi-tech
Zone, 611731 Chengdu, People's Republic of China**



Общий вид МИ «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов»

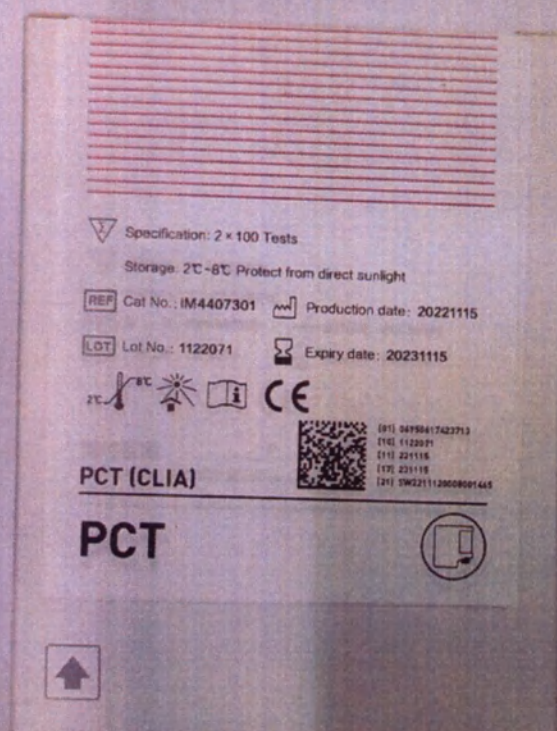

Вторичная упаковка (картонная коробка) вид спереди «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов»



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура і (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов»

迈克生物股份有限公司
住所/生产地址: 成都市高新区百川路16号
电话: + 86 28 8782 6777
传真: + 86 28 8782 5783
邮编: 611731
邮箱: maccura@maccura.com




Maccura Biotechnology Co., Ltd.
Add: 16#, Baichuan Road, Hi-tech Zone, 611731
Chengdu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86 28 8782 6777
Fax: +86 28 8782 5783
E-mail: maccura@maccura.com


www.maccura.com



Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сзади «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов»

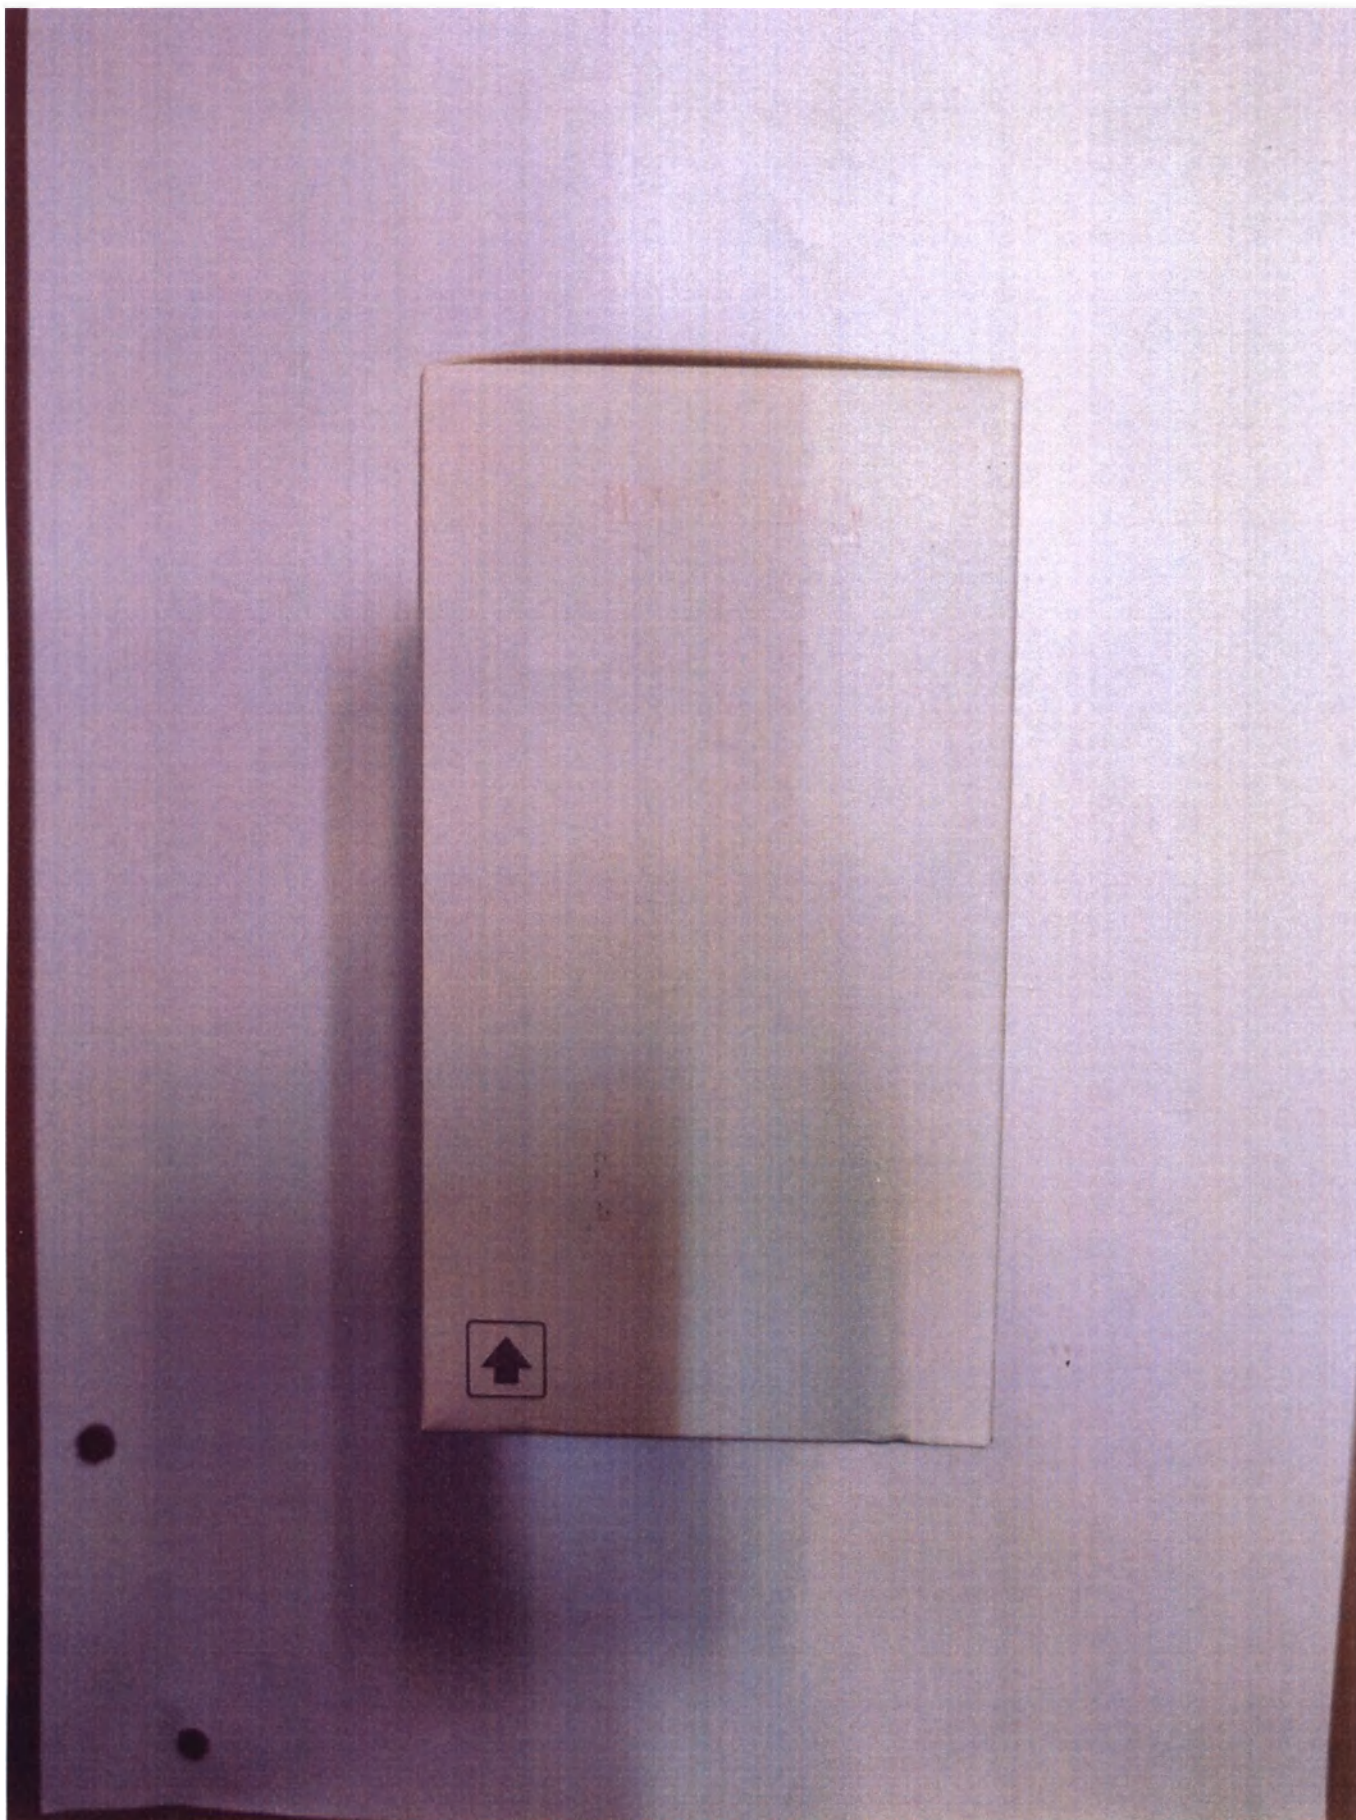


Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сбоку «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Масскура і (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов»

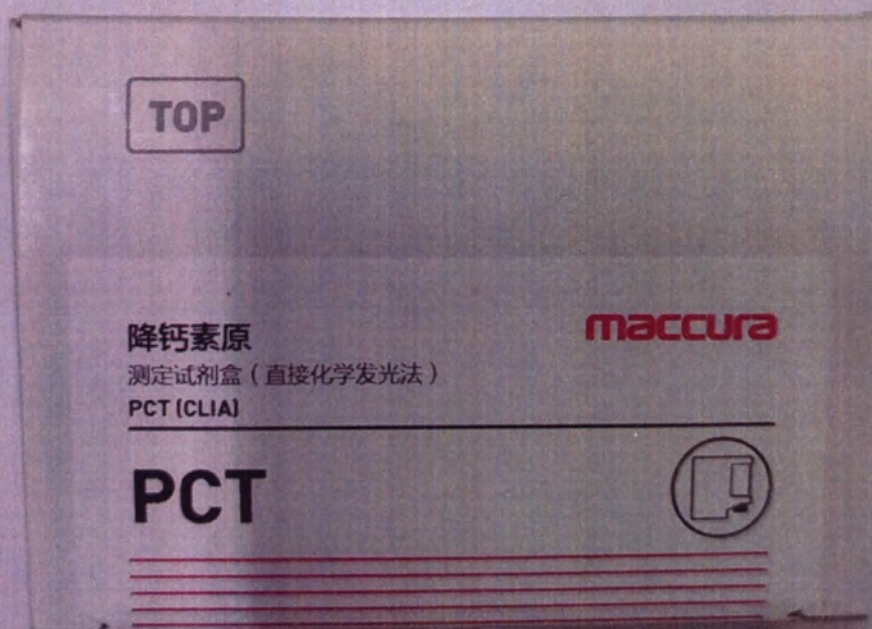

Вторичная упаковка (картонная коробка) вид сверху «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов»



Внешний вид Картриджа с реагентом R1, R2 «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Maccura i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов»

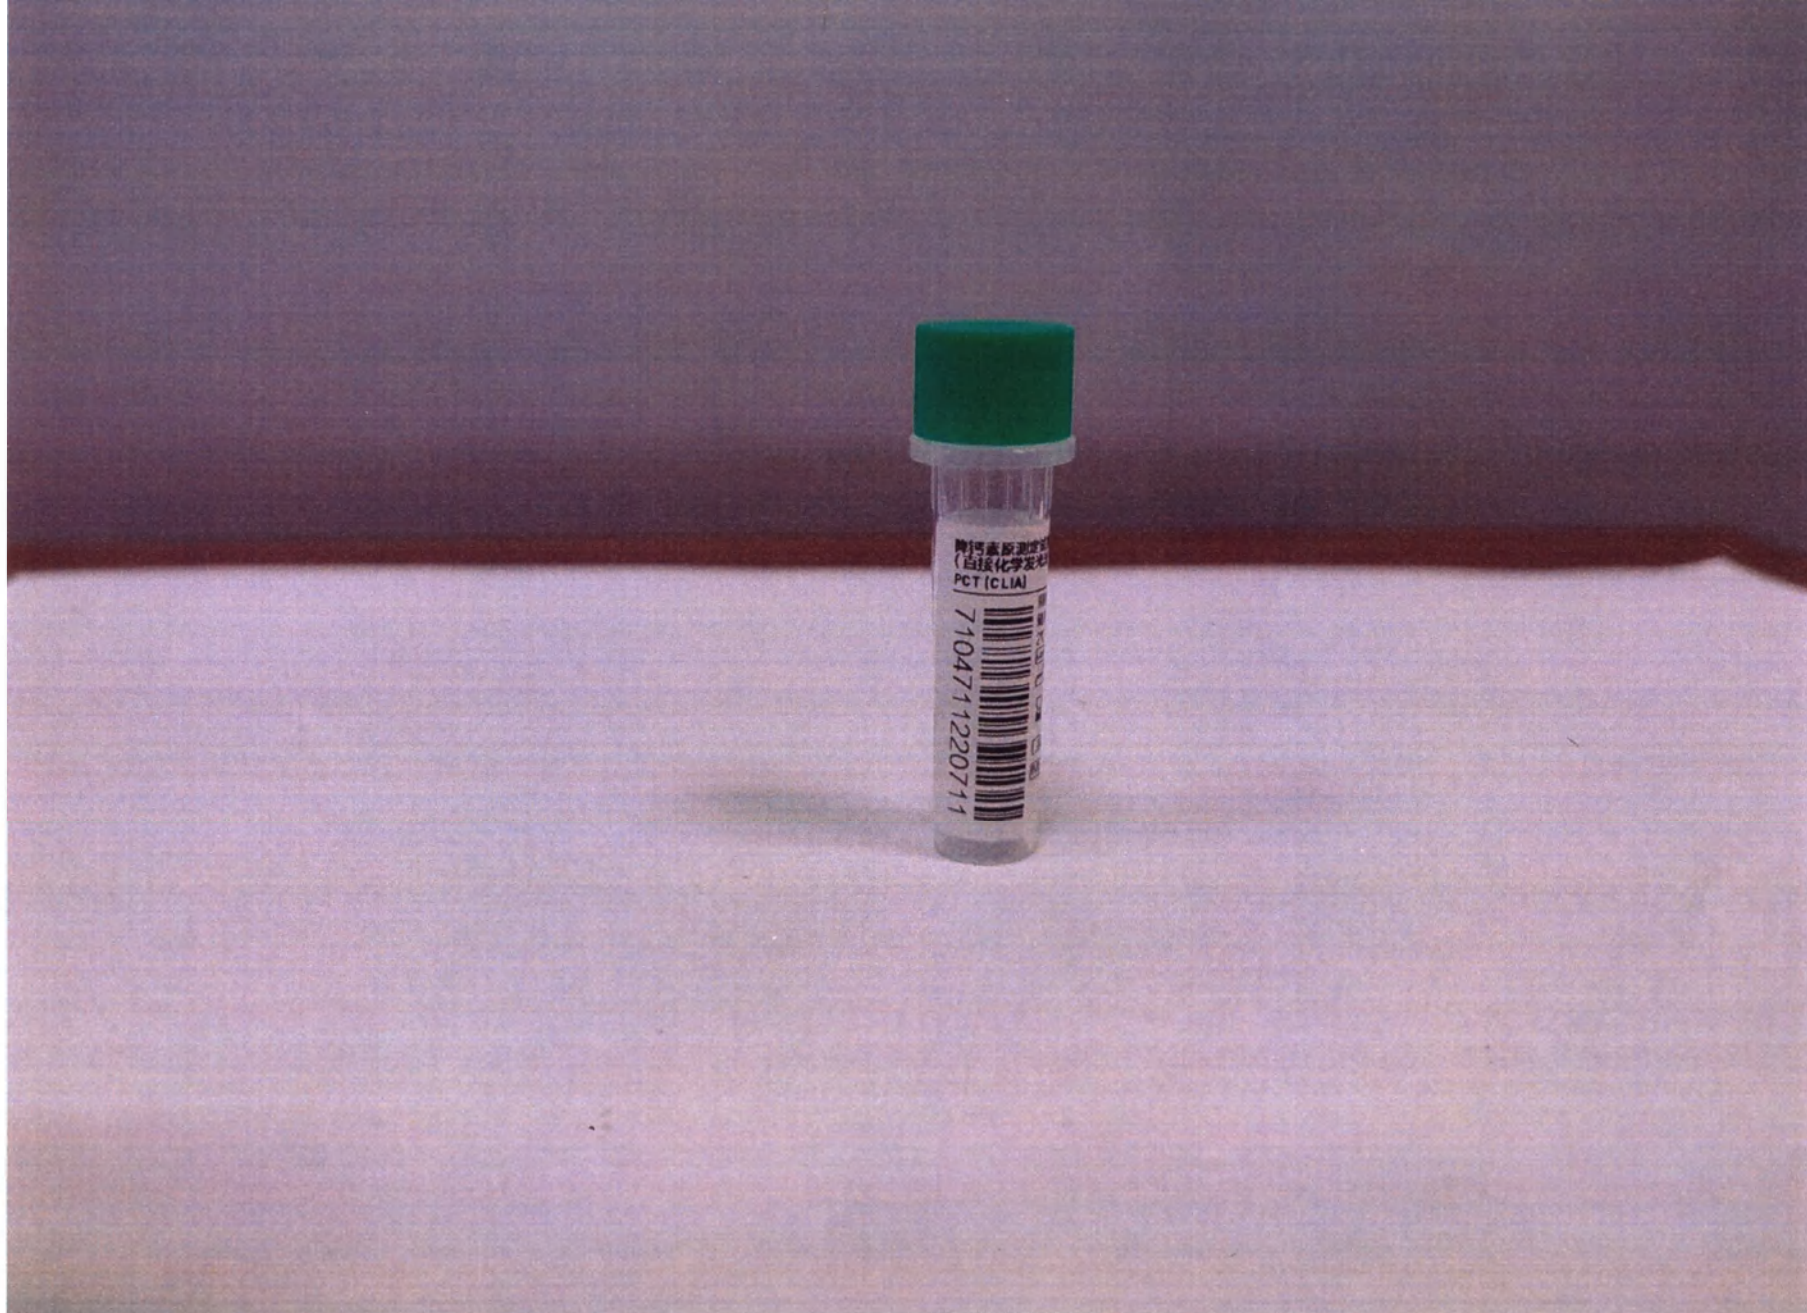


Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Massura i (PCT (CLIA))», набор на 200 тестов», сторона 1




Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2



Внешний вид пробирки Калибратора 1 (Cal 1) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Масскура i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3

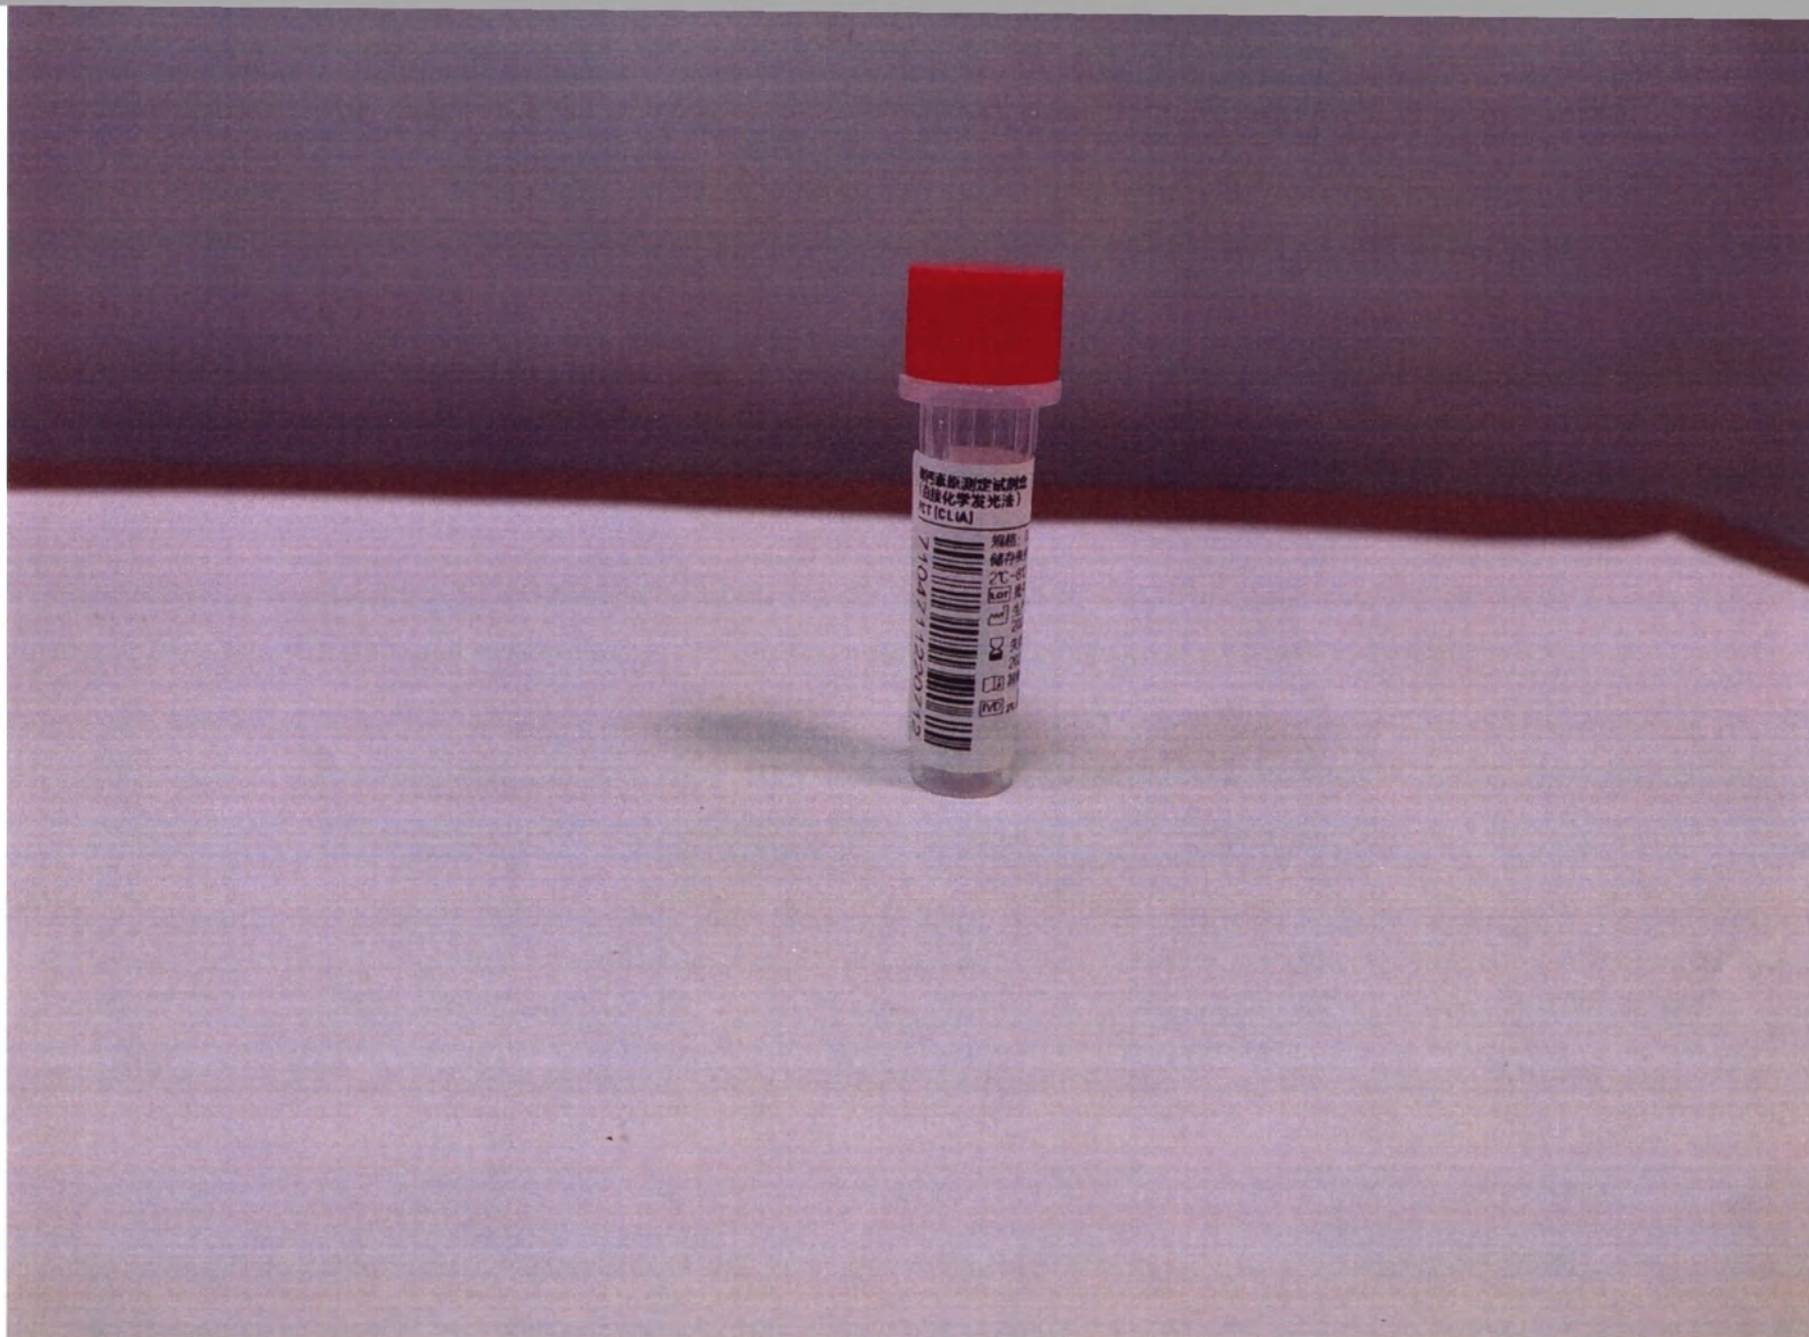

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Massura i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 1

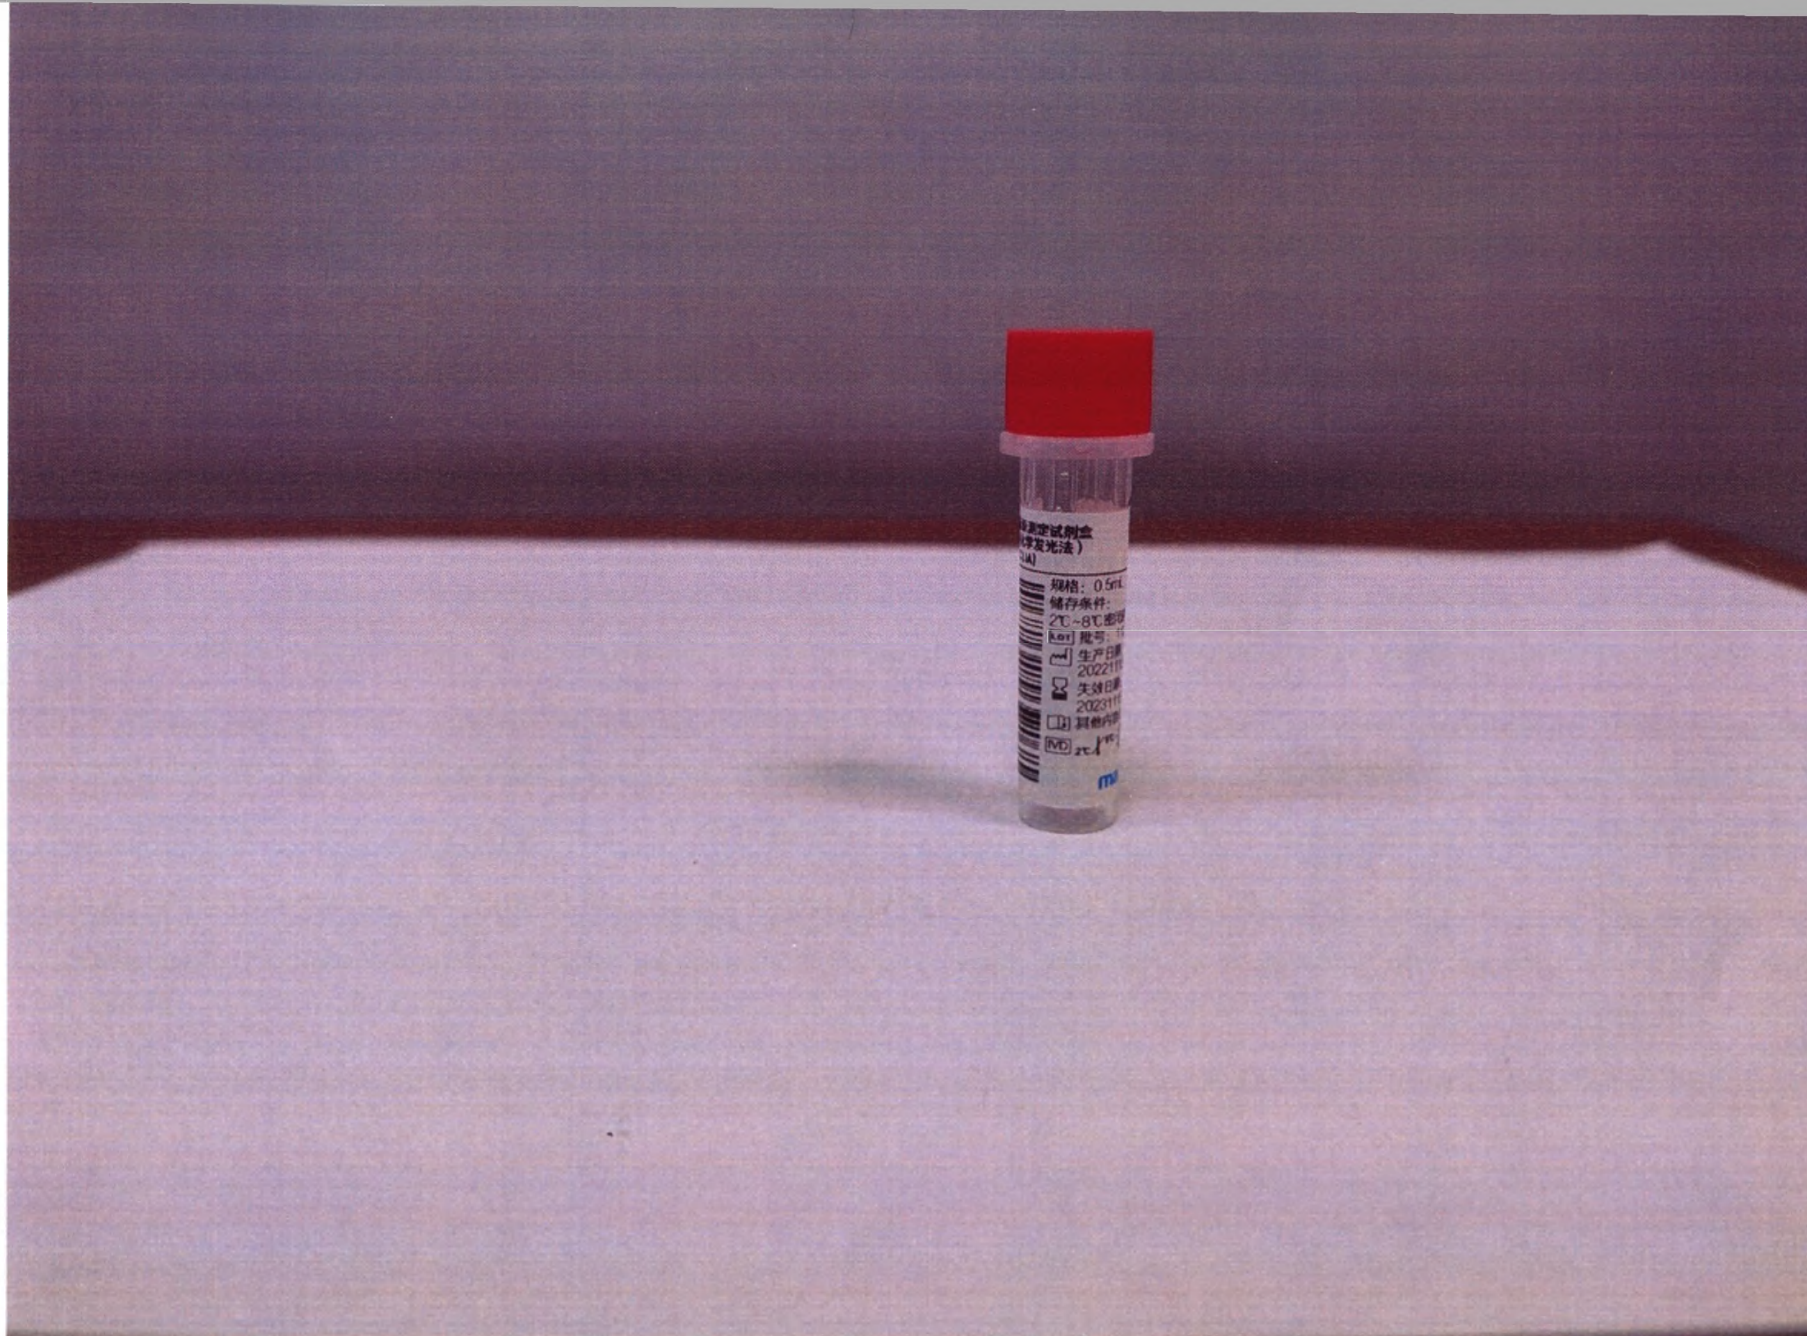

Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 2



Внешний вид пробирки Калибратора 2 (Cal 2) «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массира i (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов», сторона 3



Внешний вид Инструмента для вскрытия картриджа «Набор реагентов и калибраторов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах Массура і (PCT (CLIA)), набор на 200 тестов»



Фото транспортной упаковки

Всего прошнуровано _____
пронумеровано _____
печатью _____
Р.К. Мельниченко
Директор ООО «Совпром»

