

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НПФ СИНТОЛ»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ Синтол»
А.В. Кузубов
«20» августа 2023 г.



НАБОР МАРКИРОВОК

На медицинское изделие для диагностики ин витро
«Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий
туберкулезного комплекса (МБТК) и нетуберкулезных микобактерий
(НТМБ), а также дифференциальной диагностики видов НТМБ методом
полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ)
«Амплитуб-НТМБ- дифференциация»

Маркировку медицинского изделия для диагностики ин витро (МИ
ИВД) набора реагентов «Амплитуб-НТМБ-дифференциация» осуществляют в
соответствии с ГОСТ Р 51088-2013 и ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020.

Этикетки отпечатывают при помощи УФ плоттер-каттера Mimaki
USJV300-160 с использованием графического редактора Adobe illustrator и
оформляют в соответствии с рисунками 1-5.

На этикетке компонентов набора «Реакционная смесь в стрипованных
микропробирках, РС-Р НТМБ-Дифф» и «Реакционная смесь, содержащая
положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ в стрипованных
микропробирках, ПКО-МБТК-НТМБ» указывают:

- сокращенное название или логотип предприятия-изготовителя
(«Синтол»);
- сокращенное название набора реагентов;
- полное и/или сокращенное название компонента;
- объем компонента;

- символ «Код партии» с указанием номера серии;
- символ «Использовать до» с указанием срока годности (месяц, год);
- символ «Номер по каталогу» с указанием номера по каталогу;
- символ «Температурный диапазон» с указанием условий хранения;
- флуорофоры, используемые для детекции;
- символ «IVD».

На этикетке компонента набора «Деионизированная вода, dd H₂O» указывают:

- сокращенное название предприятия-изготовителя или логотип («Синтол»);
- сокращенное название набора реагентов;
- сокращенное название компонента «dd H₂O»;
- объем компонента;
- символ «Код партии» с указанием номера серии;
- символ «Номер по каталогу» с указанием номера по каталогу;
- символ «Температурный диапазон» с указанием условий хранения;
- надпись «Только для диагностики ин витро»;

Реагенты для проведения мультиплексной ПЦР-РВ «Амплитуб-НТМБ-дифференциация»:

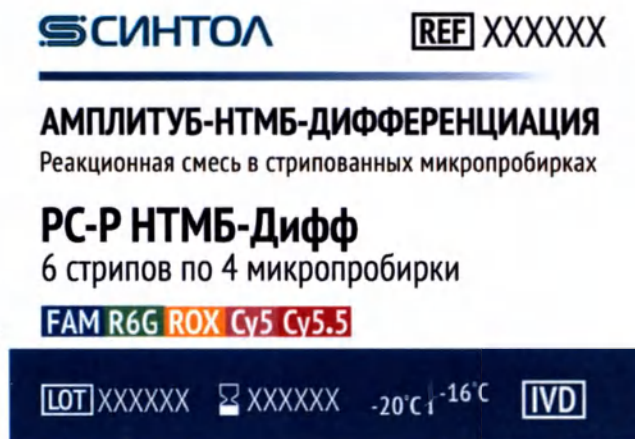


Рисунок 1 – Образец этикетки вакуумного пакета с РС-Р НТМБ-Дифф в стрипованных микропробирках

SCINTOL**REF** XXXXXX**АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь, содержащая положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ, в стрипованных микропробирках

ПКО-МБТК-НТМБ

6 стрипов по 4 микропробирки

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5**LOT** XXXXXX XXXXXX-20°C $\downarrow$ -16°C**IVD**

Рисунок 2 – Образец этикетки вакуумного пакета с ПКО МБТК-НТМБ в стрипованных микропробирках

SCINTOL**REF** XXXXXX

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

dd H₂O

Только для диагностики ин витро

1,7 мл -25°C $\downarrow$ 20°C**LOT** XXXXXX

Рисунок 3 – Образец этикетки пробирки с dd H₂O

На этикетке набора реагентов указывают:

- сокращенное название или логотип предприятия-изготовителя («Синтол»);
- символ «Изготовитель» и адрес предприятия-изготовителя;
- полное и сокращенное названия набора реагентов;
- состав набора;
- символ «IVD»;
- символ «Температурный диапазон» с указанием условий хранения;
- символ «Дата изготовления» с указанием даты изготовления (месяц, год);
- символ «Использовать до» с указанием срока годности (месяц, год);
- символ «Код партии» с указанием номера серии;
- символ «Номер по каталогу» с указанием номера по каталогу;
- символ «Содержимого достаточно для проведения n-количества тестов»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;

- номер технических условий;
- номер и дату регистрационного удостоверения;
- флуорофоры, используемые для детекции;
- надпись «Для профессионального применения».

SCINTOL

REF XXXXXX

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) и нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), а также дифференциальной диагностики видов НТМБ методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Амплитуб-НТМБ-дифференциация»

Реакционная смесь в стрипованных микропробирках, РС-Р НТМБ-Дифф	0,005 мл	10 упаковок по 6 стрипов по 4 микропробирки
Реакционная смесь, содержащая положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ в стрипованных микропробирках, ПКО-МБТК-НТМБ	0,005 мл	2 упаковки по 6 стрипов по 4 микропробирки
Деионизированная вода, dd H ₂ O	1,7 мл	2 пробирки
Инструкция по применению	-	1 штука
Паспорт качества	-	1 штука

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT
XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

-20°C

-16°C

IVD

Σ₉₆

i

ООО «НПФ Синтол»
Российская Федерация, 125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 39, корп. 1, пом.1 ком.43/РМ 12-3
email: syntol@syntol.ru www.syntol.ru

Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-005-97313483-2022
№ РЗН

Рисунок 4 – Образец этикетки ПЭТ-МЭТ¹ дой-пак пакет реагентов для проведения мультиплексной ПЦР-РВ «Амплитуб- НТМБ-дифференциация»

На каждый ящик транспортной тары должна быть наклеена этикетка из бумаги этикеточной (ГОСТ 7625-86) или бумаги писчей (ГОСТ 18510-87) с указанием:

- наименования и адреса предприятия-изготовителя;
- названия набора;
- количества наборов;
- символа «Дата изготовления» с указанием даты изготовления (месяц, год);
- символа «Использовать до» с указанием срока годности (месяц, год);
- символа «Код партии» с указанием номера серии;

¹ ПЭТ-МЭТ - представляет собой полиэфирную пленку, металлизированную алюминиевой пудрой, размер 170 *300, ZipPack, Россия

- требования к условиям хранения и транспортирования (манипуляционные знаки «Хрупкое, обращаться осторожно», «Беречь от влаги» (ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014);
- символа «Температурный диапазон»;
- массы нетто потребительской упаковки;
- массы нетто;
- массы брутто.

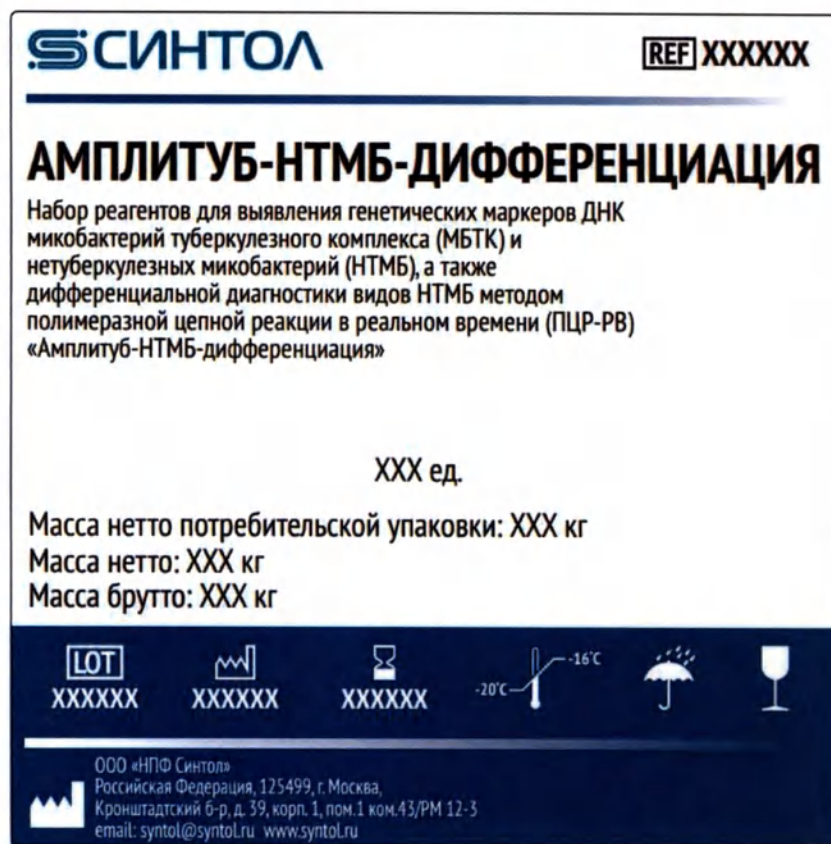


Рисунок 5 – Образец этикетки транспортной тары МИ ИВД «Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) и нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), а также дифференциальной диагностики видов НТМБ методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Амплитуб-НТМБ- дифференциация»

Прошито, пронумеровано,
проброшюровано 5 листов

Генеральный директор
ООО «НПФ Синтол»

А.В.Кузубов



SCINTOL

REF OM-700

АМПИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) и неферментных микобактерий (НТМБ), а также дифференциальной диагностики видов НТМБ методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Ампитуб-НТМБ-дифференциация»

Реакционная смесь в стрипованных микропробирках,	0,005 мл	10 упаковок по 6 стрипов по 4 микропробирки
Реакционная смесь, содержащая положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ в стрипованных микропробирках,	0,005 мл	2 упаковки по 6 стрипов по 4 микропробирки
ПКО-МБТК-НТМБ	1,7 мл	2 пробирки
Демонстрируемая вода, dd H ₂ O	-	1 штука
Инструкция по применению	-	1 штука
Паспорт качества		

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT 100823 08.2023 08.2024 -20°C -16°C IVD 96 i

ООО «НПО Синтол»
Российская Федерация, 125499, г. Москва,
Кронштадтский в-р, д. 39, корп. 1, пом. 1 ком. 43/РМ 12-3
email: syntol@syntol.ru www.syntol.ru

Для профессионального применения
ТУ 21.70.23-005-97313483-2022
№ РЗН

№ 1

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А.В.



СИНТОЛ

REF XXXXXX

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) и нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), а также дифференциальной диагностики видов НТМБ методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Амплитуб-НТМБ-дифференциация»

Реакционная смесь в стрипованных микропробирках,	0,005 мл	10 упаковок по 6 стрипов по 4 микропробирки
РК-НТМБ-Дифф		
Реакционная смесь, содержащая положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ в стрипованных микропробирках,	0,005 мл	2 упаковки по 6 стрипов по 4 микропробирки
ПКО-МБТК-НТМБ		
Демонстрируемая вода, dd H ₂ O	1,7 мл	2 пробирки
Инструкция по применению	-	1 штука
Паспорт качества	-	1 штука

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT
XXXXXX

XX.XXXX

XX.XXXX

-20°C

-16°C

IVD

96

i

ООО «НПО Синтол»
Российская Федерация, 125499, г. Москва,
Кронштадтский б-р, д. 39, корп. 1, пом. 1 ком. 43/РМ 12-3
email: syntol@syntol.ru www.syntol.ru

Для профессионального применения
ТУ 21.10.23-005-97313483-2022
№ РЗН

N2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А.В.



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Москва, 125499, Косыгинский бульвар, д.39, к.1
Тел: (499) 977-74-55 e-mail: info@cirmi.ru

ООО «НПФ Синтола»
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
«Амплитуб-НТМБ - дифференциация»

Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) и нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), а также дифференциальной диагностики видов НТМБ методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Амплитуб-НТМБ-дифференциация»

LOT XXXXXX Наборов в серии 30 Дата изготовления XX.XXXX

1. Состав, внешний вид

Наименование компонента	Характеристика и нормы	Результаты контроля	В составе
Реакционная смесь в стриповых микропробирках, РС-Р НТМБ-Дифф	Лизофильный концентрат от светло-розового до светло-сиреневого цвета, 0,005 мл	соответствует	00 стрипов по 4 микропробирки
Реакционная смесь, содержащая положительный контрольный образец ДНК МБТК и ДНК НТМБ, в стриповых микропробирках, ПК-МБТК-НТМБ	Лизофильный концентрат от светло-розового до светло-сиреневого цвета, 0,005 мл	соответствует	12 стрипов по 4 микропробирки
Демонстрационная вода, ДВНД	Прозрачная бесцветная жидкость, 1,7 мл	соответствует	2
Инструкция			
Паспорт качества			

2. Технические характеристики

Наименование показателя	Характеристика
Положительный результат ПЦР-РВ	Зарегистрирован рост сигнала с ПК-МБТК-НТМБ по каналу ОКО и РС-Р НТМБ-Дифф не Остутствует рост сигнала с образца ОКО и РС-Р НТМБ-Д
Отрицательный результат ПЦР-РВ	Остутствует рост сигнала с образца ОКО и РС-Р НТМБ-Д Остутствует рост сигнала с контрольного образца ОКО и РС-Р НТМБ-Д
Аналитическая чувствительность	Зарегистрирован рост сигнала с образцами, содержащими ДНК МБТК по каналу FAM, HE

Заключение ОБТК: «Набор реагентов для выявления туберкулезного комплекса (МБТК) и нетуберкулезных микобактерий (НТМБ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-РВ) «Амплитуб-НТМБ-дифференциация» серии LOT XXXXXX по своим показателям документации»

Годен до: XX.XXXX

Условия транспортирования: крытым транспортом (автомобильным) при температуре от минус 16 до минус 20 °С с использованием одноразового пользования, содержащих многократного применения с автоматическим поддержанием температуры. Допускается транспортирование в жесткой таре при температуре от минус 16 до минус 20 °С с использованием одноразового пользования.

Условия хранения: хранить при температуре от минус 16 до минус 20 °С в защищенной от света (использовать фольгу). Срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления. Срок годности: не более 12 месяцев с даты изготовления.

Начальник отдела ОБТК
С.В. Боровиков

Медицинским издательством для диагностики in vitro

Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) и нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), а также дифференциальной диагностики видов НТМБ методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Амплитуб-НТМБ - дифференциация»

ИНСТРУКЦИЯ по применению

2023

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Набор реагентов для выявления генетических маркеров ДНК микобактерий туберкулезного комплекса (МБТК) и нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), а также дифференциальной диагностики видов НТМБ методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Амплитуб-НТМБ-дифференциация»

Назначение: смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

Лизофильный концентрат от светло-розового до светло-сиреневого цвета, 0,005 мл

ПК-МБТК-НТМБ

Лизофильный концентрат от светло-розового до светло-сиреневого цвета, 0,005 мл

Демонстрационная вода, ДВНД

Прозрачная бесцветная жидкость, 1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

СИНТОЛА **АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ**

Реакционная смесь и стриповые микропробирки

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

ПК-МБТК-НТМБ

12 стрипов по 4 микропробирки

ДВНД

1,7 мл

Инструкция по применению

Паспорт качества

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А. В.



**КОПИЯ
ВЕРНА**

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

N4

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

СИНТОЛ

REF OM-700

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Реакционная смесь в стрипованных микропробирках

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT 100823

08.2024

-20°C -16°C

IVD



СИНТОЛ

REF XXXXXX

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Реакционная смесь в стрипованных микропробирках

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT XXXXXX

XX.XXXX

-20°C / -16°C

IVD

N 6.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

СИНТОЛ

[REF] OM-700

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Реакционная смесь, содержащая положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ, в стрипованных микропробирках

ПКО-МБТК-НТМБ

6 стрипов по 4 микропробирки

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

[LOT] 100823

08.2024

-20°C -16°C

[IVD]

№ 7

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Кузубов А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

СИНТОЛ

REF XXXXXX

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Реакционная смесь, содержащая положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ, в стрипованных микропробирках

ПКО-МБТК-НТМБ

6 стрипов по 4 микропробирки

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT XXXXXX

XX.XXXX



-20°C / -16°C

IVD

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А.В.



**КОПИЯ
ВЕРНА**

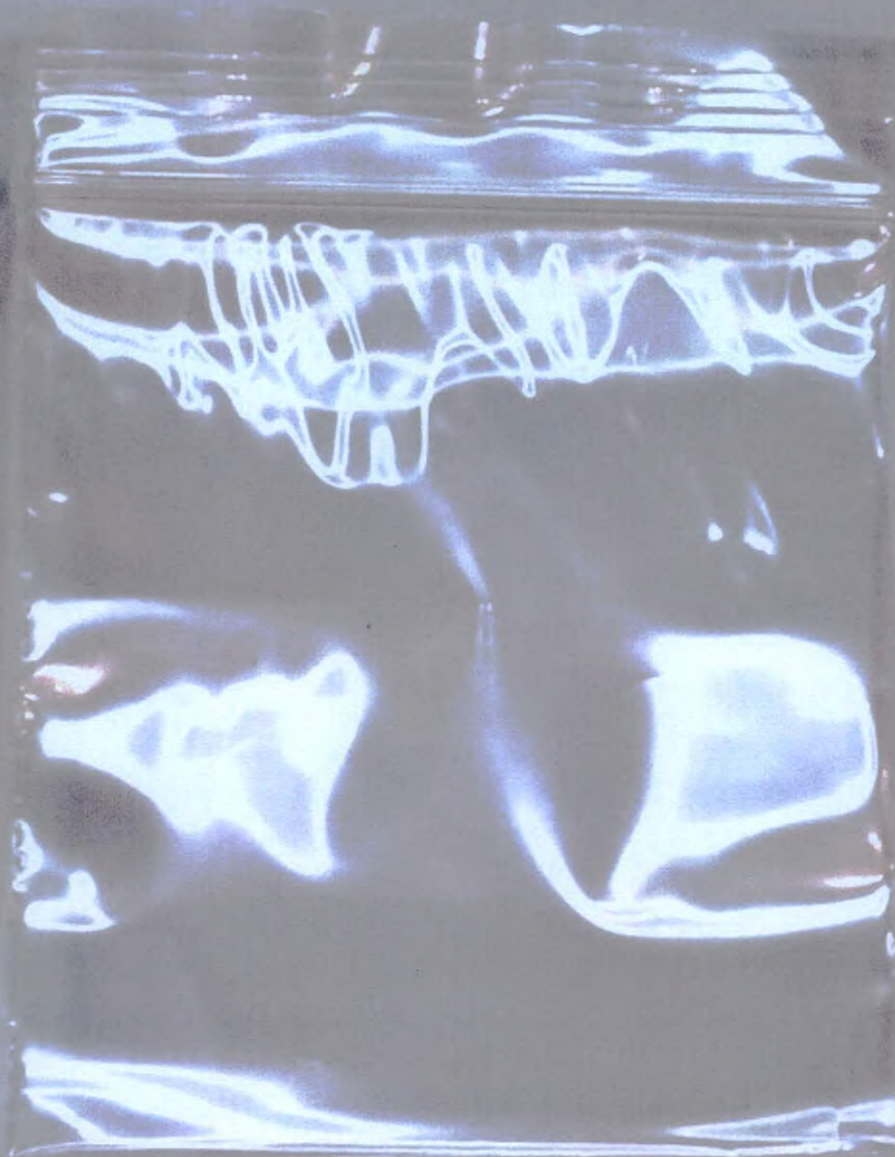
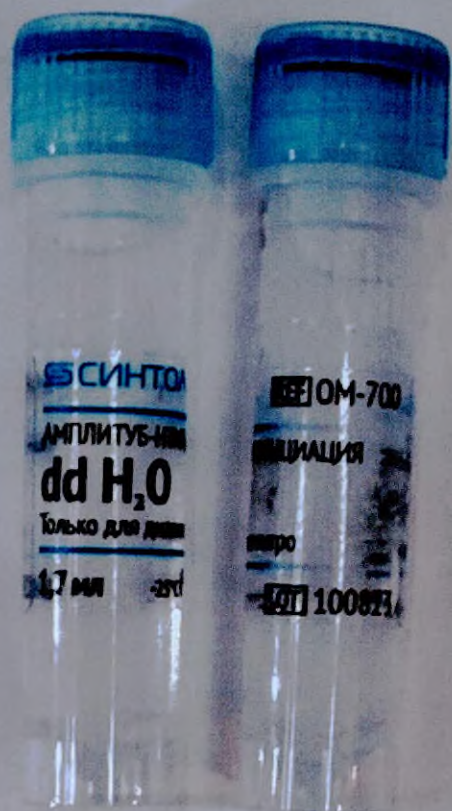


№ 9.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

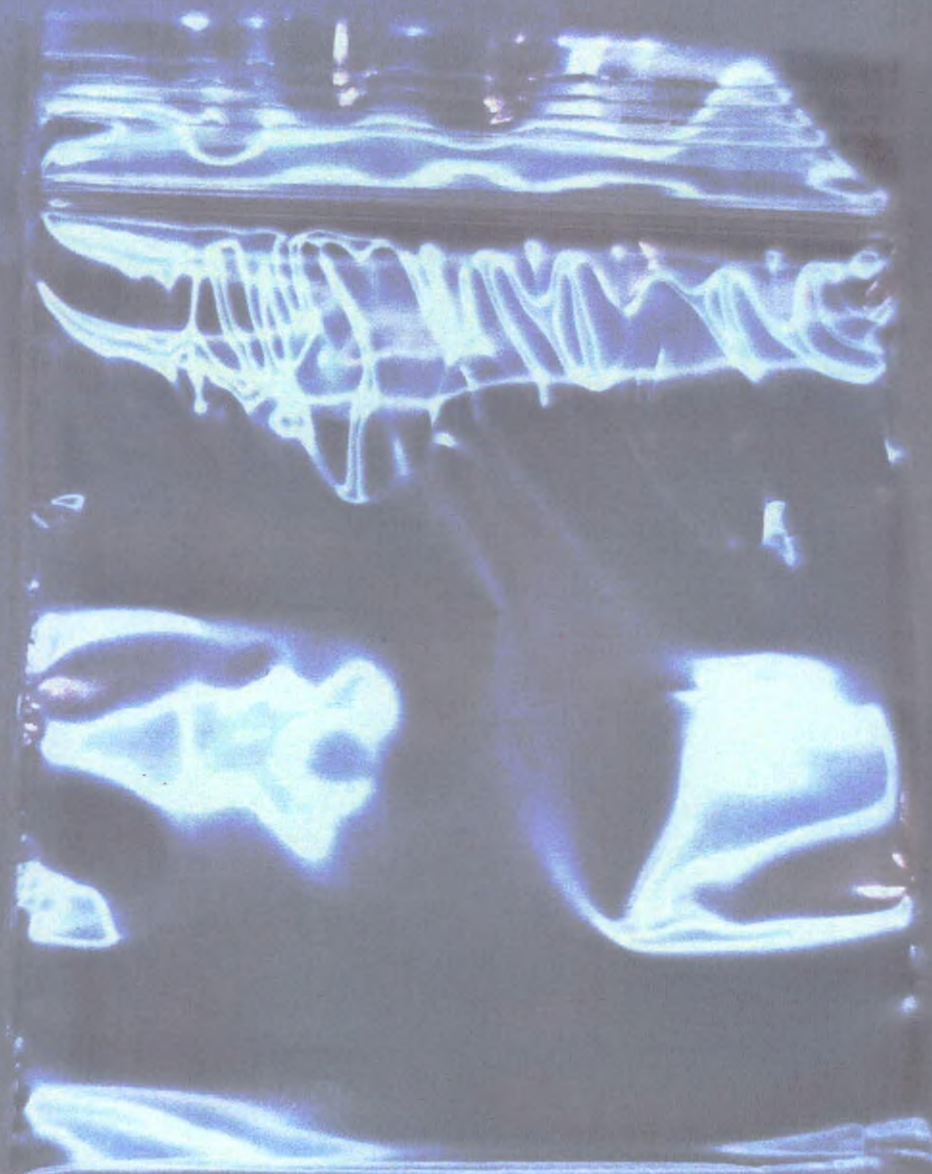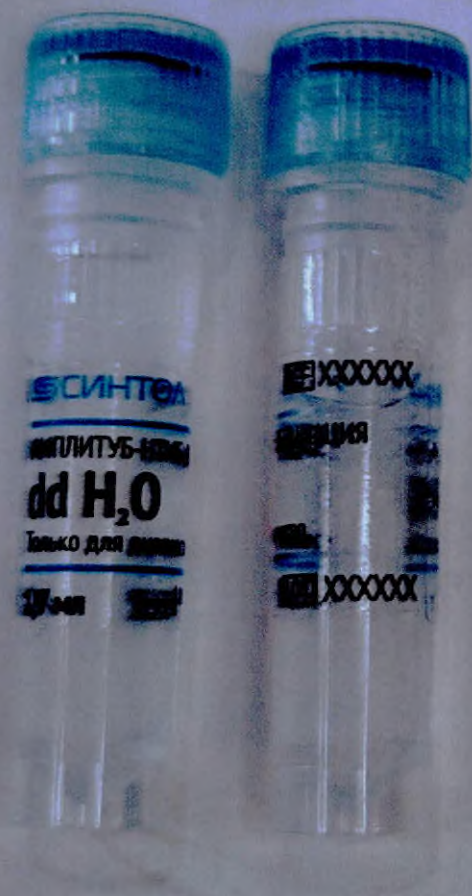

N10

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А. В.



СИНТОЛ

REF XXXXXX

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Реакционная смесь в стрипованных микропробирках

РС-Р НТМБ-Дифф

6 стрипов по 4 микропробирки

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT XXXXXX

XX.XXXX

-20°C / -16°C

IVD



№11

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ТУЗУБОВ А.В.



**КОПИЯ
ВЕРНА**



№12

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

СИНТОЛ

REF OM-700

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Реакционная смесь, содержащая положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ, в стрипованных микропробирках

ПКО-МБТК-НТМБ

6 стрипов по 4 микропробирки

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT 100823

08.2024

-20°C / -16°C

IVD



№13

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ЗУБОВ А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА

SCINTOL

REF XXXXXX

АМПЛИТУБ-НТМБ-ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Реакционная смесь, содержащая положительные контрольные образцы ДНК МБТК и НТМБ, в стрипованных микропробирках

ПКО-МБТК-НТМБ

6 стрипов по 4 микропробирки

FAM R6G ROX Cy5 Cy5.5

LOT XXXXXX

XX.XXXX

-20°C -16°C

IVD



N14

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
КУЗУБОВ А.В.



КОПИЯ
ВЕРНА