

Фотографические изображения медицинского изделия
«Анализатор автоматический иммуногематологический Neo Iris».



Анализатор автоматический иммуногематологический Neo Iris в составе:

1. Основной блок анализатора - 1 шт.
2. Центрифуга – 1 шт.
3. Штатив для пробирок пациентов Ø13, тип В – 8 шт.
4. Штатив для пробирок доноров Ø12, тип D – 2 шт.
5. Штатив для реагентов 12 x 24, тип R – 1 шт.
6. Штатив для реагентов 9 x 24, тип S – 2 шт.
7. Штатив для дилуентов 6 x 50 – 1 шт.
8. Контейнер для дилуента 50 мл – 6 шт.
9. Шкаф центрифуги – 1 шт.
10. Шкаф основного блока – 1 шт.
11. Винт для соединения шкафов – 4 шт.
12. Ключ шестигранный 5 мм – 1 шт.
13. Столик для установки монитора и клавиатуры – 1 шт.
14. Труба для крепления столика – 1 шт.
15. Проставка для установки трубы - 2 шт.
16. Винт для фиксации трубы - 2 шт.
17. Кольцо фиксирующее для столика – 1 шт.
18. Ограничитель расстояния для шкафа основного блока - 2 шт.
19. Подставка центрифуги – 1 шт.
20. Болты для фиксации центрифуги на подставке – 4 шт.
21. Ножки регулируемые для установки центрифуги на подставку – 4 шт.
22. Винты для фиксации подставки центрифуги к основному модулю – 2 шт.
23. Фильтр системного раствора – 2 шт.
24. Компакт-диск с файлами заводских настроек анализатора – 1 шт.
25. Приспособление для самопроверки раскапывателя – 1 шт.
26. Ключ для программного обеспечения Аврора – 1 шт.
27. Пружина T16124L – 1 шт.
28. Пружина T16265R – 1 шт.
29. Лоток для штативов – 1 шт.
30. Держатель микропланшета – 20 шт.
31. Штатив для держателей микропланшетов - 1 шт
32. Трубка для отходов – 1 шт
33. Кабель питания основного блока анализатора и центрифуги – 2 шт.
34. Кабель соединительный RS 232 – 1 шт.
35. Штатив для пробирок Ø16, тип А – 4 шт.
36. Штатив для пробирок Ø10-17 мм, тип С – 4 шт.
37. Штатив для пробирок Eppendorf Ø11 мм, тип Е – 1 шт.
38. Штатив для реагентов Ø43 мм, 5x43, тип Т – 1 шт.
39. Системный блок специального персонального компьютера – 1 шт.
40. Кабель питания специального персонального компьютера - 1 шт.
41. Компакт-диск для восстановления программного обеспечения анализатора – 1 шт.
42. Компакт-диск с программой Acronis – 1 шт.
43. Коробка с Компакт-диск с драйверами и платой расширения на 4 USB – 1 шт.
44. Инструкция по быстрой установке – 1 шт.
45. Клавиатура – 1 шт.
46. Кабель USB для клавиатуры – 1 шт.
47. Трекбол – 1 шт
48. Липучки – 2 шт.
49. Флуоресцентная лампа – 1 шт.
50. Набор предохранителей – 1 шт., в составе

1. Предохранитель 0.315 А, 5х20 мм – 1 шт.
2. Предохранитель 1 А, 5х20 мм – 2 шт.
3. Предохранитель 1.6 А/250 В, 5х20 мм – 2 шт.
4. Предохранитель 2 А/250 В, 5х20 мм – 2 шт.
5. Предохранитель 3.15 А – 5 шт.
6. Предохранитель 6.3 А – 2 шт.
7. Предохранитель 1.6 А, 7.4х3.1 мм – 2 шт.
8. Предохранитель 3 А/63 В, 7.4х3.1 мм – 2 шт.
9. Предохранитель 4 А, 5х20 мм – 2 шт.
10. Предохранитель 5 А, 6.3х32 мм – 2 шт.
51. Монитор сенсорный – 1 шт.
52. Видеокабель VGA – 1 шт.
53. Видеокабель DVI – 1 шт.
54. Кабель USB – 1 шт.
55. Аудиокабель – 1 шт.
56. Кабель питания монитора US – 1 шт.
57. Кабель питания монитора Euro – 1 шт.
58. Блок питания монитора - 1 шт.
59. Инструкция по быстрой установке монитора – 1 шт.
60. Компакт-диск с инструкцией по эксплуатации монитора – 1 шт.
61. Пластина для установки монитора – 1 шт.
62. Винты для фиксации пластины – 4 шт.
63. Считыватель штрих-кодов ручной – 1 шт.
64. Держатель считывателя штрих-кодов – 1 шт.
65. Кабель считывателя штрих-кодов – 1 шт.
66. Информационный вкладыш считывателя штрих-кодов – 1 шт.
67. Источник бесперебойного питания (ИБП) – 1 шт.
68. Кабель питания промежуточный – 2 шт.
69. Кабель RS 232 – 1 шт.
70. Кабель USB – 1 шт.
71. Вкладыш с информацией о безопасности ИБП – 1 шт.
72. Компакт-диск с документацией ИБП – 1 шт.
73. Компакт-диск с программным обеспечением ИБП – 1 шт.
74. Инструкция по установке ИБП – 1 шт.
75. Колодка питания на 6 розеток – 1 шт.
76. Кабель питания ИБП - 1 шт.
77. Принтер – 1 шт.
78. Кабель питания принтера UK – 1 шт.
79. Кабель питания принтера Euro – 1 шт.
80. Кабель принтера USB – 1 шт.
81. Компакт-диск с программным обеспечением принтера – 1 шт.
82. Инструкция по установке принтера – 1 шт.
83. Стартовый комплект расходных материалов
 1. Диспенсер для шариков – 2 шт.
 2. Шарика для перемешивания реагентов – 40 шт.
 3. Микропланшеты Галилео – 160 шт.
84. Канистра для системного раствора 22 л – 1 шт.
85. Канистра для системного раствора 10 л – 1 шт.
86. Канистра для отходов 10 л – 1 шт.
87. Канистра для слива отходов 10 л – 1 шт.
88. Клапан шприца – 1 шт.
89. Шприц насоса 1000 мкл – 1 шт.
90. Шприц насоса 500 мкл – 2 шт.

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия



II. Фотографические изображения состава медицинского изделия


1. Основной блок анализатора




2. Центрифуга



3. Штатив для пробирок пациентов Ø13, тип В

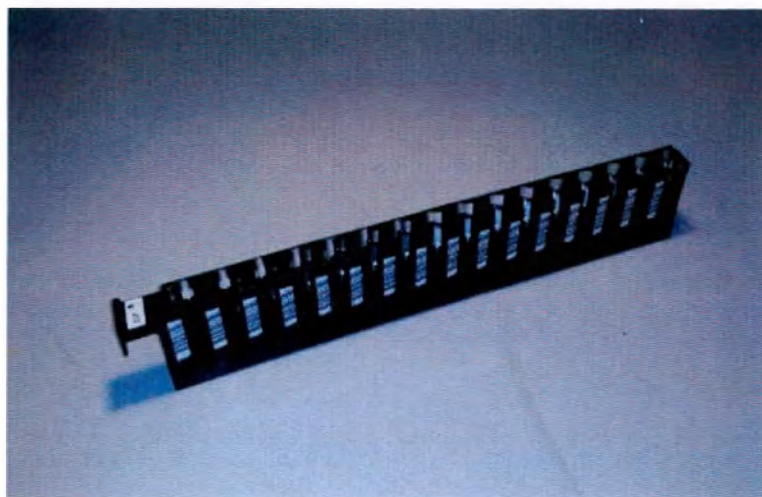


4. Штатив для пробирок доноров Ø12, тип D

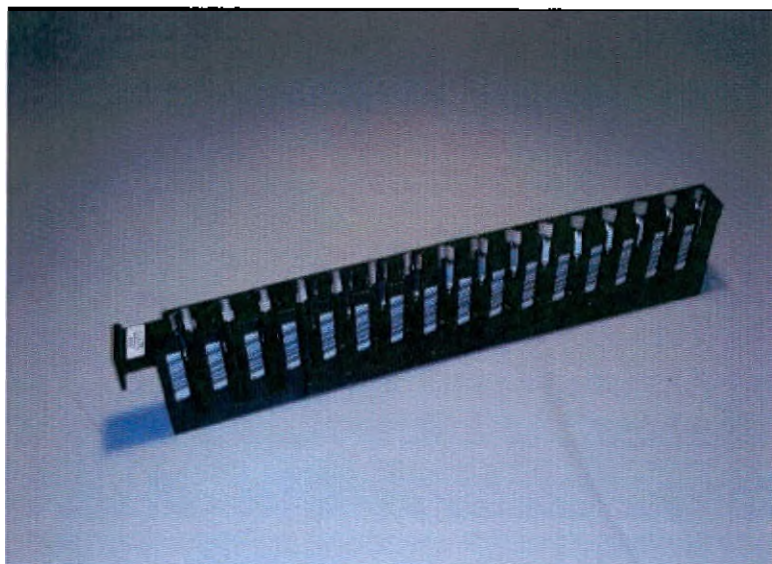


5. Штатив для реагентов 12 x 24, тип R (длина 388 мм)




6. Штатив для реагентов 9 x 24, тип S

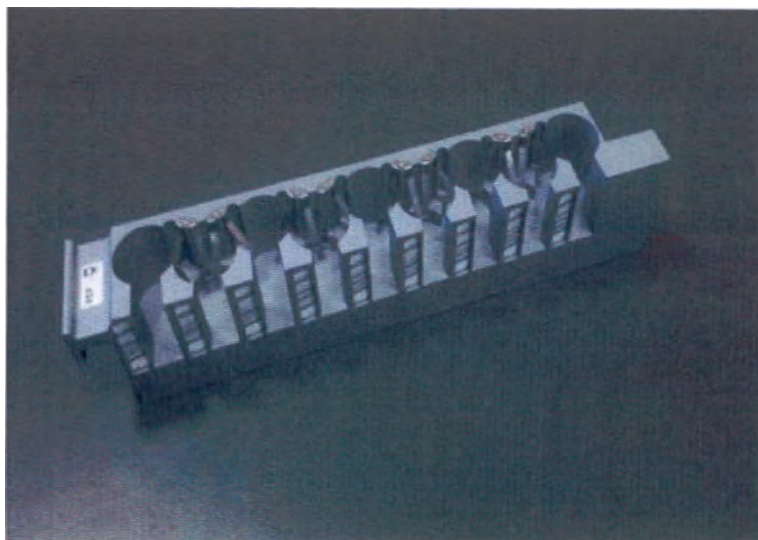

7. Штатив для дилюента 6 x 50

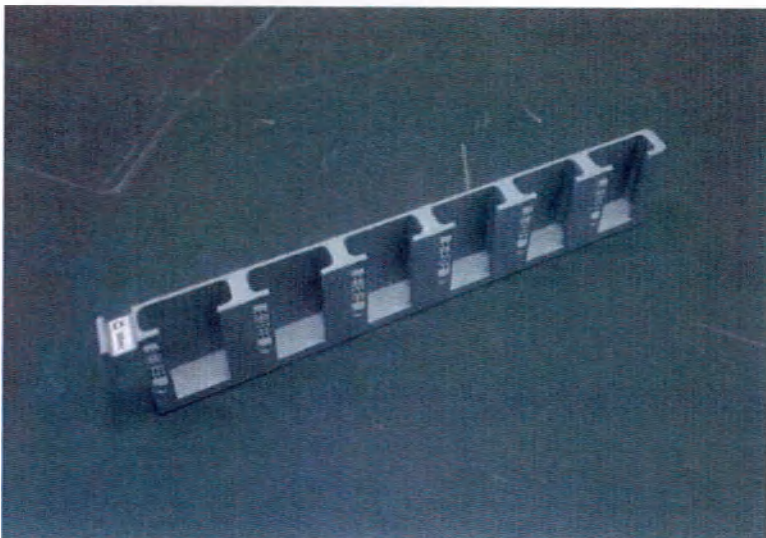

8. Контейнер для дилюента 50 мл

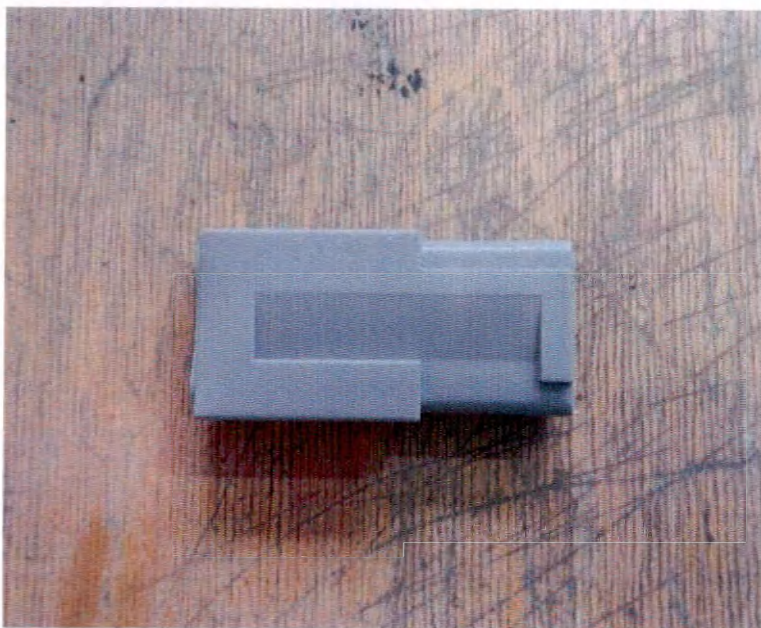

9. Шкаф центрифуги



10. Шкаф основного блока



11. Винт для соединения шкафов



12. Ключ Шестигранный 5 мм



13. Столик для установки монитора и клавиатуры



14. Труба для крепления столика



15. Проставка для установки трубы




16. Винт для фиксации трубы




17. Кольцо фиксирующее для столика



18. Ограничитель расстояния для шкафа основного блока

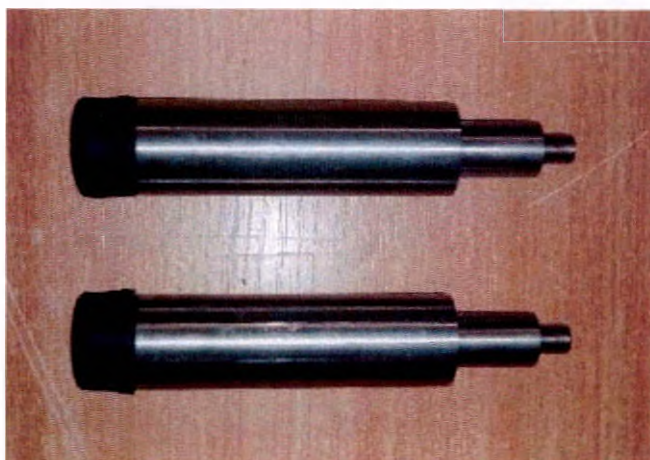


19. Подставка центрифуги

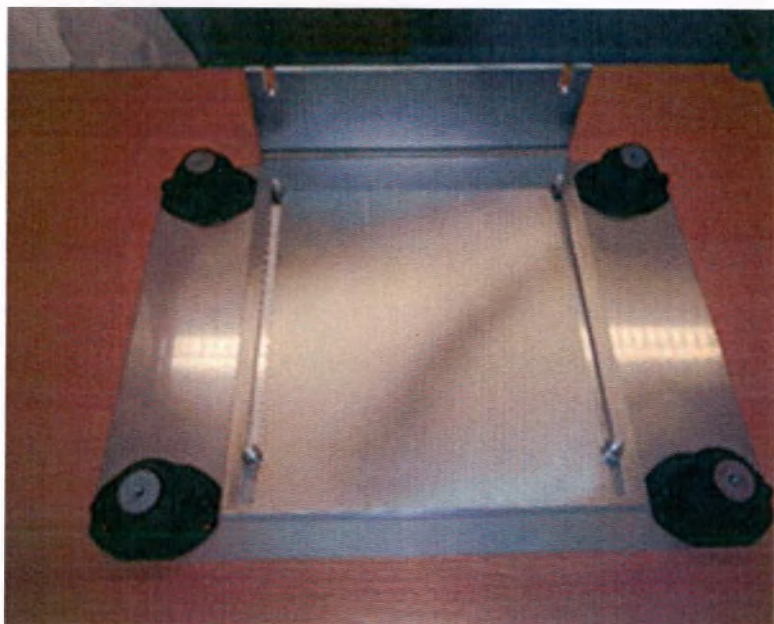

20. Болты для фиксации центрифуги на подставке



21. Ножки регулируемые для установки центрифуги на подставку

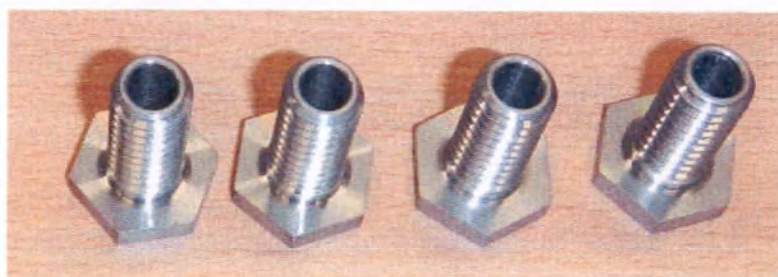

22. Винты для фиксации подставки центрифуги к основному модулю



23. Фильтр системного раствора



24. Компакт-диск с файлами заводских настроек анализатора




25. Приспособление для самопроверки раскапывателя




26. Ключ для программного обеспечения Аврора



27. Пружина T16265R

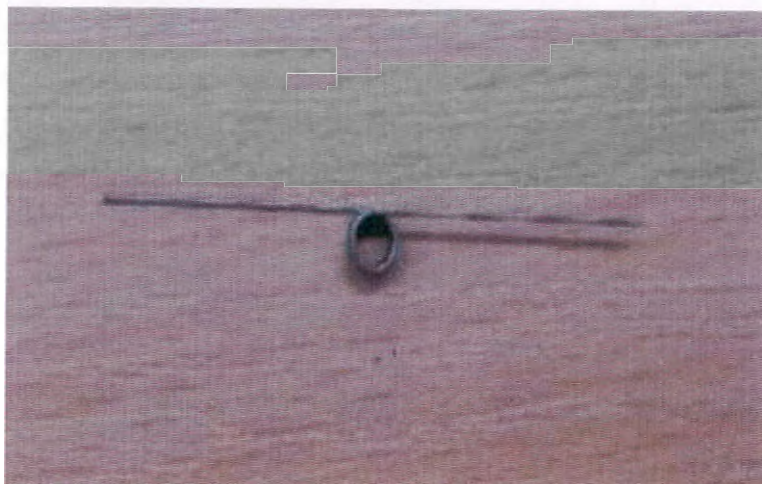


28. Пружина T16124L

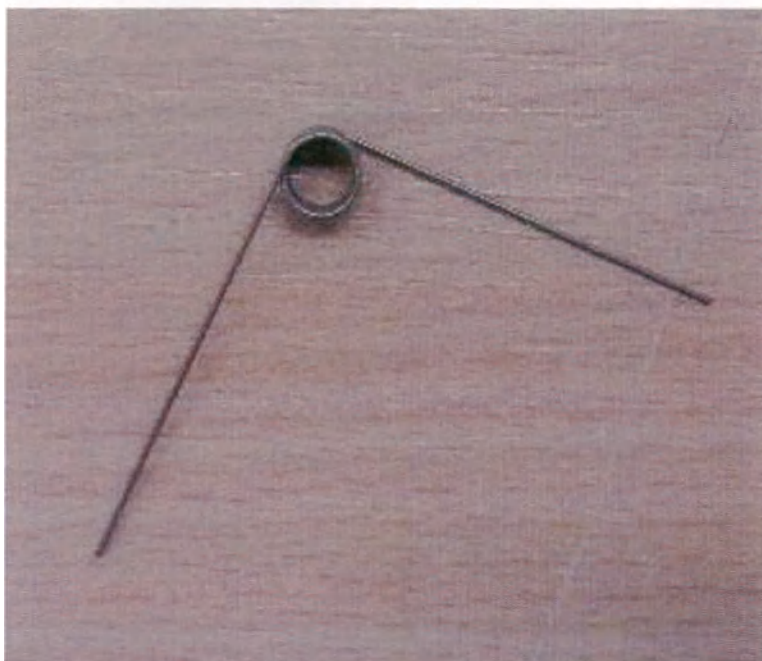

29. Лоток для штативов



30. Держатель микропланшета

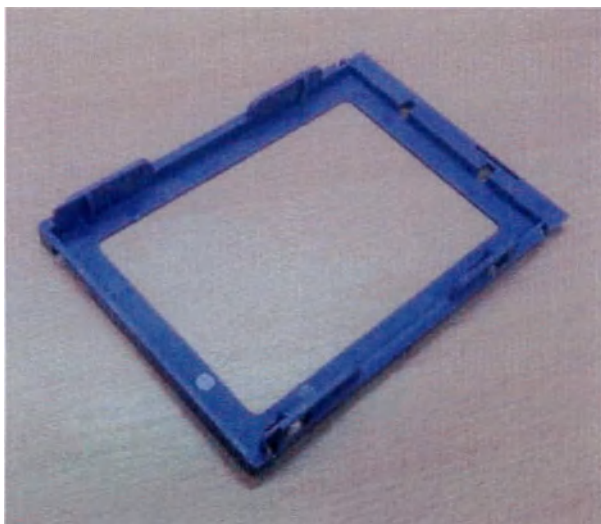

31. Штатив для держателей микропланшетов



32. Труба для отходов




33. Кабель питания основного блока анализатора и центрифуги




34. Соединительный кабель RS 232




35. Штатив для пробирок Ø16, тип А

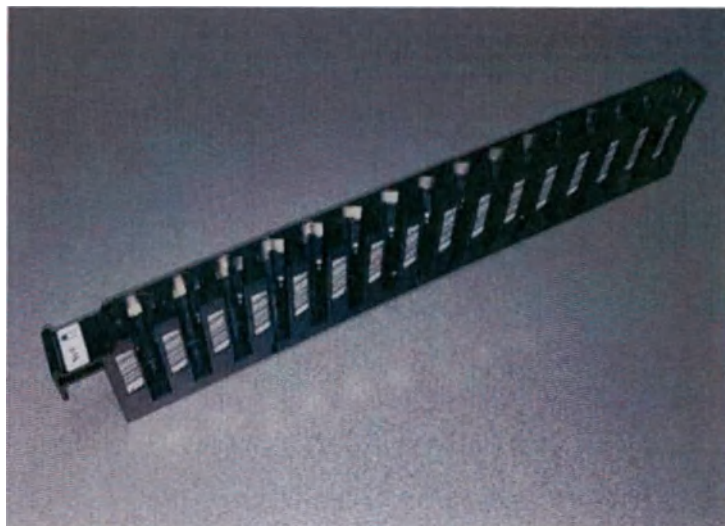


36. Штатив для пробирок Ø10-17 мм, тип С

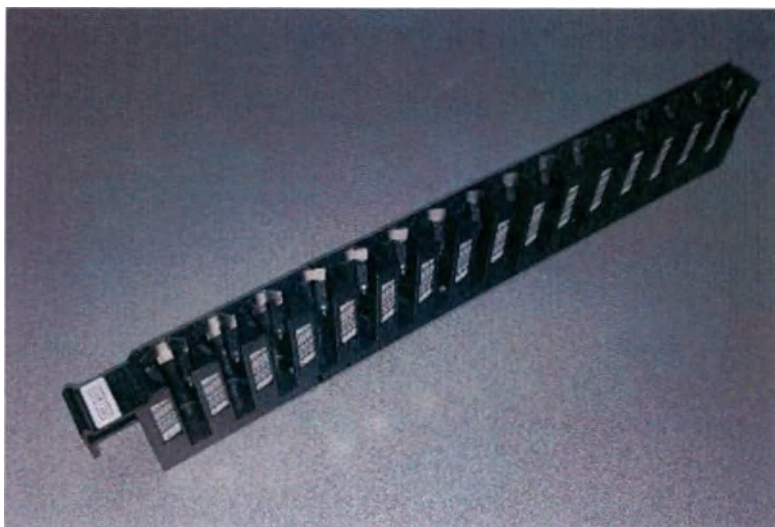

37. Штатив для пробирок Eppendorf Ø11 мм, тип Е

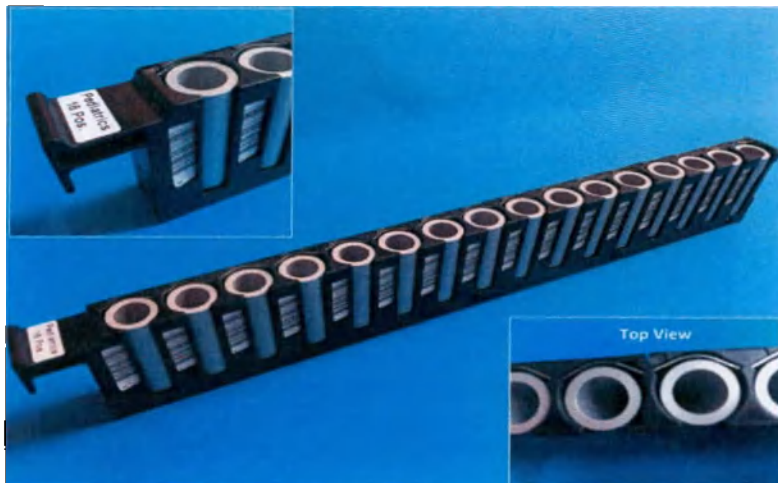

38. Штатив для реагентов Ø43 мм, 5x43, тип Т

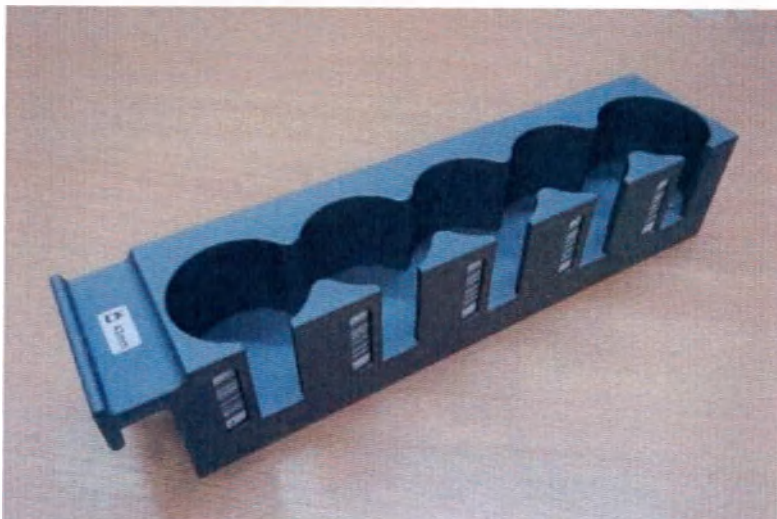

39. Системный блок специального персонального компьютера




40. Кабель питания специального персонального компьютера



41. Компакт-диск для восстановления программного обеспечения анализатора



42. Компакт-диск с программой Acronis

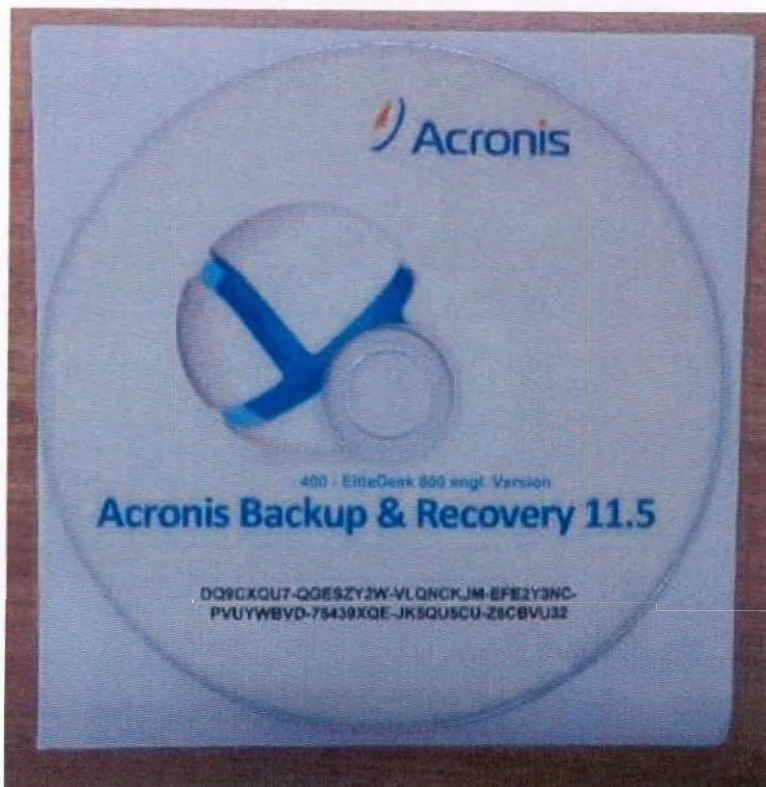

[illegible]

45. Клавиатура



46. Кабель USB для клавиатуры



47. Трекбол



48. Липучки



49. Флуоресцентная лампа



50. Набор предохранителей, в составе


1. Предохранитель 0.315 А, 5х20 мм




2. Предохранитель 1 А, 5х20 мм




3. Предохранитель 1.6А/ 250 В, 5х20 мм

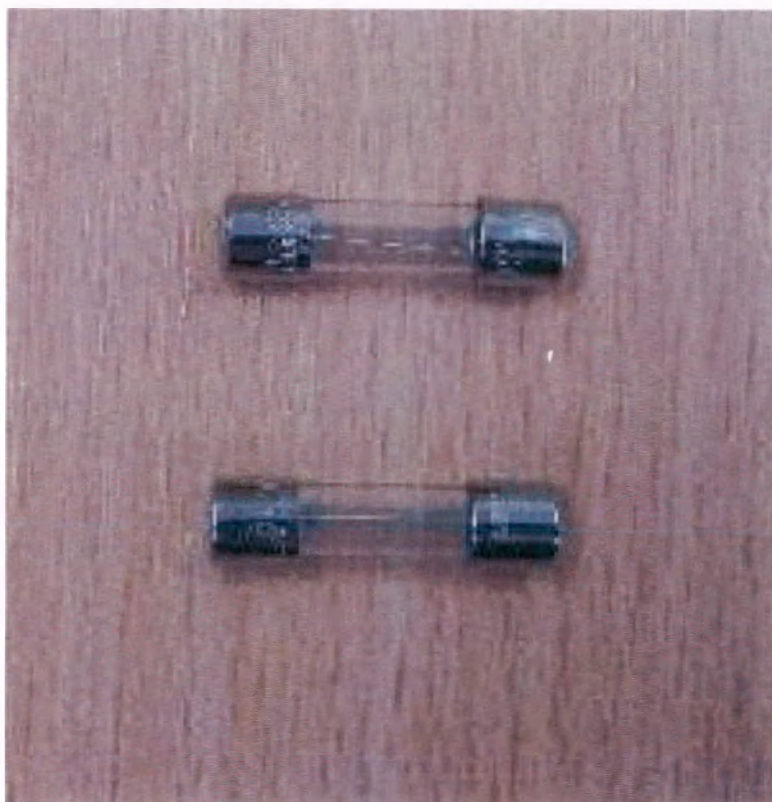


4. Предохранитель 2 А/250 В, 5х20 мм

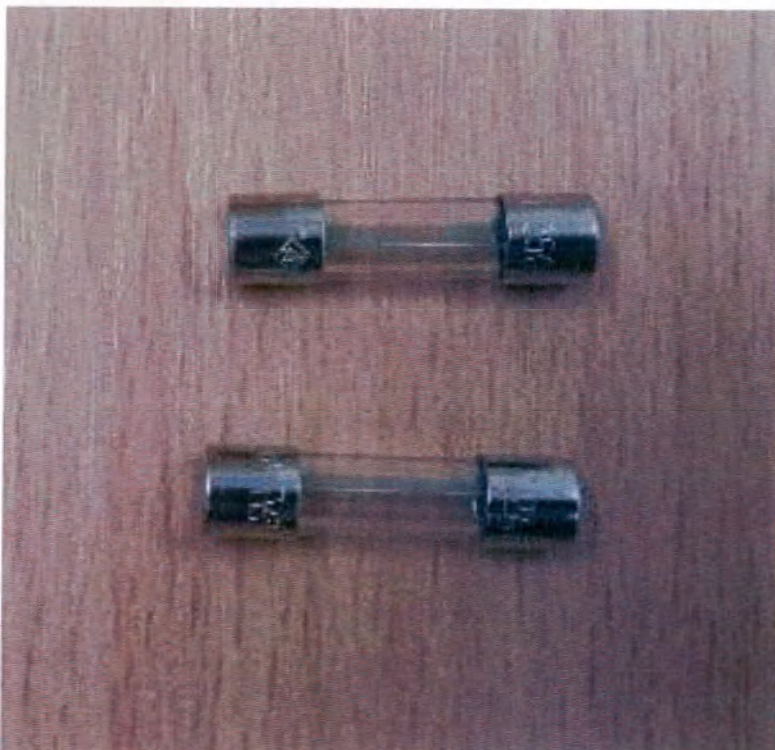


5. Предохранитель 3.15 А

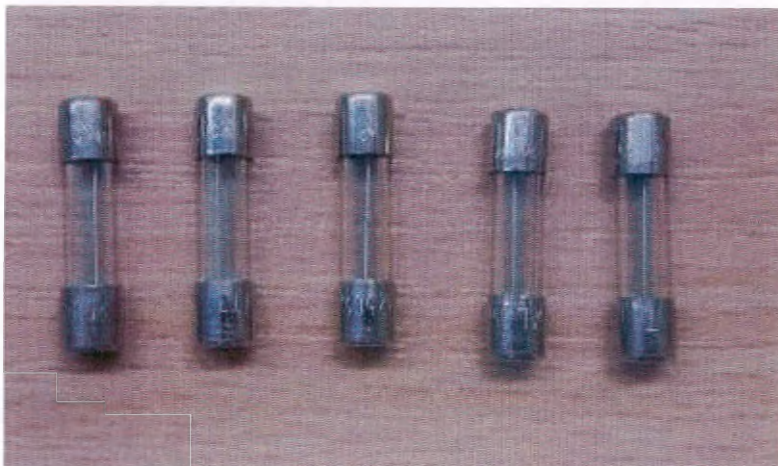

6. Предохранитель 6.3 А

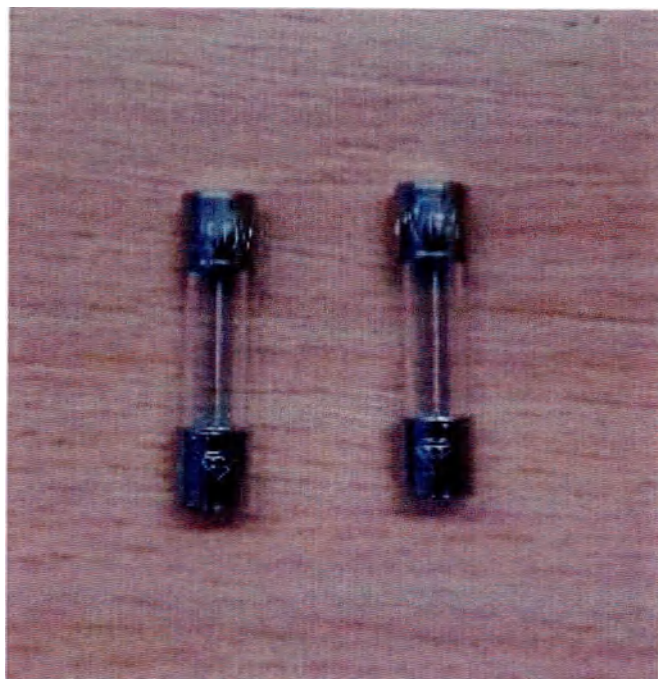


7. Предохранитель 1.6А, 7.4x3.1 мм

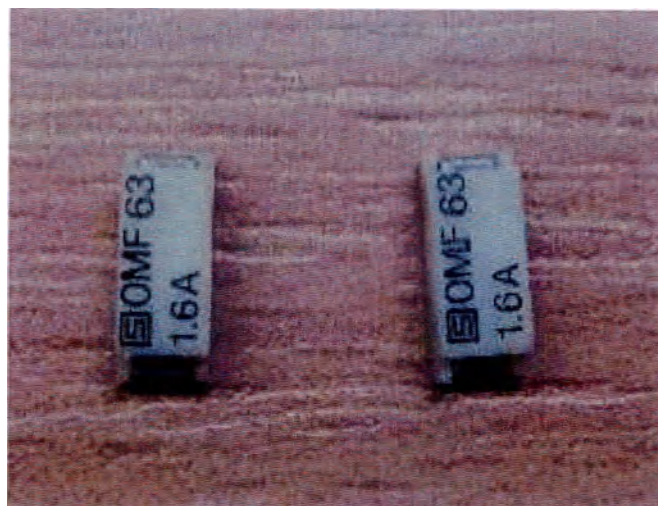


8. Предохранитель 3 А/63 В, 7.4x3.1 мм



9. Предохранитель 4 А, 5x20 мм

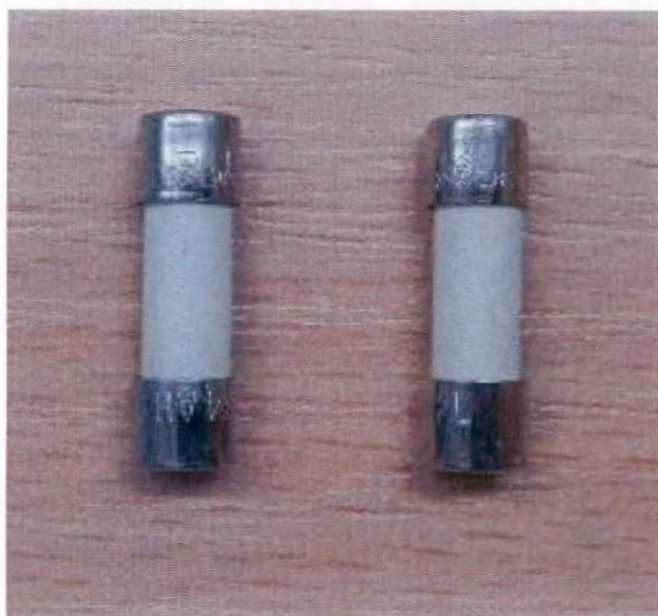


10. Предохранитель 5 А, 6.3x32 мм

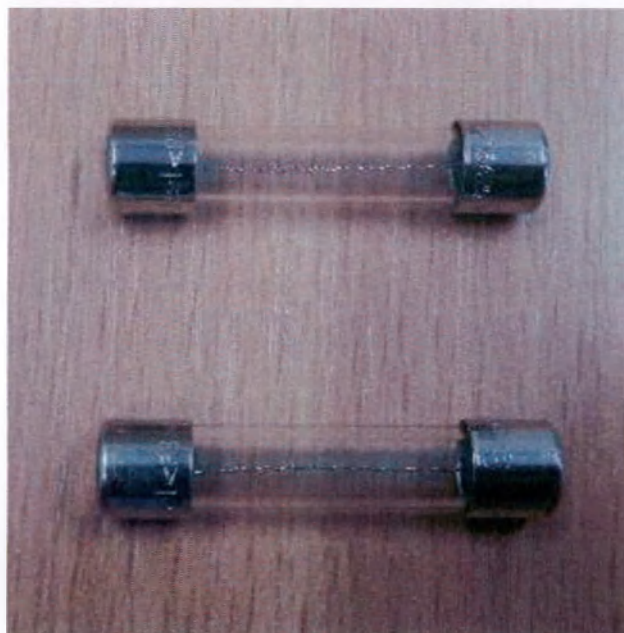


51. Монитор сенсорный



52. Видеокабель VGA

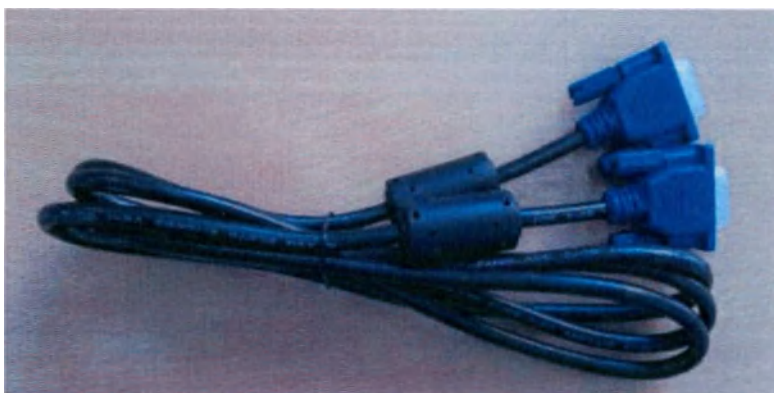


53. Видеокабель DVI

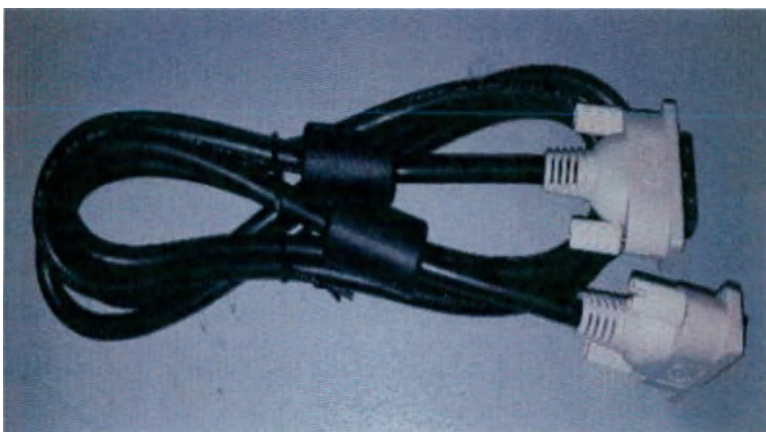


54. Кабель USB



55. Аудиокабель

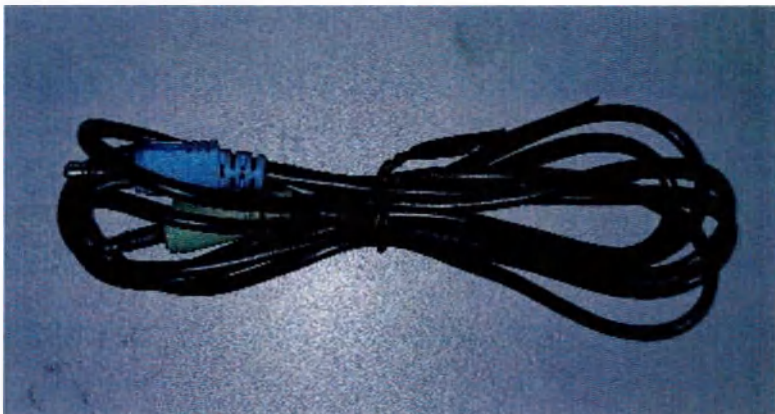

56. Кабель питания монитора US

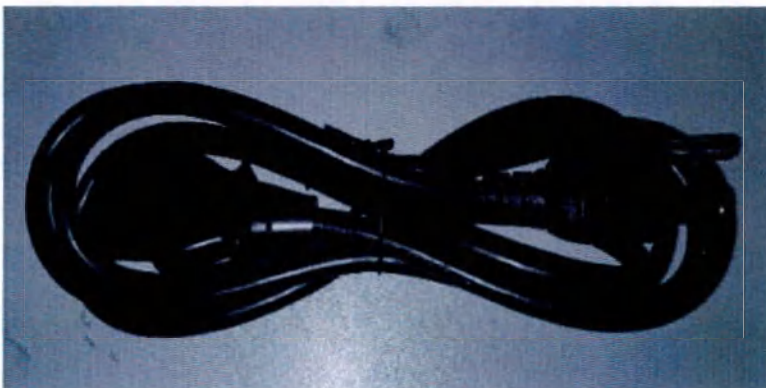


57. Кабель питания монитора Euro




58. Блок питания монитора




59. Инструкция по быстрой установке монитора

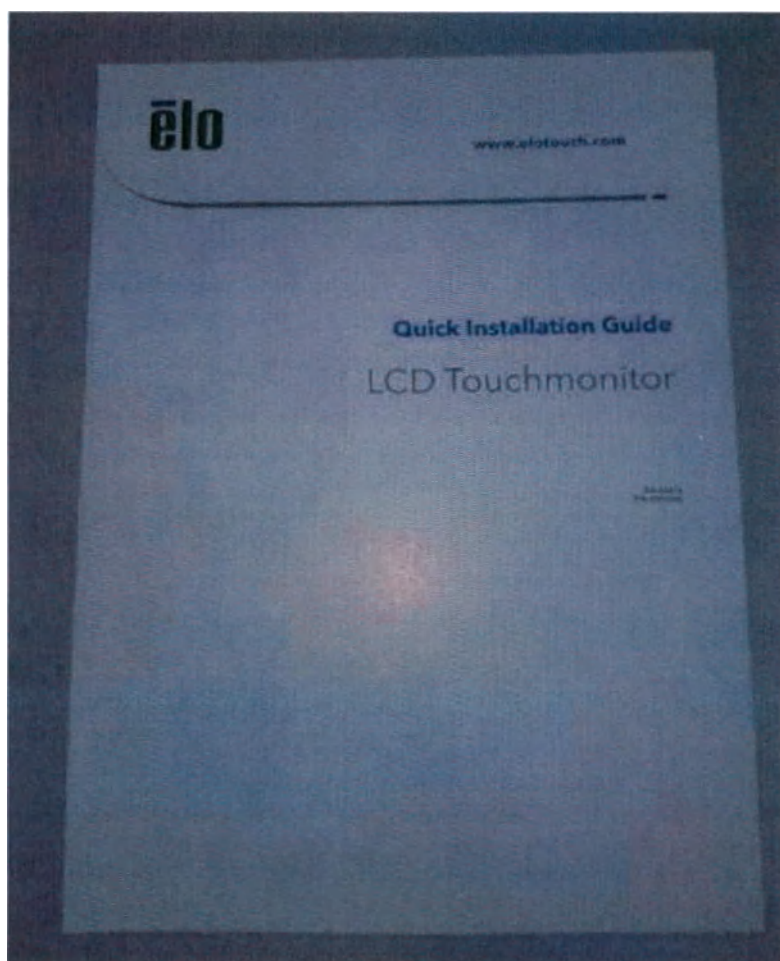

60. Компакт-диск с инструкцией по эксплуатации монитора

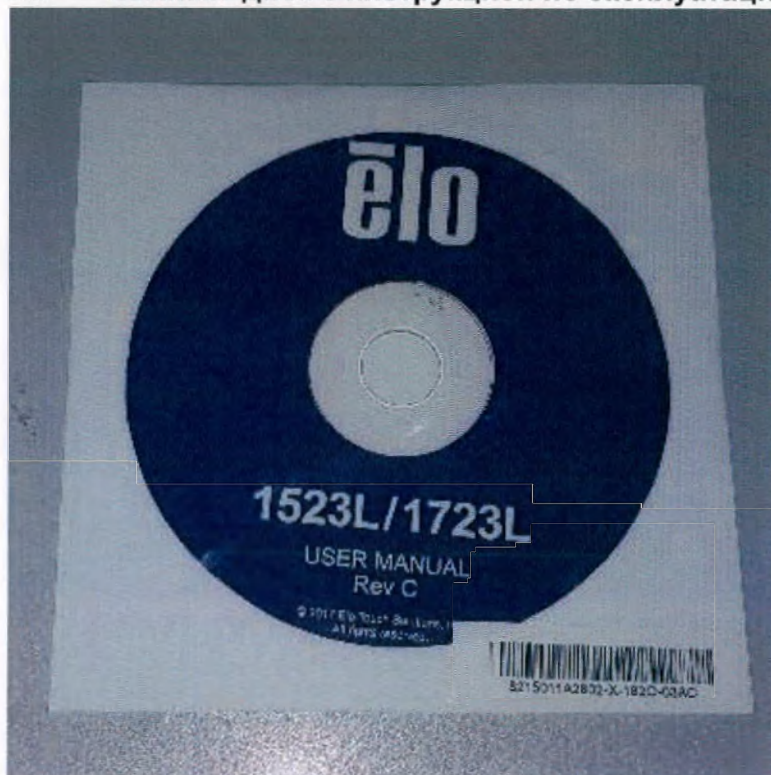

61. Пластина для установки монитора

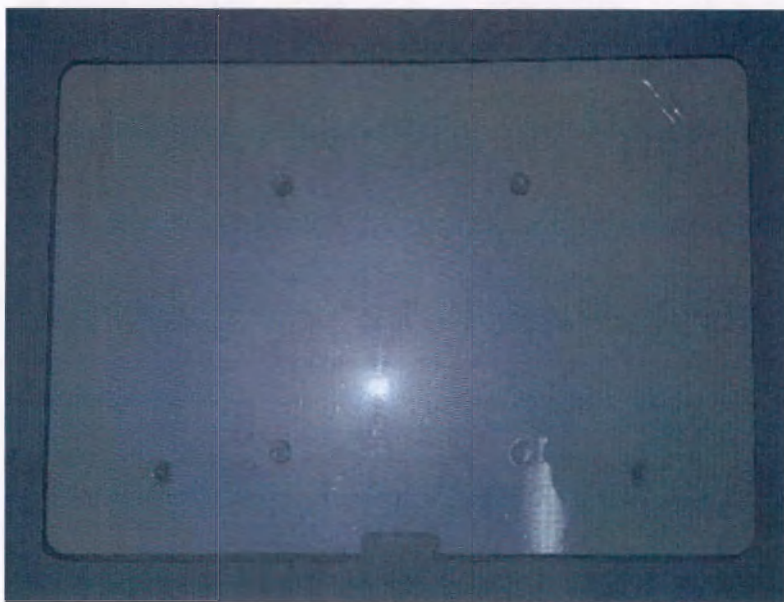

62. Винты для фиксации пластины



63. Считыватель штрих-кодов ручной




64. Держатель считывателя штрих-кодов



65. Кабель считывателя штрих-кодов




66. Информационный вкладыш считывателя штрих-кодов

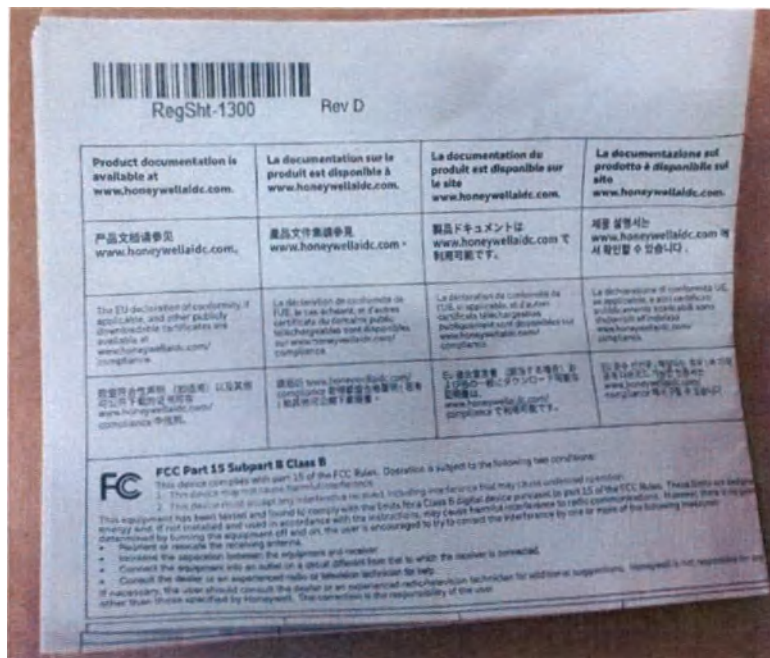


67. Источник бесперебойного питания (ИБП)




68. Кабель питания промежуточный

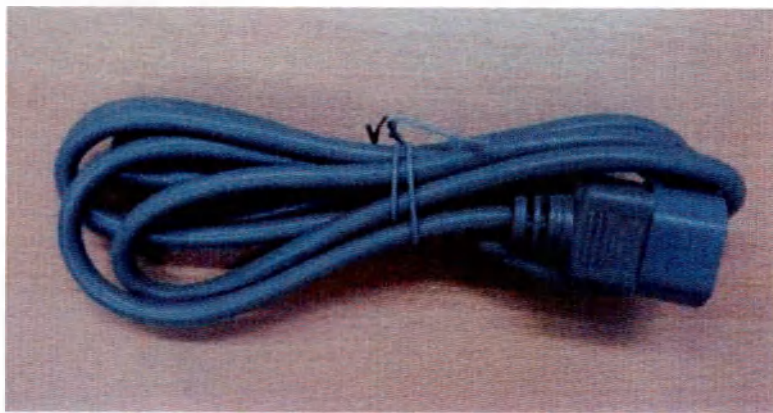


69. Кабель RS 232

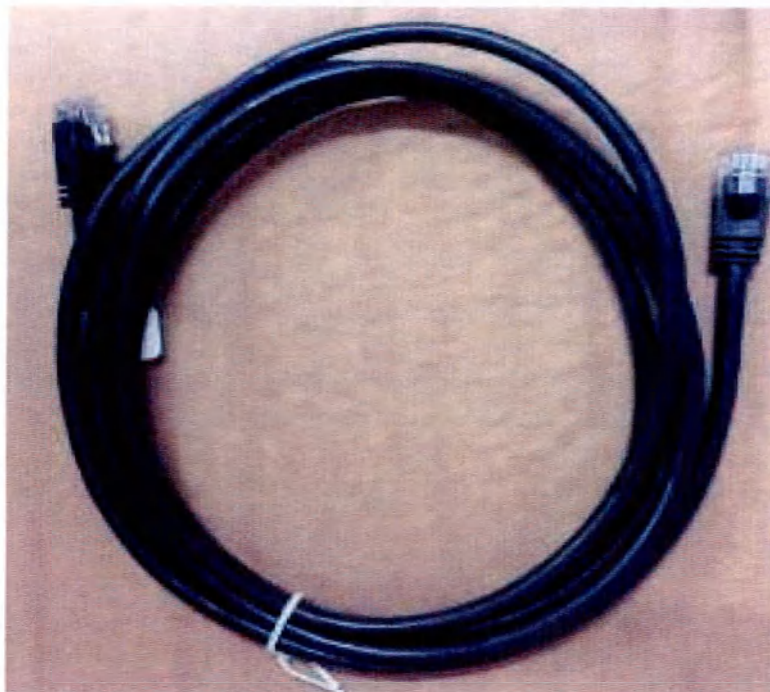


70. Кабель USB

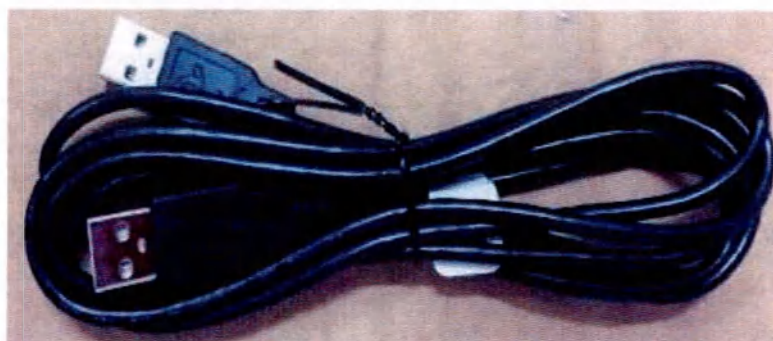


71. Вкладыш с информацией о безопасности ИБП

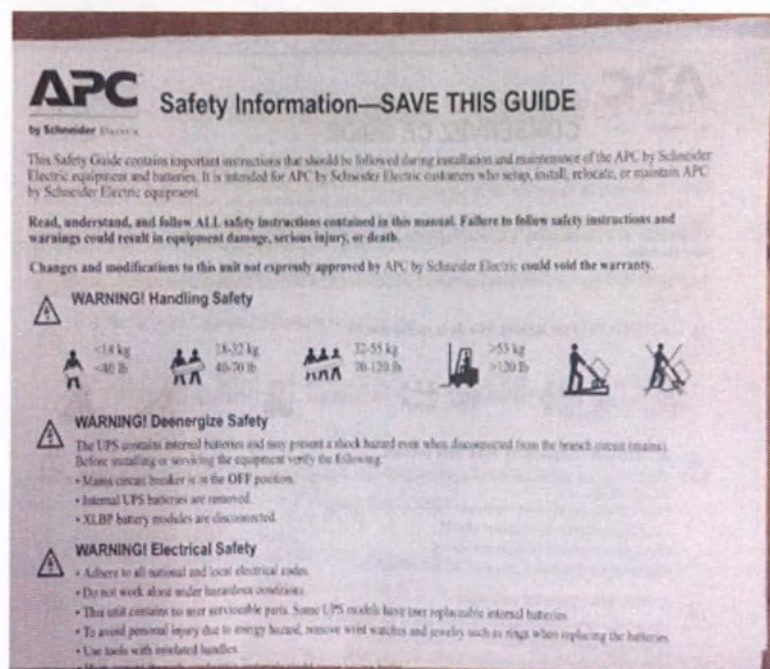


72. Компакт-диск с документацией ИБП

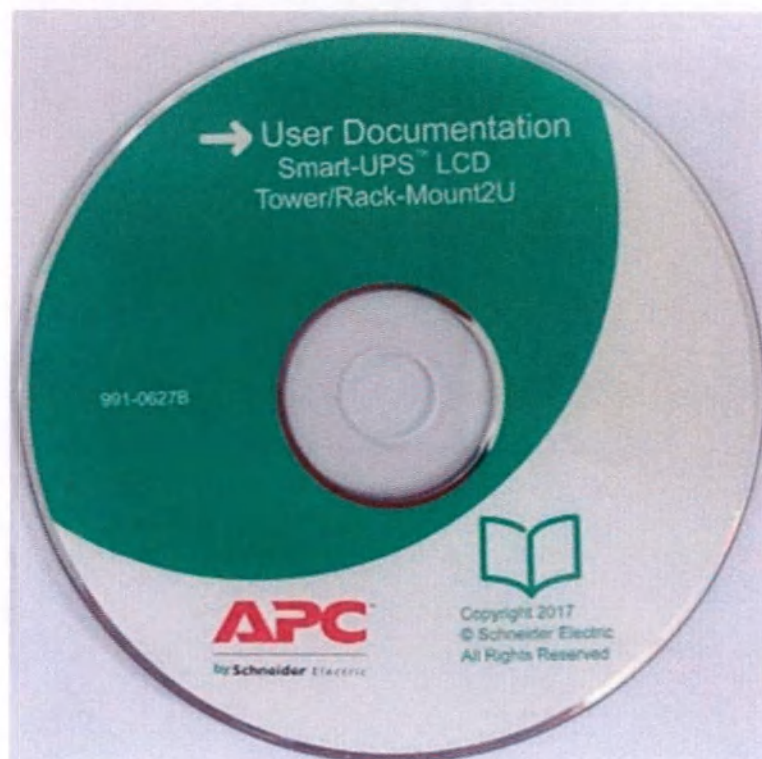


73. Компакт-диск с программным обеспечением ИБП

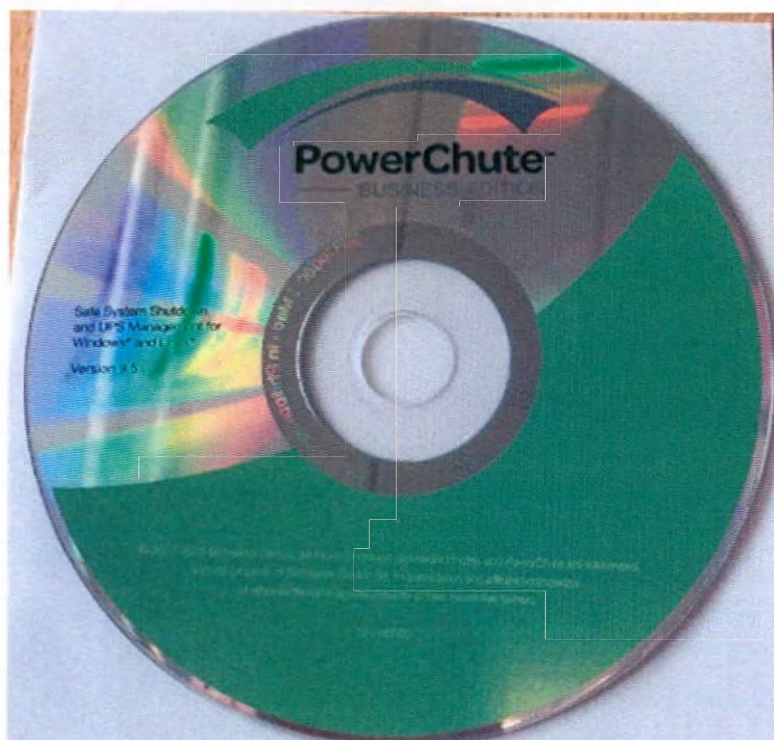

74. Инструкция по установке ИБП

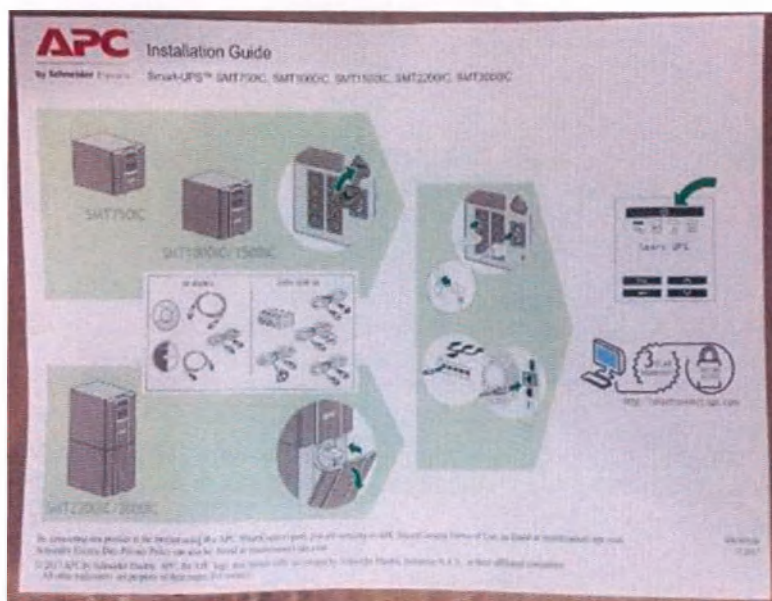

75. Колодка питания на 6 розеток

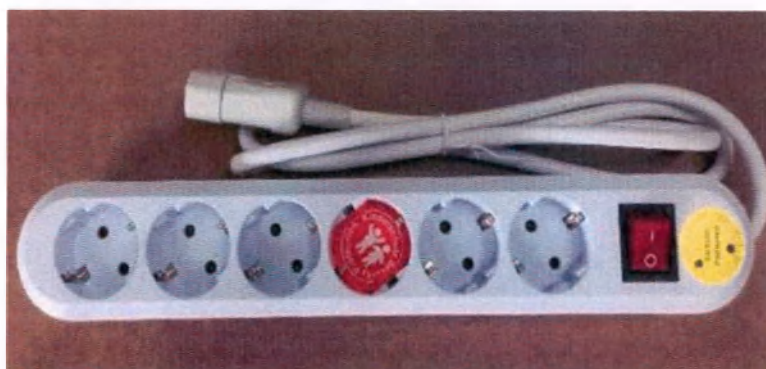

76. Кабель питания ИБП



77. Принтер



78. Кабель питания принтера UK




79. Кабель питания принтера Euro



80. Кабель принтера USB



81. Компакт-диск с программным обеспечением принтера

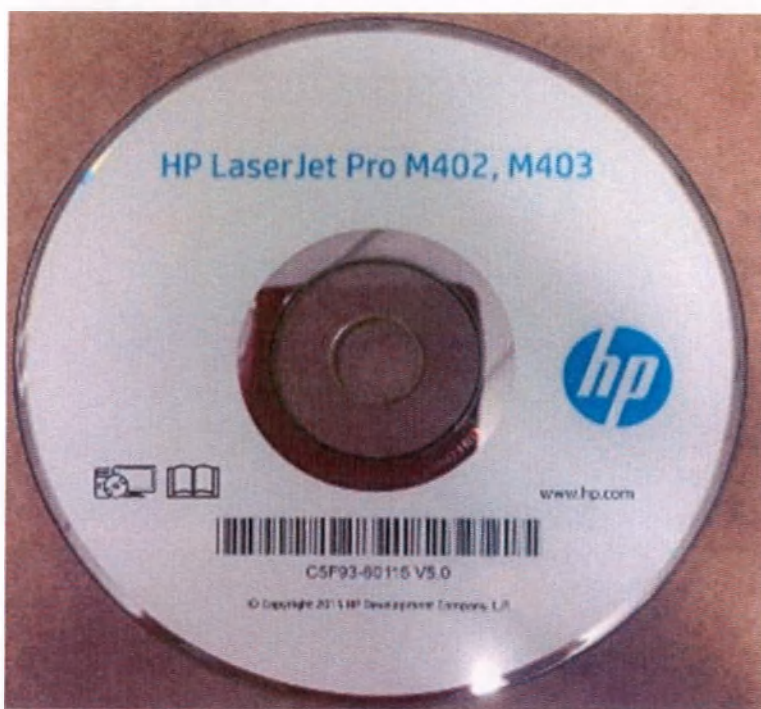

82. Инструкция по установке принтера



83. Стартовый комплект расходных материалов

1. Диспенсер для шариков




2. Шарики для перемешивания реагентов



3. Микропланшет Галилео



84. Канистра для системного раствора 22 л

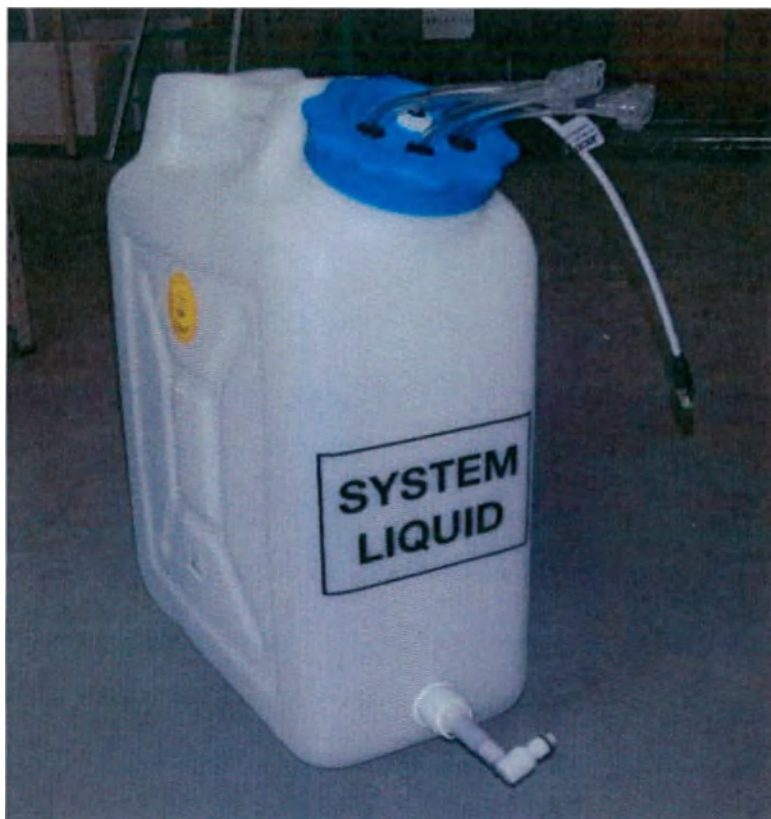

85. Канистра для системного раствора 10 л



86. Канистра для отходов 10 л



87. Канистра для слива отходов 10 л



88. Клапан шприца



89. Шприц насоса 1000 мкл




90. Шприц насоса 500 мкл



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

43 (сорок три) л.

Директор
ООО «Иммукор-Восток»

 А.В. Иоанесян



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Иммукор-Восток»



А.В. Иоанесян

«01» июня 2023 г.

Макеты этикеток на медицинское изделие

**«Анализатор автоматический иммуногематологический Neo Iris»,
производства Immucor Medizinische Diagnostik GmbH (Германия)**

Анализатор автоматический иммуногематологический Neo Iris

Макет этикетки аппарата:

Анализатор автоматический иммуногематологический Neo Iris	
РУ РЗН № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX	
Напряжение и частота: 100-240 В; 47-63 Гц Потребляемая мощность: 425 ВА	
 SN 5030100388	  
 03.2019	
Только для профессионального применения	
	IMMUCOR Medizinische Diagnostik GmbH (Иммукор Медизинише Diagnostik ГмбХ), Robert-Bosch- Strasse 32, D-63303 Dreieich, Germany (Германия)
Уполномоченный представитель производителя: ООО «Иммукор-Восток», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4, корп.1, этаж 2, помещение 1А, комната 55	

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) л.

Директор
ООО «Иммукор-Восток»

А.В. Иоанесян



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.В. Иоанесян", written over a horizontal line.