

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БелПласГрупп»

УНП 491322004


246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Пригородная, 4

e-mail: belplasgrup@inbox.ru

р/счет BY55 AEBK3012 0047 4763 0000 0000

ЗАО «БТА Банк» г. Минск ул. В. Хоружей, 20-2

Код AEBKBY2X

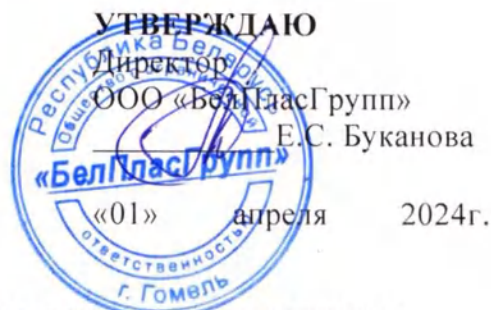

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Средства ухода за кишечными стомами: Калоприемники однокомпонентные и двухкомпонентные, дренируемые и недренируемые

Производства ООО «БелПласГрупп», Республика Беларусь 246010, г. Гомель,
ул. Пригородная, 4

Маркировка медицинского изделия «Средства ухода за кишечными стомами: Калоприемники однокомпонентные и двухкомпонентные, дренируемые и недренируемые»
(далее по тексту – изделия)

На изделия наносится маркировка диаметров вырезаемых отверстий и окружностей, по которым они должны вырезаться.

Маркировка индивидуальной упаковки калоприемника

- наименование изготовителя;
- страну и адрес изготовителя;
- наименование изделия;
- назначение изделия;
- артикул (при наличии);
- диапазон вырезаемого отверстия*, мм;
- размер стомного мешка*, мл;
- размер (диаметр) фланца, соответствующий фланцу пластины**, мм;
- дату изготовления (месяц, год) или знак п.5.1.3 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- дату окончания срока годности (месяц, год) или знак п.5.1.4 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- номер партии,
- упаковщик №;
- надпись: «Нестерильно» или символ п.5.2.7 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Не использовать повторно» или символ п.5.4.2 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации» или символ п.5.4.4 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте» ***;
- надпись: «Не подвергать нагреванию и замораживанию» ***;
- надпись: «Избегать воздействия прямых солнечных лучей, или символ п.5.3.2 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Ограничение температуры» с указанием диапазона температур или символ п.5.3.7 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- сведения об ограничениях (противопоказаниях) для применения;
- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;
- штриховой идентификационный код.

Маркировка индивидуальной упаковки адгезивной пластины-полукольца для дополнительной фиксации пластин калоприемников, пояса для калоприемников с регулируемой длиной должна содержать:

- наименование изготовителя;
- страну и адрес изготовителя;
- наименование изделия;
- ширину, внешний и внутренний диаметр, мм (для адгезивной пластины-полукольца);
- длину (для пояса);
- номер партии,
- упаковщик №,
- описание изделия,
- сведения об ограничениях (противопоказаниях) для применения;
- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;
- штриховой идентификационный код,
- дату изготовления (месяц, год) или знак п.5.1.3 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- дату окончания срока годности (месяц, год) или знак п.5.1.4 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Нестерильно» или символ п.5.2.7 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Не использовать повторно» или символ п.5.4.2 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации» или символ п.5.4.4 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте» ***;
- надпись: «Не подвергать нагреванию и замораживанию» ***;
- надпись: «Избегать воздействия прямых солнечных лучей, или символ п.5.3.2 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Ограничение температуры» с указанием диапазона температур или символ п.5.3.7 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

Маркировка потребительской упаковки.

Маркировка потребительской упаковки должна содержать:

- наименование изготовителя;
- страну и адрес изготовителя;
- наименование изделия;
- артикул (при наличии);
- диапазон вырезаемого отверстия, мм;
- размер стомного мешка, мл;
- внешний и внутренний диаметр, мм адгезивной пластины-полукольца (при необходимости);
- дату изготовления (месяц, год) или знак п.5.1.3 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- дату окончания срока годности (месяц, год) или знак п.5.1.4 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- номер партии;
- упаковщик №;
- надпись: «Нестерильно» или символ п.5.2.7 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Не использовать повторно» или символ п.5.4.2 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации» или символ п.5.4.4 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте»;
- надпись: «Не подвергать нагреванию и замораживанию»;
- надпись: «Избегать воздействия прямых солнечных лучей, или символ п.5.3.2 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Ограничение температуры» с указанием диапазона температур или символ п.5.3.7 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения;
- штриховой идентификационный код.

Маркировка транспортной упаковки наносится на этикетку, которая должна быть наклеена на упаковку и должна содержать:

- наименование изготовителя;
- страну и адрес изготовителя;
- наименование изделия;
- количество изделий в упаковке;
- надпись: «Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте»;
- надпись: «Не подвергать нагреванию и замораживанию»;
- надпись: «Избегать воздействия прямых солнечных лучей, или символ п.5.3.2 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- надпись: «Ограничение температуры» с указанием диапазона температур или символ п.5.3.7 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;

- дату окончания срока годности (месяц, год) или знак п.5.1.4 по ГОСТ Р ИСО 15223-1;
- массу брутто, кг;
- упаковщик №;
- штриховой идентификационный код,
- манипуляционный знак «Крюками не брать» по ГОСТ 14192.

Примечание:

*- только для калоприемников;

** - только для двухкомпонентных калоприемников;

*** - только для калоприемников, адгезивных пластин-полукольцев.

Макеты маркировки упаковки изделия для РФ

1) Макет маркировки индивидуальной упаковки калоприемников двухкомпонентных дренируемых

ООО "БелПласГрупп" Республика Беларусь 246010 г. Гомель ул. Пригородная,4 (232)25-24-22 e-mail: belplagrup@inbox.ru	
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ, ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ	
КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ	
Калоприемник двухкомпонентный дренируемый – 1 шт.; Стомный мешок для двухкомпонентного дренируемого калоприемника XXX – 1 шт. Адгезивная плоская пластина для двухкомпонентного калоприемника XX – 1 шт. Зажим для стомного мешка – 1 шт.	
REF	XXXXX
Диапазон вырезаемого отверстия, мм- от X до XX Размер стомного мешка, мл- XXX Размер (диаметр) фланца, соответствующий фланцу пластины, мм- XX Партия № _____ Упаковщик № _____ Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте Не подвергать нагреванию и замораживанию	
Назначение Для фиксации при помощи клея на коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий (кишечного содержимого) после колостомии и устранения его агрессивного воздействия на кожу стомированных больных.	
Противопоказания к применению Индивидуальная непереносимость материалов изделия	
Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY	Место для штрих-кода
 – XX-XXXX	
 – XX-XXXX	
     	

2) Макет маркировки индивидуальной упаковки калоприемников двухкомпонентных недренируемых

ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru

**СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ**

КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ

Калоприемник двухкомпонентный недренируемый – 1 шт.;
Стомный мешок для двухкомпонентного недренируемого калоприемника XXX – 1 шт.
Адгезивная плоская пластина для двухкомпонентного калоприемника XX – 1 шт.

REF

XXXXX

Диапазон вырезаемого отверстия, мм- от X до XX
Размер стомного мешка, мл- XXX
Размер (диаметр) фланца, соответствующий фланцу пластины, мм- XX
Партия № _____ Упаковщик № _____
Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Назначение
Для фиксации при помощи клея на коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий (кишечного содержимого) после колостомии и устранения его агрессивного воздействия на кожу стомированных больных.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY

 – XX-XXXX
 – XX-XXXX

Место для
штрих-кода







 -5°C min +40°C max



3) Макет маркировки индивидуальной упаковки калоприемников
однокомпонентных дренируемых

ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ

КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ

Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной – 1 шт.
Зажим для стомного мешка – 1 шт.

REF

XXXXX

Диапазон вырезаемого отверстия, мм- от X до XX
Размер стомного мешка, мл- XXX
Партия № _____ Упаковщик № _____
Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Назначение
Для фиксации при помощи клея на коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий (кишечного содержимого) после колостомии и устранения его агрессивного воздействия на кожу стомированных больных.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY

 – XX-XXXX
 – XX-XXXX

**Место для
штрих-кода**

4) Макет маркировки индивидуальной упаковки калоприемников
однокомпонентных недренируемых

ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ

КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ

Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной –
1 шт.

REF **XXXXX**


Диапазон вырезаемого отверстия, мм- от X до XX
Размер стомного мешка, мл- XXX
Партия № _____ Упаковщик № _____
Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Назначение
Для фиксации при помощи клея на коже пациента вокруг стомы и использования в
качестве емкости для сбора фекалий (кишечного содержимого) после колостомии
и устранения его агрессивного воздействия на кожу стомированных больных.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY

 – XX-XXXX **Место для
штрих-кода**
 – XX-XXXX

5) Макет маркировки индивидуальной упаковки адгезивной пластины-полукольца для дополнительной фиксации пластин калоприемников

ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ

КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ

Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников – 1 шт.

Ширина, мм _____
Внешний диаметр, мм _____
Внутренний диаметр, мм _____
Партия № _____ Упаковщик № _____
Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Применяется для дополнительной фиксации пластин калоприемников на теле.
Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY

 – XX-XXXX
 – XX-XXXX

Место для
штрих-кода







 -5°C min +40°C max



ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ

КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ

Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников – 1 шт.

Ширина, мм _____
Внешний диаметр, мм _____
Внутренний диаметр, мм _____
Партия № _____ Упаковщик № _____
Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Применяется для дополнительной фиксации пластин калоприемников на теле.
Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY

 – XX-XXXX
 – XX-XXXX

Место для
штрих-кода







 -5°C min +40°C max



ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная,4
(232)25-24-22 e-mail: belplagrup@inbox.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ

КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ

Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников – 1 шт.

Ширина, мм _____
Внешний диаметр, мм _____
Внутренний диаметр, мм _____
Партия № _____ Упаковщик № _____
Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Применяется для дополнительной фиксации пластин калоприемников на теле.
Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY

 – XX-XXXX

 – XX-XXXX

Место для
штрих-кода



ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная,4
(232)25-24-22 e-mail: belplagrup@inbox.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ

КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ

Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников – 1 шт.

Ширина, мм _____
Внешний диаметр, мм _____
Внутренний диаметр, мм _____
Партия № _____ Упаковщик № _____
Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию


Применяется для дополнительной фиксации пластин калоприемников на теле.
Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY

 – XX-XXXX

 – XX-XXXX

Место для
штрих-кода



6)Макет маркировки индивидуальной упаковки пояса для калоприемников с регулируемой длиной

ООО "БелПласГрупп" Республика Беларусь 246010 г. Гомель ул. Пригородная,4 (232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ, ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ	
Пояс для калоприемников с регулируемой длиной 1 шт.	
Длина, см _____	
Партия № _____ Упаковщик № _____	
Применяется для крепления к мешку калоприемника Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY Противопоказания к применению Индивидуальная непереносимость материалов изделия	
 – XX-XXXX  – XX-XXXX	Место для штрих-кода
     +5°C min +40°C max 	

ООО "БелПласГрупп" Республика Беларусь 246010 г. Гомель ул. Пригородная,4 (232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ, ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ	
Пояс для калоприемников с регулируемой длиной 1 шт.	
Длина, см _____	
Партия № _____ Упаковщик № _____	
Применяется для крепления к мешку калоприемника Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY Противопоказания к применению Индивидуальная непереносимость материалов изделия	
 – XX-XXXX  – XX-XXXX	Место для штрих-кода
     +5°C min +40°C max 	

6) Макет маркировки потребительской упаковки изделий

ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru

**СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ**

КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ

Состав:

- Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной – 1 шт.
- Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников – 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

REF XXXXX

Диапазон вырезаемого отверстия, мм- от X до XX
Размер стомного мешка, мл- XXX

Внешний диаметр адгезивной пластины-полукольца, мм _____
Внутренний диаметр адгезивной пластины-полукольца, мм _____

Партия № _____ Упаковщик № _____
Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY

 – XX-XXXX
 – XX-XXXX

Место для
штрих-кода

ООО "БелПласГрупп"

Республика Беларусь

246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4

(232)25-24-22 e-mail: belplastrup@inbox.ru

**СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ**

КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ

Состав:

- Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной – 1 шт.
- Зажим для стомного мешка – 1 шт.
- Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников – 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

XXXXX

REF

Диапазон вырезаемого отверстия, мм- от X до XX
Размер стомного мешка, мл- XXX

Внешний диаметр адгезивной пластины-полукольца, мм _____
Внутренний диаметр адгезивной пластины-полукольца, мм _____

Партия № _____ Упаковщик № _____

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY



– XX-XXXX



– XX-XXXX

Место для
штрих-кода



ООО "БелПласГрупп"

Республика Беларусь

246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplastrup@inbox.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ

КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ

Состав:

- Калоприемник двухкомпонентный дренируемый – 1 шт.:
- Стомный мешок для двухкомпонентного дренируемого калоприемника XXX – 1 шт.
- Адгезивная плоская пластина для двухкомпонентного калоприемника XX – 1 шт.
- Зажим для стомного мешка – 1 шт.
- Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников – 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

REF

XXXXX

Диапазон вырезаемого отверстия, мм- от X до XX
Размер стомного мешка, мл- XXX

Внешний диаметр адгезивной пластины-полукольца, мм _____
Внутренний диаметр адгезивной пластины-полукольца, мм _____

Партия № _____ Упаковщик № _____

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY




– XX-XXXX



– XX-XXXX

Место для
штрих-кода



ООО "БелПласГрупп"

Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplasgrup@inbox.ru

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ

КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ

Состав:

- Калоприемник двухкомпонентный недренируемый – 1 шт.:
- Стомный мешок для двухкомпонентного недренируемого калоприемника XXX – 1 шт.
- Адгезивная плоская пластина для двухкомпонентного калоприемника XX – 1 шт.
- Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников – 1 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.

REF

XXXXX

Диапазон вырезаемого отверстия, мм- от X до XX
Размер стомного мешка, мл- XXX

Внешний диаметр адгезивной пластины-полукольца, мм _____
Внутренний диаметр адгезивной пластины-полукольца, мм _____

Партия № _____ Упаковщик № _____

Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/YYYY



- XX-XXXX



- XX-XXXX

Место для
штрих-кода



7) Макет маркировки транспортной упаковки изделий

ООО "БелПласГрупп"
Республика Беларусь
246010 г. Гомель ул. Пригородная, 4
(232)25-24-22 e-mail: belplastrup@inbox.ru

**СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КИШЕЧНЫМИ СТОМАМИ
КАЛОПРИЕМНИКИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ,
ДРЕНИРУЕМЫЕ И НЕДРЕНИРУЕМЫЕ**

**КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ
КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ
КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ НЕДРЕНИРУЕМЫЙ
КАЛОПРИЕМНИК ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ДРЕНИРУЕМЫЙ**
(*указывается необходимый вариант исполнения)

Количество изделий, шт _____


Масса брутто, кг _____

Упаковщик № _____


Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте
Не подвергать нагреванию и замораживанию

Место для
штрих-кода

 - XX-XXXX

Описание используемых символов:

 Запрет на повторное применение	 нестерильно
 Изготовитель	 Дата изготовления
 Использовать до	 Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
 Не использовать при повреждении упаковки	 Не допускать воздействия солнечного света
 Беречь от влаги	 Запрещение применения крюков при поднятии груза
 Температурный диапазон	

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «БелПласт групп»

Е.С. Буканова



«01»

апреля

2024г.

*Принято и согласовано
наши 16 листов*

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«БелПласГрупп»

УНП 491322004

246010, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Пригородная, 4

e-mail: belplasgrup@inbox.ru

р/счет BY55 AEBK3012 0047 4763 0000 0000

ЗАО «БТА Банк» г. Минск ул. В. Хоружей, 20-2

Код AEBKBY2X

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ИНВЕСТО»

Э.А. Запольский

« 30 » мая 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Средства ухода за кишечными стомами:

Калоприемники однокомпонентные и двухкомпонентные, дренируемые и недренируемые

производства ООО «БелПласГрупп»,

Республика Беларусь 246010, г. Гомель, ул. Пригородная, 4

2023

Средства ухода за кишечными стомами: Калоприемники однокомпонентные и двухкомпонентные, дренируемые и недренируемые, в составе:

1. Калоприемник однокомпонентный недренируемый, в составе:

1.1. Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной, варианты исполнения:

ОНп ФП мини; ОНп ФП медиум; ОНп ФП макси;



Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной,
варианты исполнения:

ОНл ФП мини; ОНл ФП медиум; ОНл ФП макси;





Вид сзади

Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной,
варианты исполнения:
ОНп БП мини; ОНп БП медиум; ОНп БП макси;




Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной,
варианты исполнения:

ОНл БП мини; ОНл БП медиум; ОНл БП макси:




Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной,
варианты исполнения:
ОНп ФН мини; ОНп ФН медиум; ОНп ФН макси:

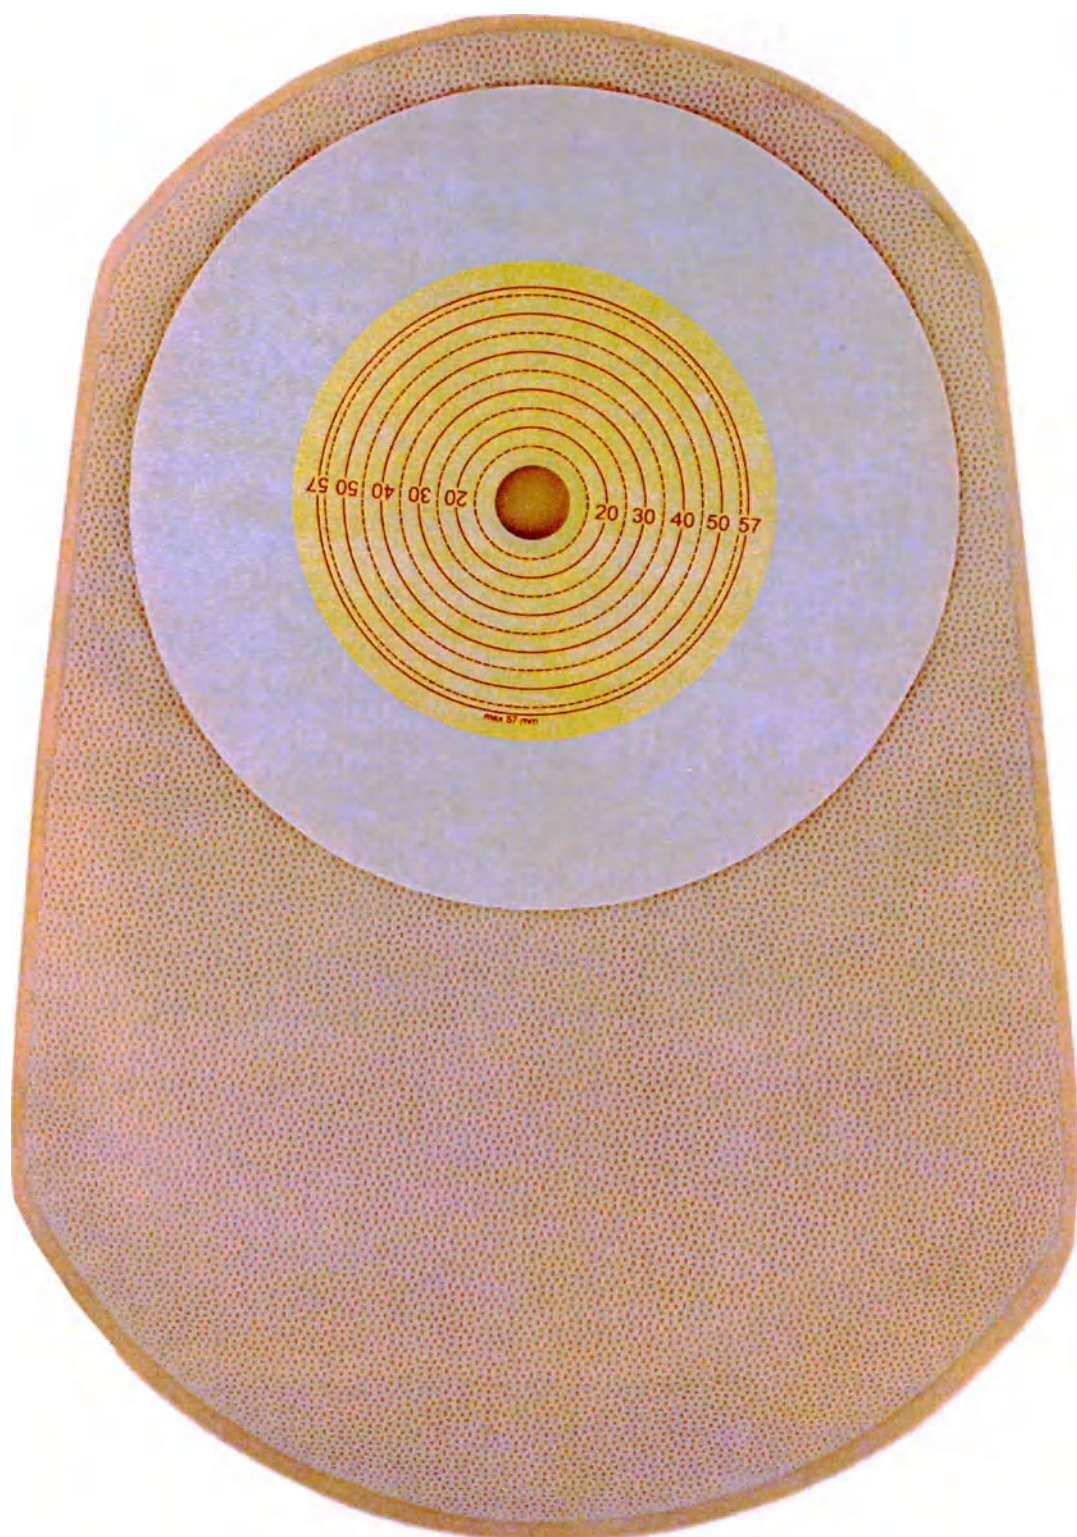



Вид сзади

Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной,
варианты исполнения:
ОНл ФН мини; ОНл ФН медиум; ОНл ФН макси;

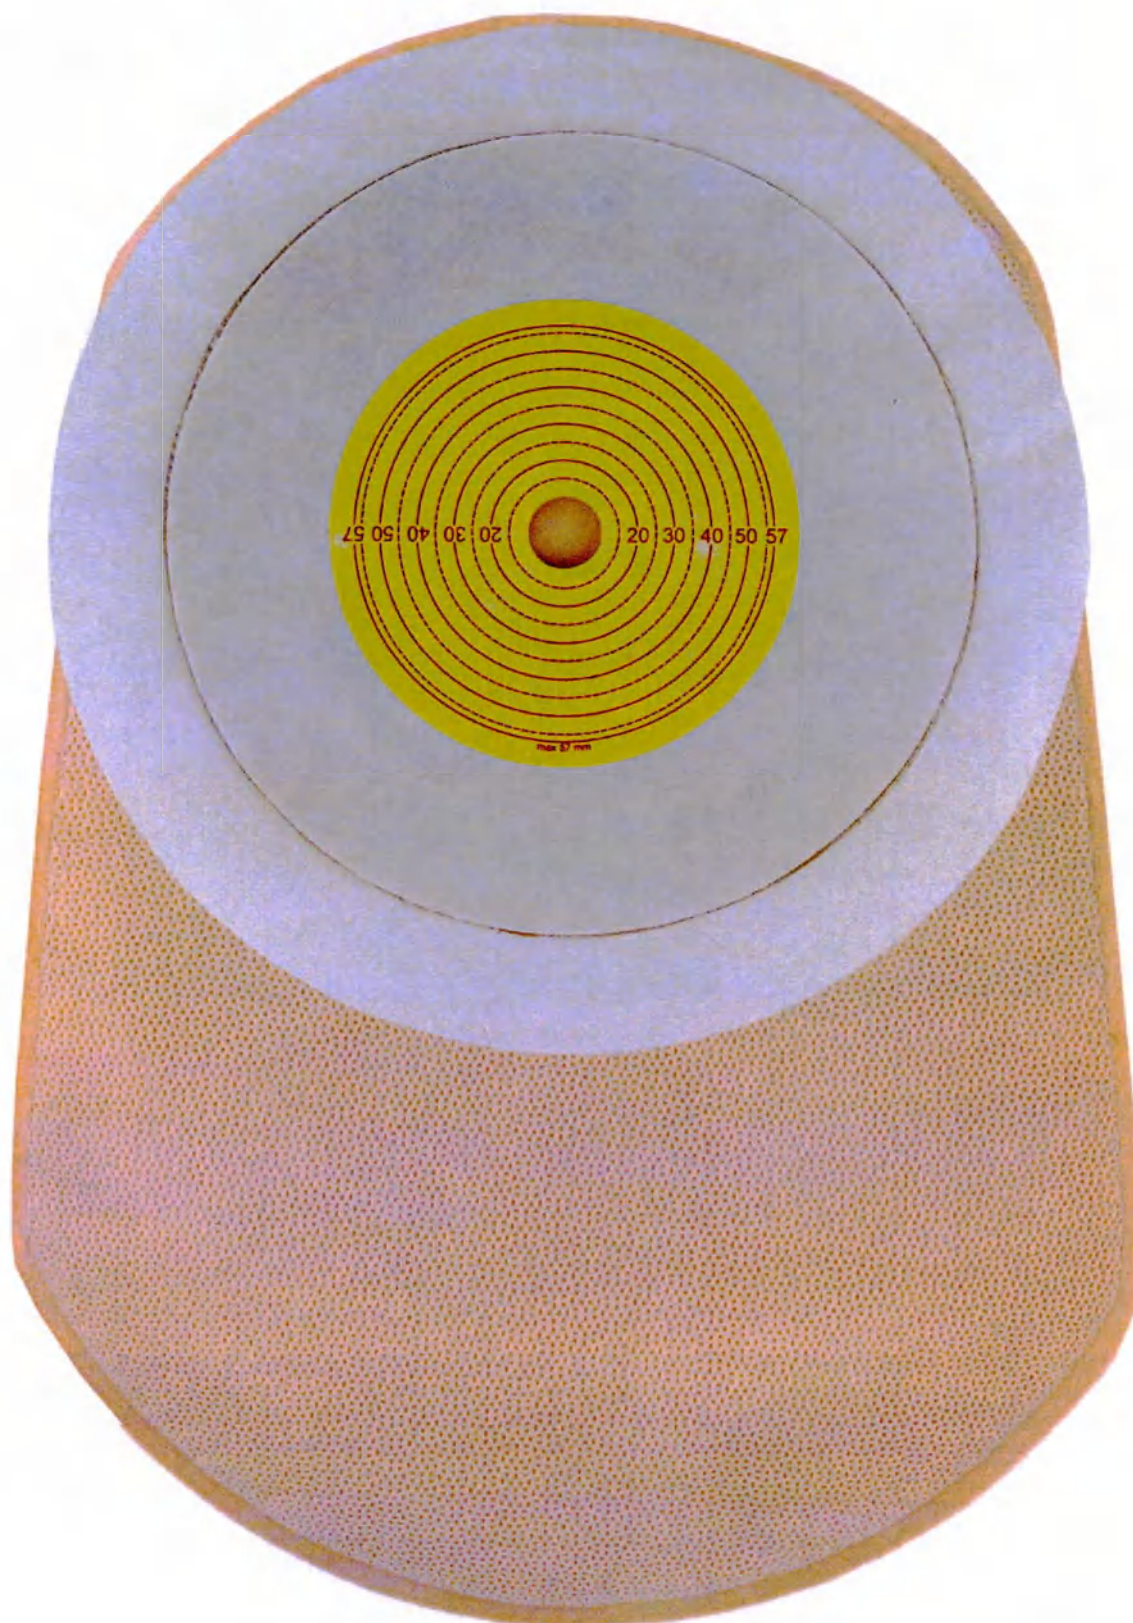





Вид сзади

Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной, варианты исполнения:


ОНп БН мини; ОНп БН медиум; ОНп БН макси;

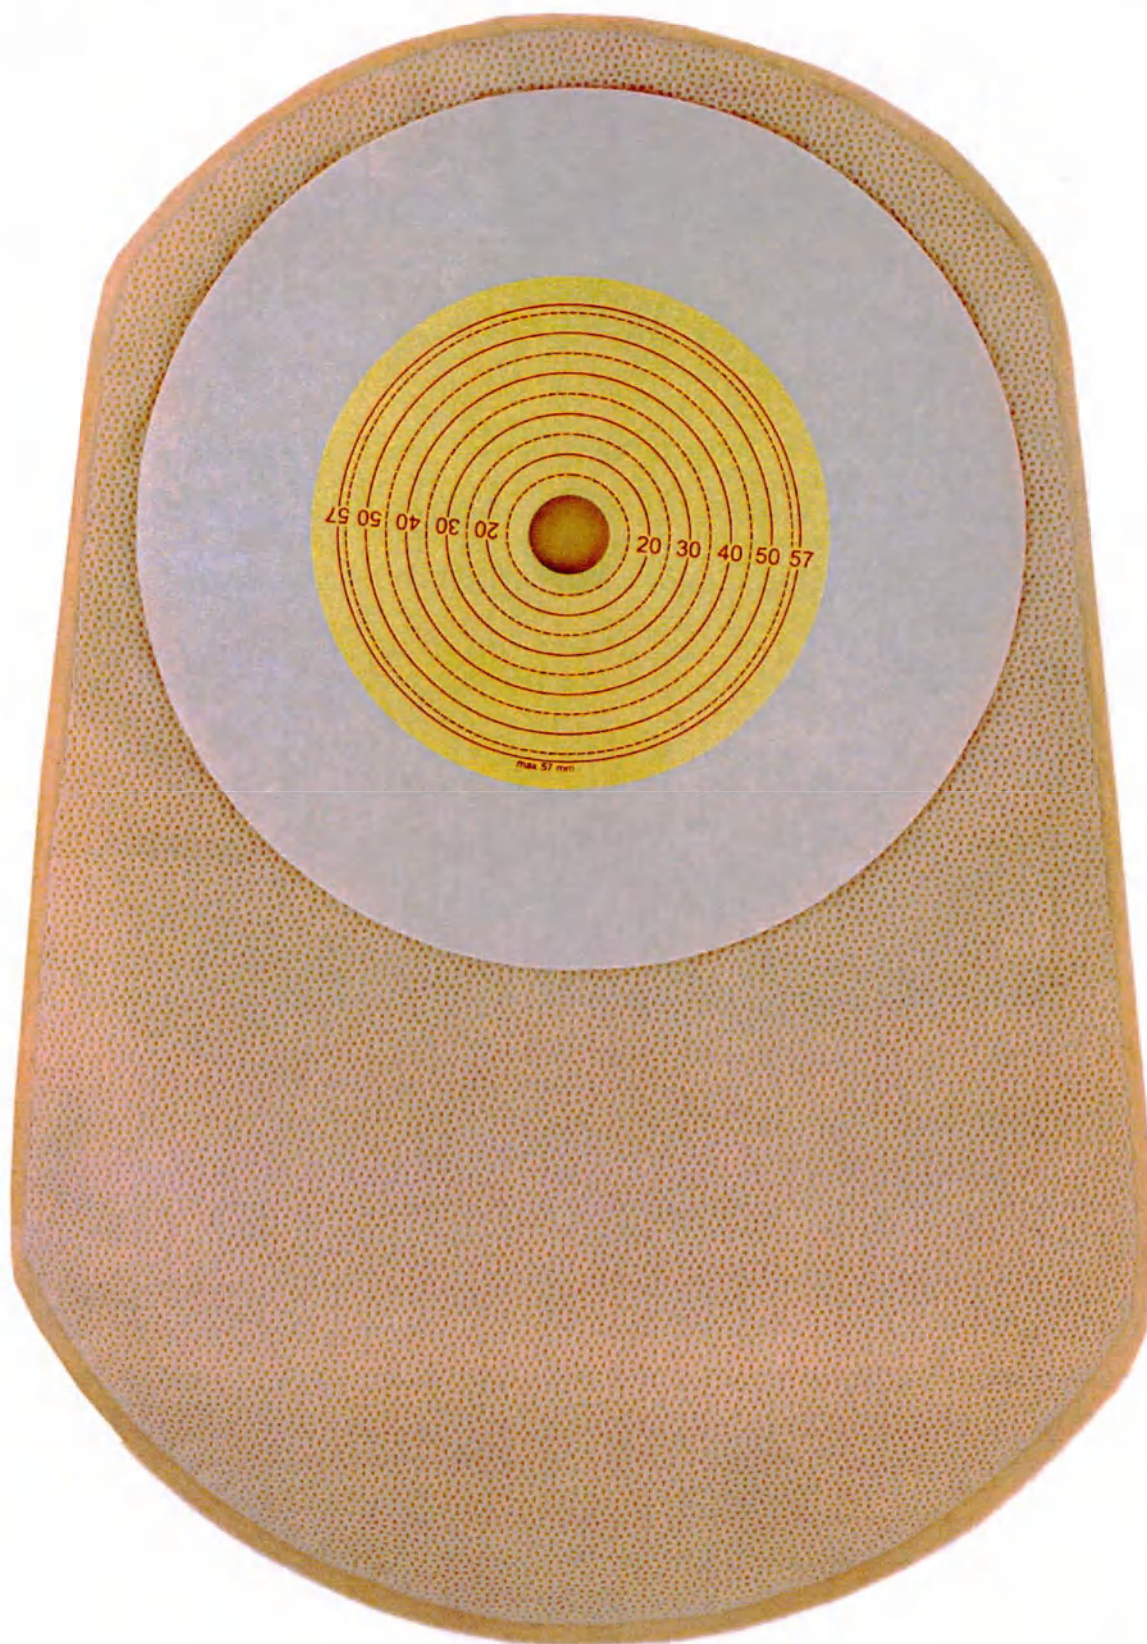

Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной адгезивной пластиной,
варианты исполнения:
ОНл БН мини; ОНл БН медиум; ОНл БН макси:

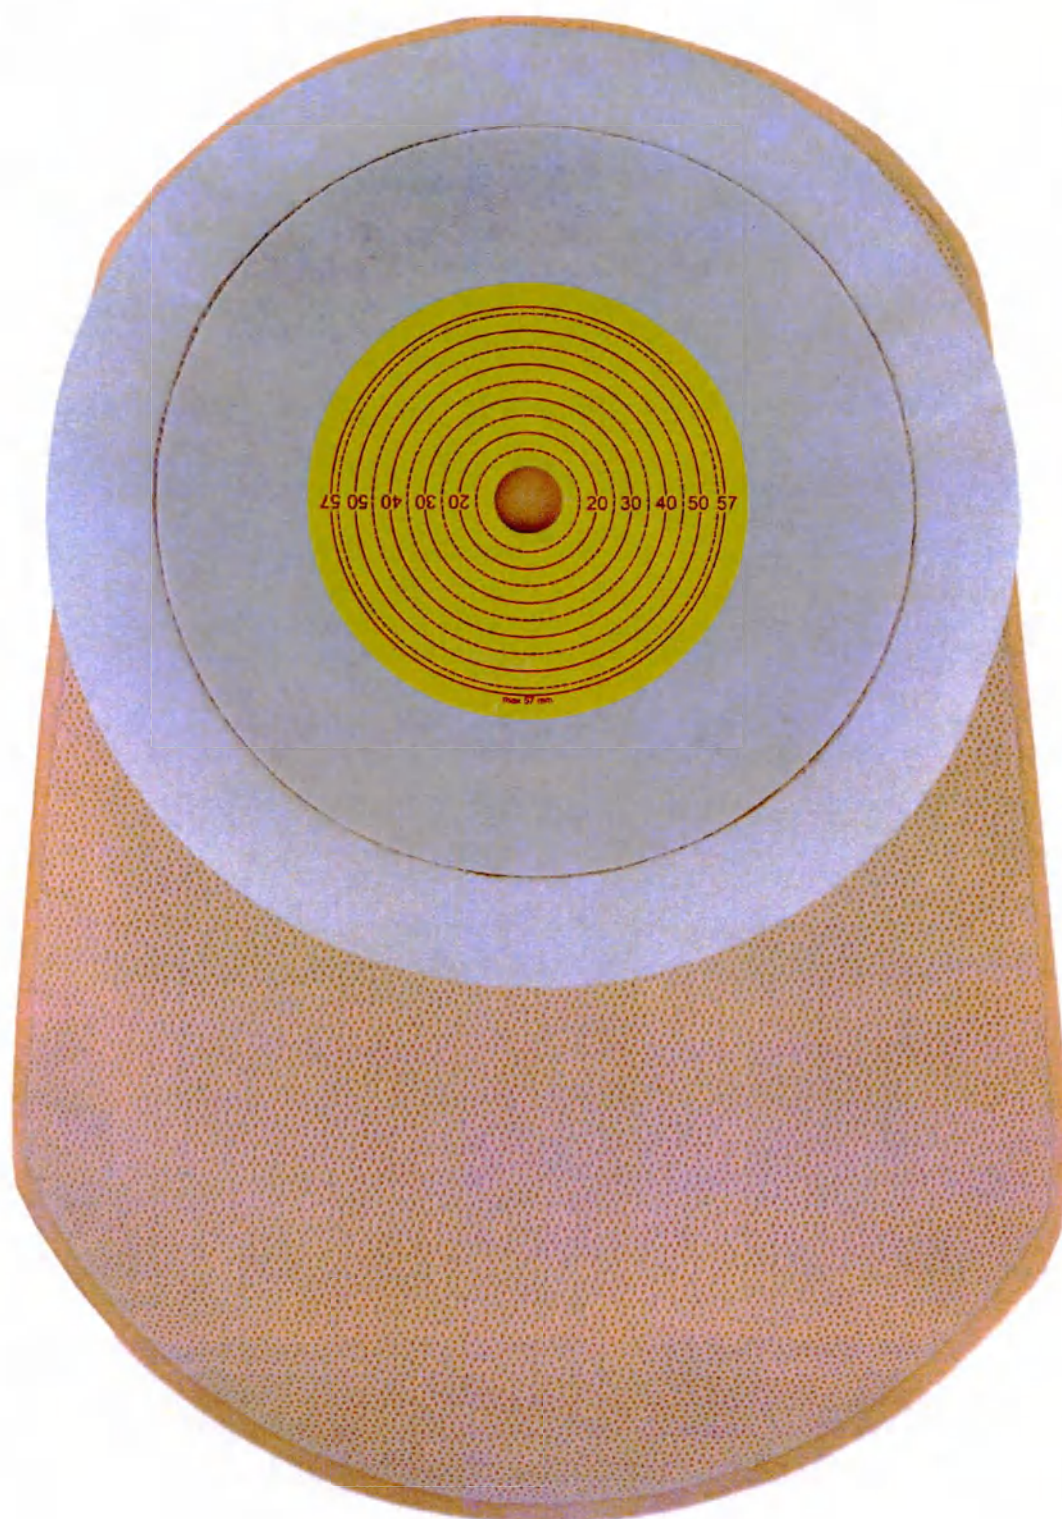

1.2. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников:

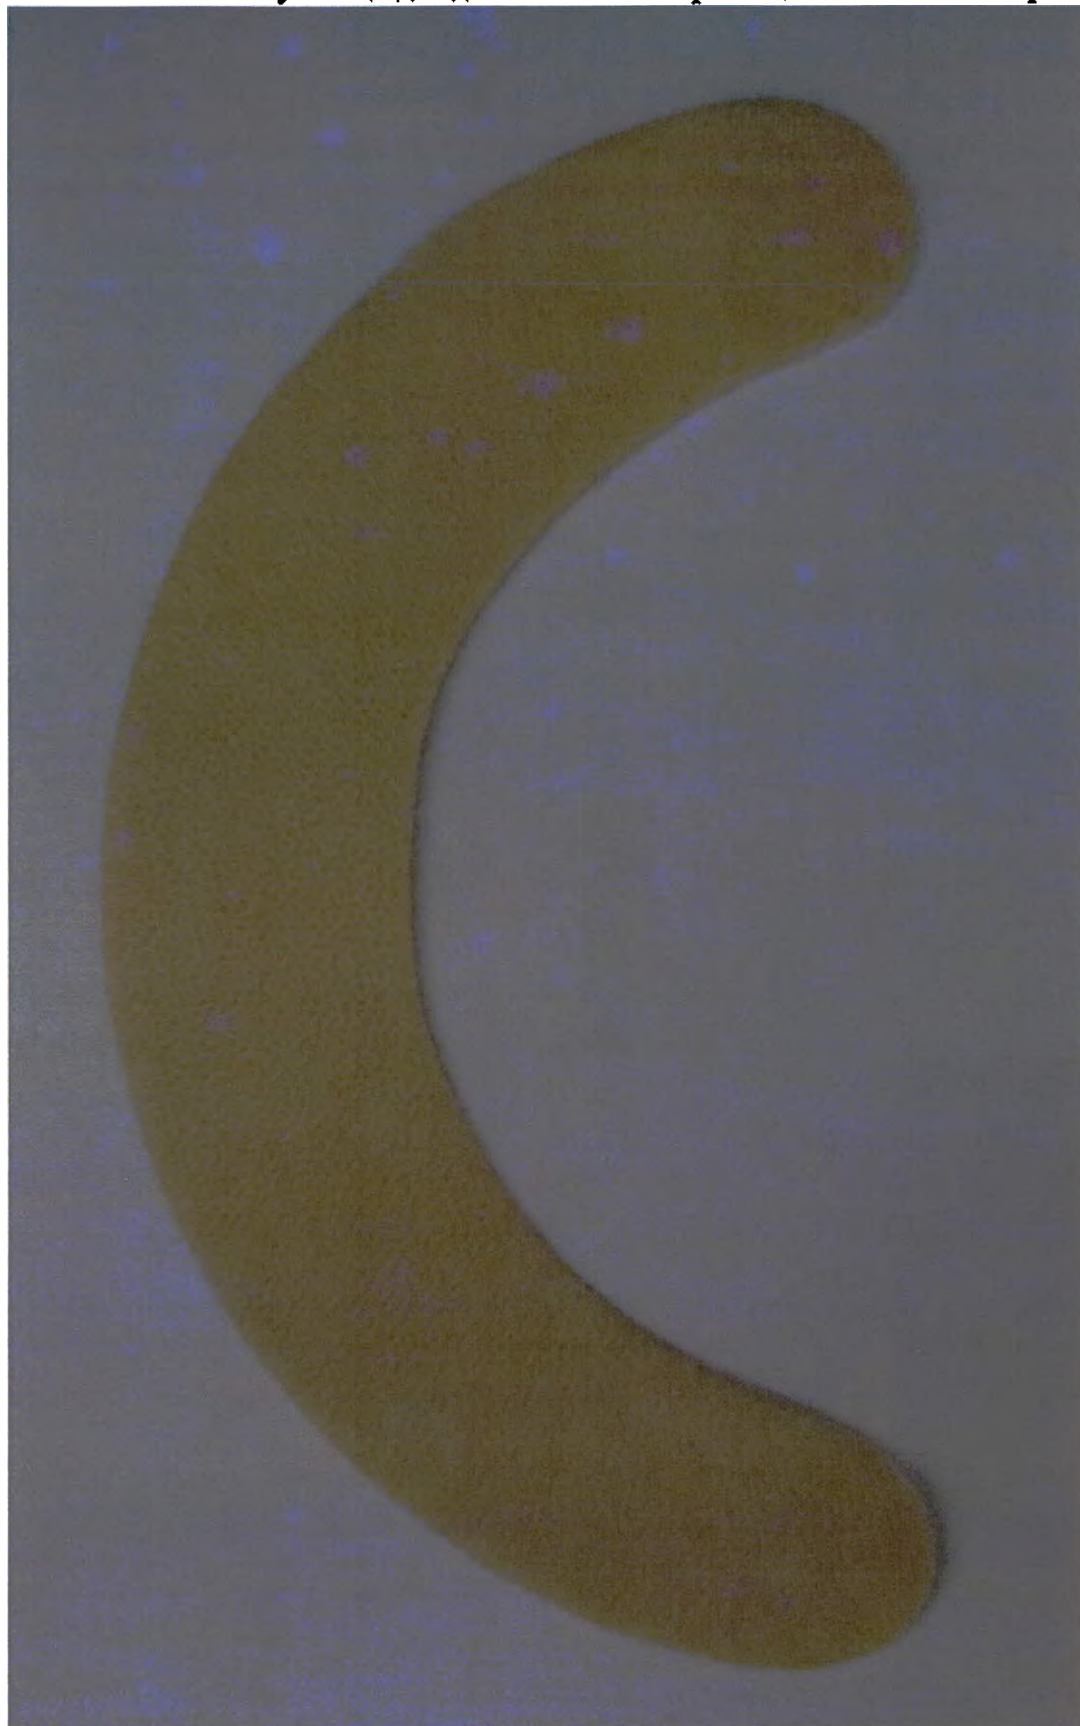


2. Калоприемник однокомпонентный дренируемый, в составе:

2.1. Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной, с зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:


ОДп ФП мини; ОДп ФП медиум; ОДп ФП макси;



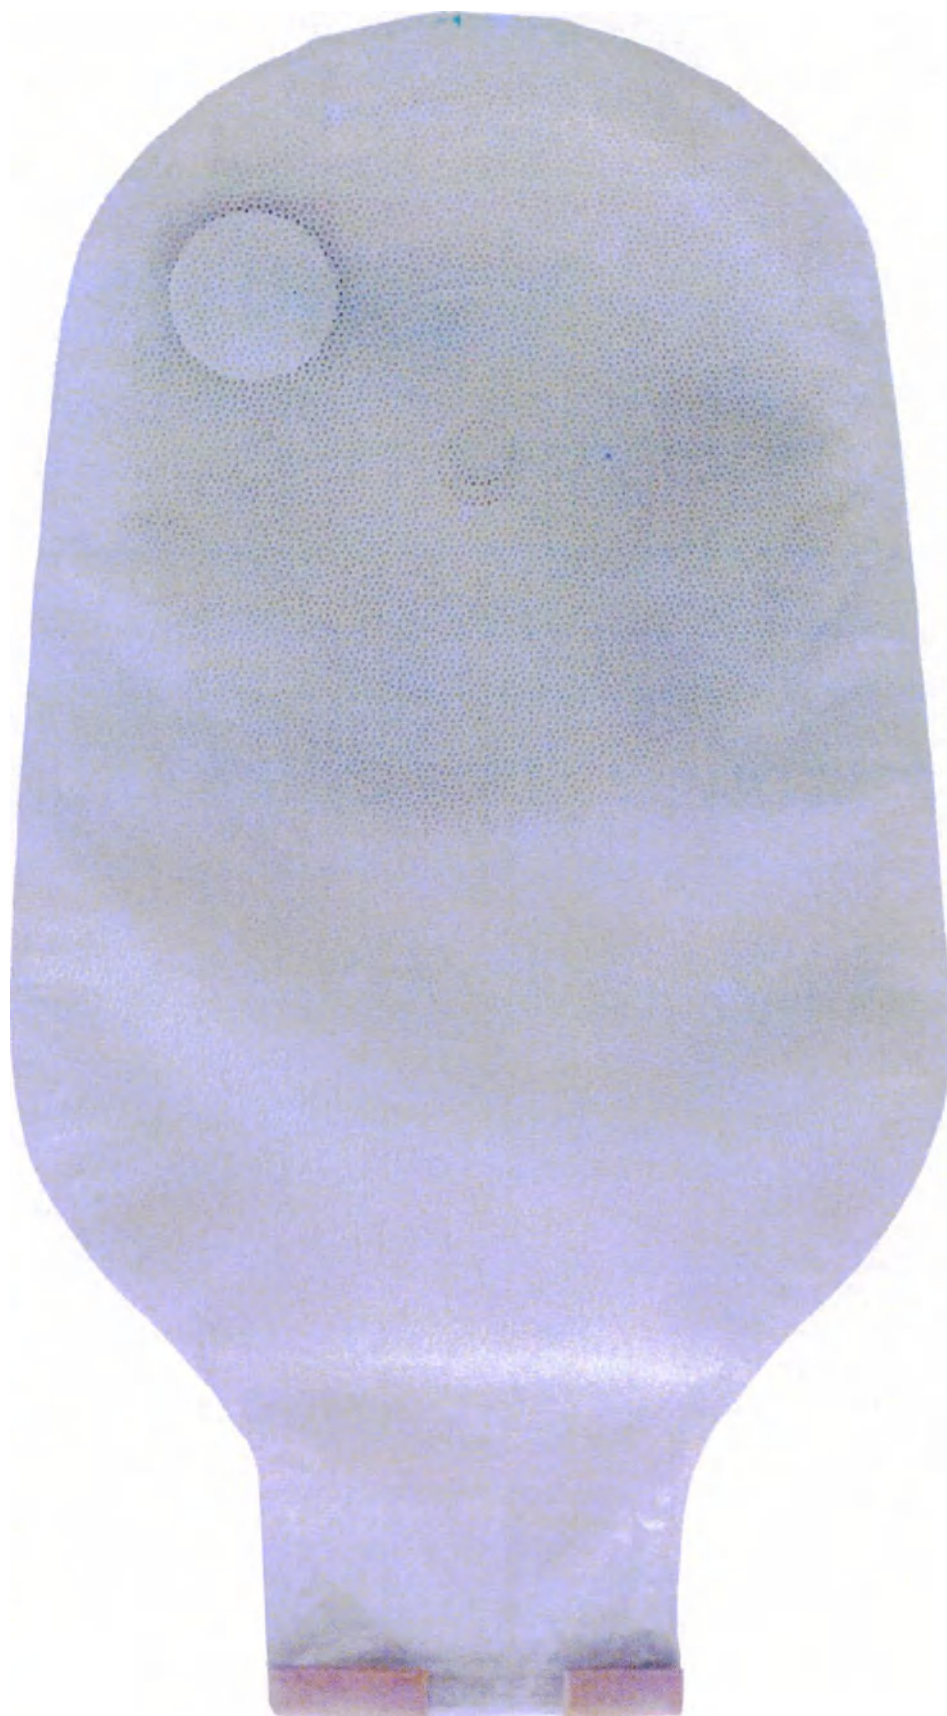

Вид сзади

Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной, с зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ОДл ФП мини; ОДл ФП медиум; ОДл ФП макси;

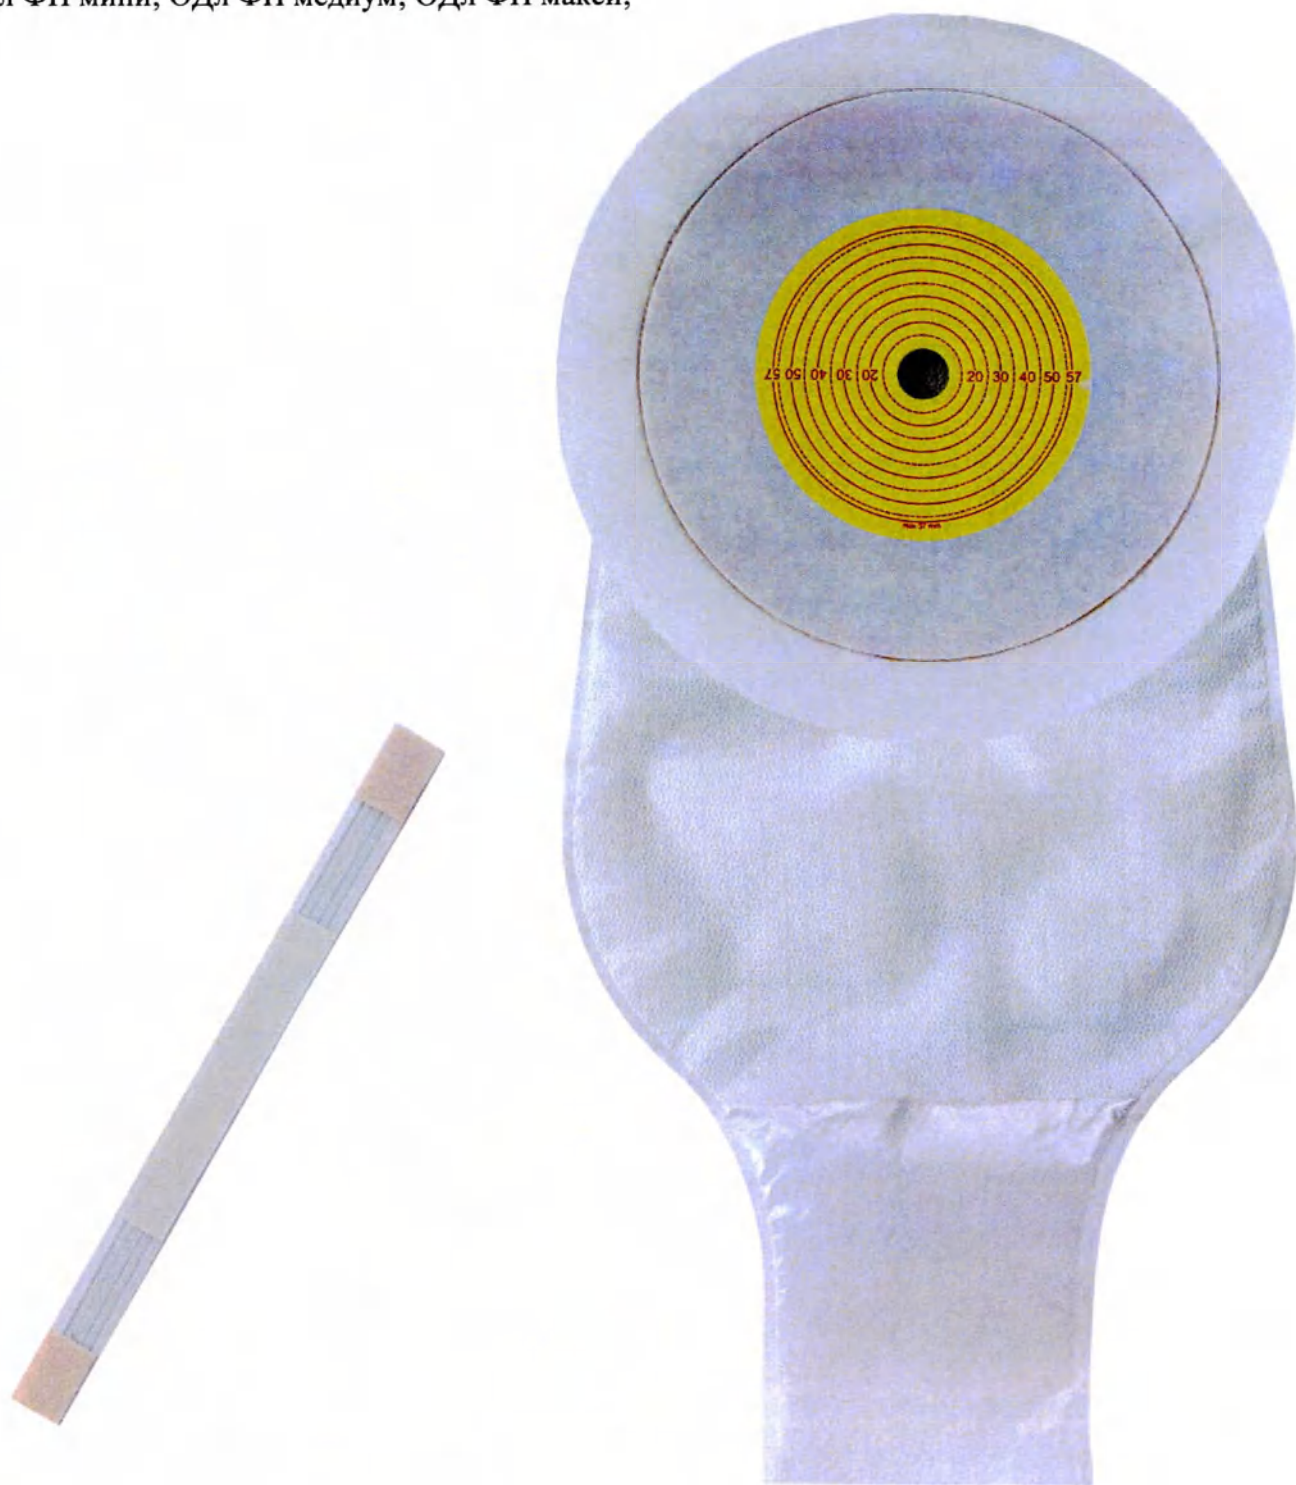




Вид сзади


Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной, с зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ОДп БП мини; ОДп БП медиум; ОДп БП макси:



Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной, с зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ОДл БП мини; ОДл БП медиум; ОДл БП макси;

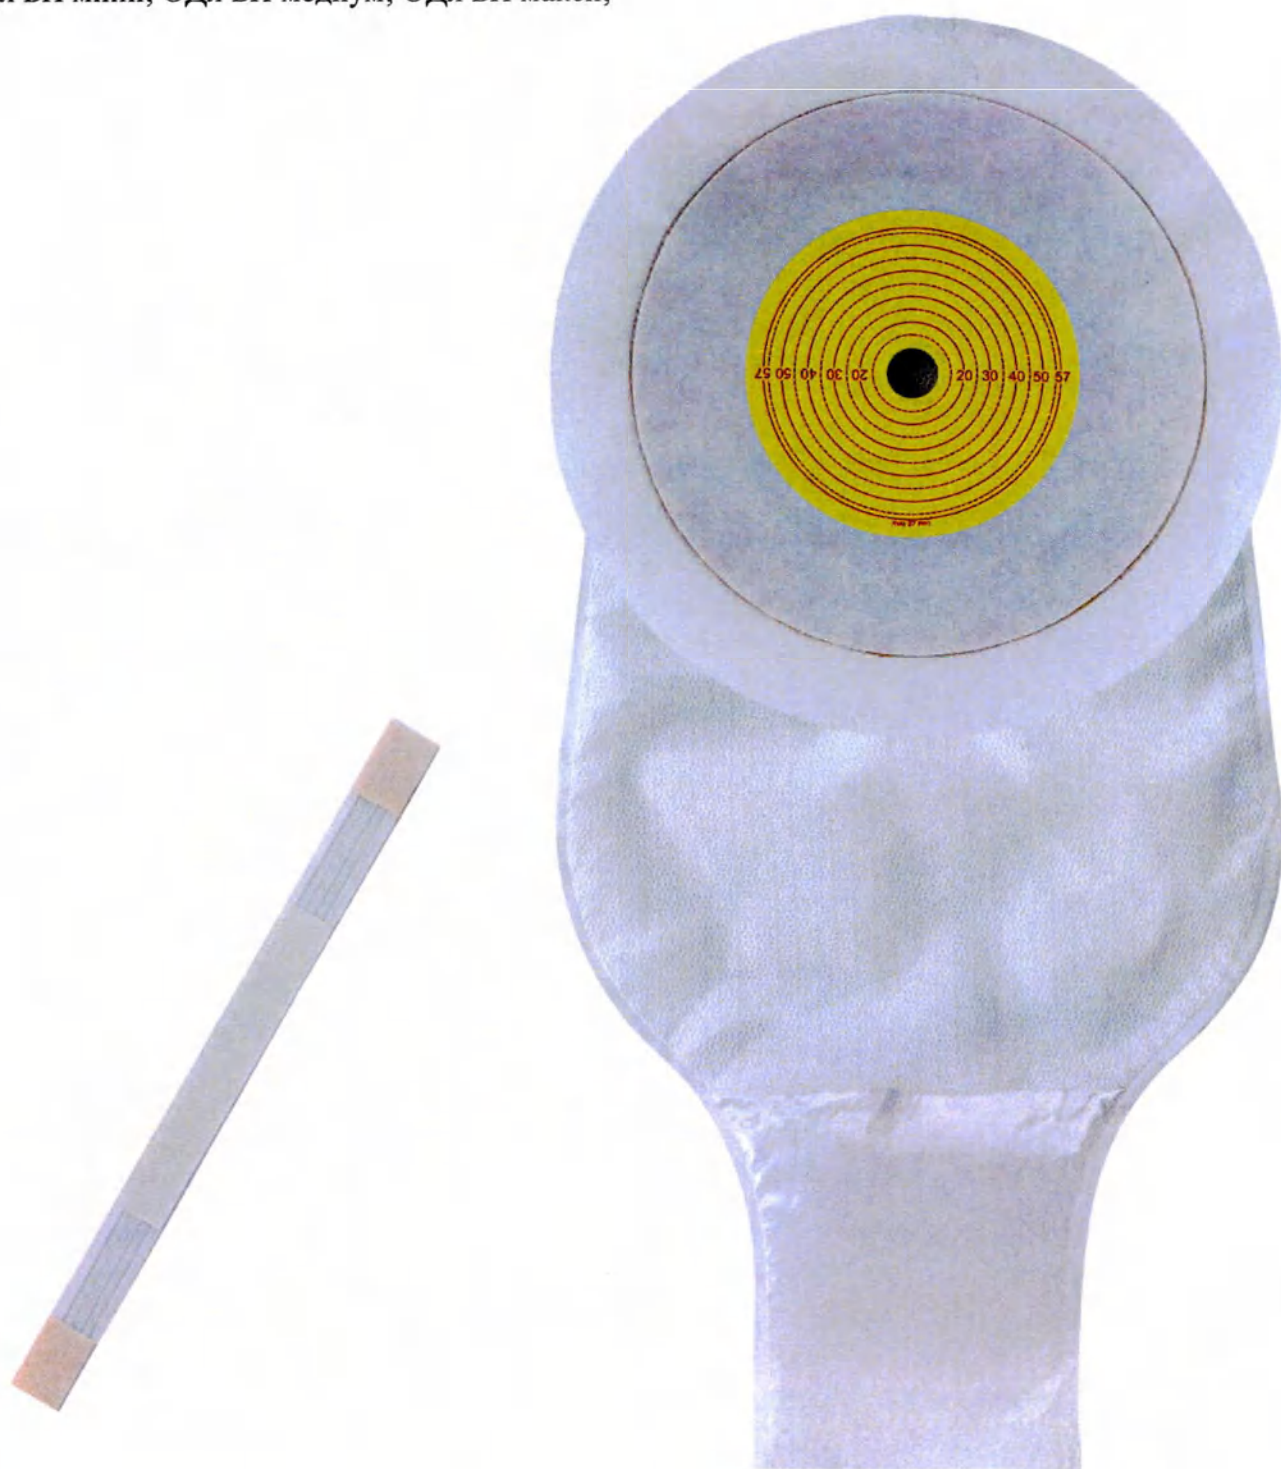


Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной, с зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ОДп ФН мини; ОДп ФН медиум; ОДп ФН макси;

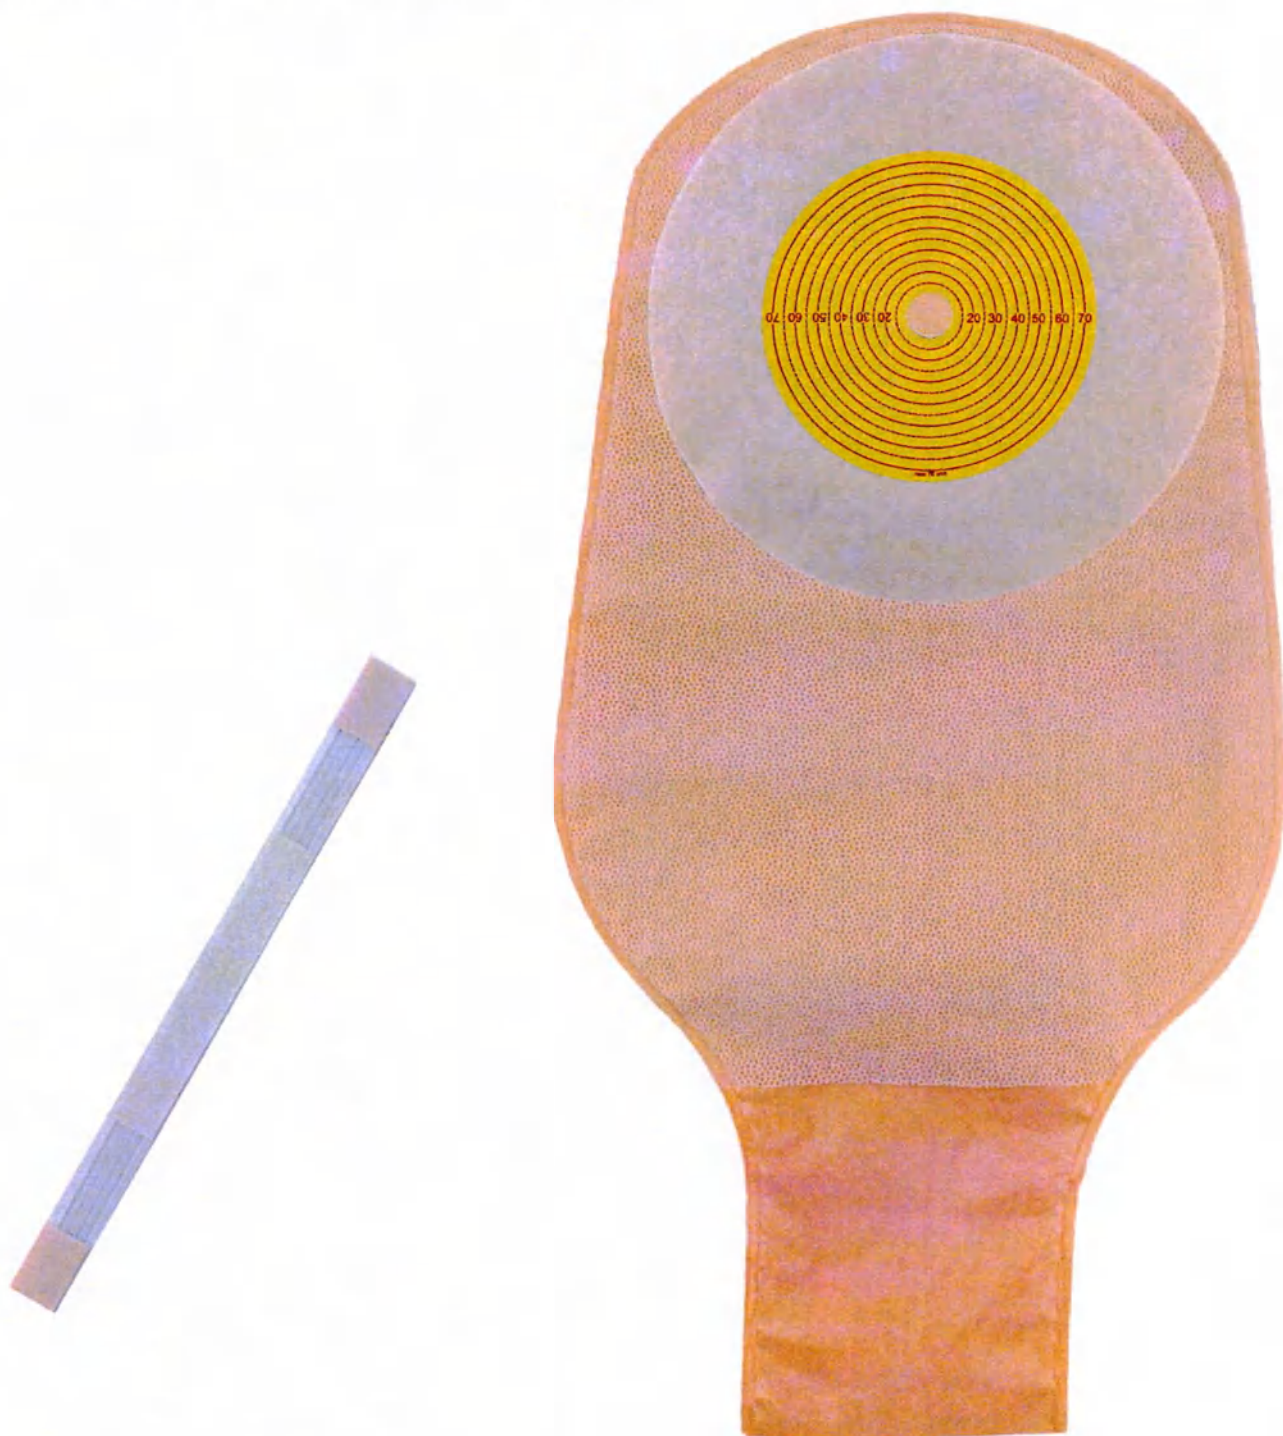



Вид сзади


Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной, с зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ОДл ФН мини; ОДл ФН медиум; ОДл ФН макси:

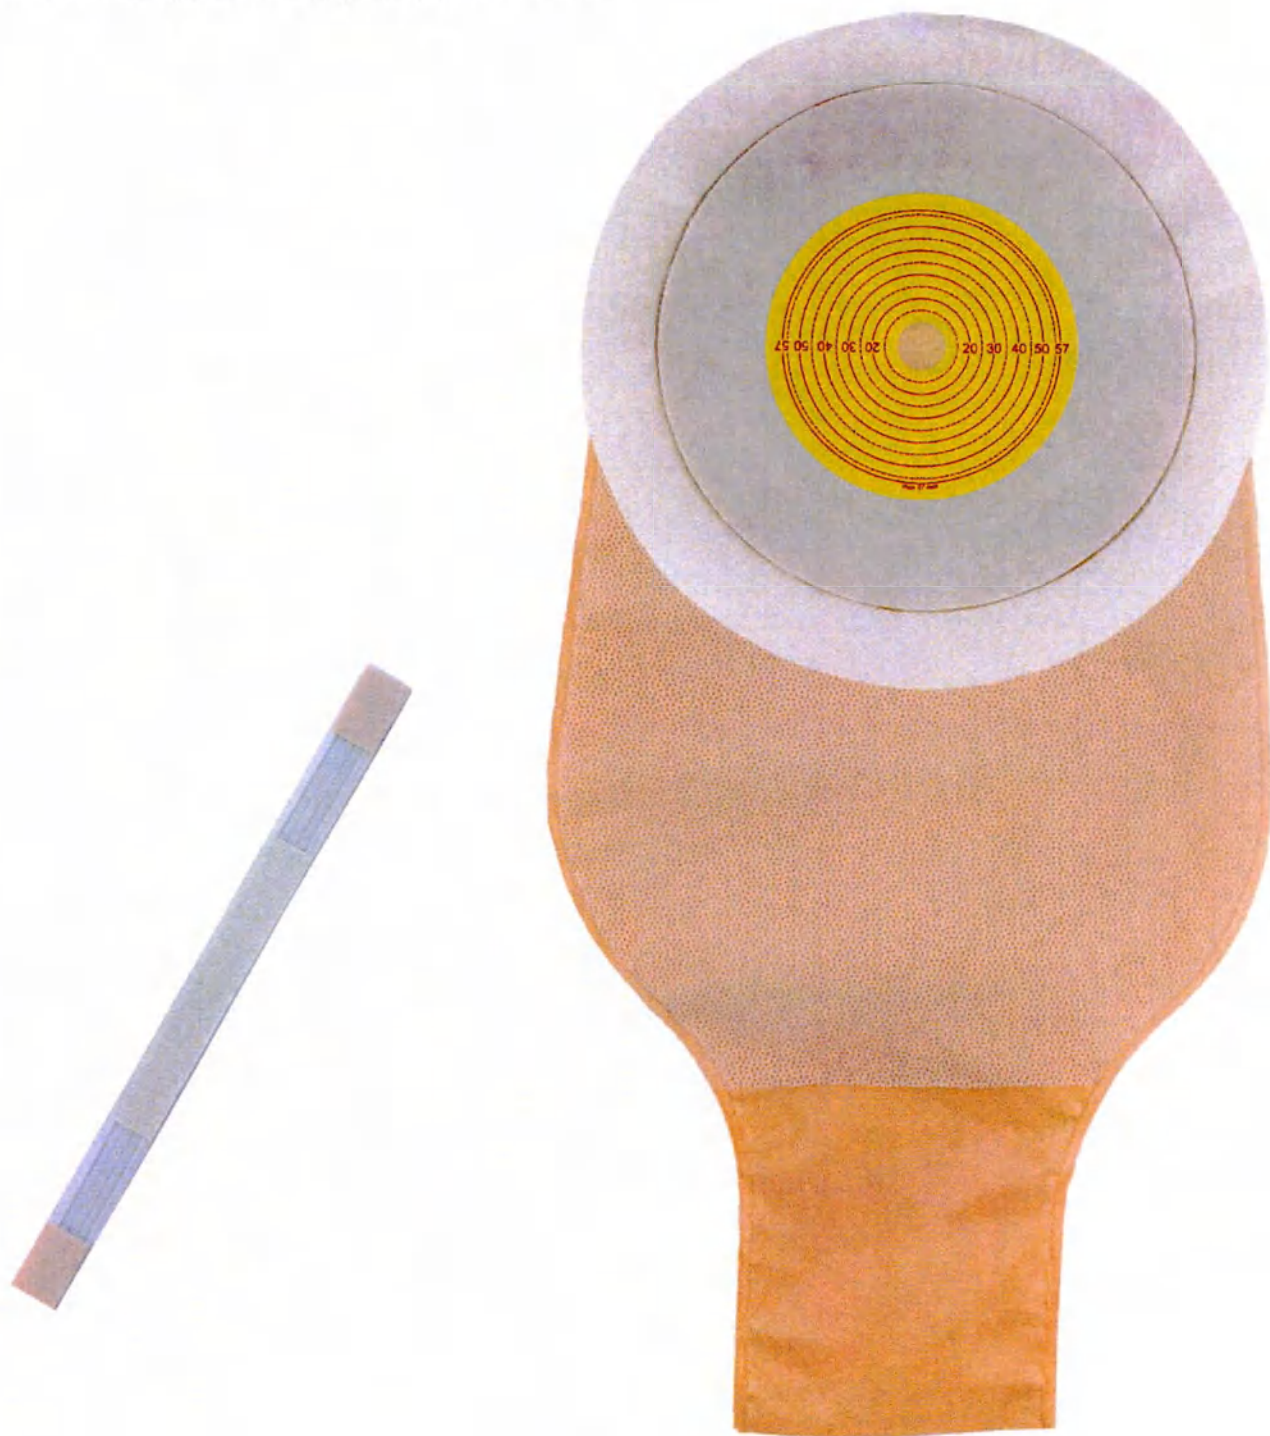




Вид сзади


Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной, с зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ОДп БН мини; ОДп БН медиум; ОДп БН макси;

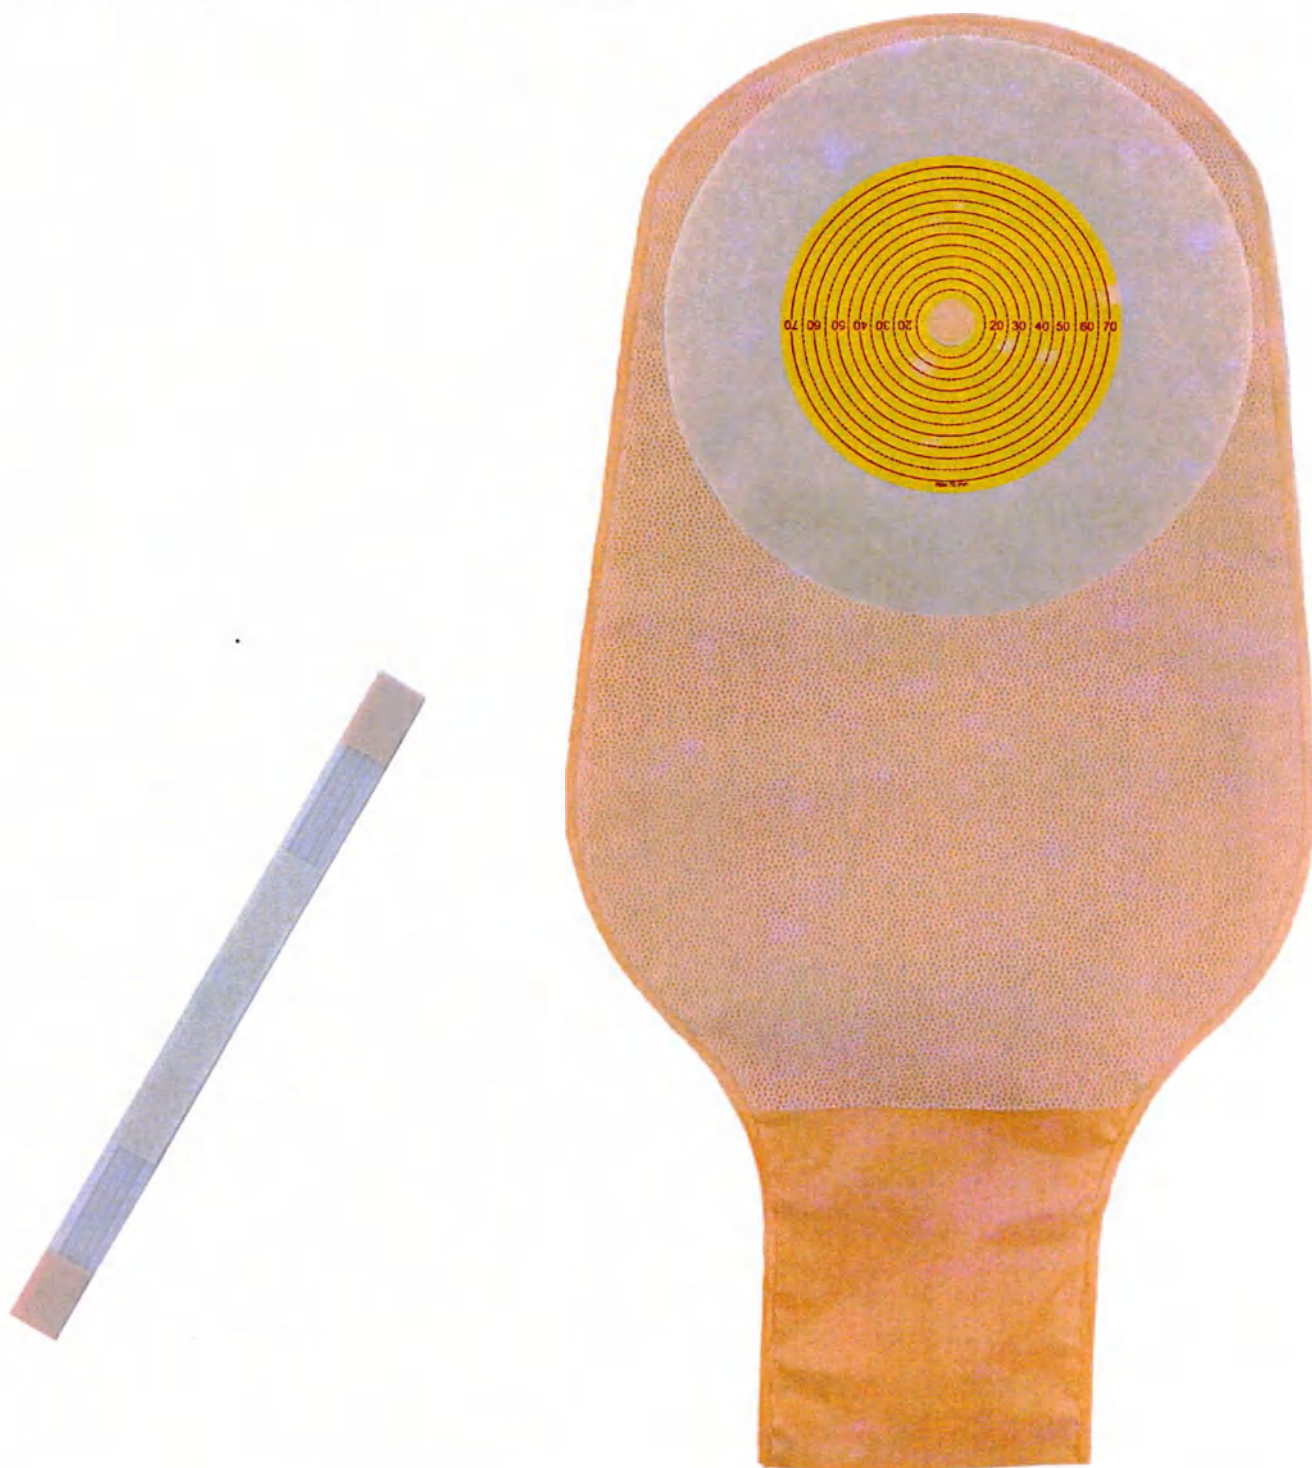

Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной адгезивной пластиной, с зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ОДл БН мини; ОДл БН медиум; ОДл БН макси,

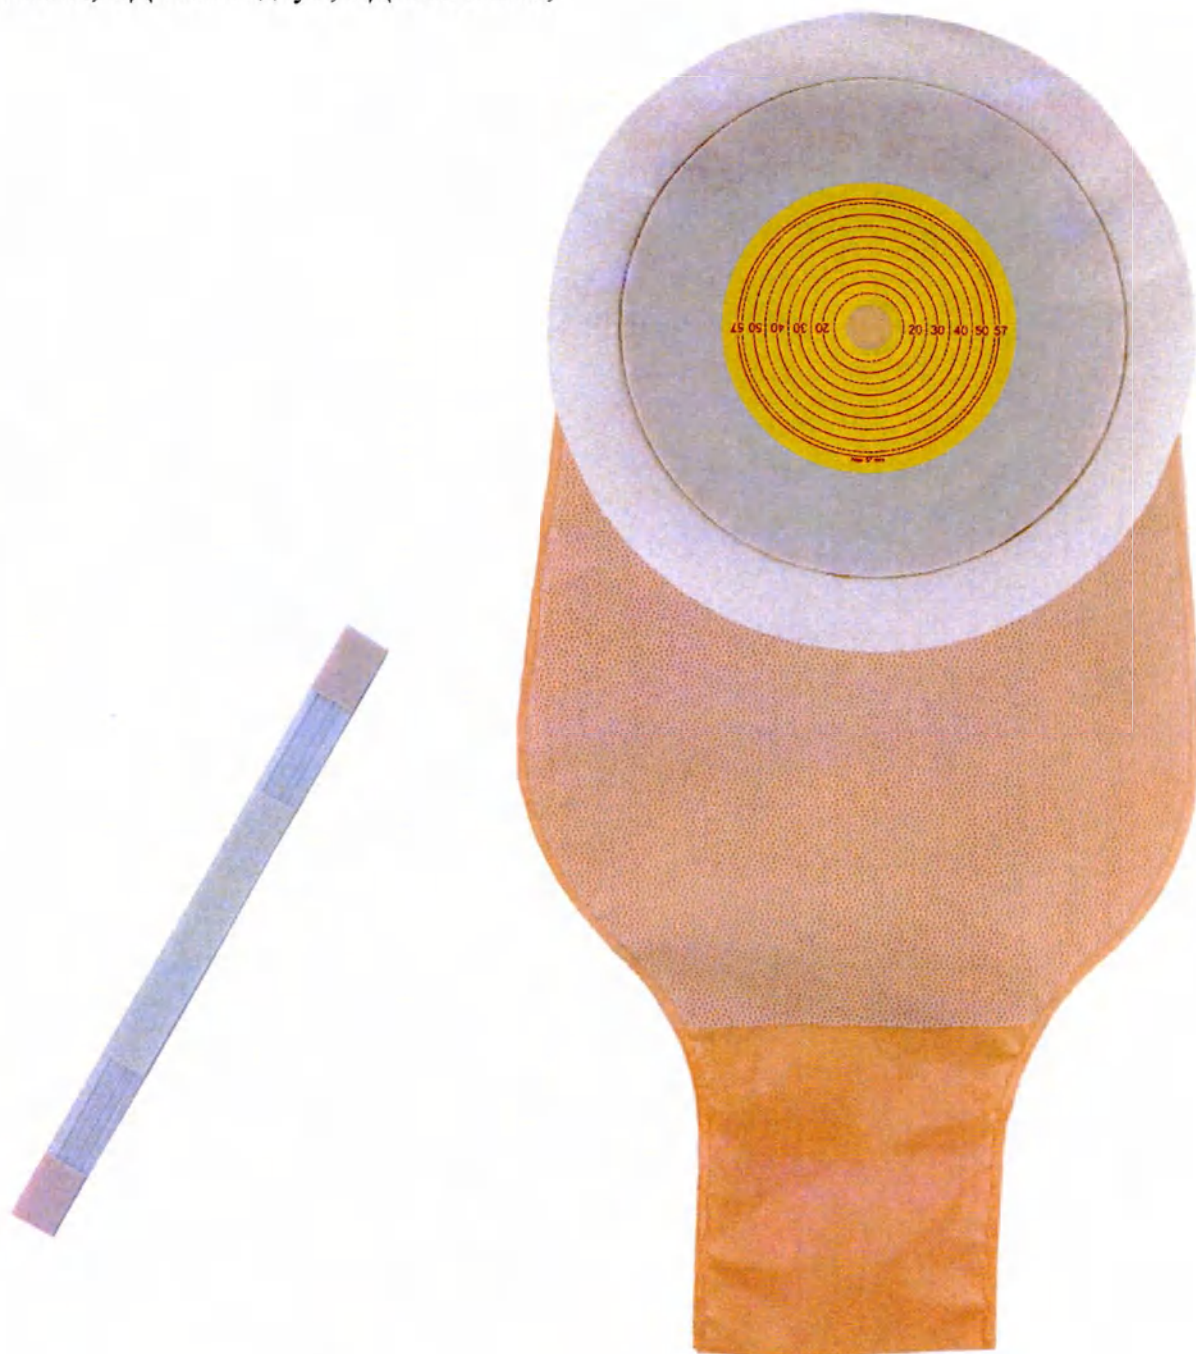

2.2. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников:

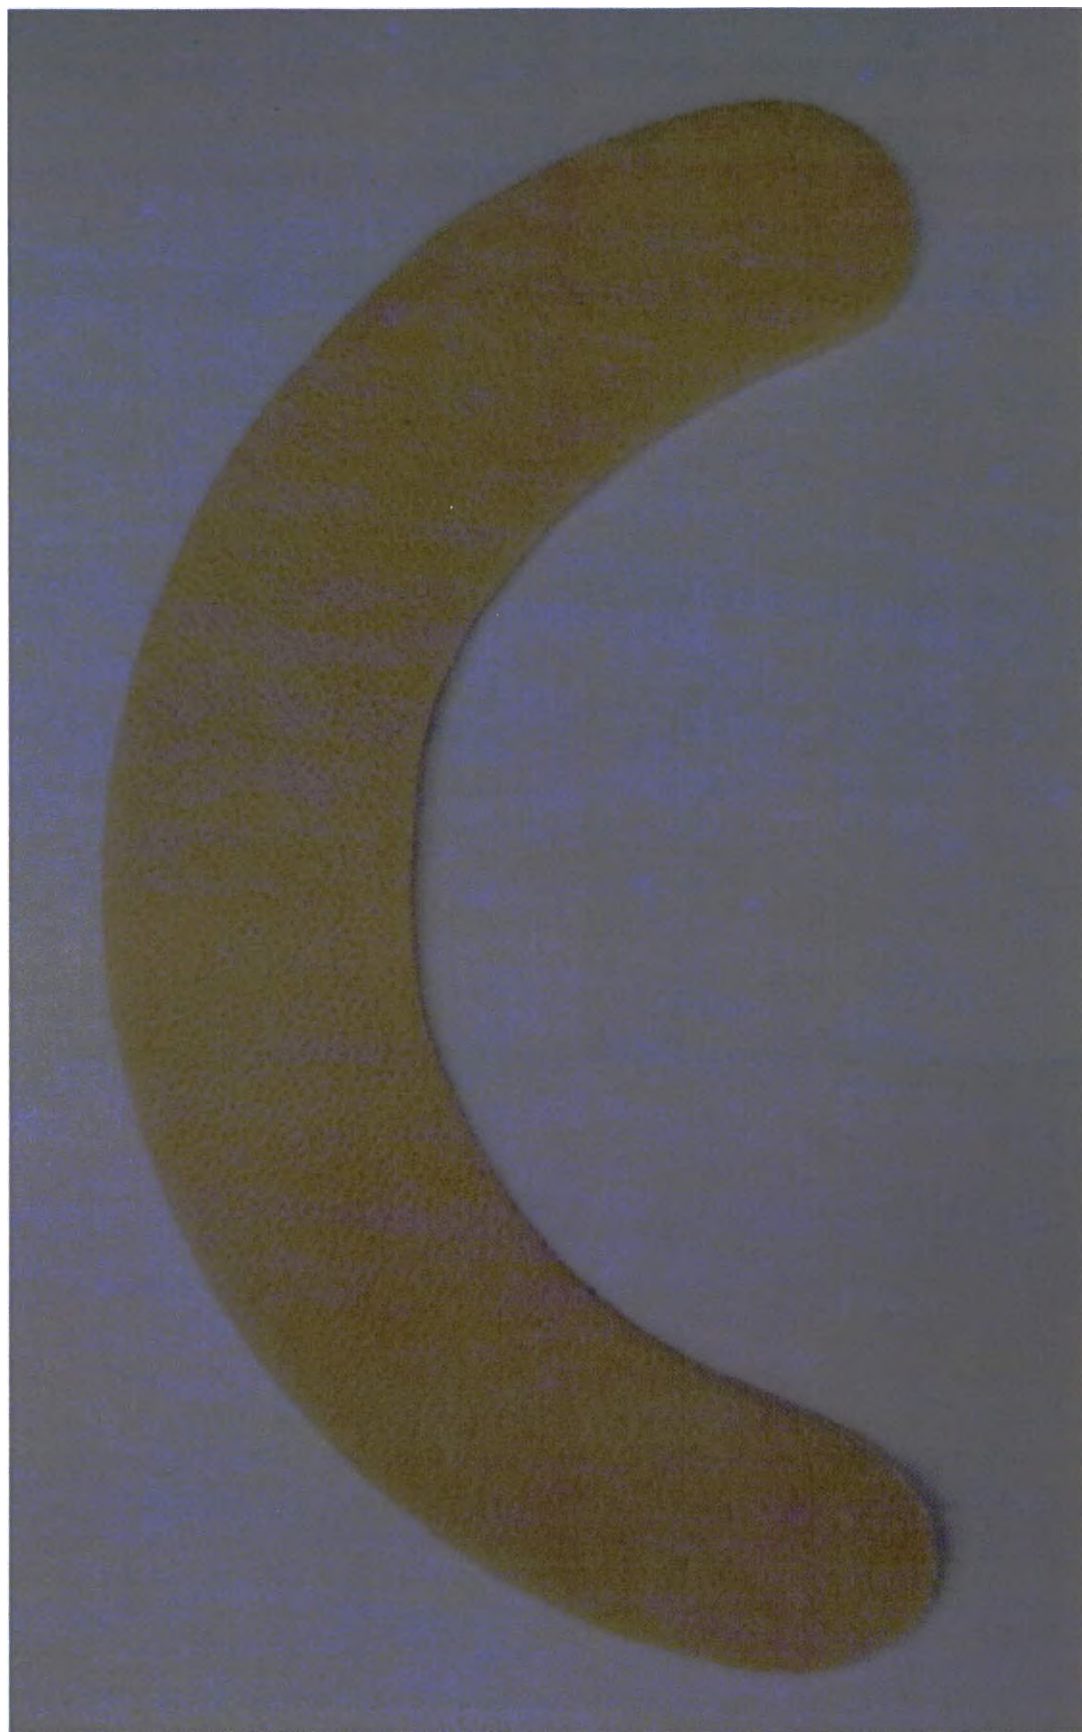


3. Калоприемник двухкомпонентный недренируемый, в составе:

3.1. Калоприемник двухкомпонентный недренируемый со стомным мешком и адгезивной пластиной, варианты исполнения:

ДНп ФПн мини; ДНп ФПн медиум; ДНп ФПн макси;




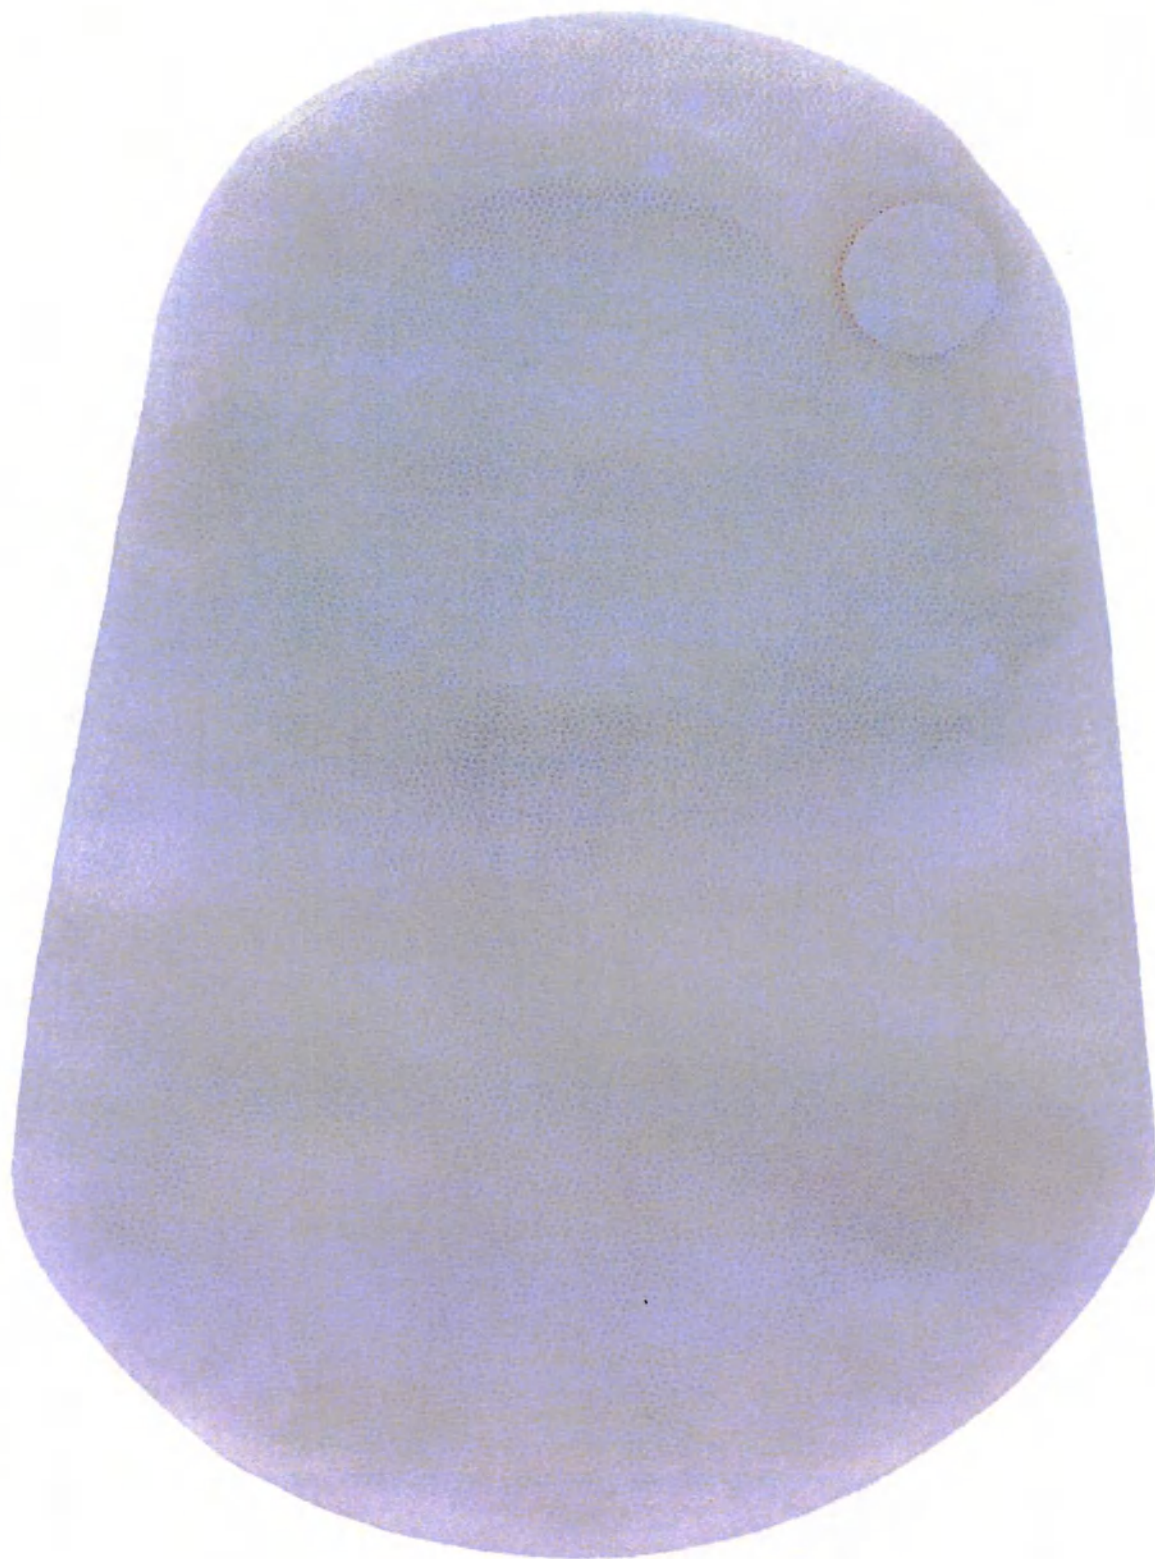

Вид сзади

Калоприемник двухкомпонентный недренируемый со стомным мешком и адгезивной пластиной, варианты исполнения:

ДНл ФПн мини; ДНл ФПн медиум; ДНл ФПн макси:

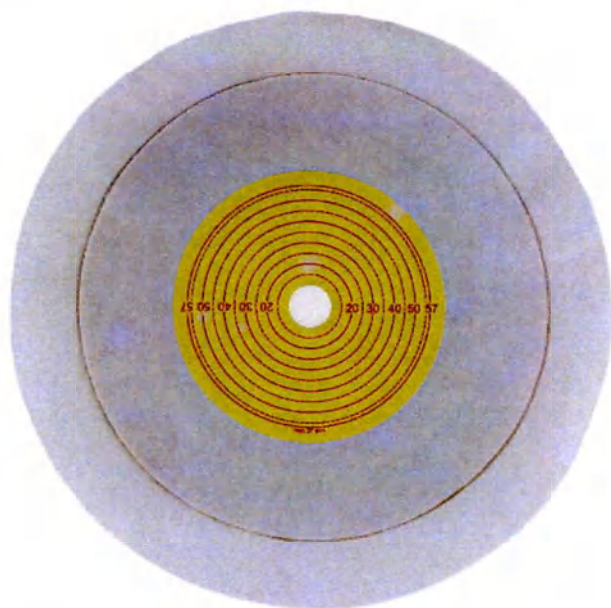



Вид сзади

Калоприемник двухкомпонентный недренируемый со стомным мешком и адгезивной пластиной, варианты исполнения:

ДНп БПн мини; ДНп БПн медиум; ДНп БПн макси:



ДНл БПн мини; ДНл БПн медиум; ДНл БПн макси:



Калоприемник двухкомпонентный недренируемый со стомным мешком и адгезивной пластиной, варианты исполнения:

ДНп ФНн мини; ДНп ФНн медиум; ДНп ФНн макси:





Вид сзади

Калоприемник двухкомпонентный недренируемый со стомным мешком и адгезивной пластиной, варианты исполнения:

ДНл ФНн мини; ДНл ФНн медиум; ДНл ФНн макси:





Вид сзади

Калоприемник двухкомпонентный недренируемый со стомным мешком и адгезивной пластиной, варианты исполнения:

ДНп БНн мини; ДНп БНн медиум; ДНп БНн макси:




ДНл БНн мини; ДНл БНн медиум; ДНл БНн макси:



3.2. Стомный мешок для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, варианты исполнения:

ФПн мини; ФПн медиум; ФПн макси;



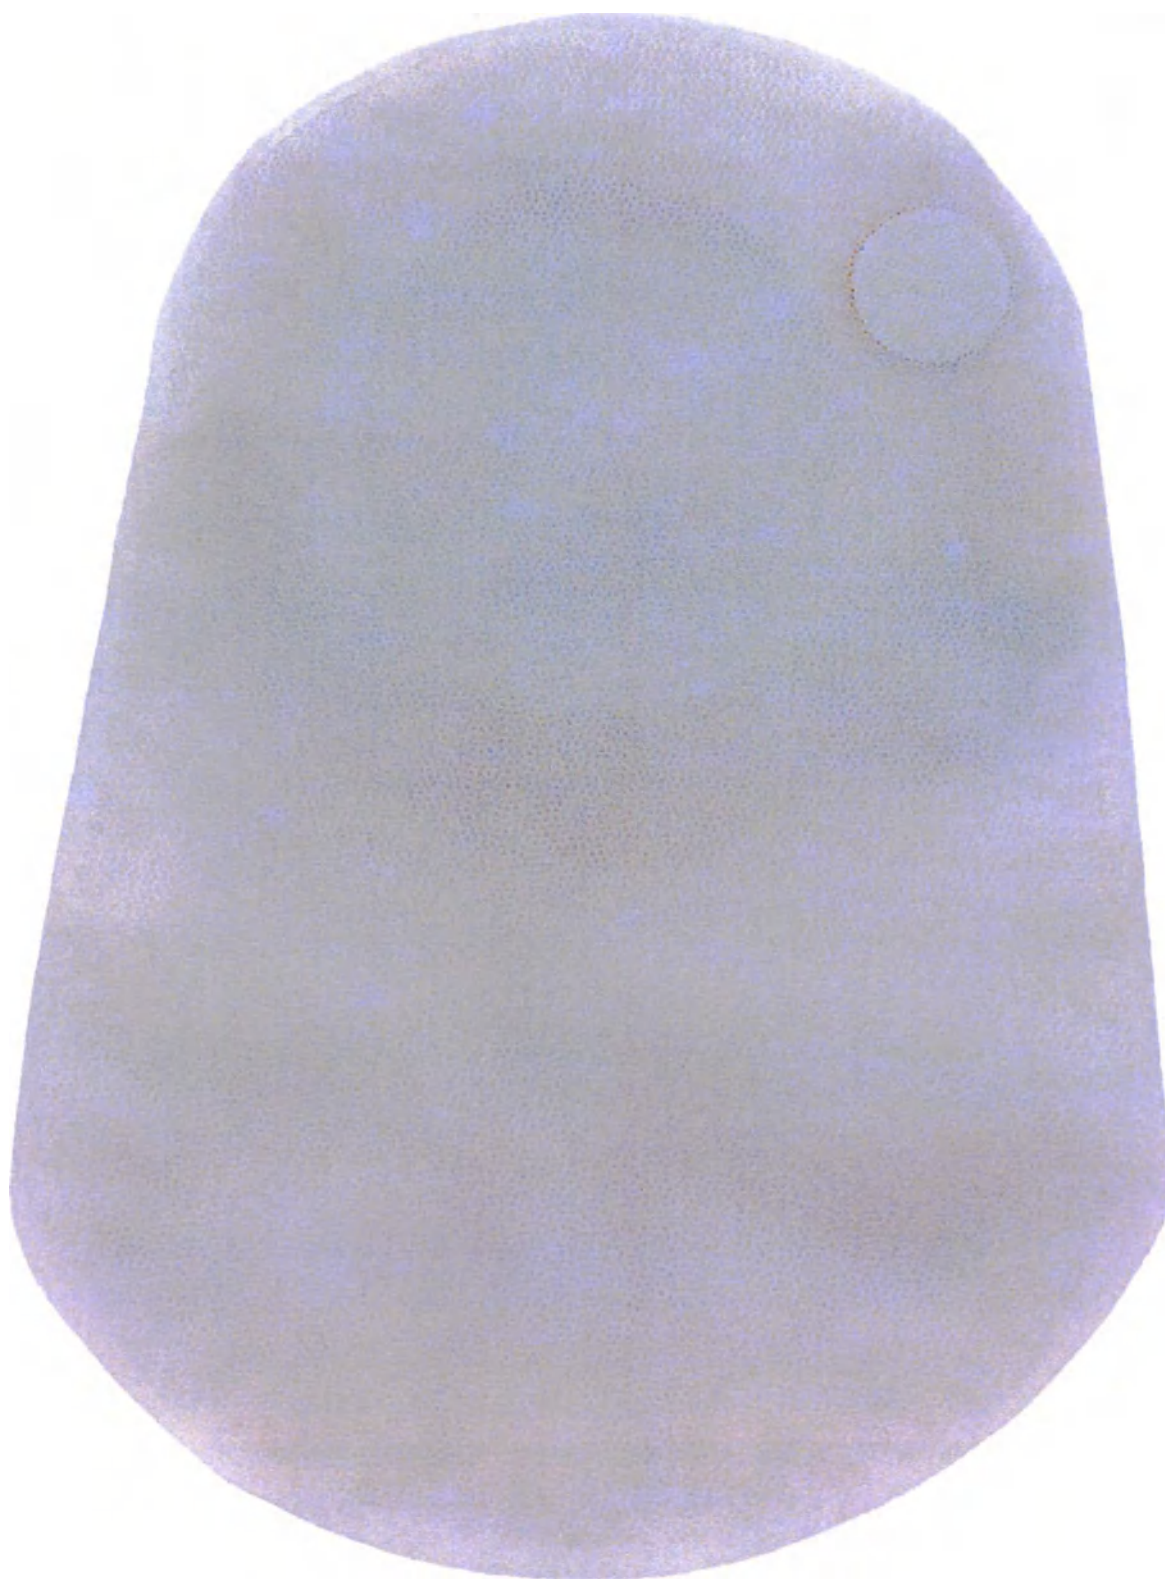

Вид сзади

Стомный мешок для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, варианты исполнения:
БПн мини; БПн медиум; БПн макси:



Стомный мешок для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, варианты исполнения:
ФНн мини; ФНн медиум; ФНн макси:




Стомный мешок для двухкомпонентного недренируемого калоприемника, варианты исполнения:
БНн мини; БНн медиум; БНн макси:




3.3. Адгезивная плоская пластина для двухкомпонентного калоприемника, вариант исполнения: КП:



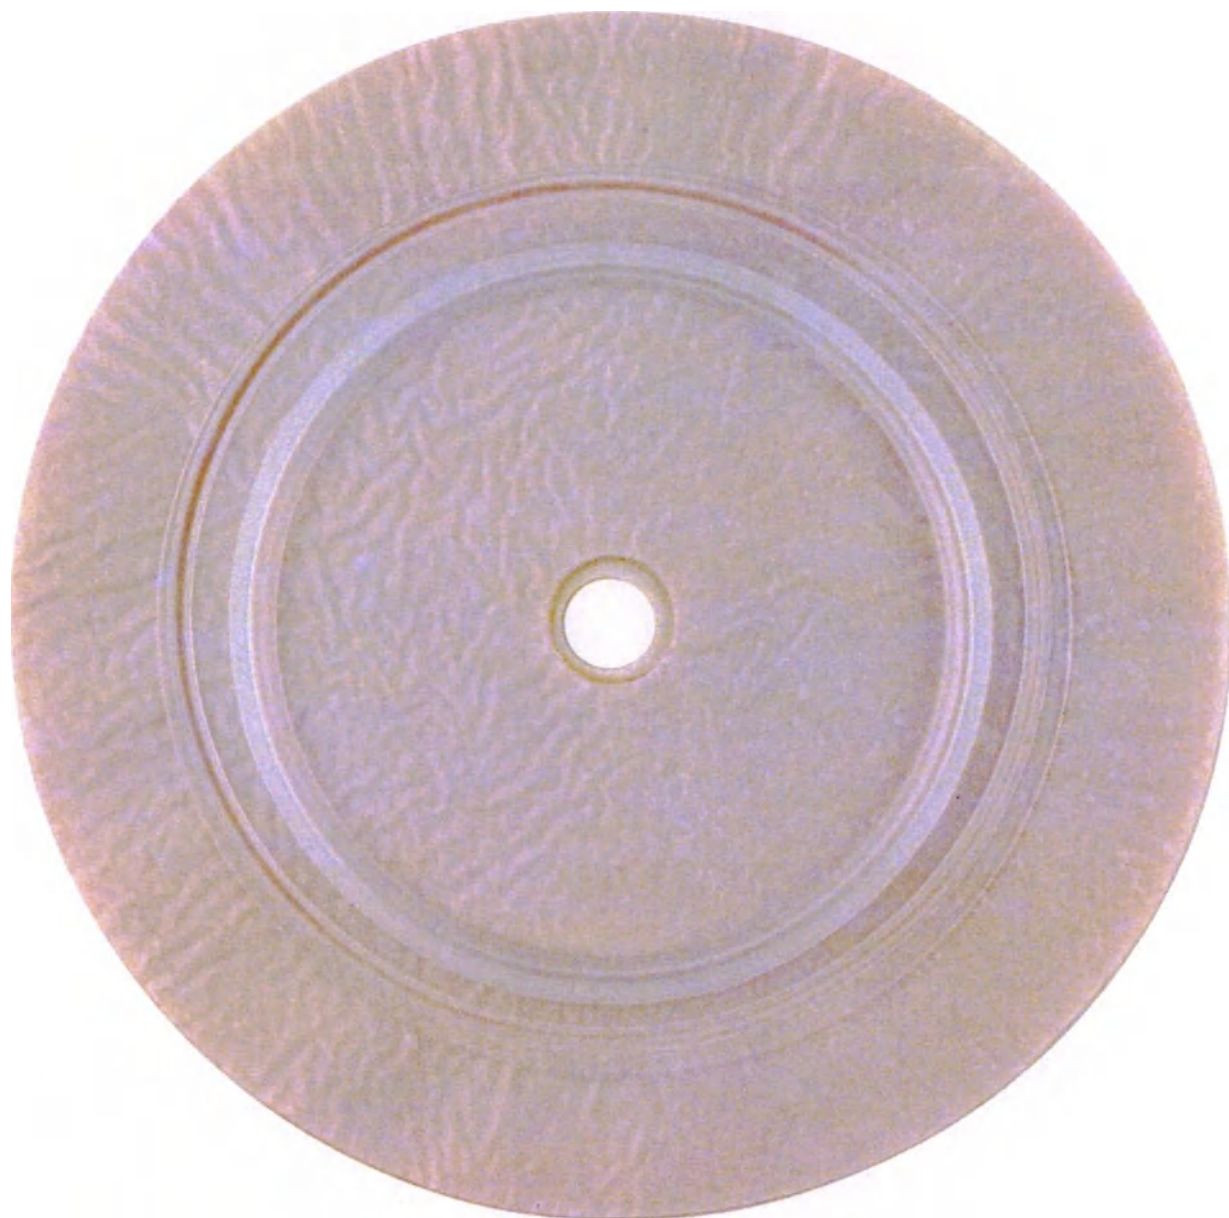


Вид сзади


Адгезивная плоская пластина для двухкомпонентного калоприемника, вариант исполнения: КЛ:

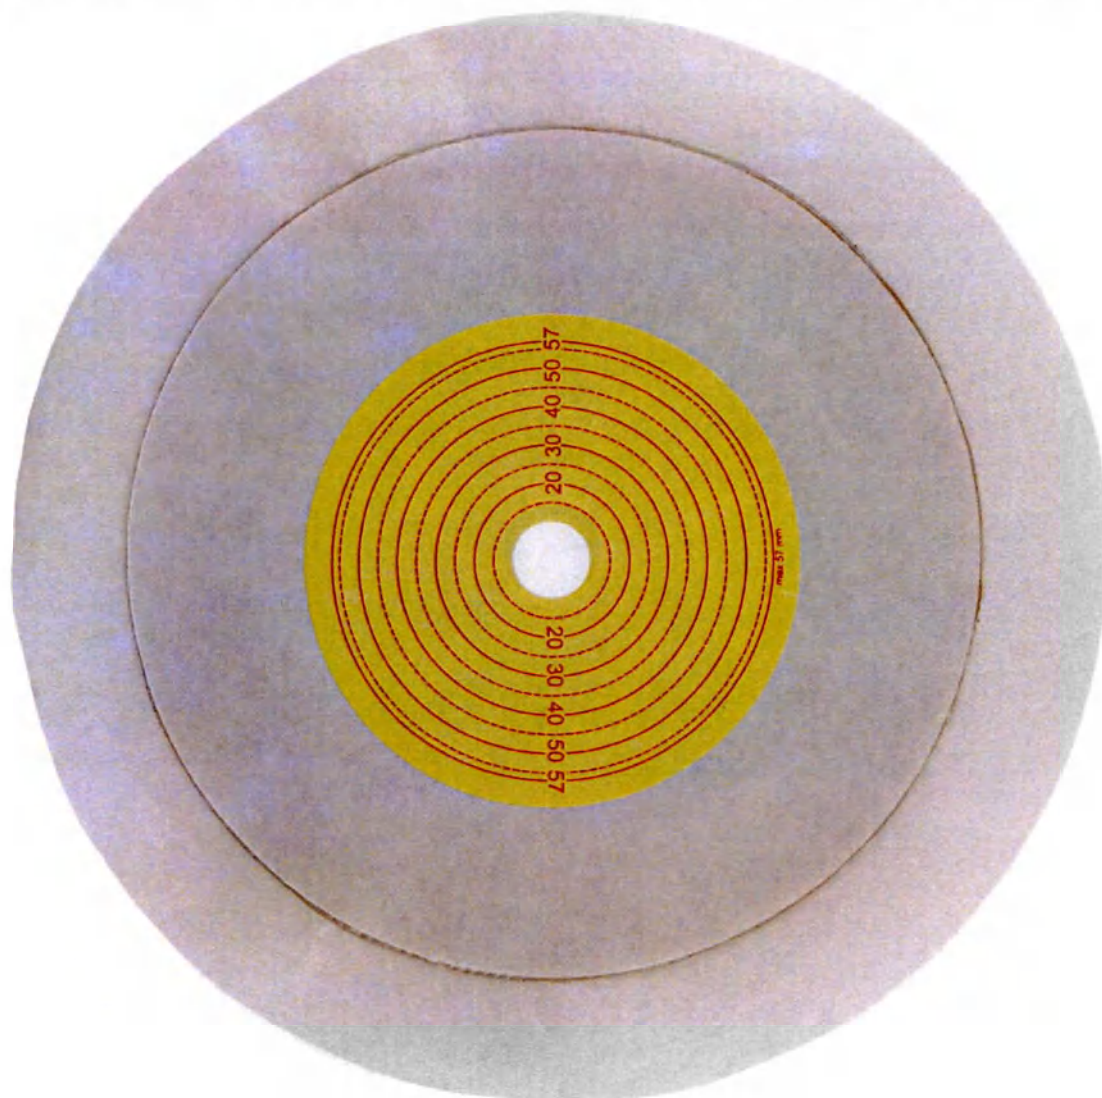




Вид сзади

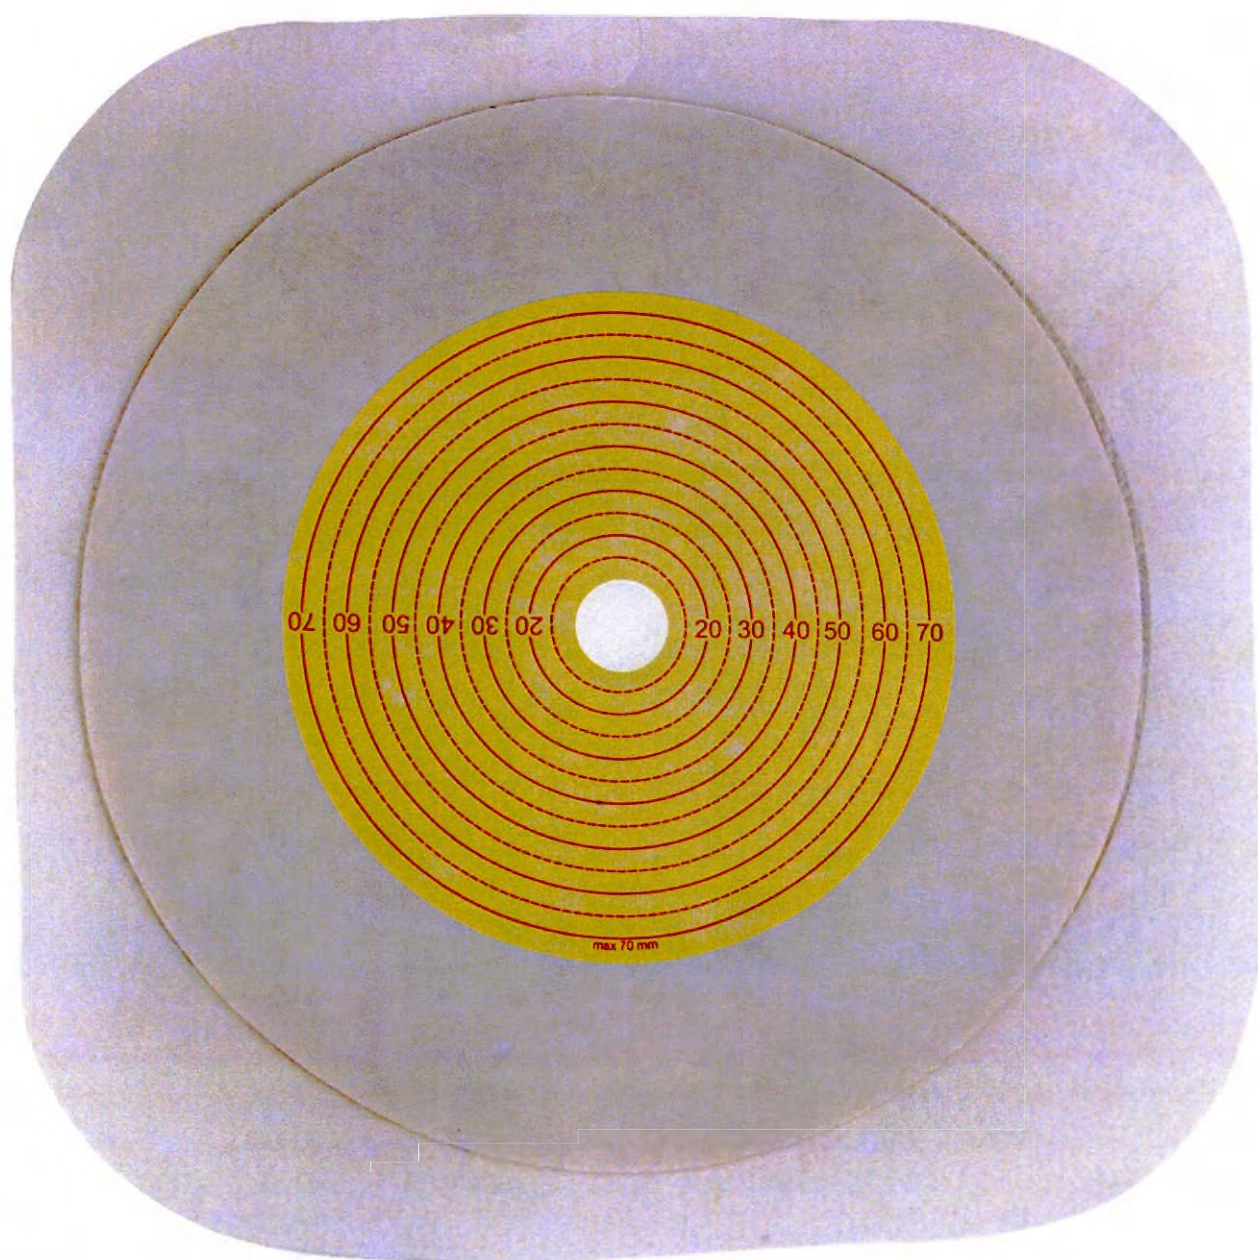

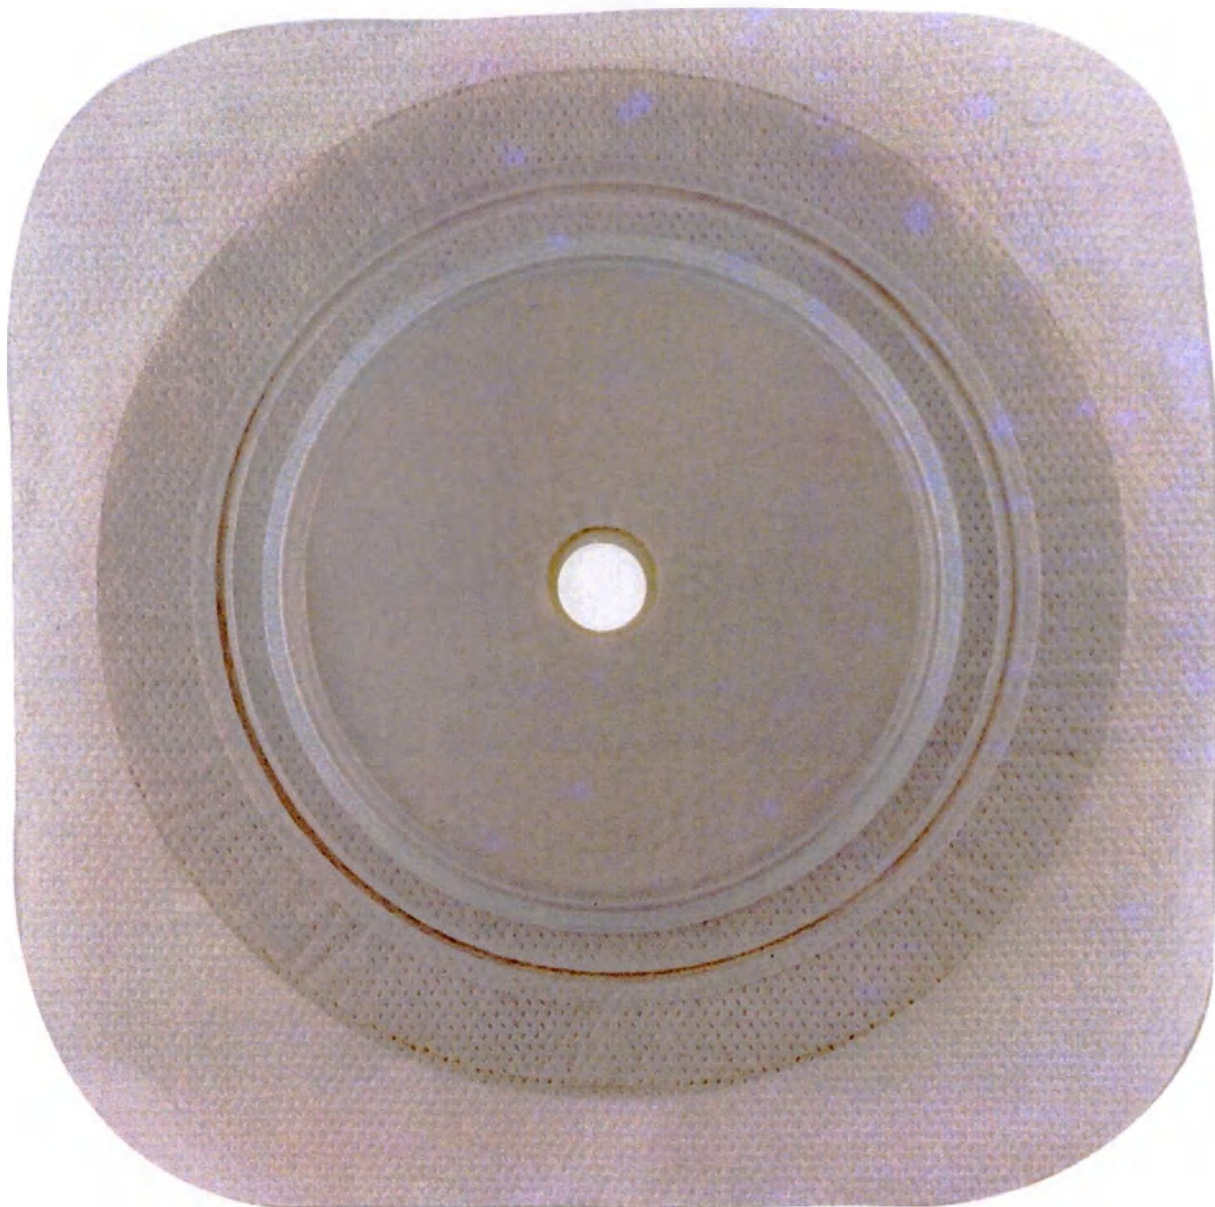


Вид сзади

3.4. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников:

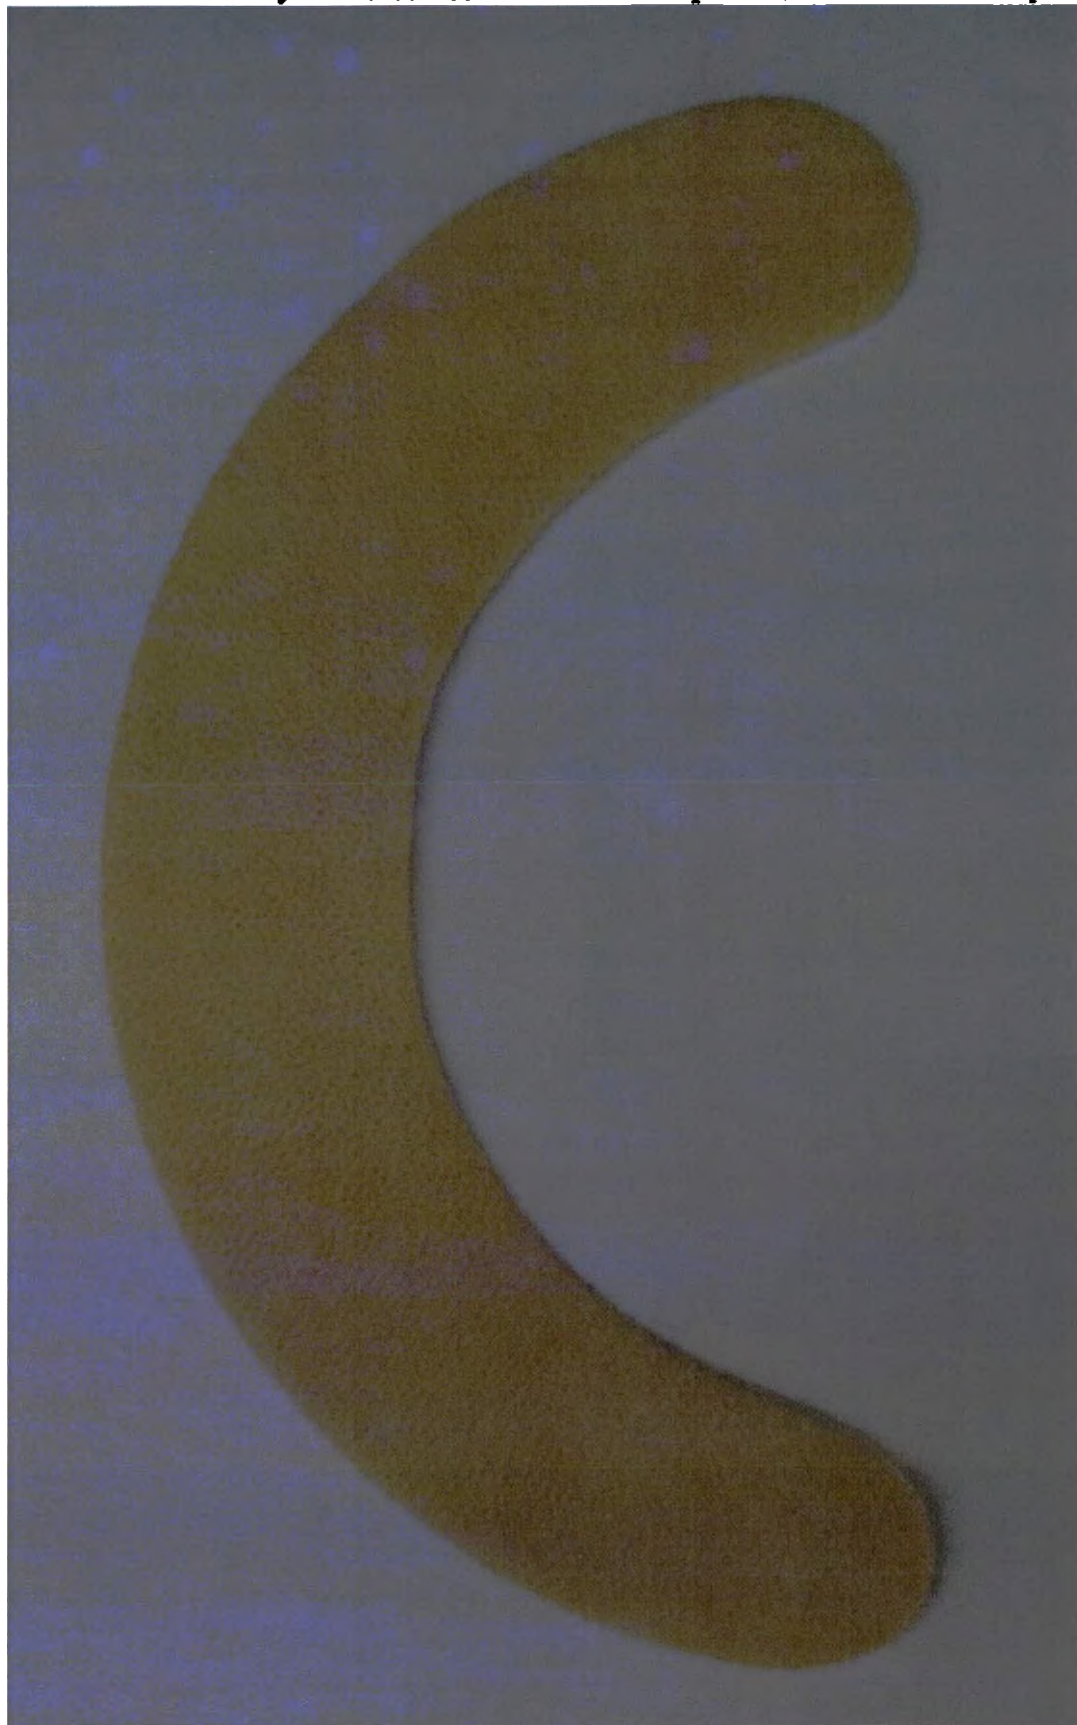

3.5. Пояс для калоприемников с регулируемой длиной:

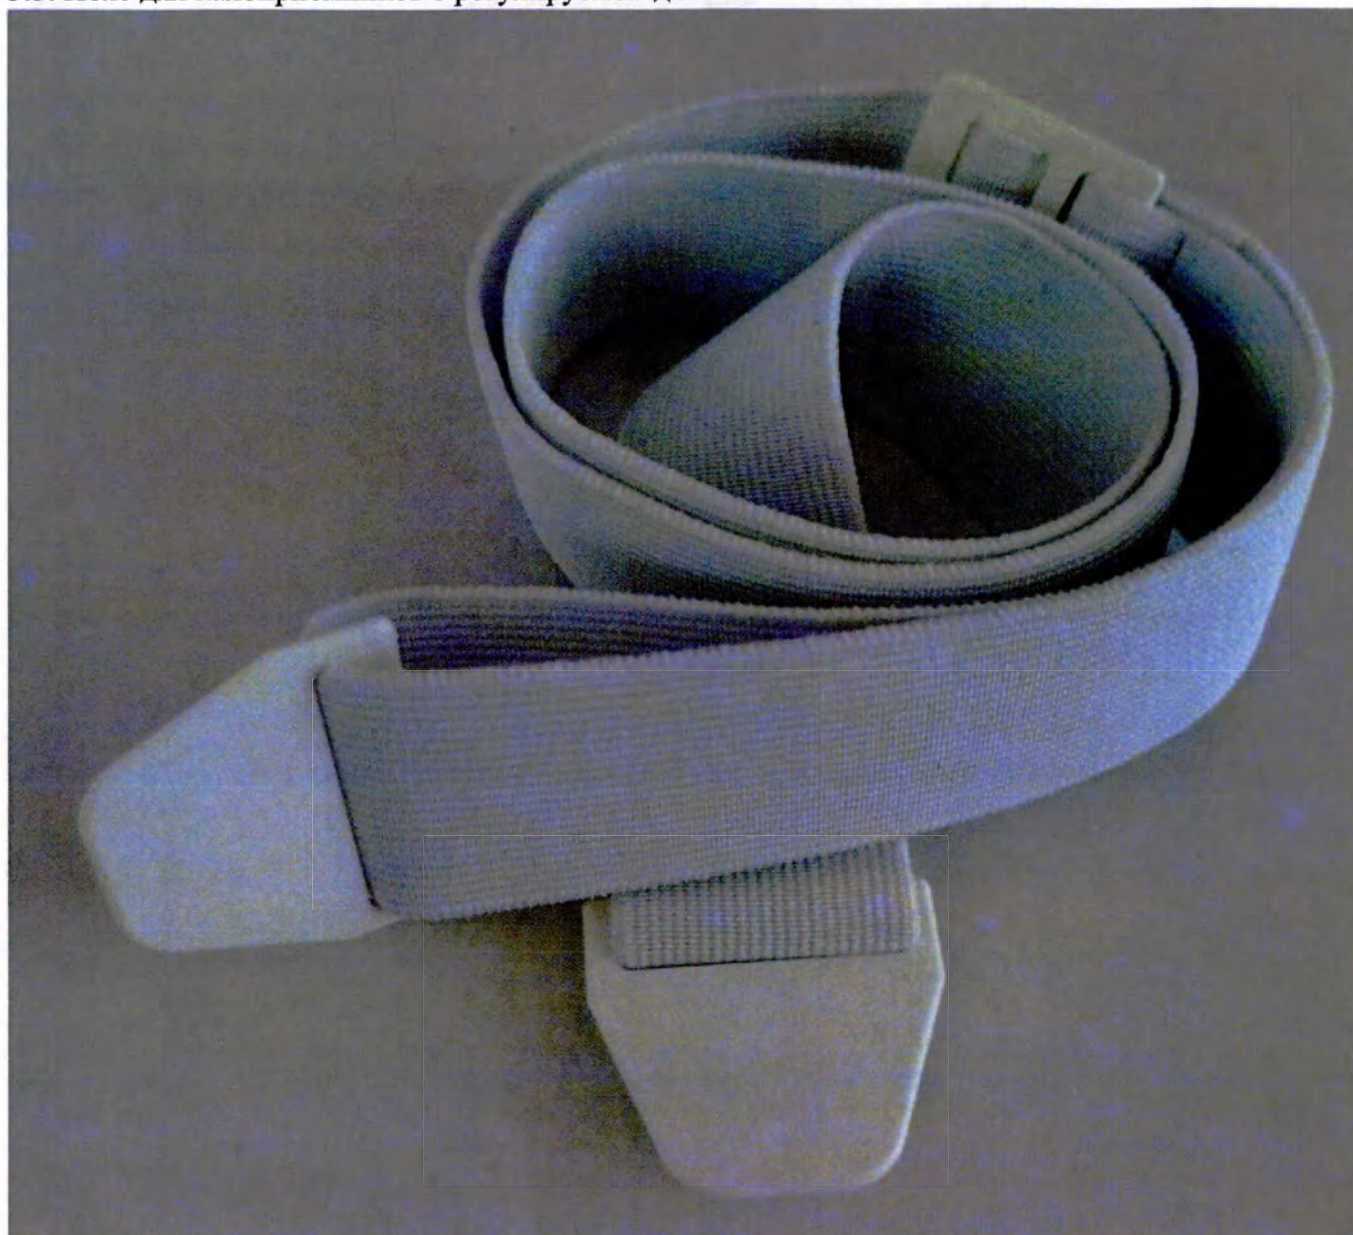

4. Калоприемник двухкомпонентный дренируемый, в составе:

4.1. Калоприемник двухкомпонентный дренируемый со стомным мешком, адгезивной пластиной и зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:

ДДп ФПд мини; ДДп ФПд медиум; ДДп ФПд макси;





Вид сзади

Калоприемник двухкомпонентный дренируемый со стомным мешком, адгезивной пластиной и зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ДДл ФПд мини; ДДл ФПд медиум; ДДл ФПд макси;





Вид сзади

Калоприемник двухкомпонентный дренируемый со стомным мешком, адгезивной пластиной и зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ДДп БПд мини; ДДп БПд медиум; ДДп БПд макси:



Калоприемник двухкомпонентный дренируемый со стомным мешком, адгезивной пластиной и зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ДДл БПд мини; ДДл БПд медиум; ДДл БПд макси:



Калоприемник двухкомпонентный дренируемый со стомным мешком, адгезивной пластиной и зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ДДп ФНд мини; ДДп ФНд медиум; ДДп ФНд макси:





Вид сзади

Калоприемник двухкомпонентный дренируемый со стомным мешком, адгезивной пластиной и зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ДДл ФНд мини; ДДл ФНд медиум; ДДл ФНд макси:





Вид сзади

Калоприемник двухкомпонентный дренируемый со стомным мешком, адгезивной пластиной и зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ДДп БНд мини; ДДп БНд медиум; ДДп БНд макси;



Калоприемник двухкомпонентный дренируемый со стомным мешком, адгезивной пластиной и зажимом для стомного мешка, варианты исполнения:
ДДл БНд мини; ДДл БНд медиум; ДДл БНд макси:



4.2. Стомный мешок для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, варианты исполнения:

ФПд мини; ФПд медиум; ФПд макси;





Вид сзади

Стомный мешок для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, варианты исполнения:
БПд мини; БПд медиум; БПд макси:



Стомный мешок для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, варианты исполнения:
ФНд мини; ФНд медиум; ФНд макси:





Вид сзади

Стомный мешок для двухкомпонентного дренируемого калоприемника, варианты исполнения:
БНд мини; БНд медиум; БНд макси:




4.3. Зажим для стомного мешка – 1 шт.;

4.4. Адгезивная плоская пластина для двухкомпонентного халоприемника, вариант исполнения: КП:



Адгезивная плоская пластина для двухкомпонентного калоприемника, вариант исполнения: КЛ:

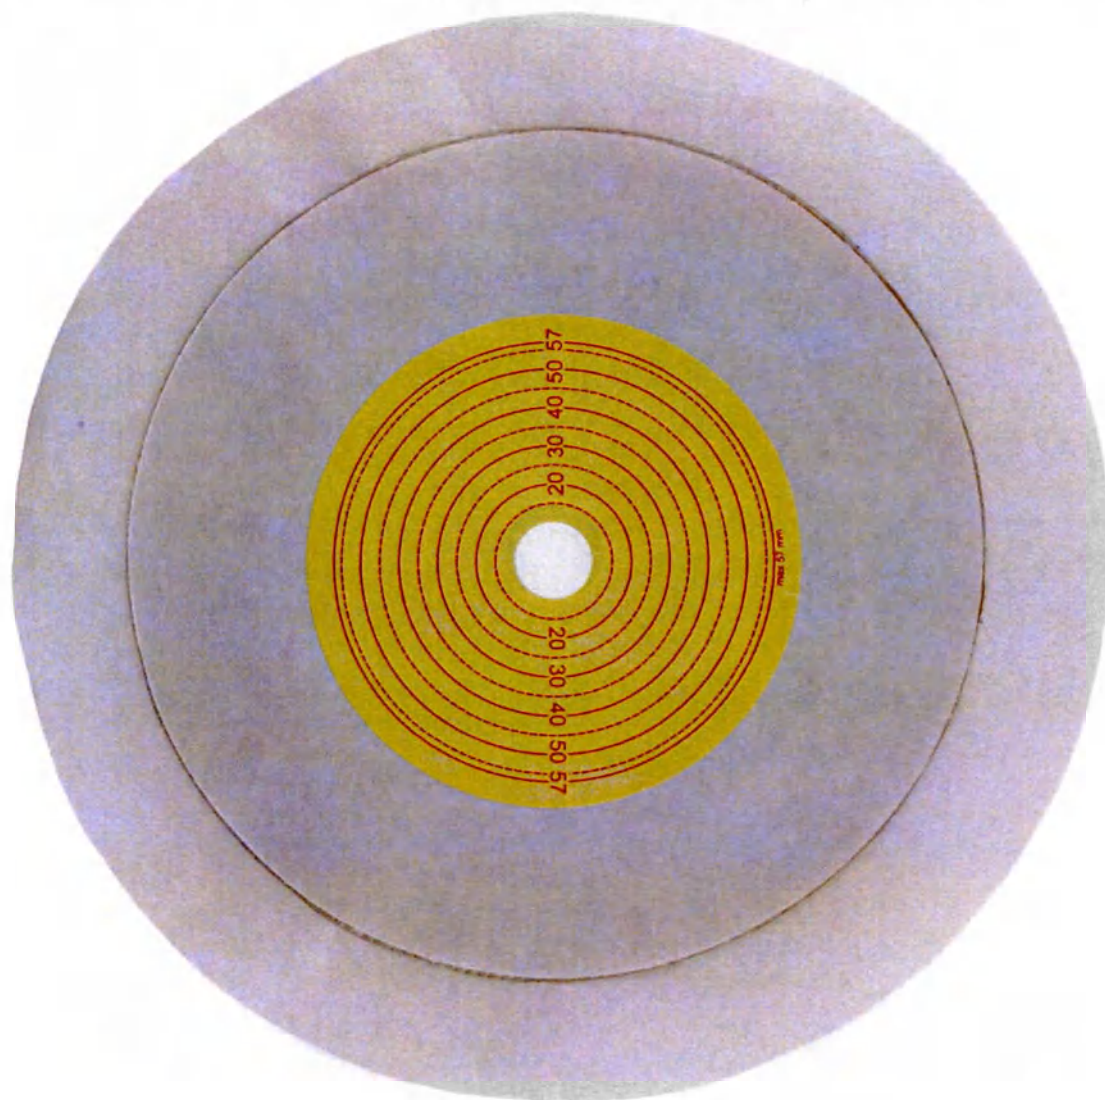




Вид сзади






Вид сзади

4.5. Пояс для калоприемников с регулируемой длиной:

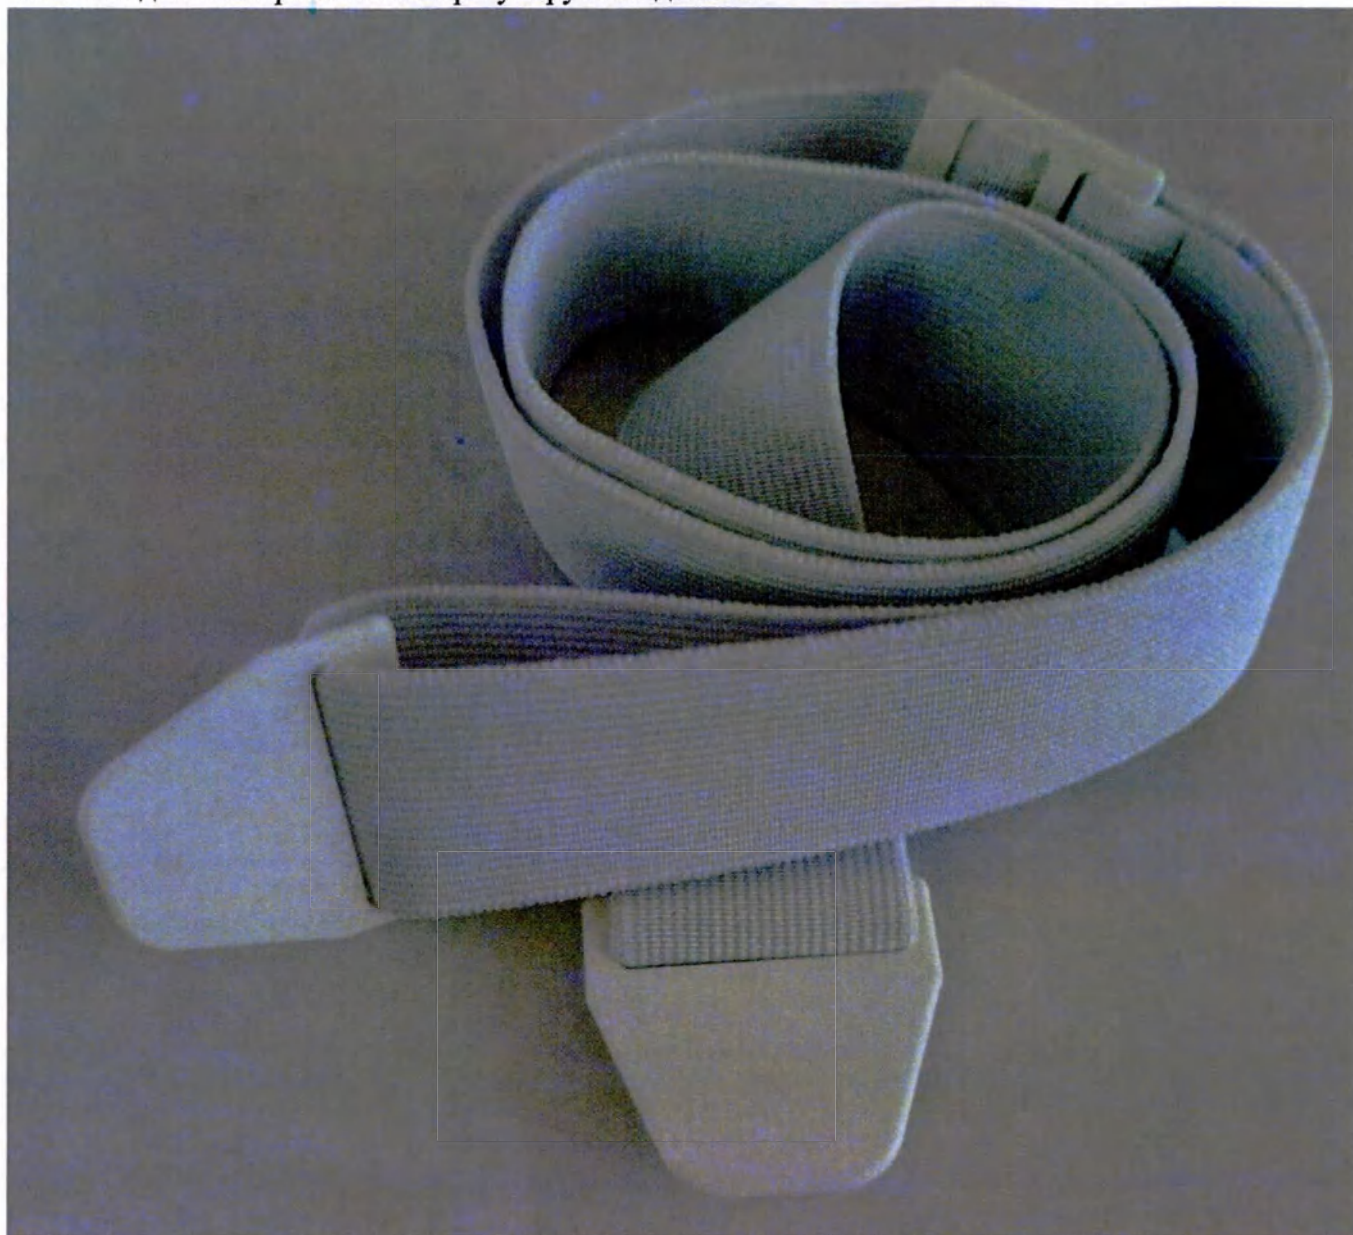

4.6. Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников:

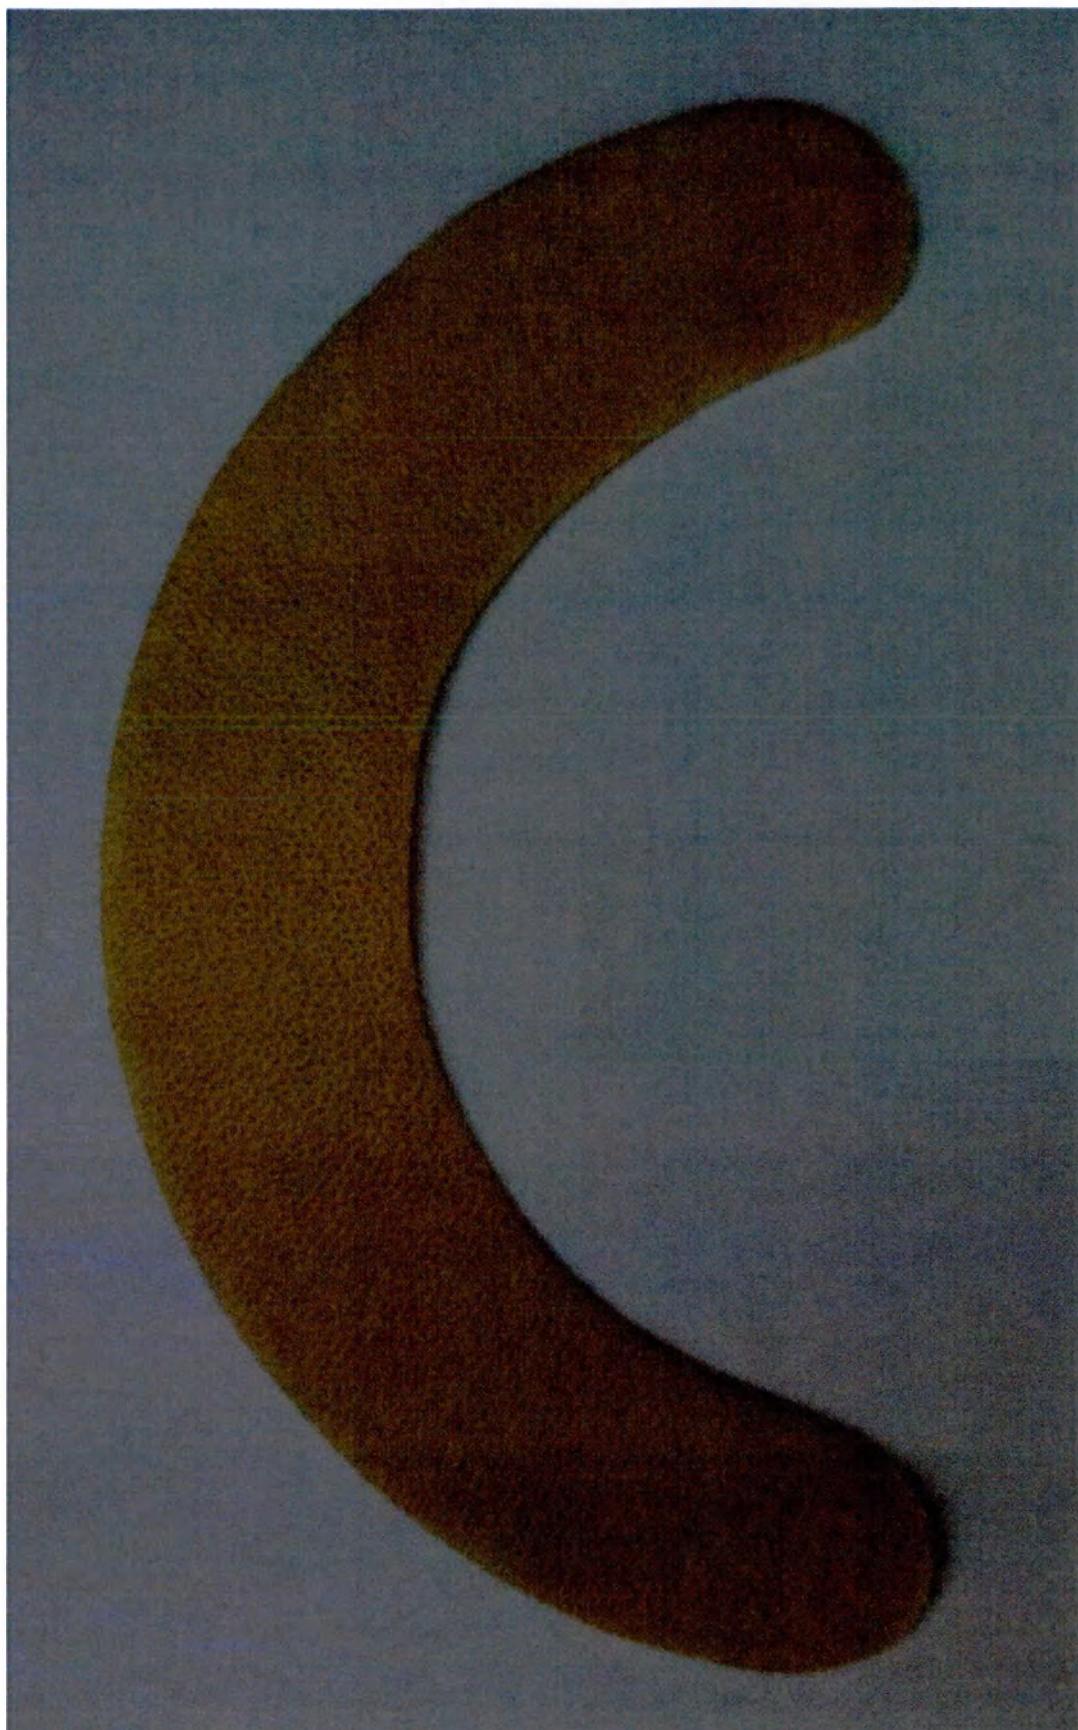


Инструкция по применению:

ОБЪЕКТЫ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 1. Наименование объекта: ООО ЦРПМ
 2. Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Восточная, д. 100
 3. Контактное лицо: Илья Владимирович
 4. Контактный телефон: +375 29 666 66 66
 5. Контактный e-mail: info@cirmi.ru


Инструкция по применению
 1. Общие сведения
 2. Описание объекта
 3. Описание оборудования
 4. Описание персонала
 5. Описание документации
 6. Описание мероприятий
 7. Описание результатов
 8. Заключение

Минск, 2023 г.

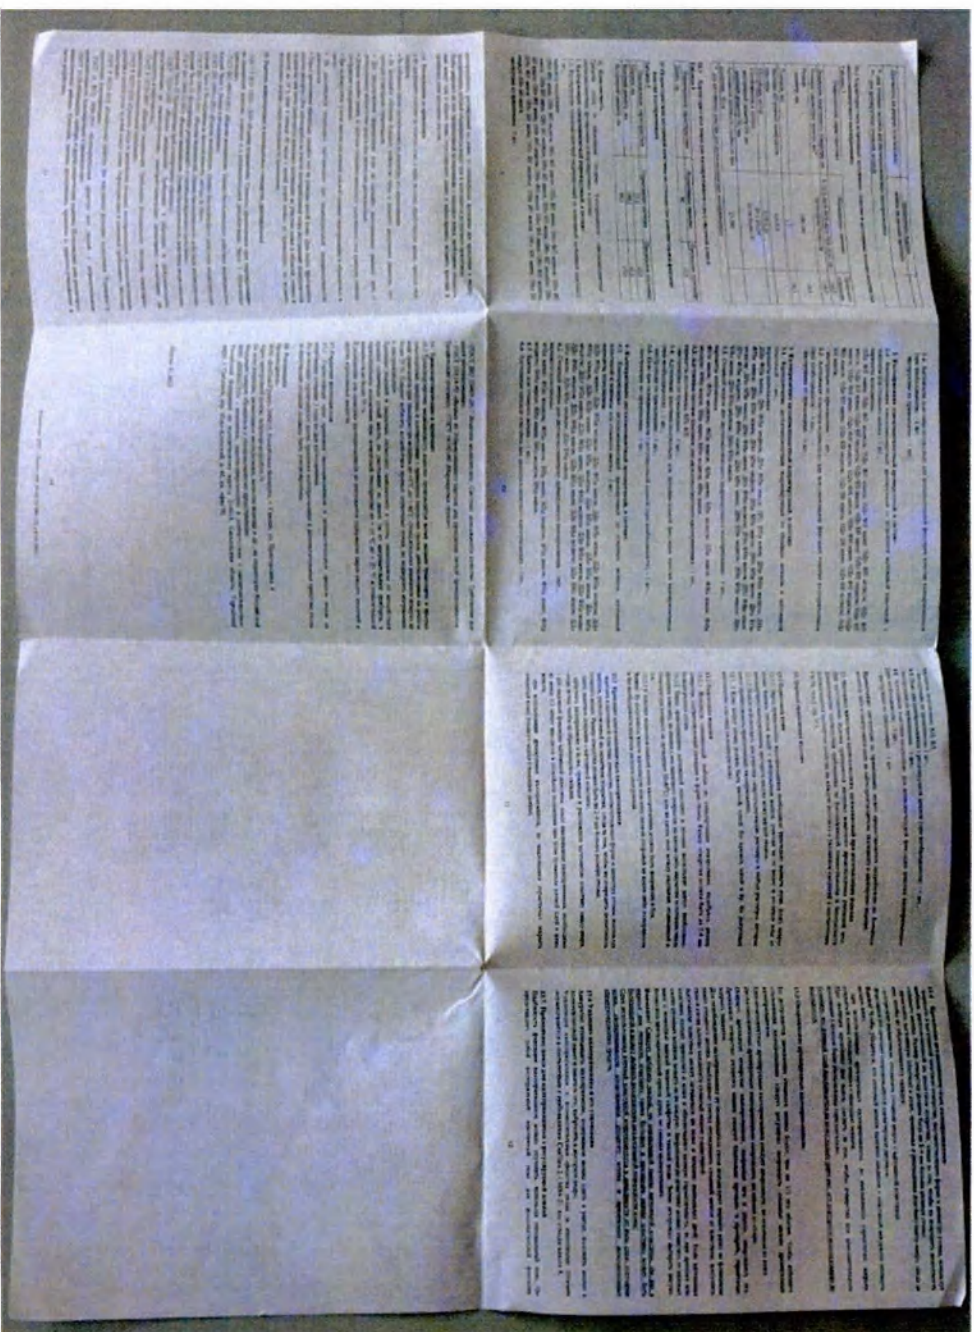

Транспортная тара:



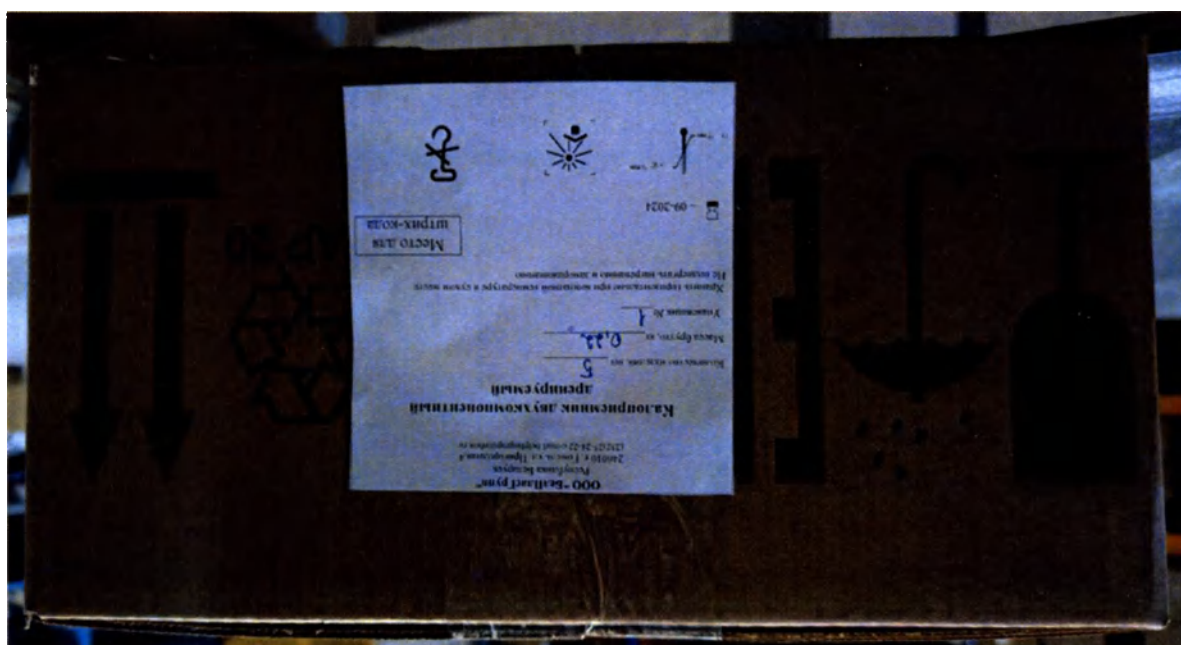

Всего в документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
80 (восемидесяти) листов

Уполномоченный представитель
производителя на основании доверенности
от 10.06.2022

Директор

ООО «ИНВЕСТО»

Э.А. Запольский
«30» июня 2023г

