



Р-ФАРМ
Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Берзариная,
д. 19, корп. 1
+7 (495) 956 79 37
info@rpharm.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

АО «Р-Фарм»

Старший специалист по регистрации
по доверенности № 332 от 22.08.2023 г.


Борзых М.В.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare Blue 755 с
принадлежностями,**

производства MinFound Medical Systems Co., Ltd. / МинФаунд Медикал Системс Ко., Лтд.
No.851, Yinhai Road, Xiasha Street, Qiantang District, Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R.
China (Китай)

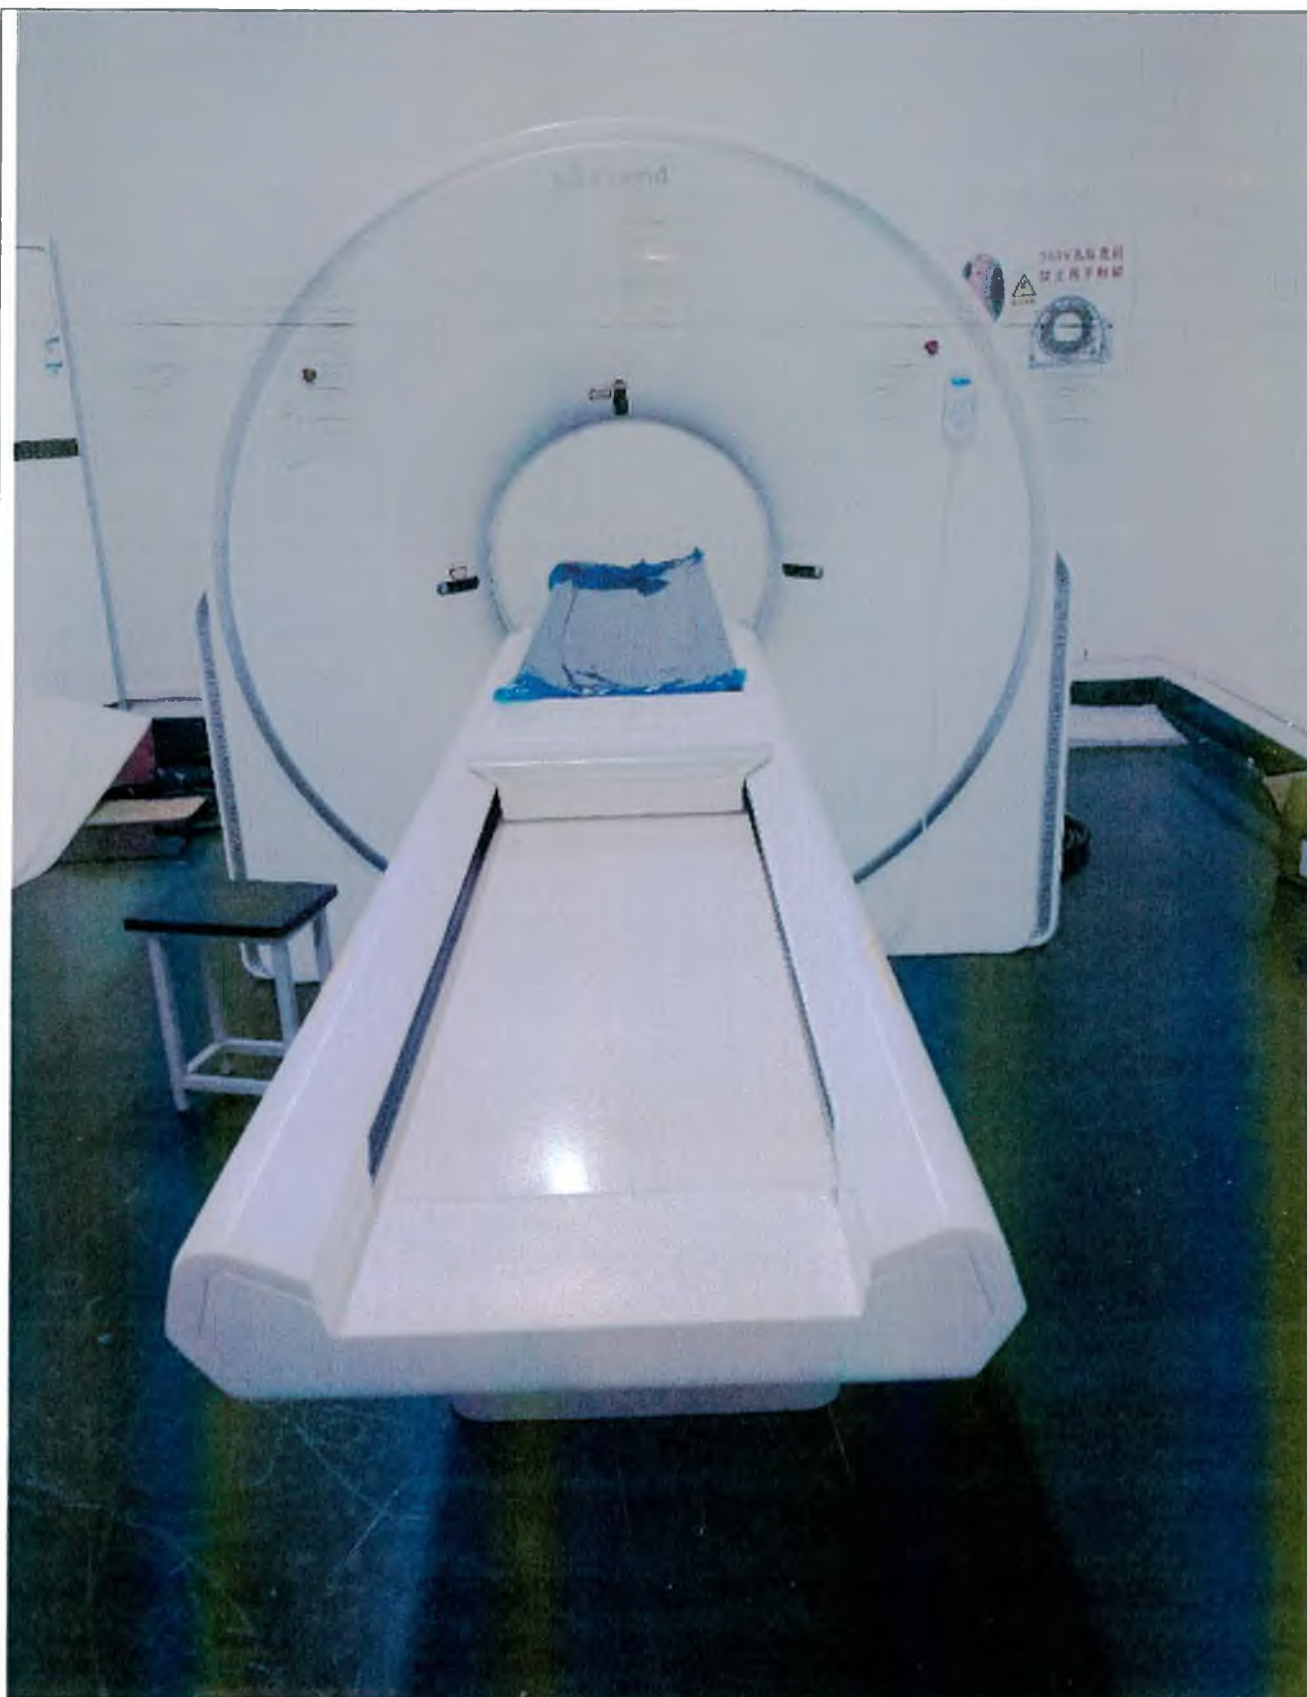

Общий вид медицинского изделия
Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare Blue 755 с принадлежностями.

MinFound

X-ray Computed Tomography System

Model: ScintCare Blue 755

Input Voltage: 3N~380V/400V, 50/60Hz

Momentary power: 50kVA

Continuous power: 20kVA

X-ray output: 0-32kW



Dec.2022



MIN01A08010455



MinFound Medical Systems Co., Ltd.

Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road, Hangzhou


Economic and Technological Development Zone,

Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R. China



Маркировка медицинского изделия

Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare Blue 755 с принадлежностями.

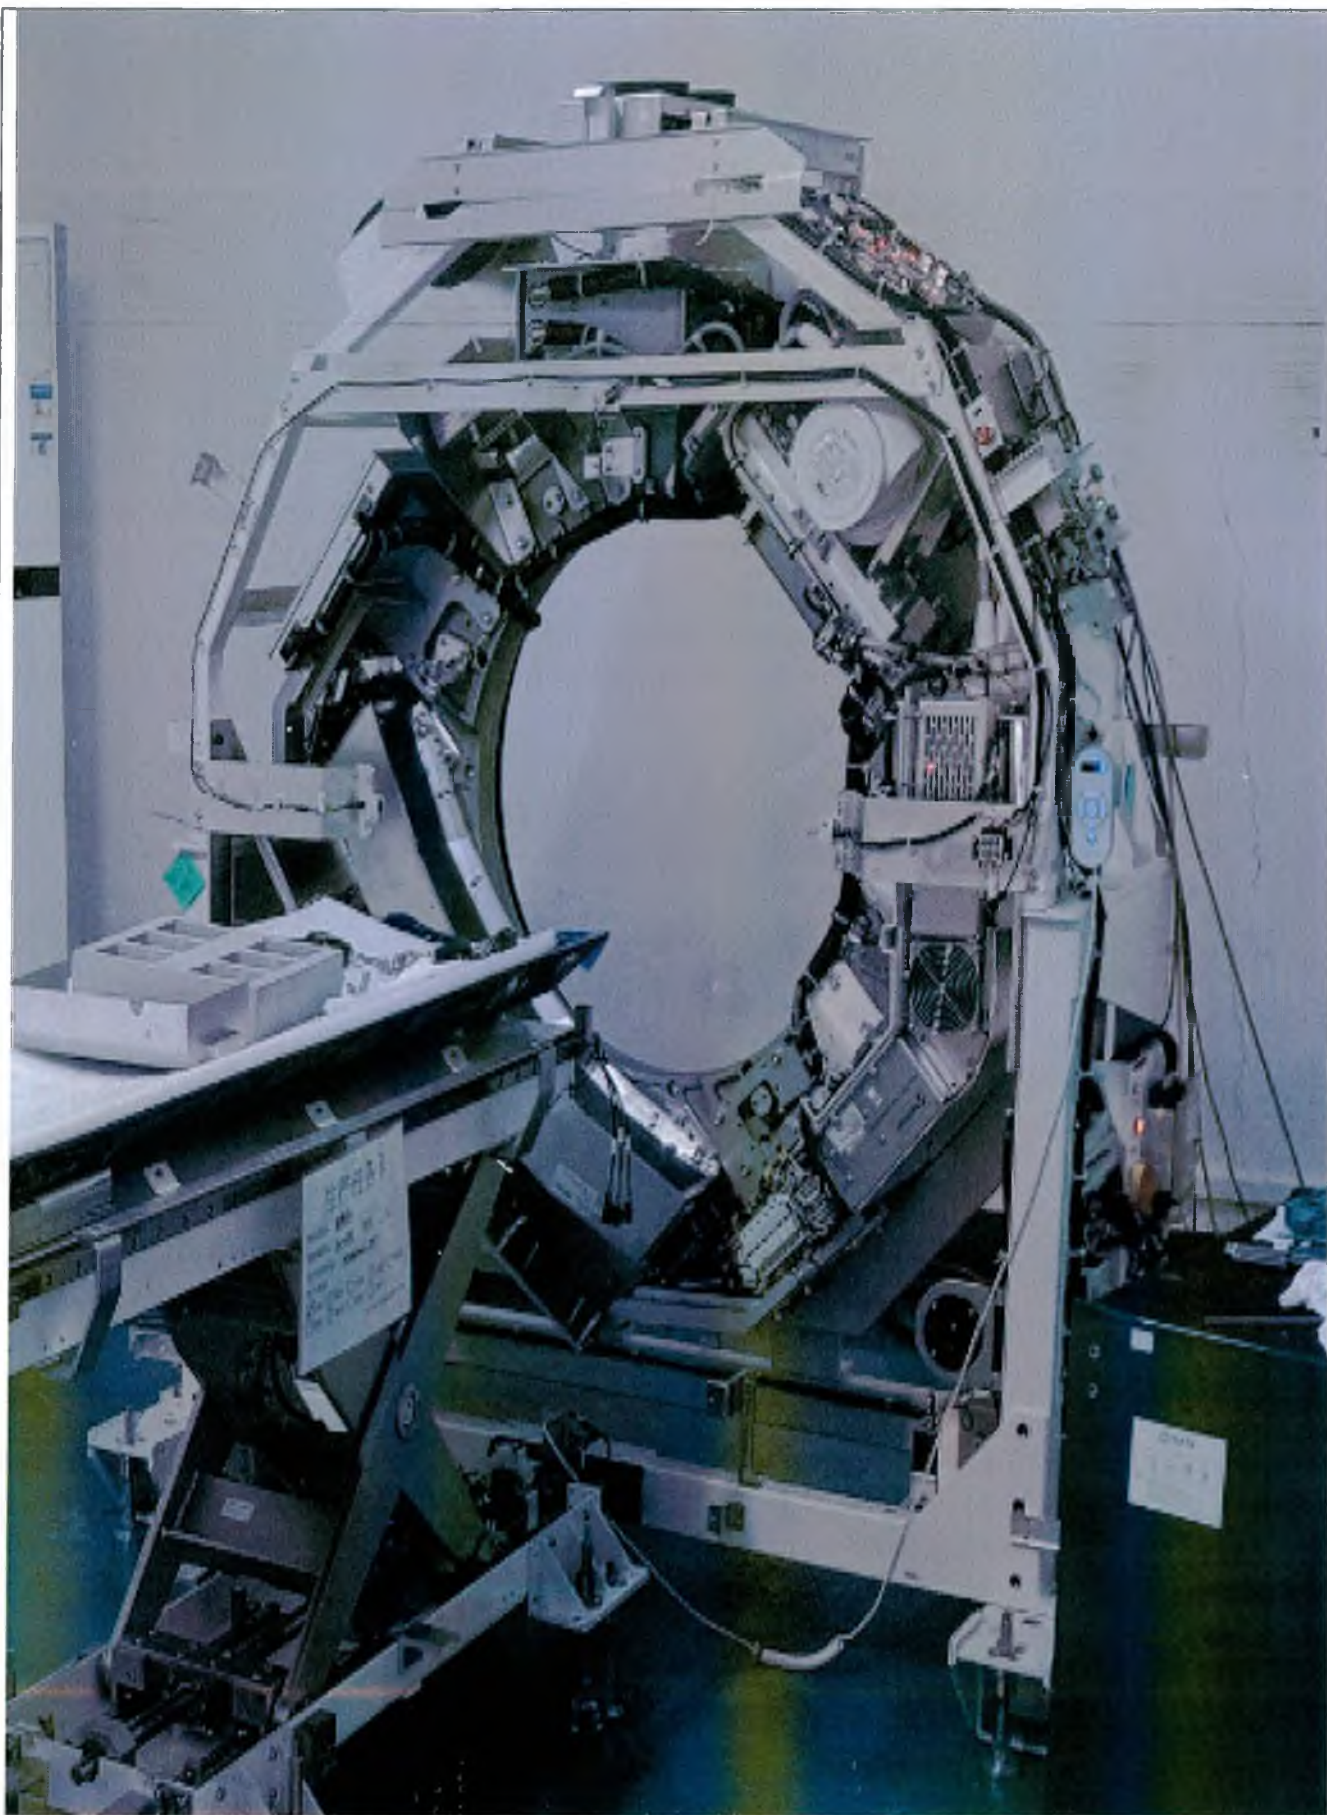

Гентри для сканирования с блоком распределения питания.



Part Name : Gantry

Part Model : GAN-040

 Dec.2022

 MIN01PP000001

 MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road,
Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou City, 310018
Zhejiang, P.R. China



Part Name : Gantry

Part Model : GAN-039

 Dec.2022

 MIN01PP000001

 MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road,
Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou City, 310018
Zhejiang, P.R. China



Part Name : Gantry

Part Model : GAN-034

 Dec.2022

 MIN01PP000001

 MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road,
Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou City, 310018
Zhejiang, P.R. China




Part Name : Gantry

Part Model : GAN-007

 Dec.2022

 MIN010G0455

 MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road,
Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou City, 310018
Zhejiang, P.R. China



Part Name : Gantry

Part Model : GAN-005

 Dec.2022

 MIN01PP000001

 MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road,
Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou City, 310018
Zhejiang, P.R. China



Part Name : Gantry


Part Model : GAN-033

 Dec.2022

 MIN01PP000001

 MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road,
Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou City, 310018
Zhejiang, P.R. China

Примеры маркировки
Гентри для сканирования с блоком распределения питания.

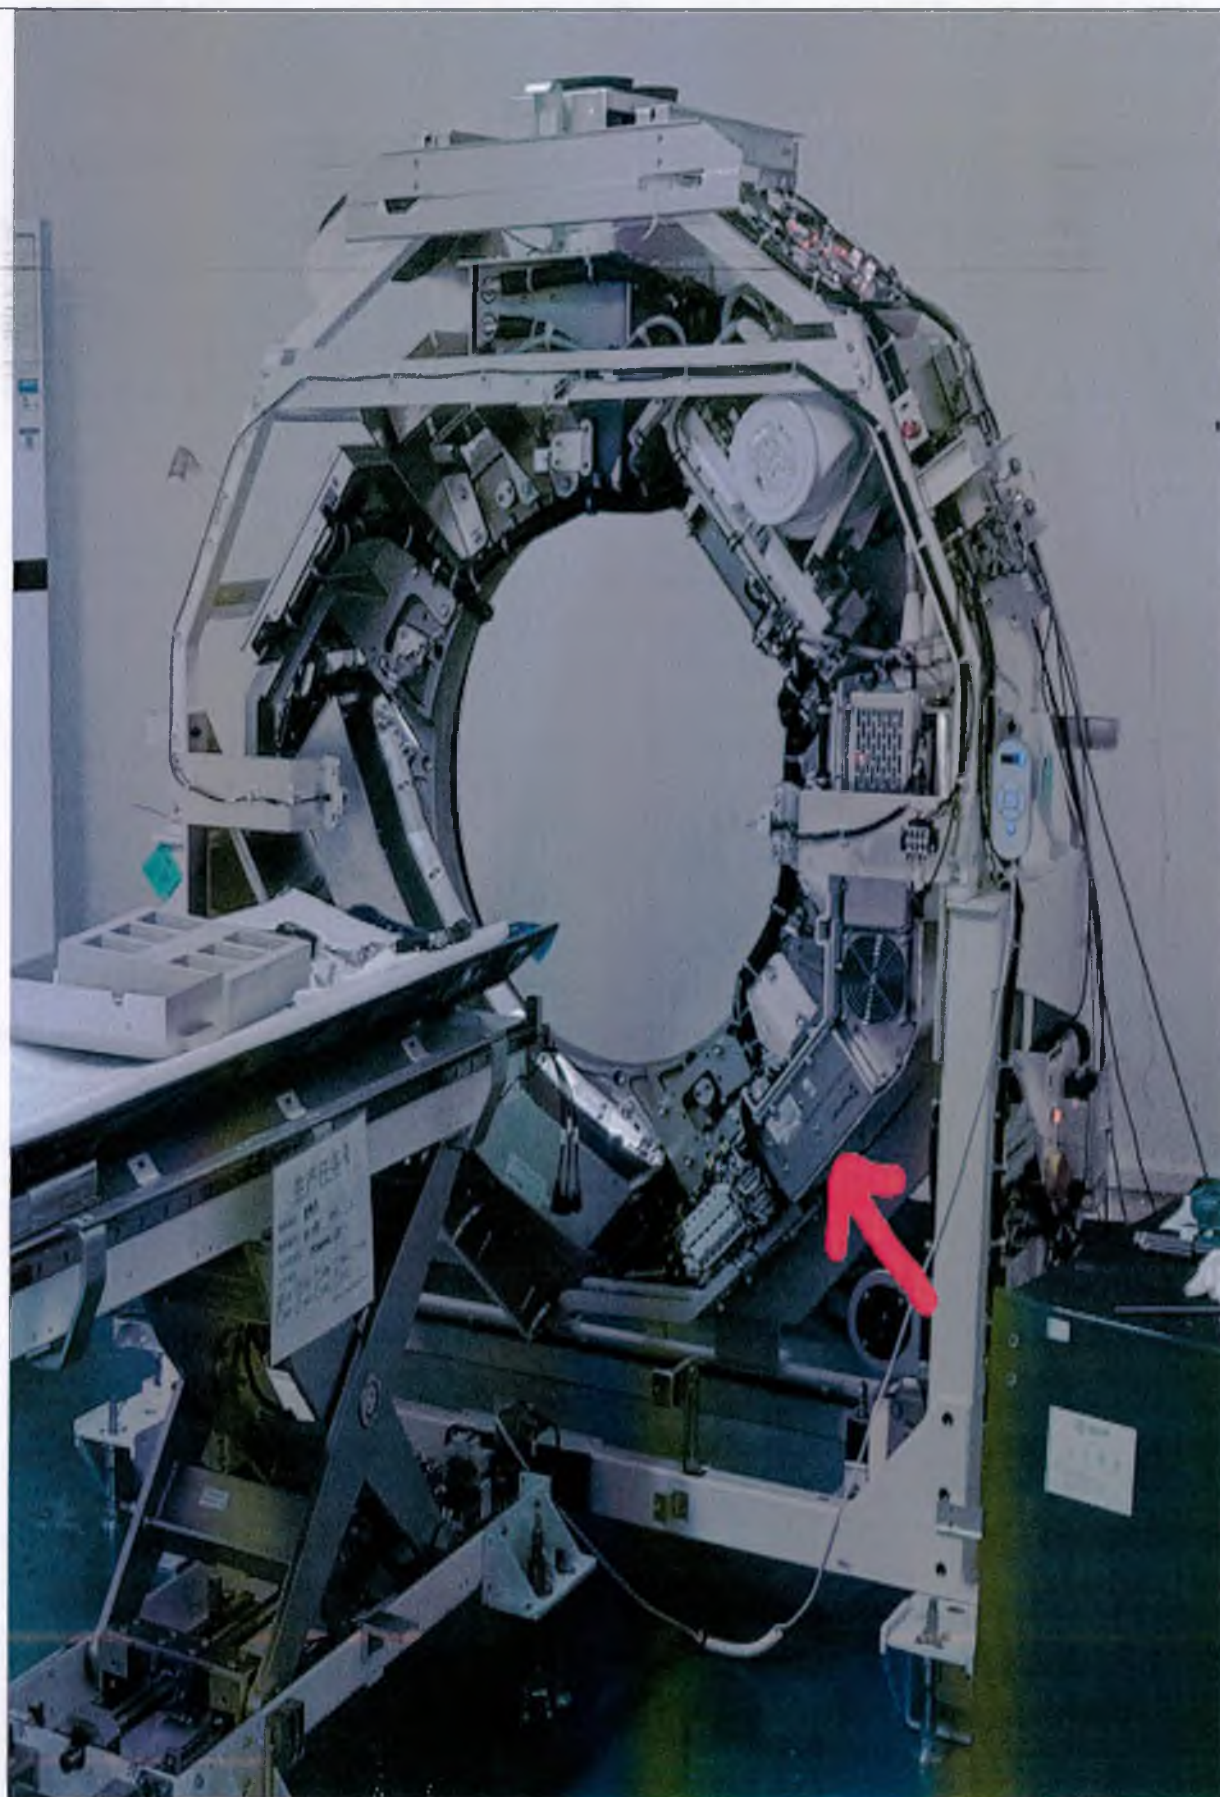

Генератор рентгеновский.



High Voltage Electronics Corporation

Hauppauge, NY 11788 Assembled in Mexico P3

PART NO: X5610

REV: C3

MODEL: CT70PN32X5610

220-230VAC +15/-10% 50/60Hz 5A


SERIAL NO: 108692926-A000001

400 V $\sim$ +15/-20% 50/60Hz 80A

$\rightarrow$ +1-70kV --- 300mA, 32kW MAX

24/18

Приаер маркировки
Генератора рентгеновскогоо модель CT70PN32X5610 производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США

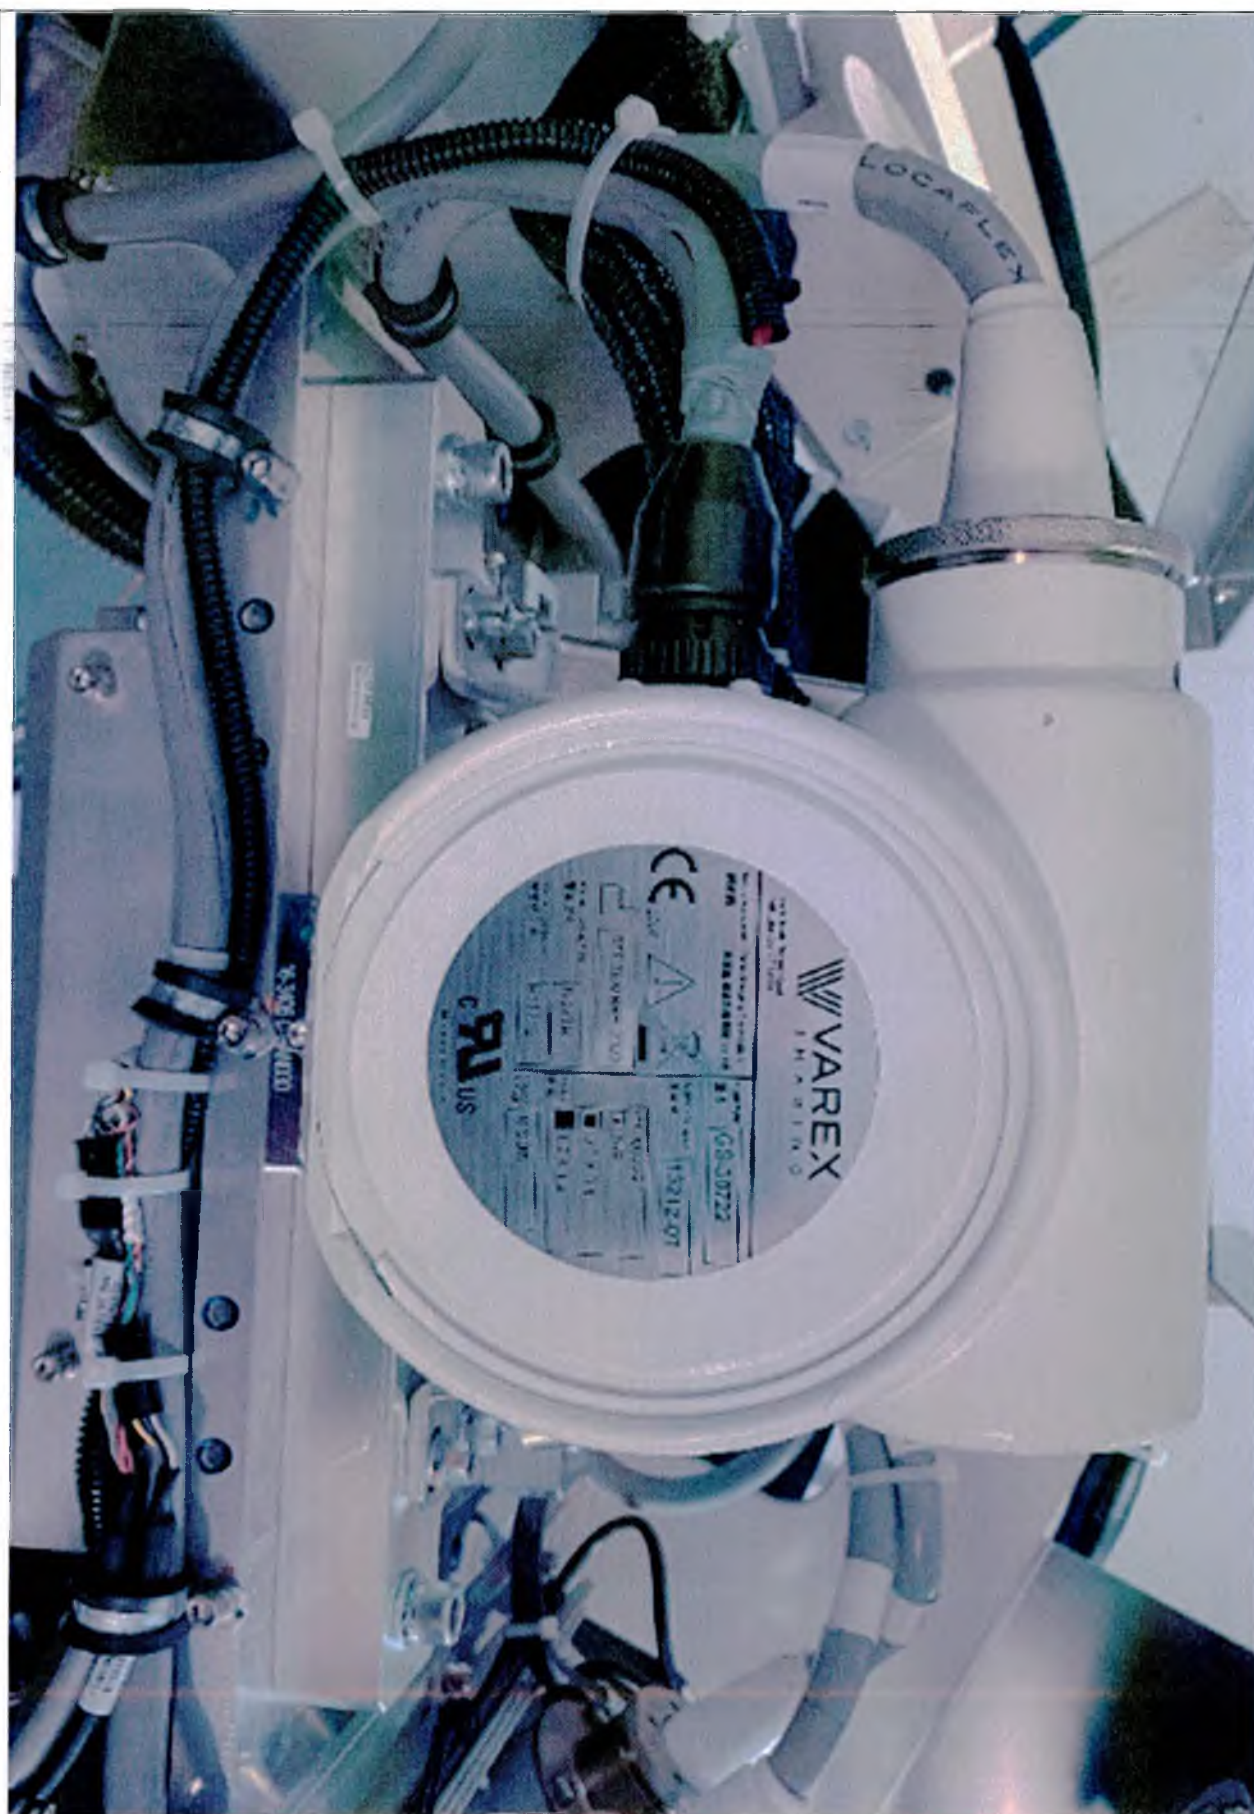


Блок источника рентгеновского излучения с трубкой рентгеновской. модель В-240Н с трубкой рентгеновской модель GS-30722 производства Varex Imaging Corporation, США




Пример маркировки
Блока источника рентгеновского излучения модель B-240H с трубкой рентгеновской модель GS-30722
производства Varex Imaging Corporation, США



Блок источника рентгеновского излучения модель YY 3520N с трубкой рентгеновской модель VX 2948
производства Kunshan Yiyuan Medical Technology Co., Ltd., Китай

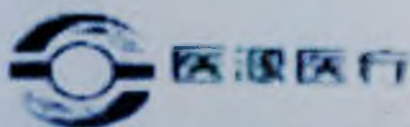

 昆山医源医疗技术有限公司
昆山开发区西湖路28号

医用诊断旋转阳极X射线管组件

型号: YY 3520N

物料号: D xm LT0090200

序列号: 120113001

X射线管

型号: VX 2948

物料号: D xm LT0010200

序列号: 220113001

管
↓
1.0mmAL@75KV

标称电压: 140KV

 0.6×0.8 YY/T 0063

 1.2×1.4 YY/T 0063

生产日期: 2020.11

使用期限: 详见说明书

其他内容详见说明书

Пример маркировки блока источника рентгеновского излучения модель YY 3520N с трубкой рентгеновской модель VX 2948 производства Kunshan Yiyuan Medical Technology Co., Ltd., Китай




Коллиматор модель CMT-011.

MinFound

Part Name : Collimator

Part Model : CMT-011

Equivalent filtration : 2.3mmAl



Nov.2022


SN

RAR001000555









MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road, Hangzhou
Economic and Technological Development Zone,
Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R. China


Пример маркировки
Коллиматор модель CMT-011.

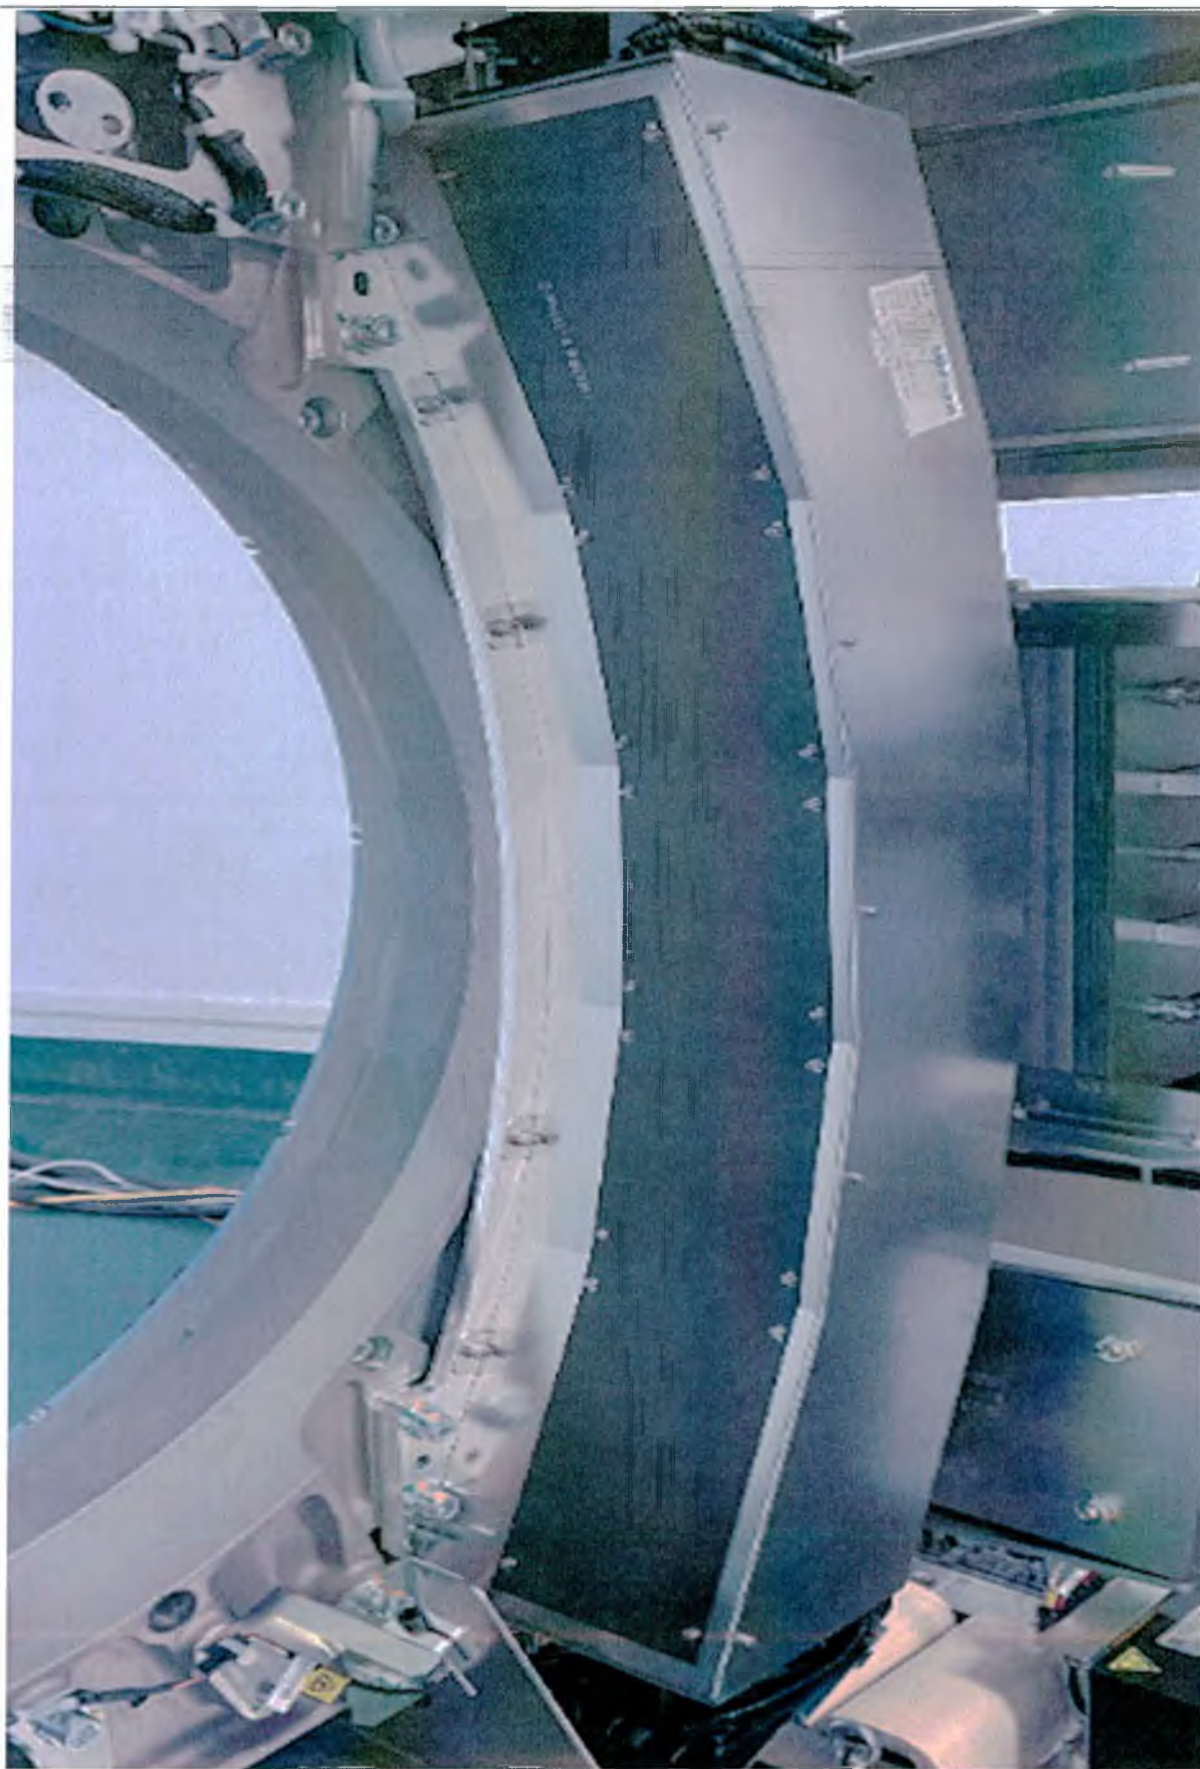

Детектор рентгеновского излучения.

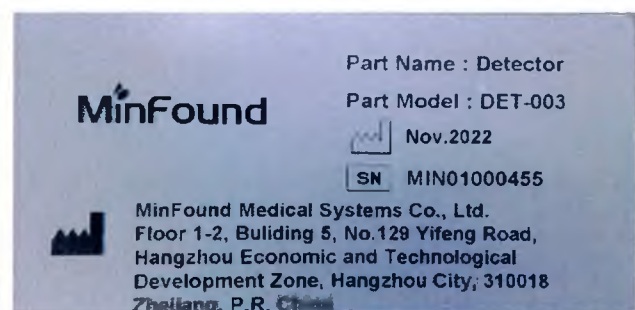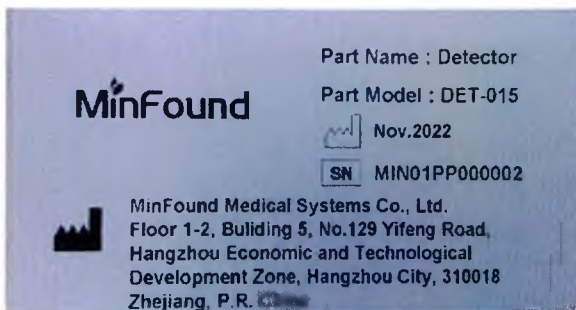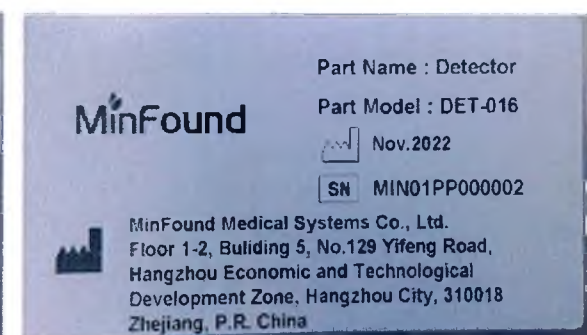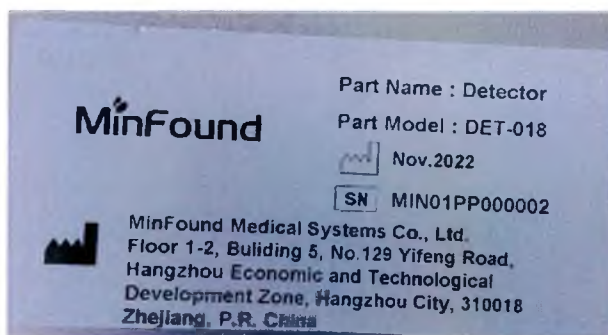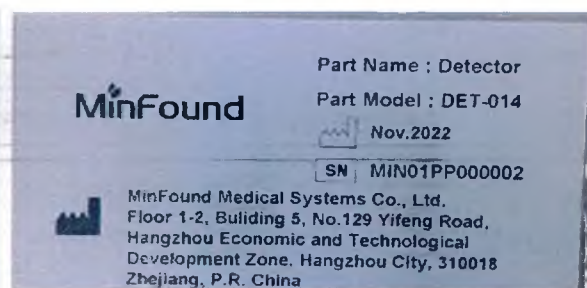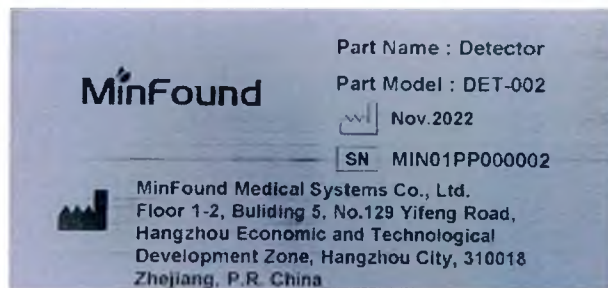

Примеры маркировки Детектора рентгеновского излучения

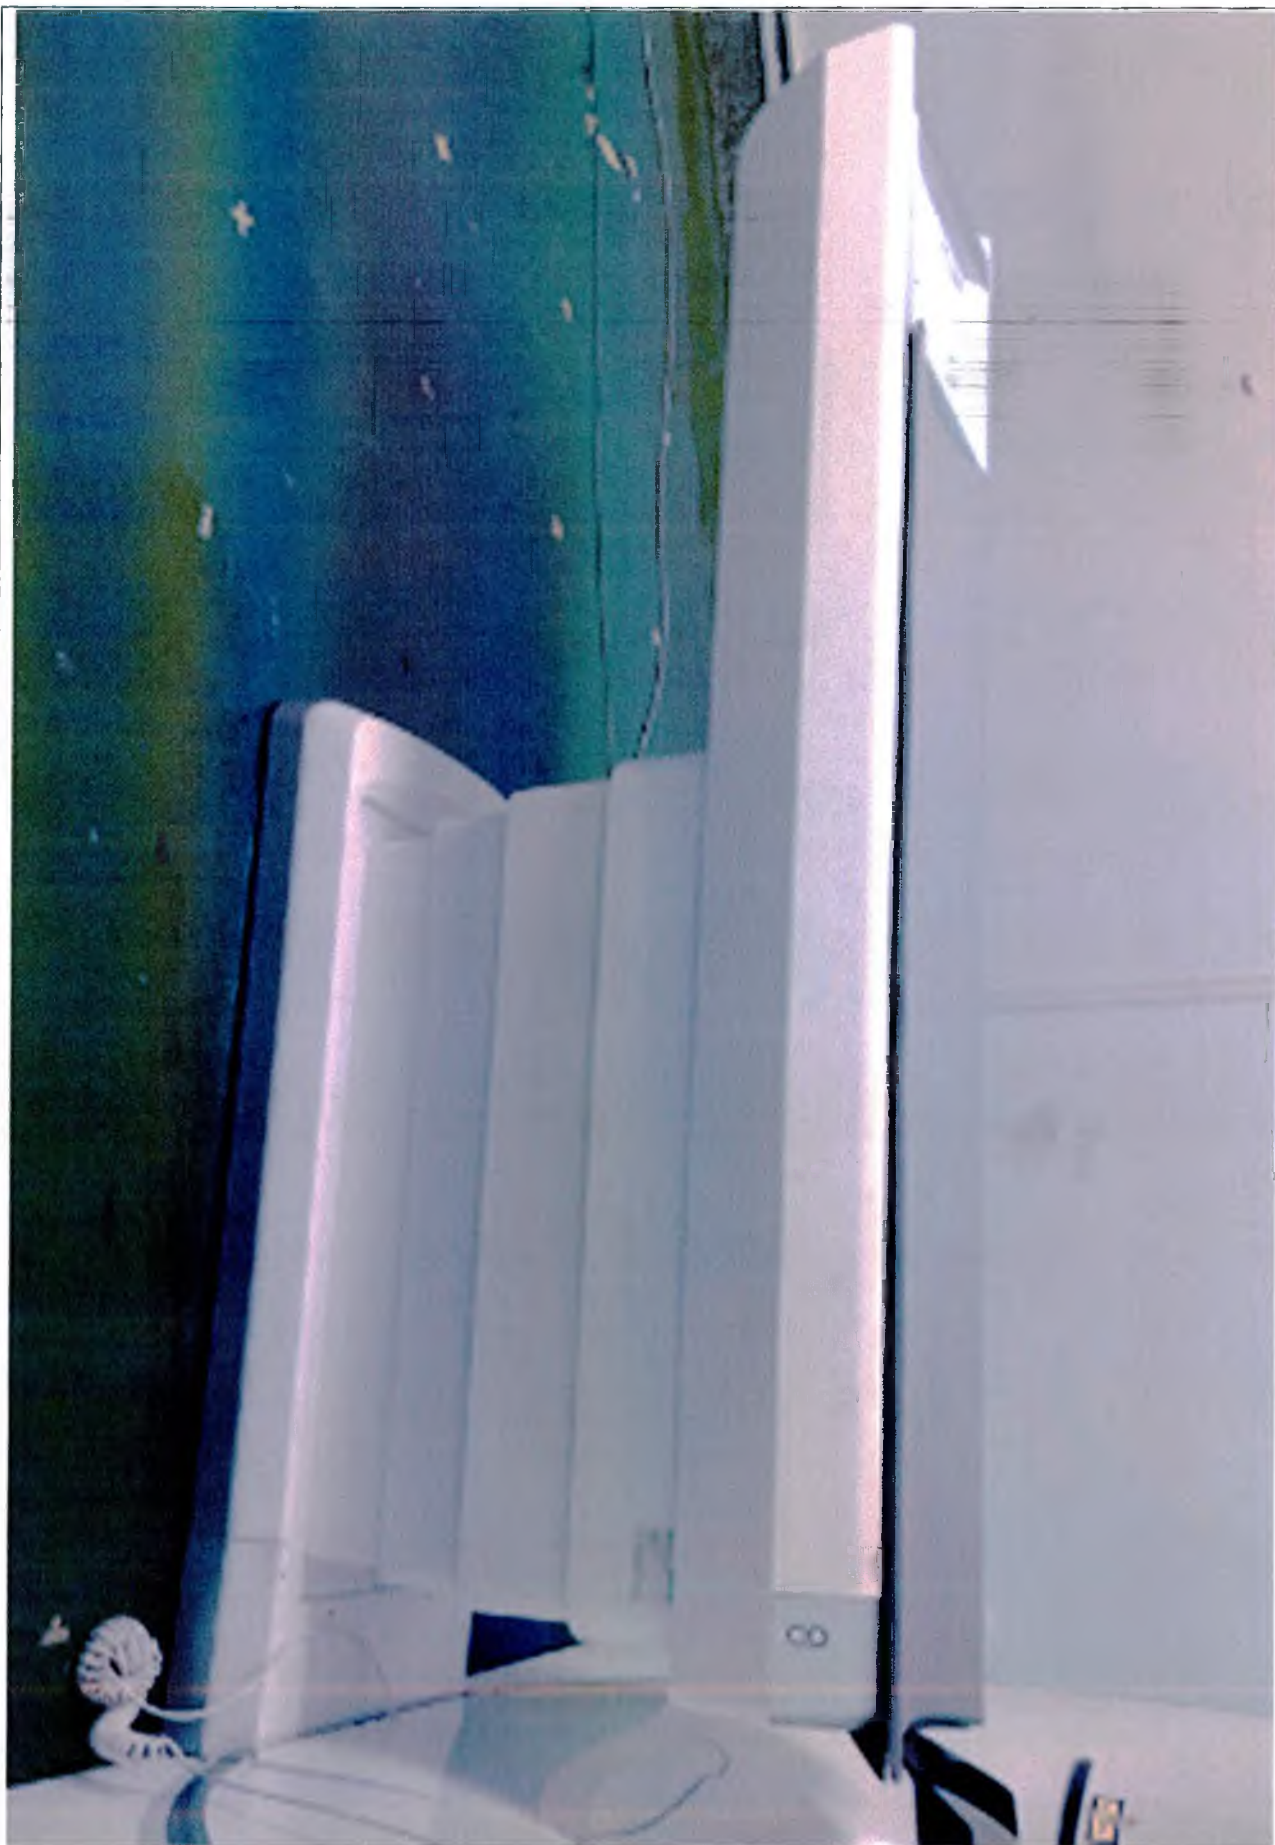

Стол для пациента с ручным управлением модель PAT-004.


MinFound

Part Name : Patient Table

Part Model : PAT-004



Dec.2022



MIN01000455






MinFound Medical Systems Co., Ltd.
Floor 1-2, Buliding 5, No.129 Yifeng Road,
Hangzhou Economic and Technological
Development Zone, Hangzhou City, 310018
Zhejiang, P.R. China

Пример маркировки Стола для пациента с ручным управлением модель PAT-004.



Консоль управления.

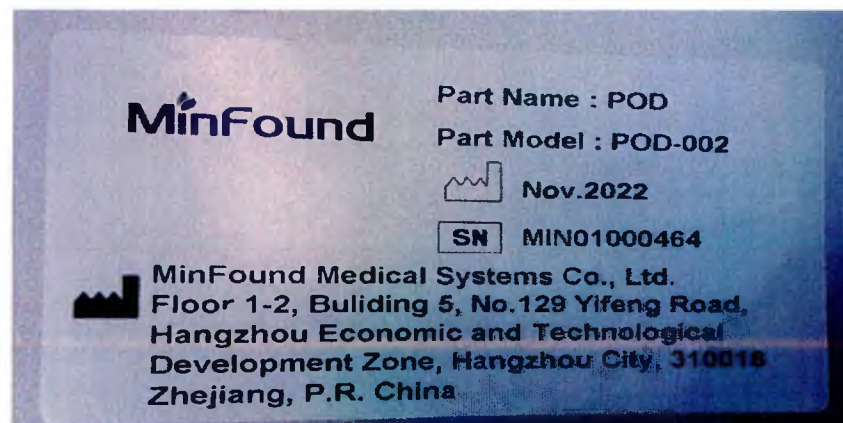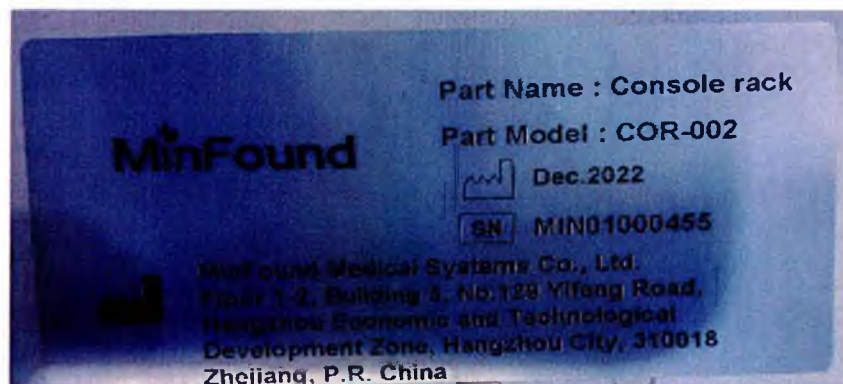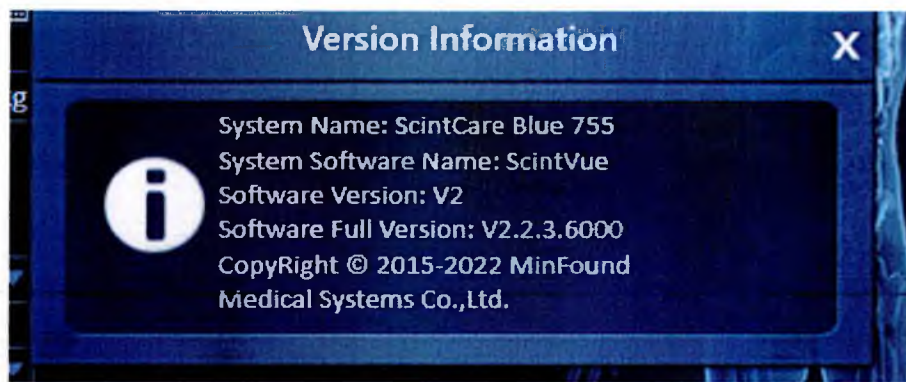

Примеры маркировки Консоли управления:
 Вид экрана с версией базового программного обеспечения Консоли управления;
 Примеры маркировки Монитора;
 Стойки консоли;
 Пульты управления.

MinFound

«APPROVE» / «УТВЕРЖДАЮ»
MinFound Medical Systems Co., Ltd.
МинФаунд Медикал Системс Ко., Лтд.

President/ Президент
(должность)

Yaofa Wang/ Яофа Ван
(Ф.И.О.)


20 September 2023
day / день month / месяц
(подпись)

Stamp/Печать

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**OPERATION MANUAL
OF THE MEDICAL DEVICE**

**Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare Blue 755
с принадлежностями
X-ray Computed Tomography System ScintCare Blue 755
with accessories**

MinFound Medical Systems Co., Ltd. / МинФаунд Медикал Системс Ко., Лтд.

No.851, Yinhai Road, Xiasha Street, Qiantang District, Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R.
China (Китай)

Руководство по эксплуатации.

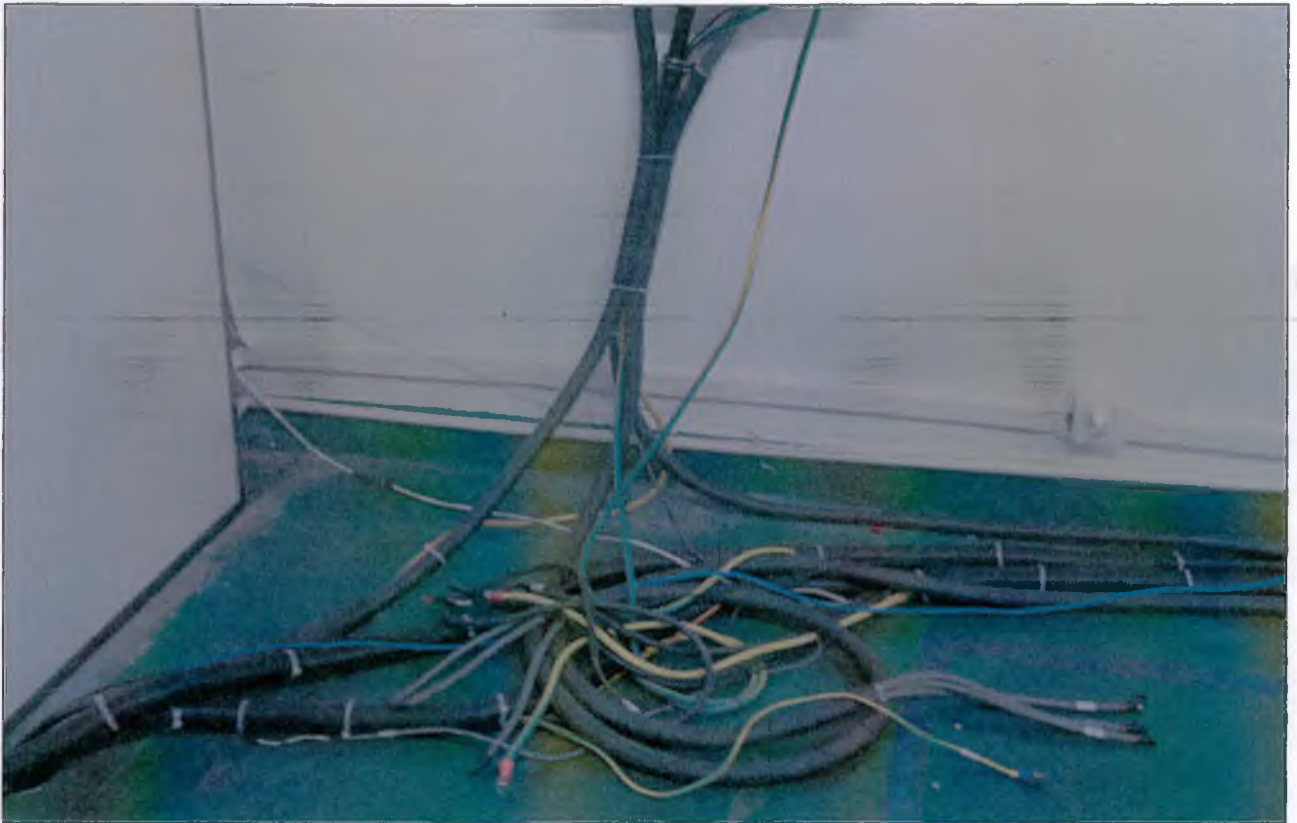

Кабели.



Рабочая станция обработки медицинских изображений IntelliAtlas

Medical Image Processing Software

Specifications : IntelliAtlas

Registration certificate number :

Product technical requirement number :

Production enterprise license number :

Registrant Name : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Registrant's domicile : Room 310, Building 2, No. 181, Wuchang Avenue, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Producer company : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Production address : No.851, Yinhai St., Xiasha Sub-district, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Software release version : V3

Software version : 3.0.0.0000

After-sales service company : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Customer service number : 400 035 8898


Zip code : 310018

E-mail : info@minfound.com

Serial number :

For other contents, please refer to the user manual

Вид экрана с указанием версии ПО Рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas

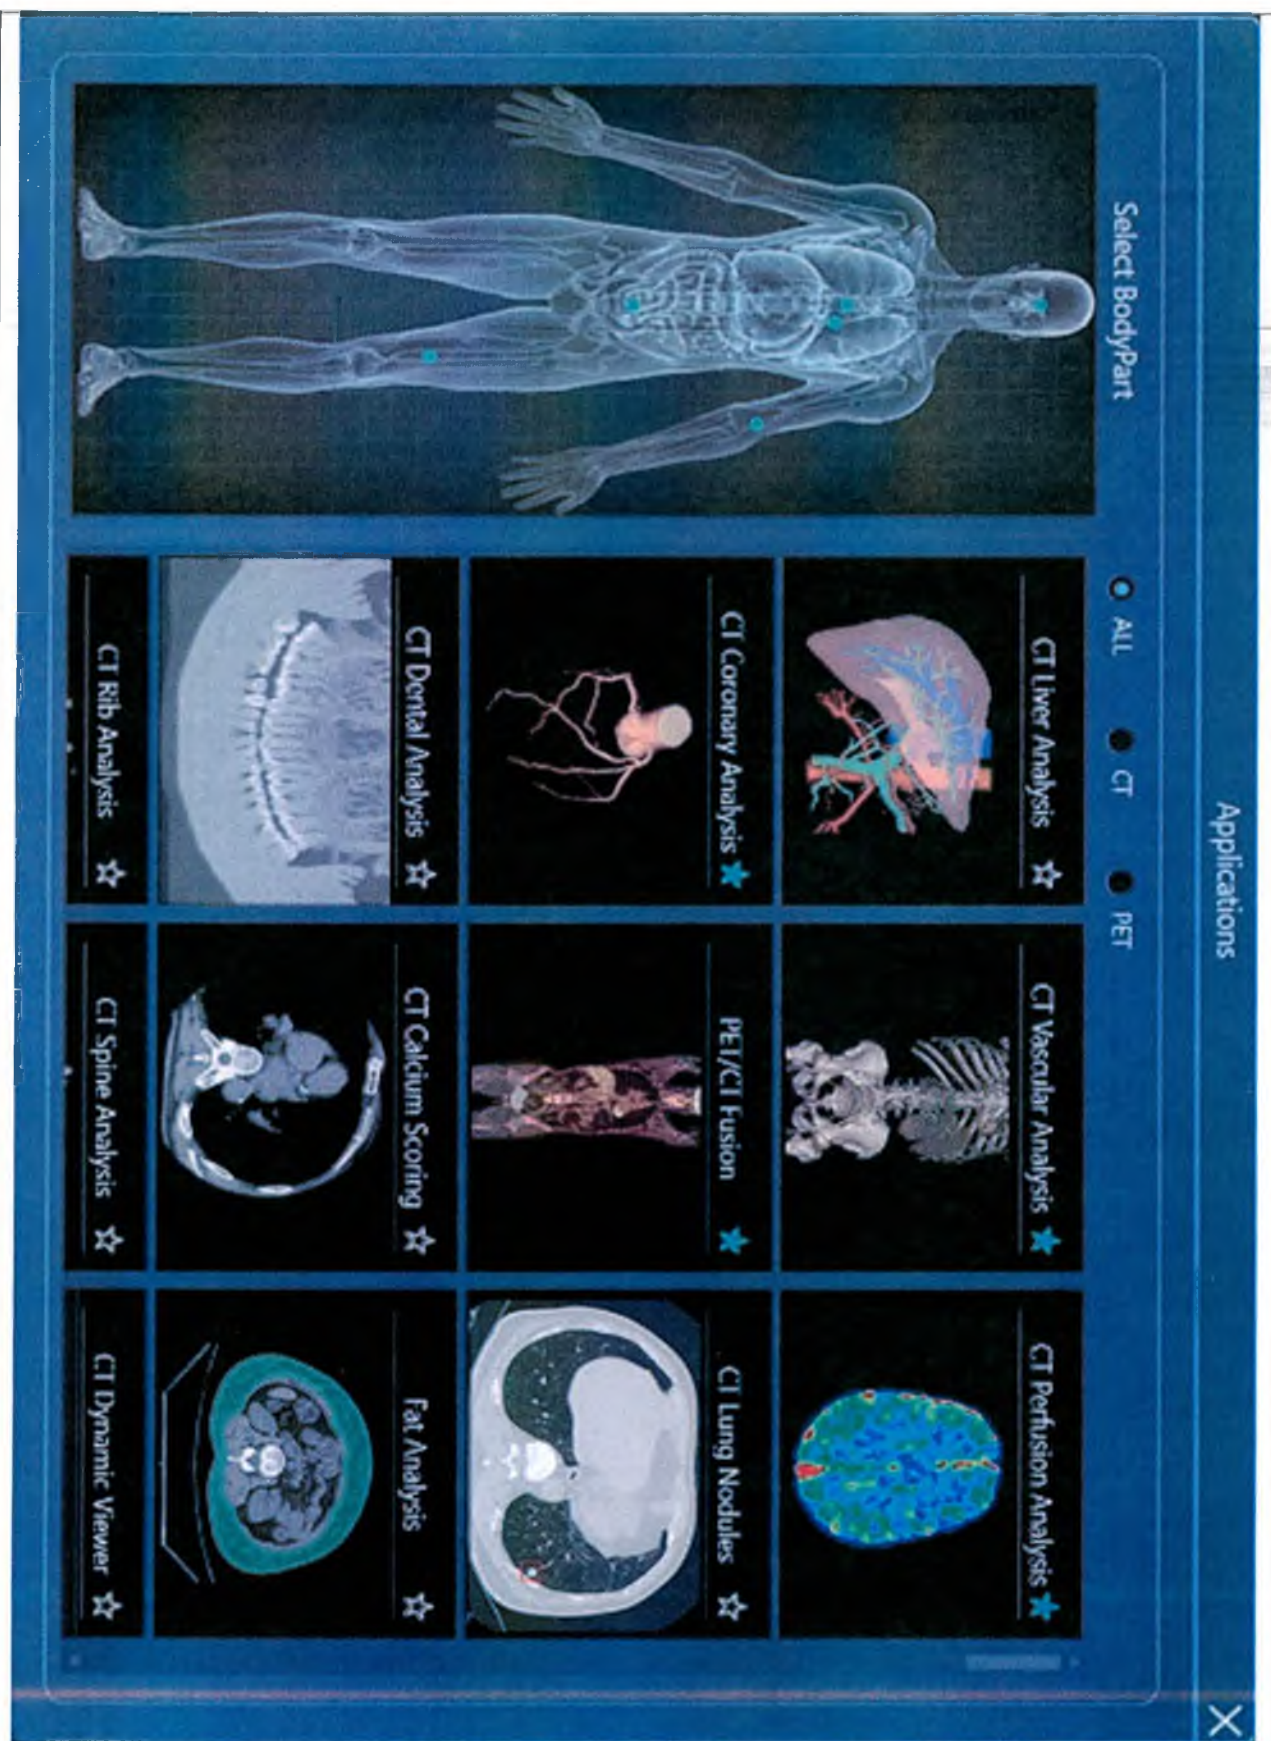

Вид экрана выбора программ обработки Рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas



Примеры маркировки Рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas:

- Монитор;
- Системный блок.

Scan Parameters

kv kv
mA mA
mAs mAs
Rot. Time s/r
Collimation
☐ Auto Voice
Focal Spot
Shape Filter
ImA
SFOV mm

Start mm
End mm
Length mm
Direction
No. of Scans
Scan Time s
Preview

Scan Trigger

	Planned	Notification
CTDIvol(mGy)	57.08	50 PhantomSize(cm):16
CTDIvol/s(mGy/s)	38.05	33.33
DLP(mGy.cm)	684.96	1000
Dose Efficiency	80.40%	70%
Acc. CTDIvol(mGy)	0	Reference
AlertCTDI(mGy)	10000	
Acc. DLP(mGy.cm)	0	

Scan Info

▼ 1.1_Head_Axial

1 Scout

2 Axial

2.1 HEAD_STND 5

2.2 HEAD_BONE 5

Scan Parameters
☰

kv kv
Rot. Time s/r
Start mm

mA mA
mAs mAs
Length mm

No. of Scans

Plan	CTDI vol	Plan DLP	PhantomSize
57.08 mGy	684.96 mGy.cm	16	

Модуль увеличения количества срезов в четыре раза (при необходимости).

ООО ЦРМИ
 INFO@CIRMI.RU
 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

24



Фантом для контроля качества и калибровки (при необходимости).



Матрас для стола пациента.




Держатель для головы.




Подушка для держателя головы.



Удлинитель стола пациента.

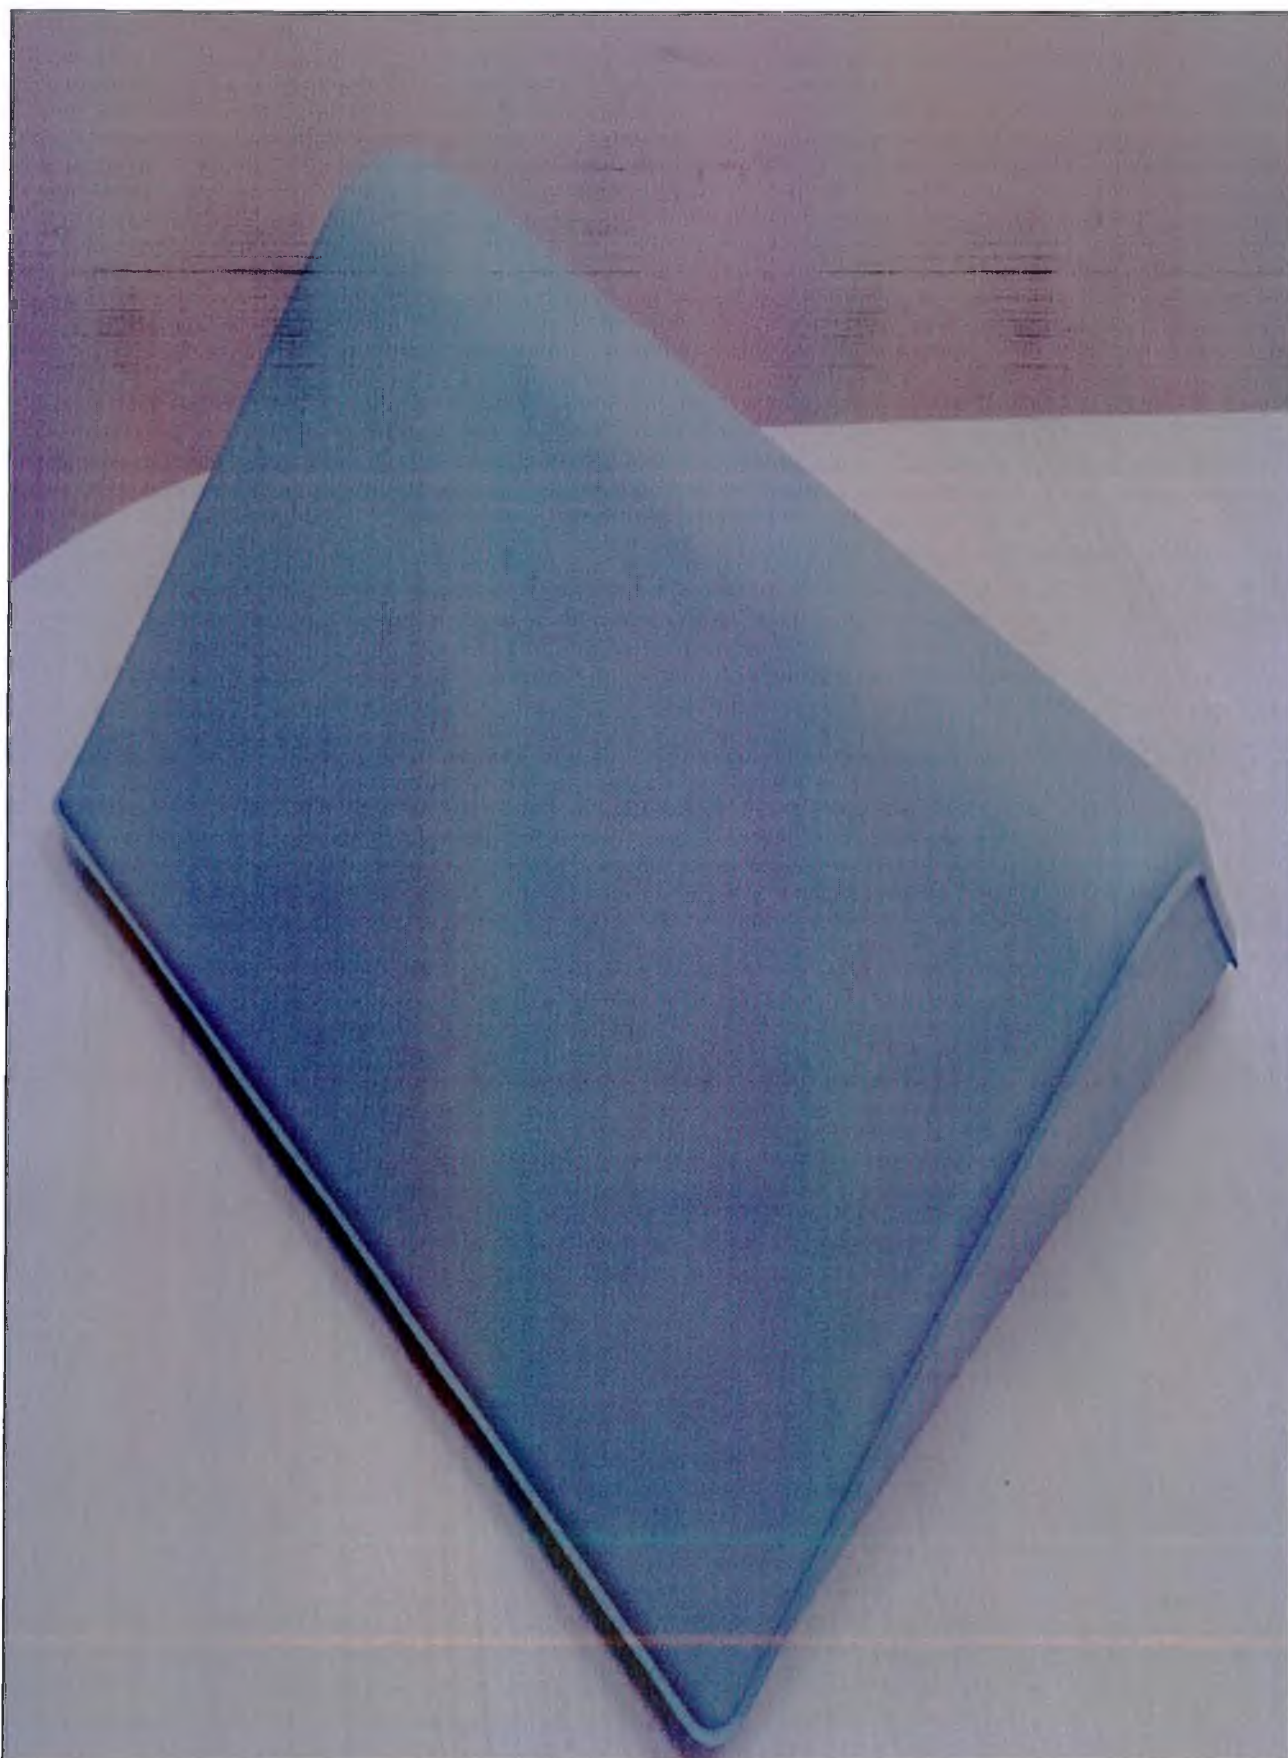


Подушка под колени.

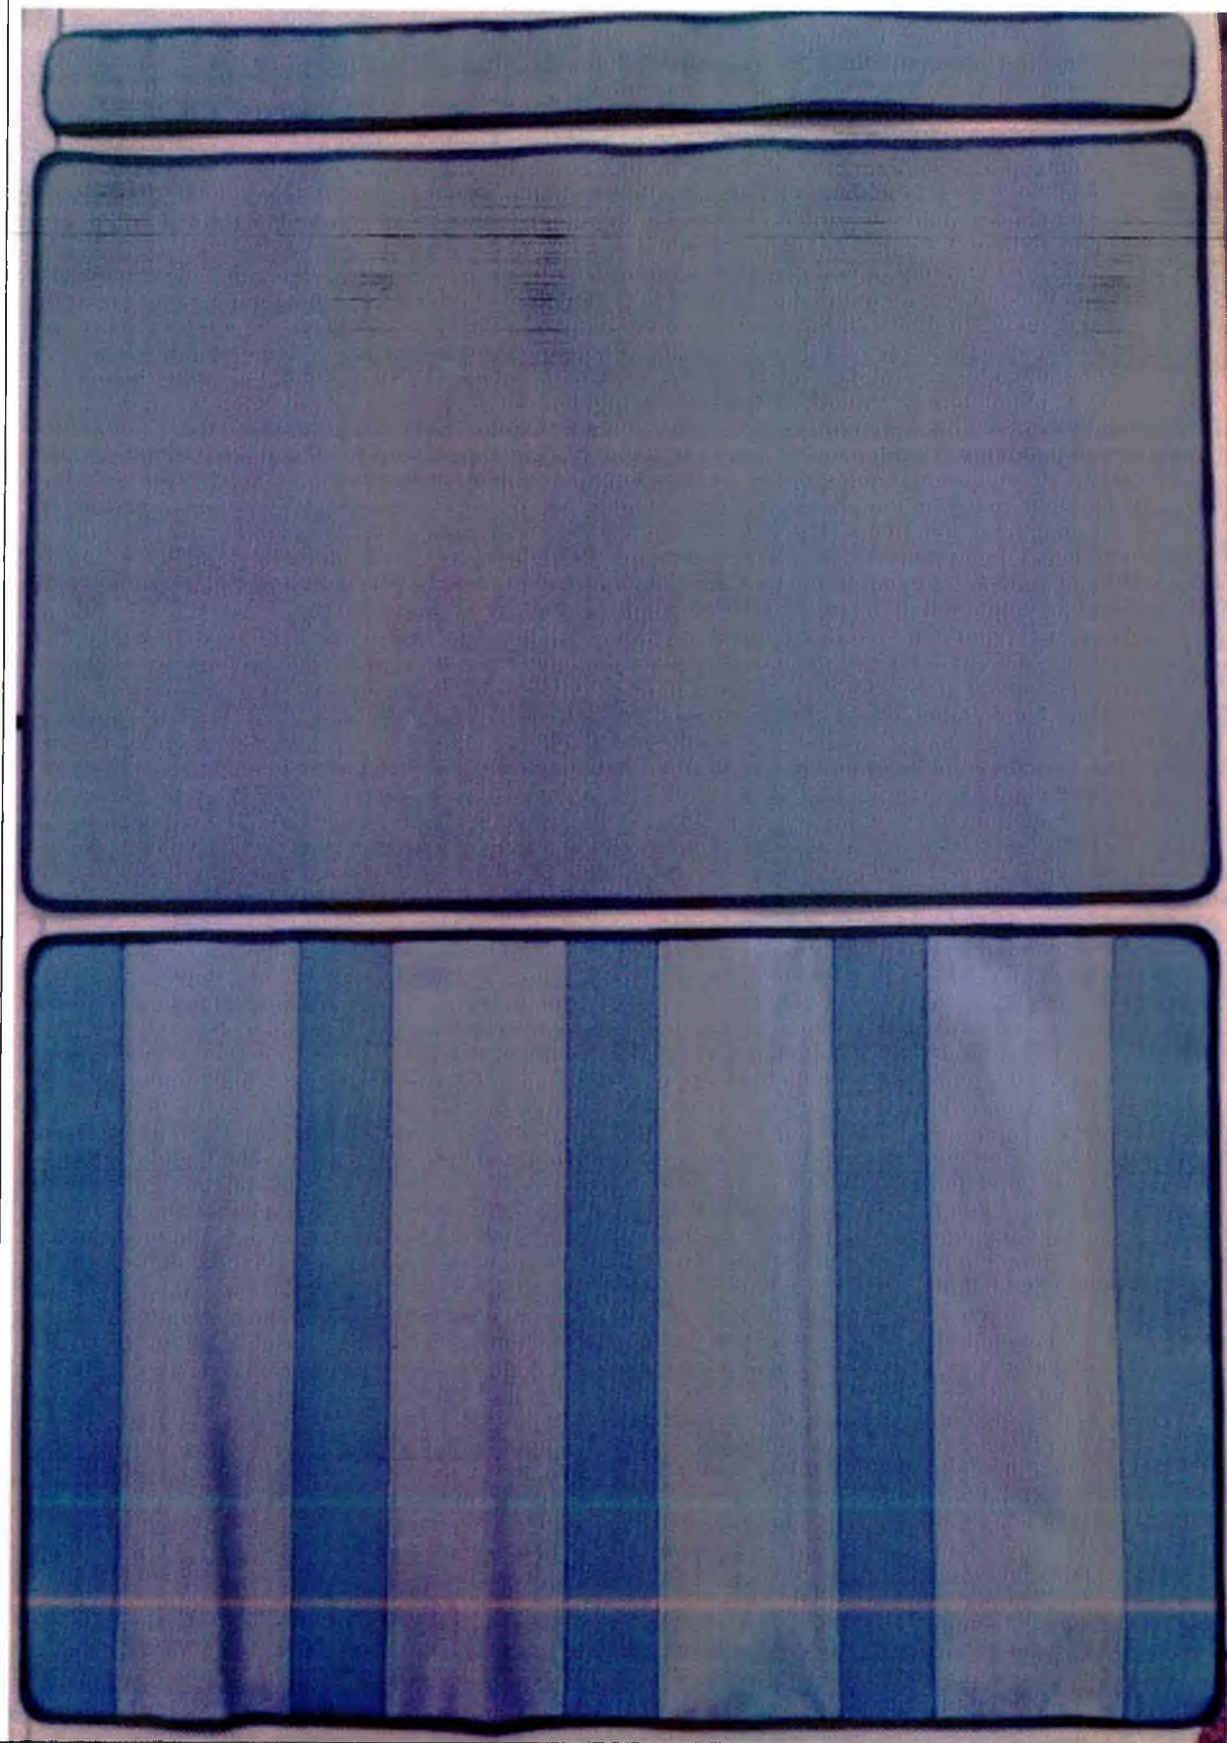

Ремни для фиксации пациента.



Стол для консоли управления.

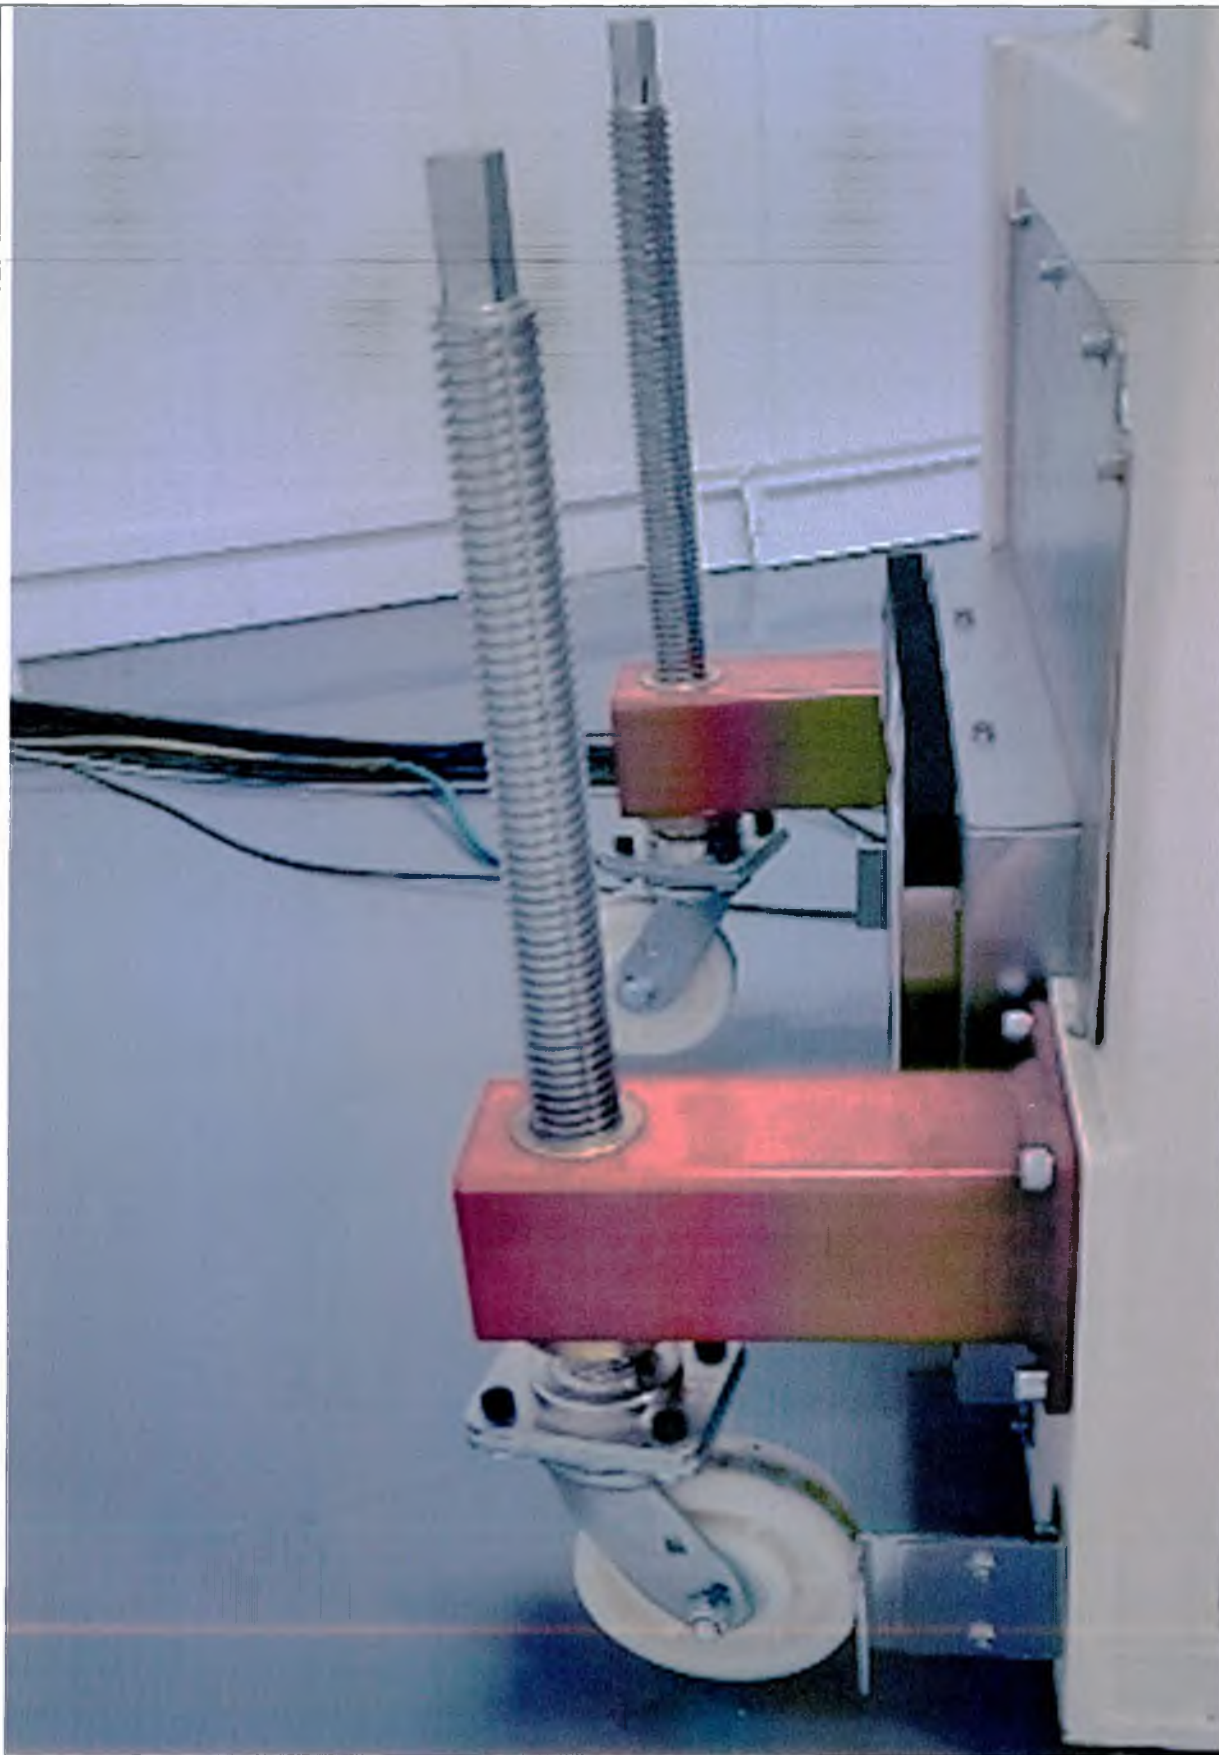

Устройство транспортировочное для гентри для сканирования.




Устройство транспортировочное для стола для укладки пациента.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа сосудов.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для оценки перфузии головного мозга.

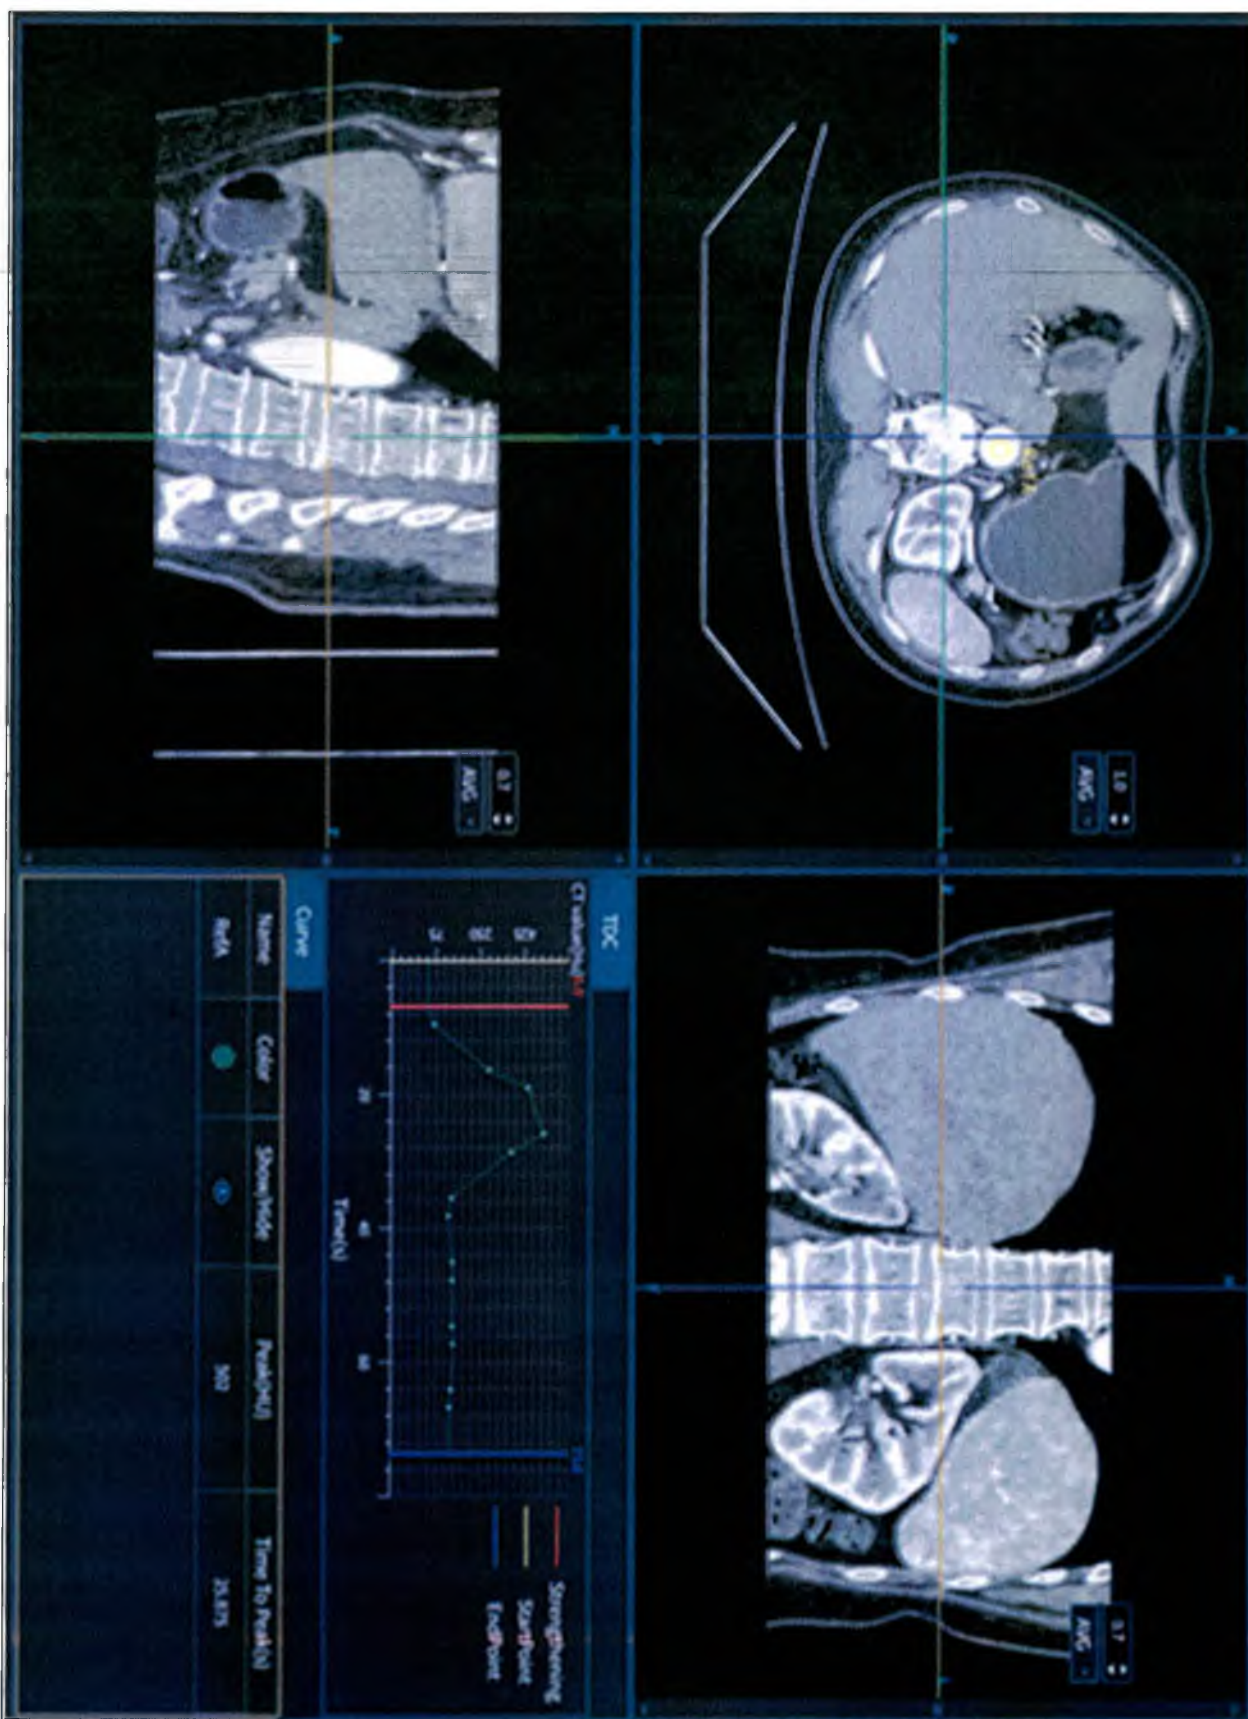


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
 - для оценки перфузии внутренних органов.

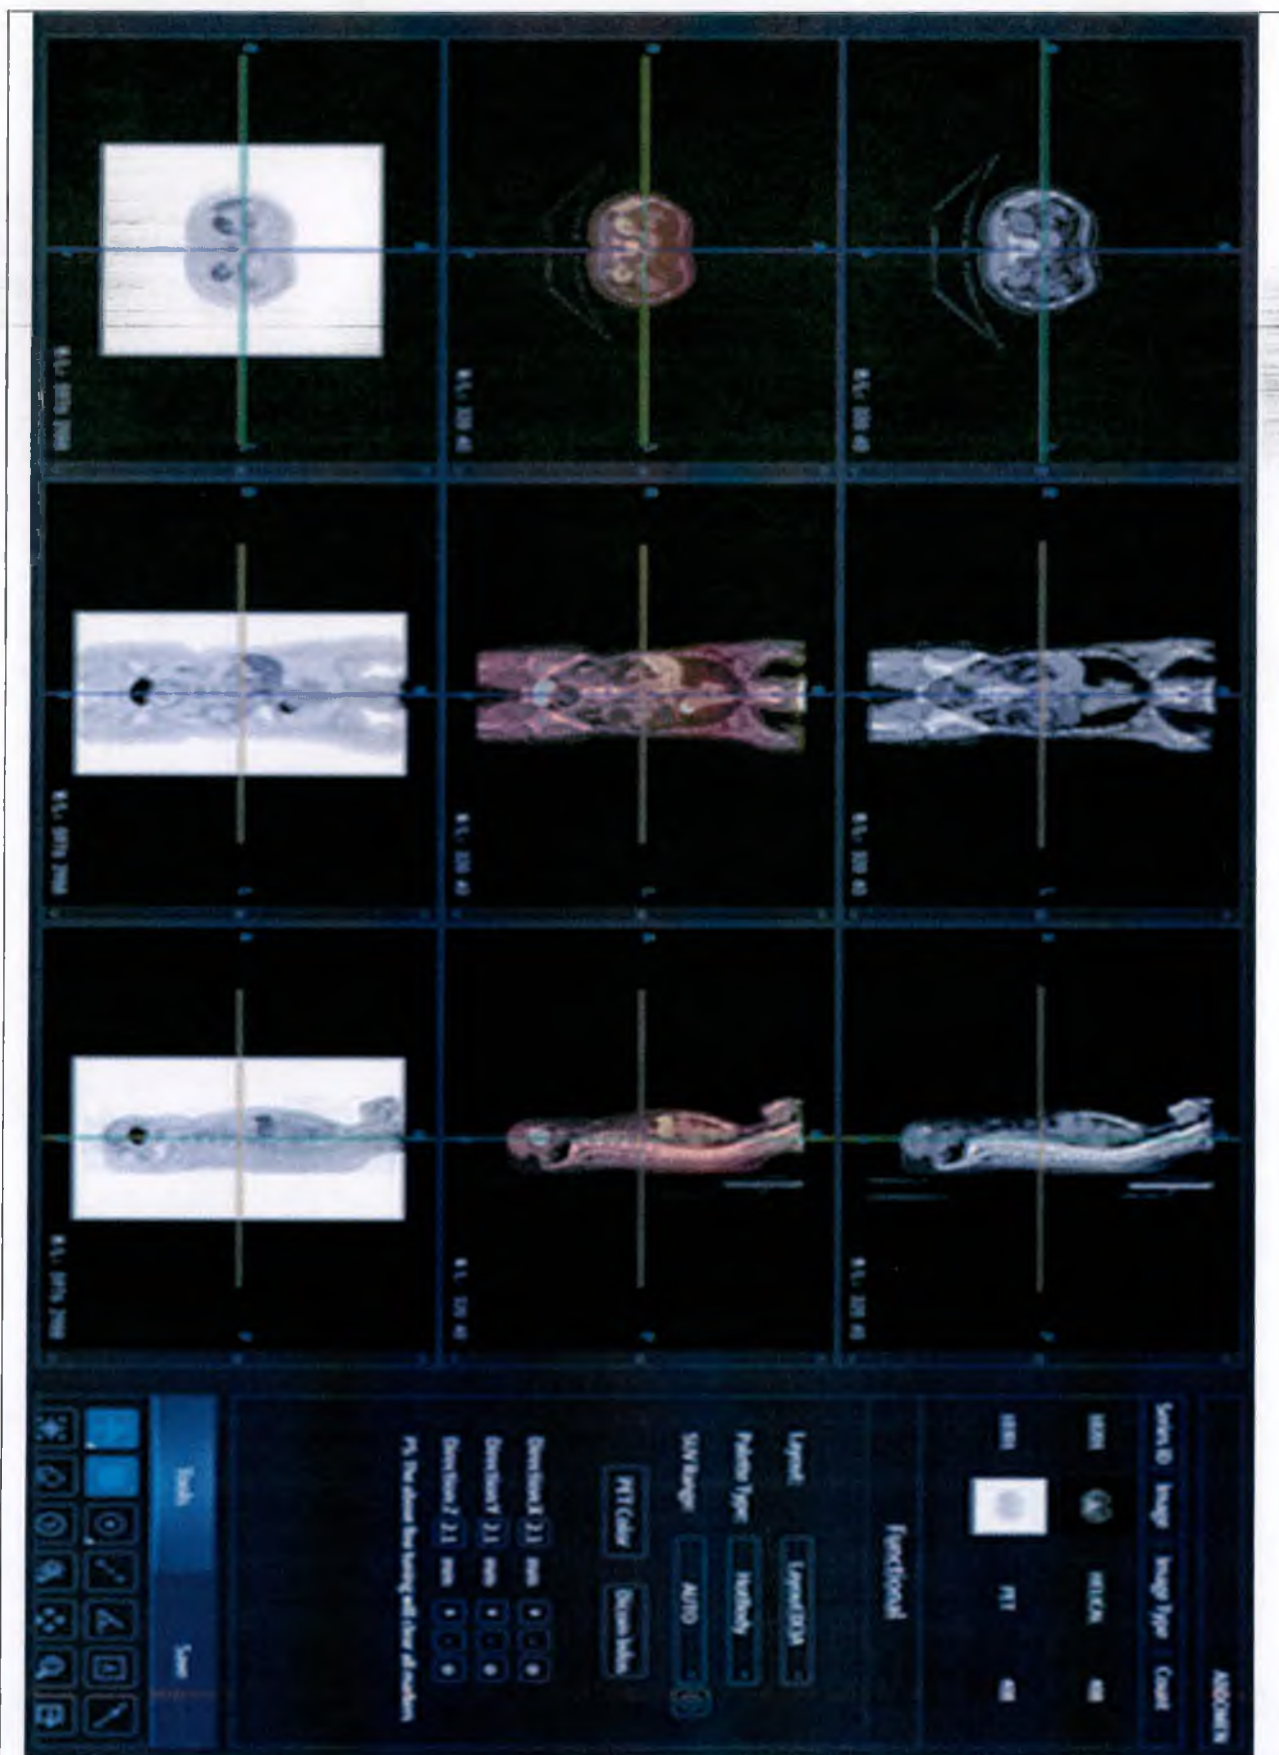

Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
 - для совмещения изображений разных модальностей.

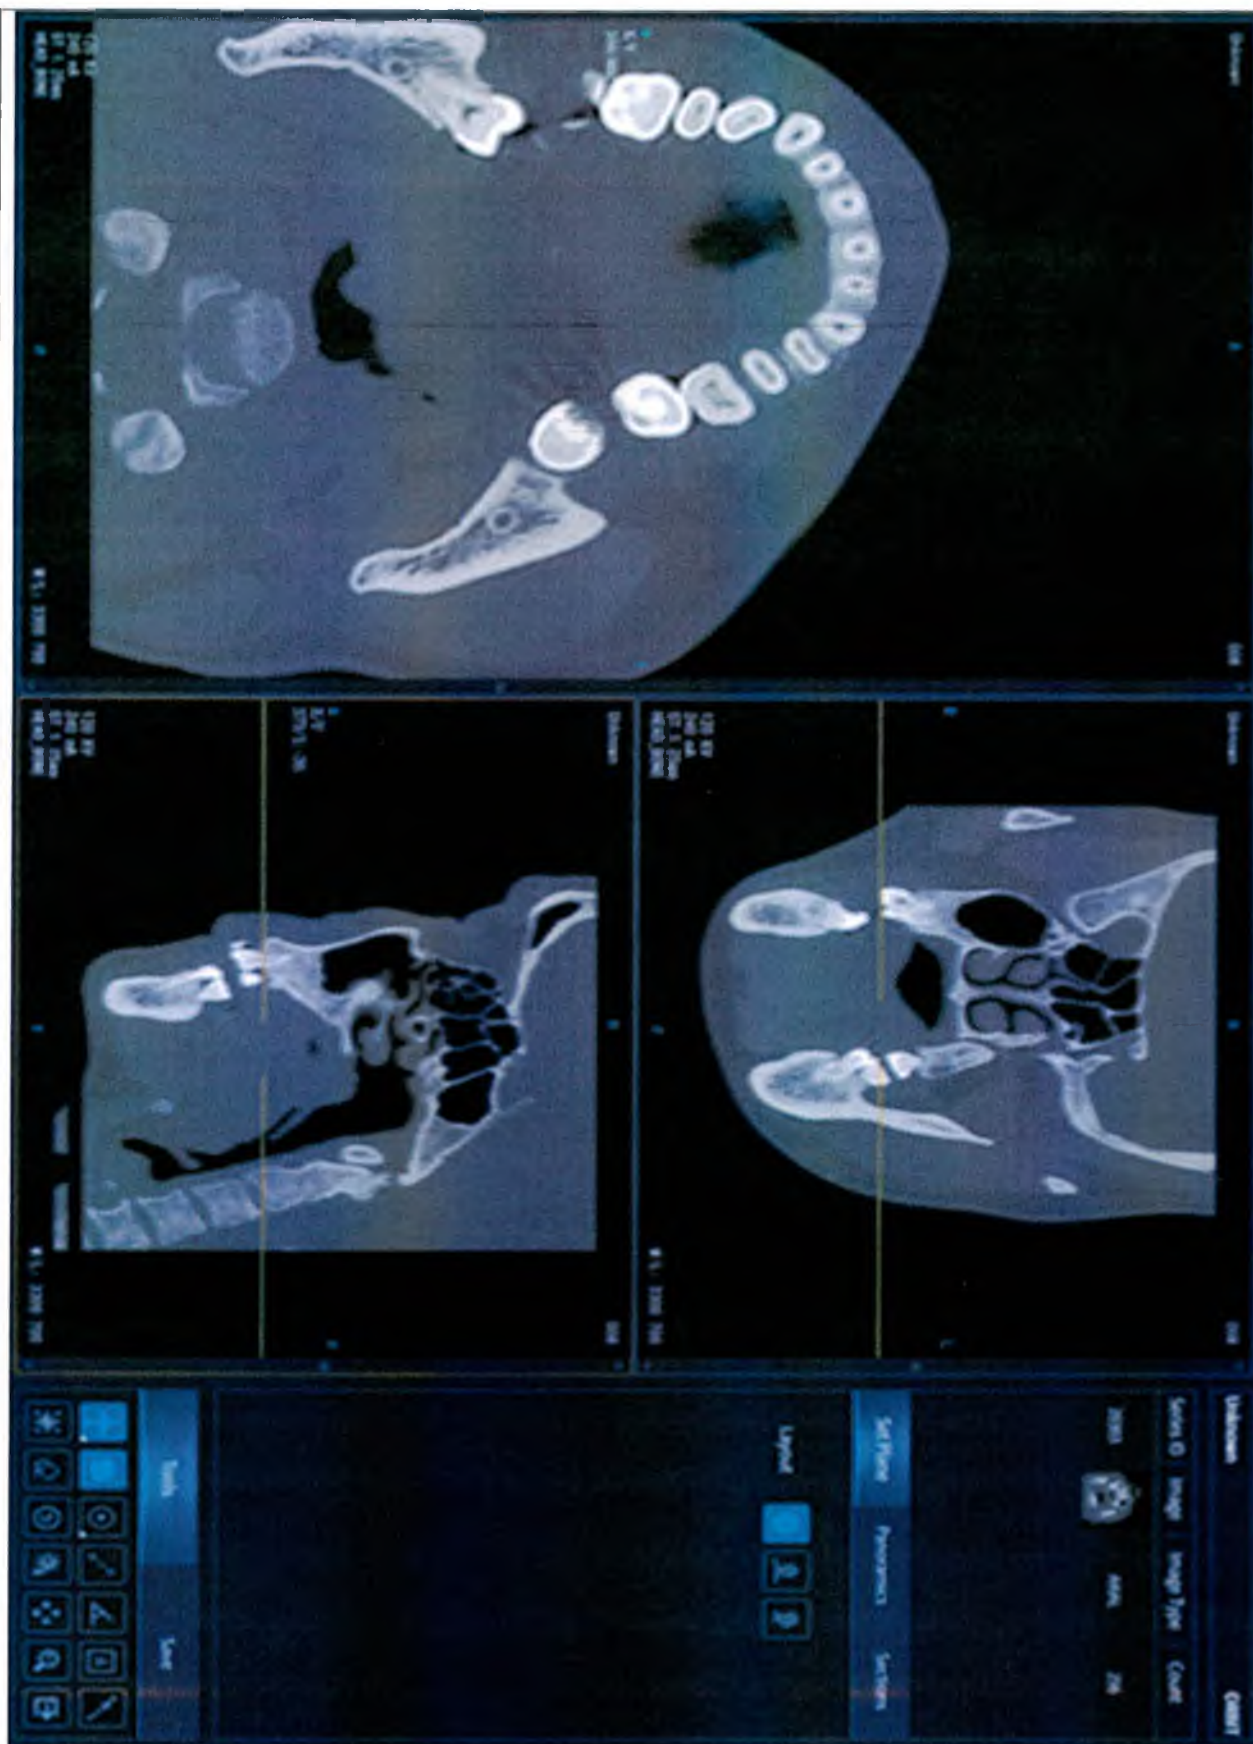


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
 - для анализа стоматологических изображений.

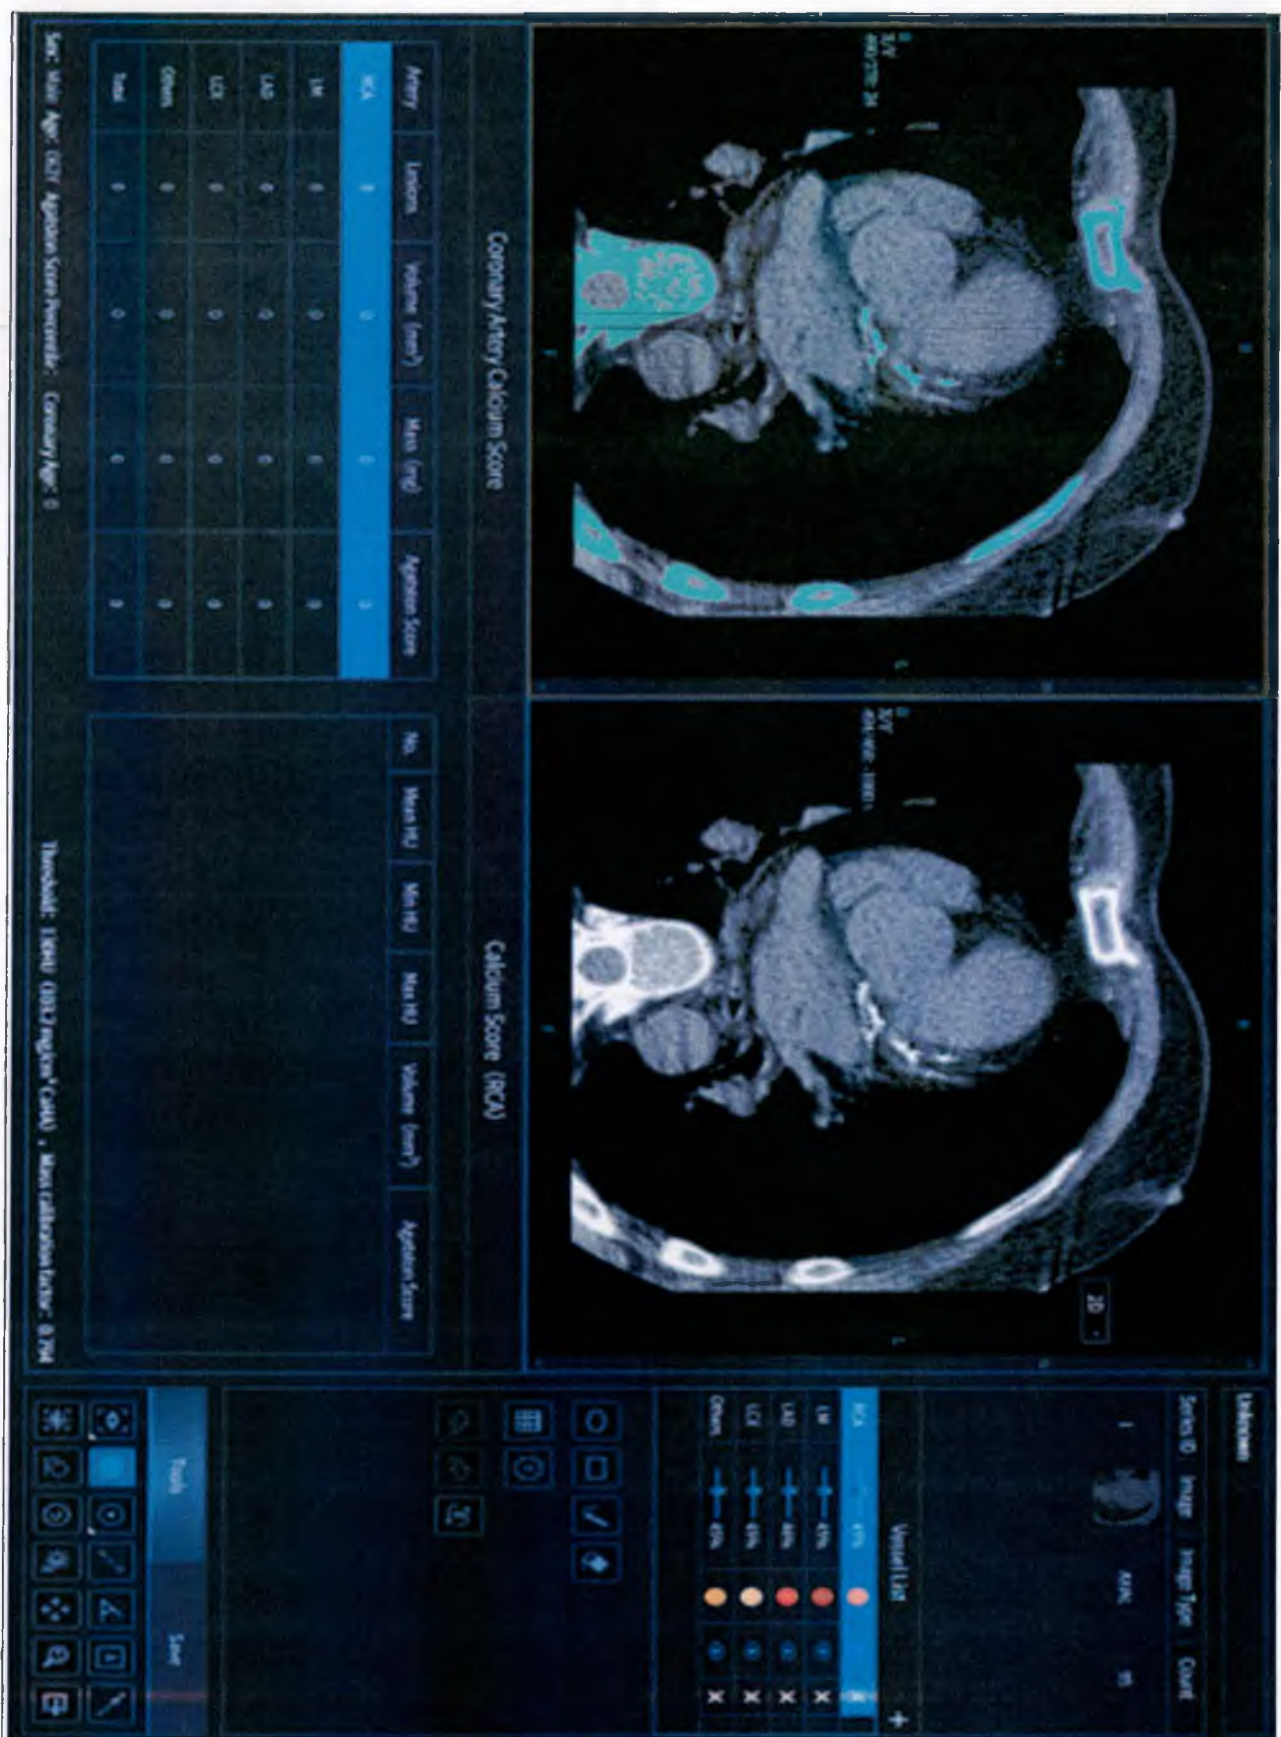


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для оценки содержания кальция.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для оценки перфузии миокарда.

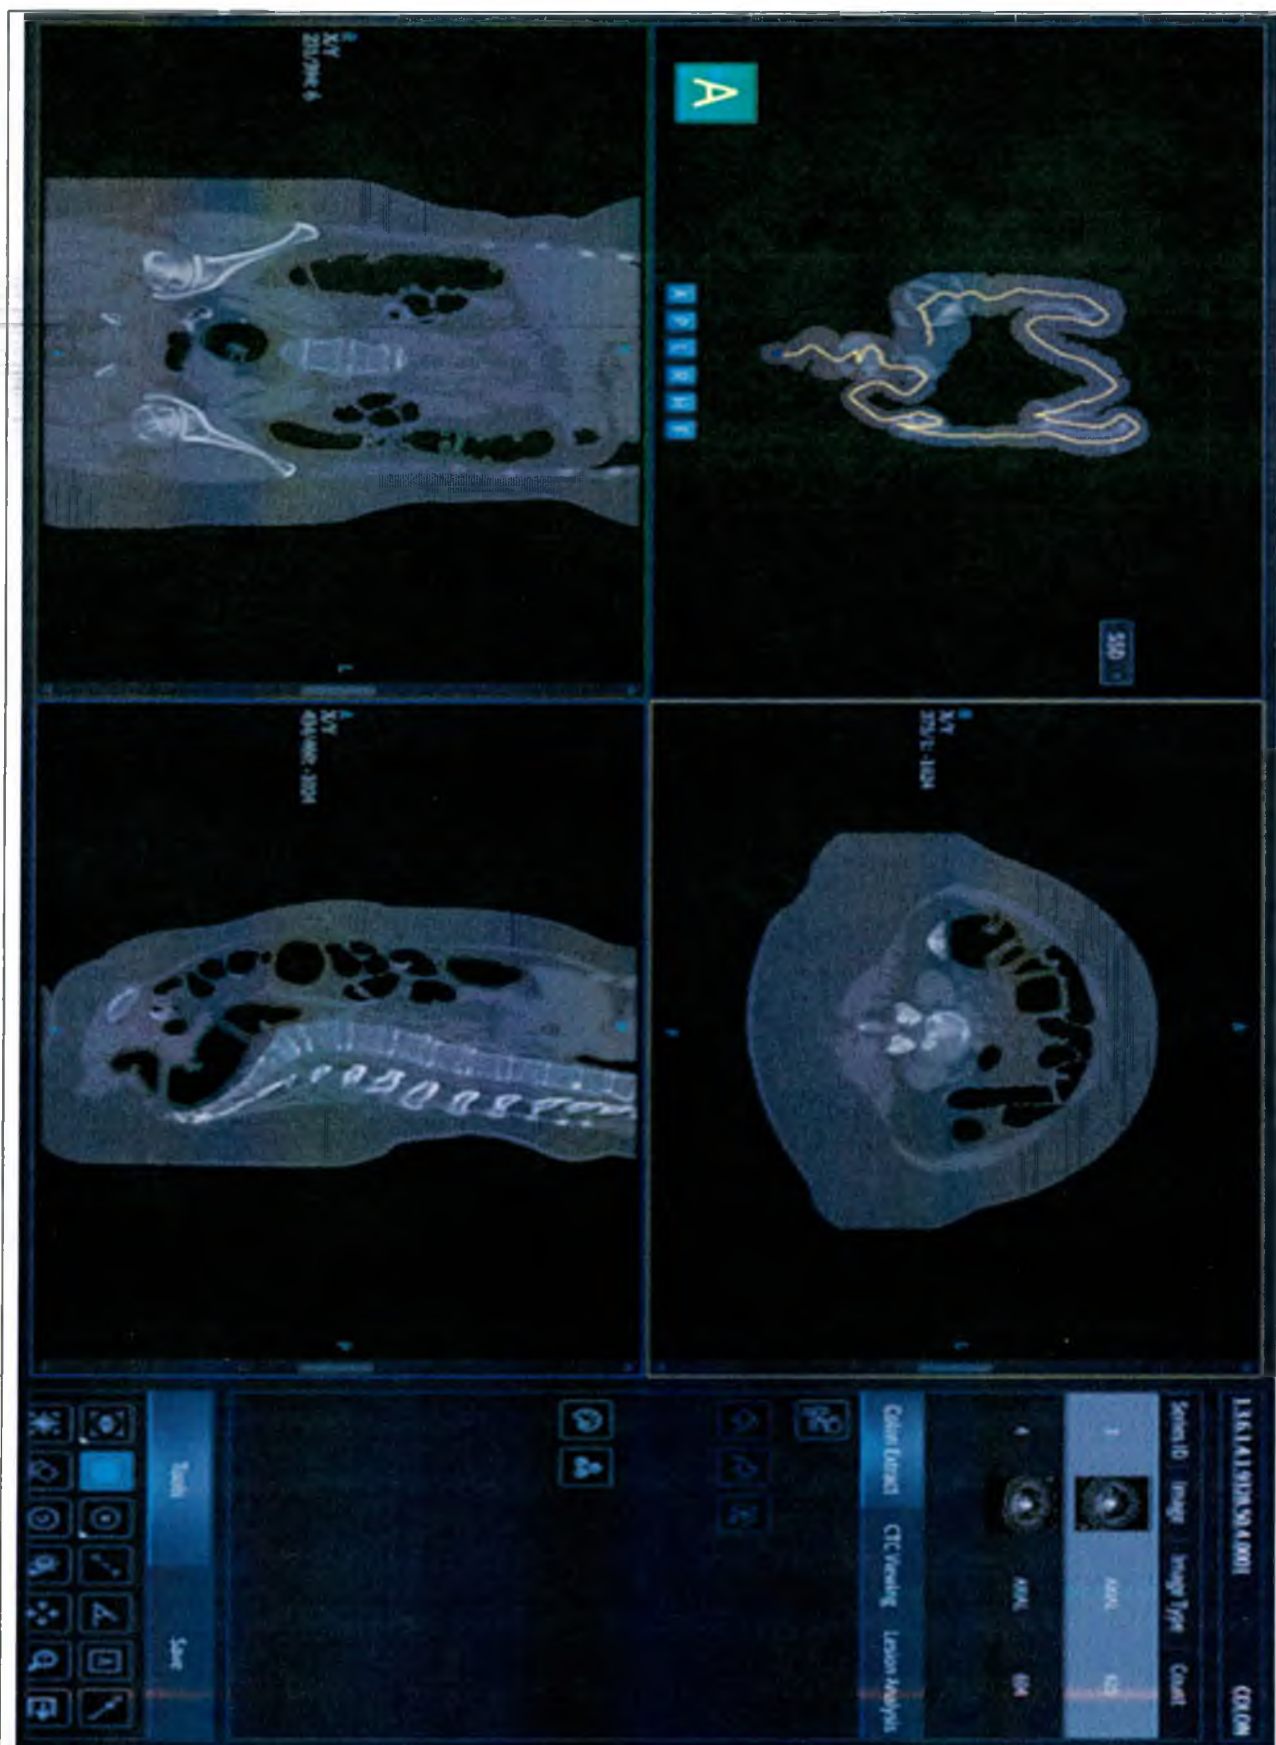


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для кишечной визуализации.

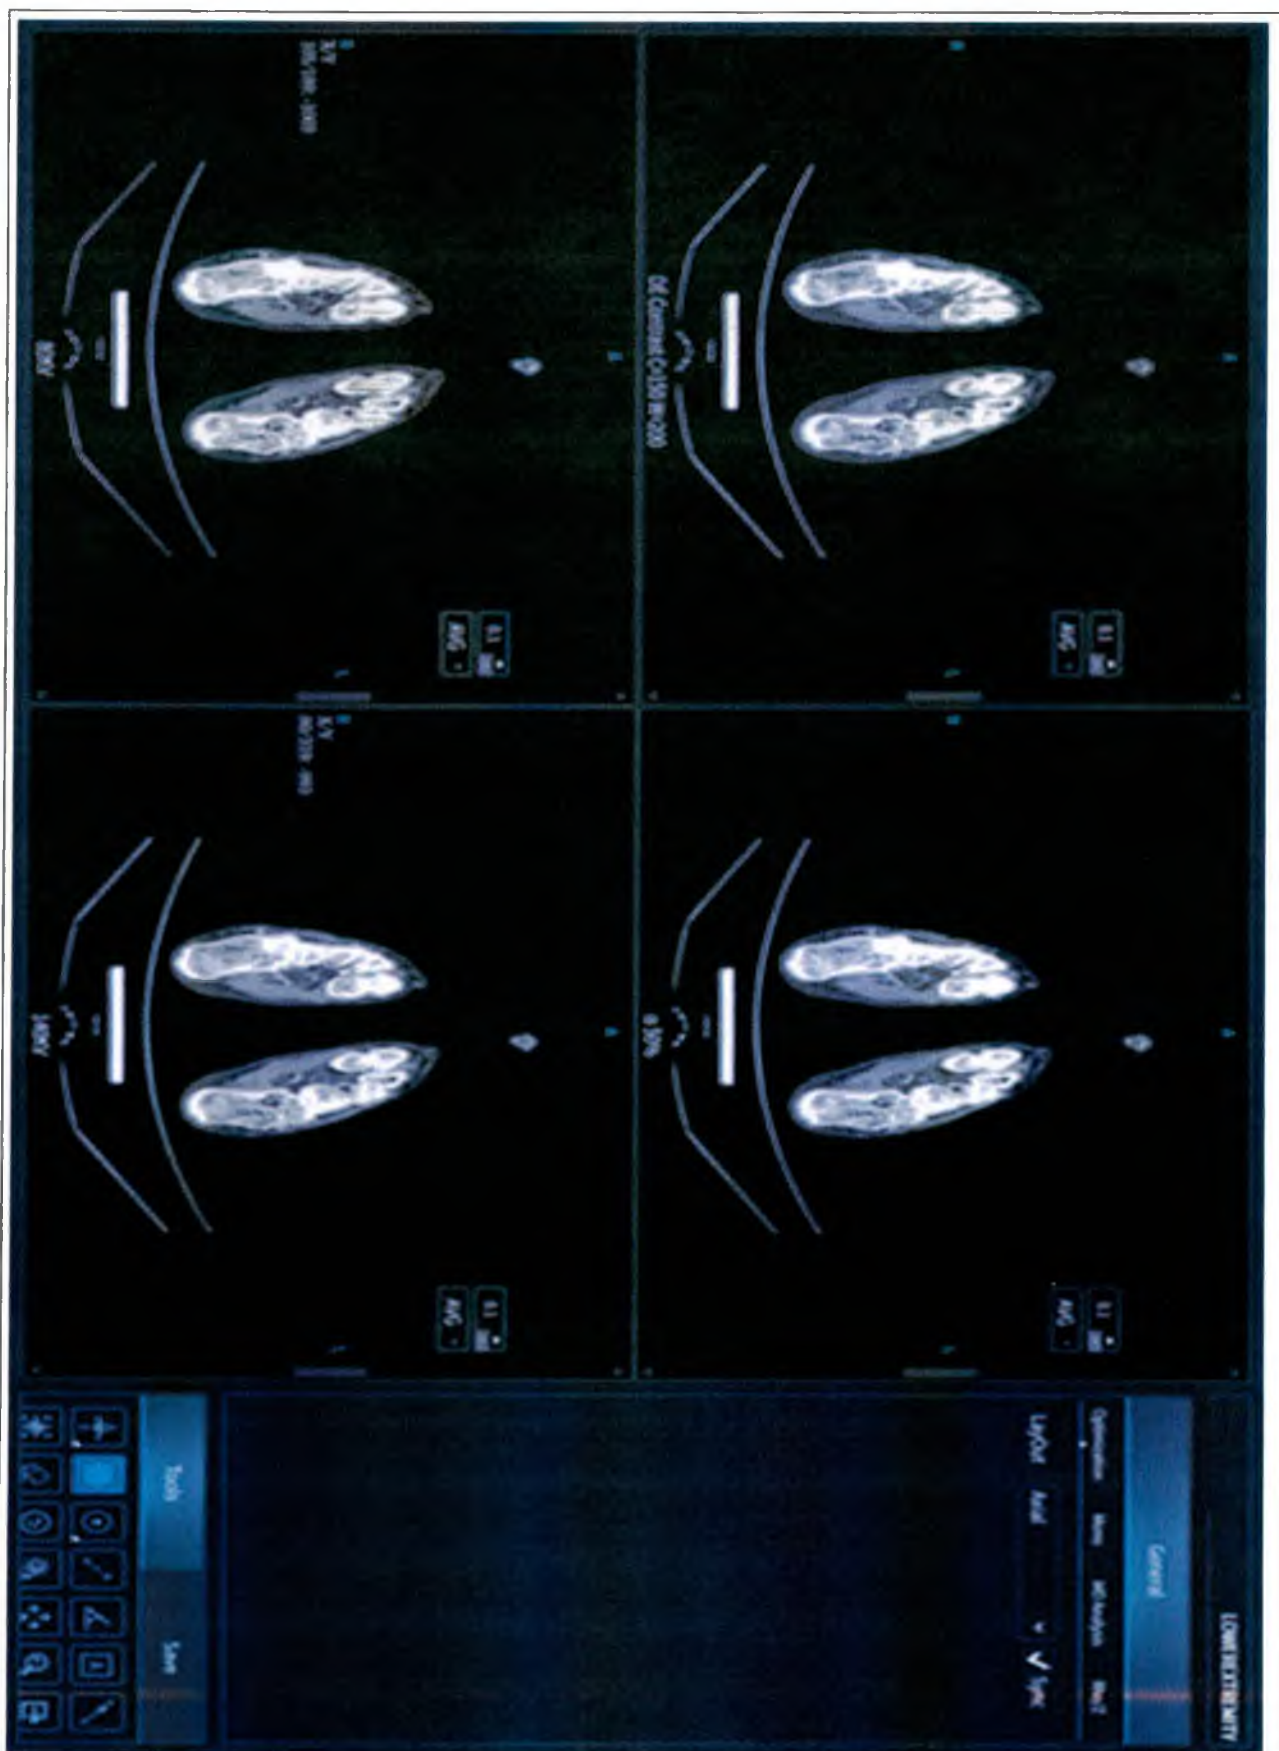

Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
 - для спектральной визуализации и анализа спектральных изображений.

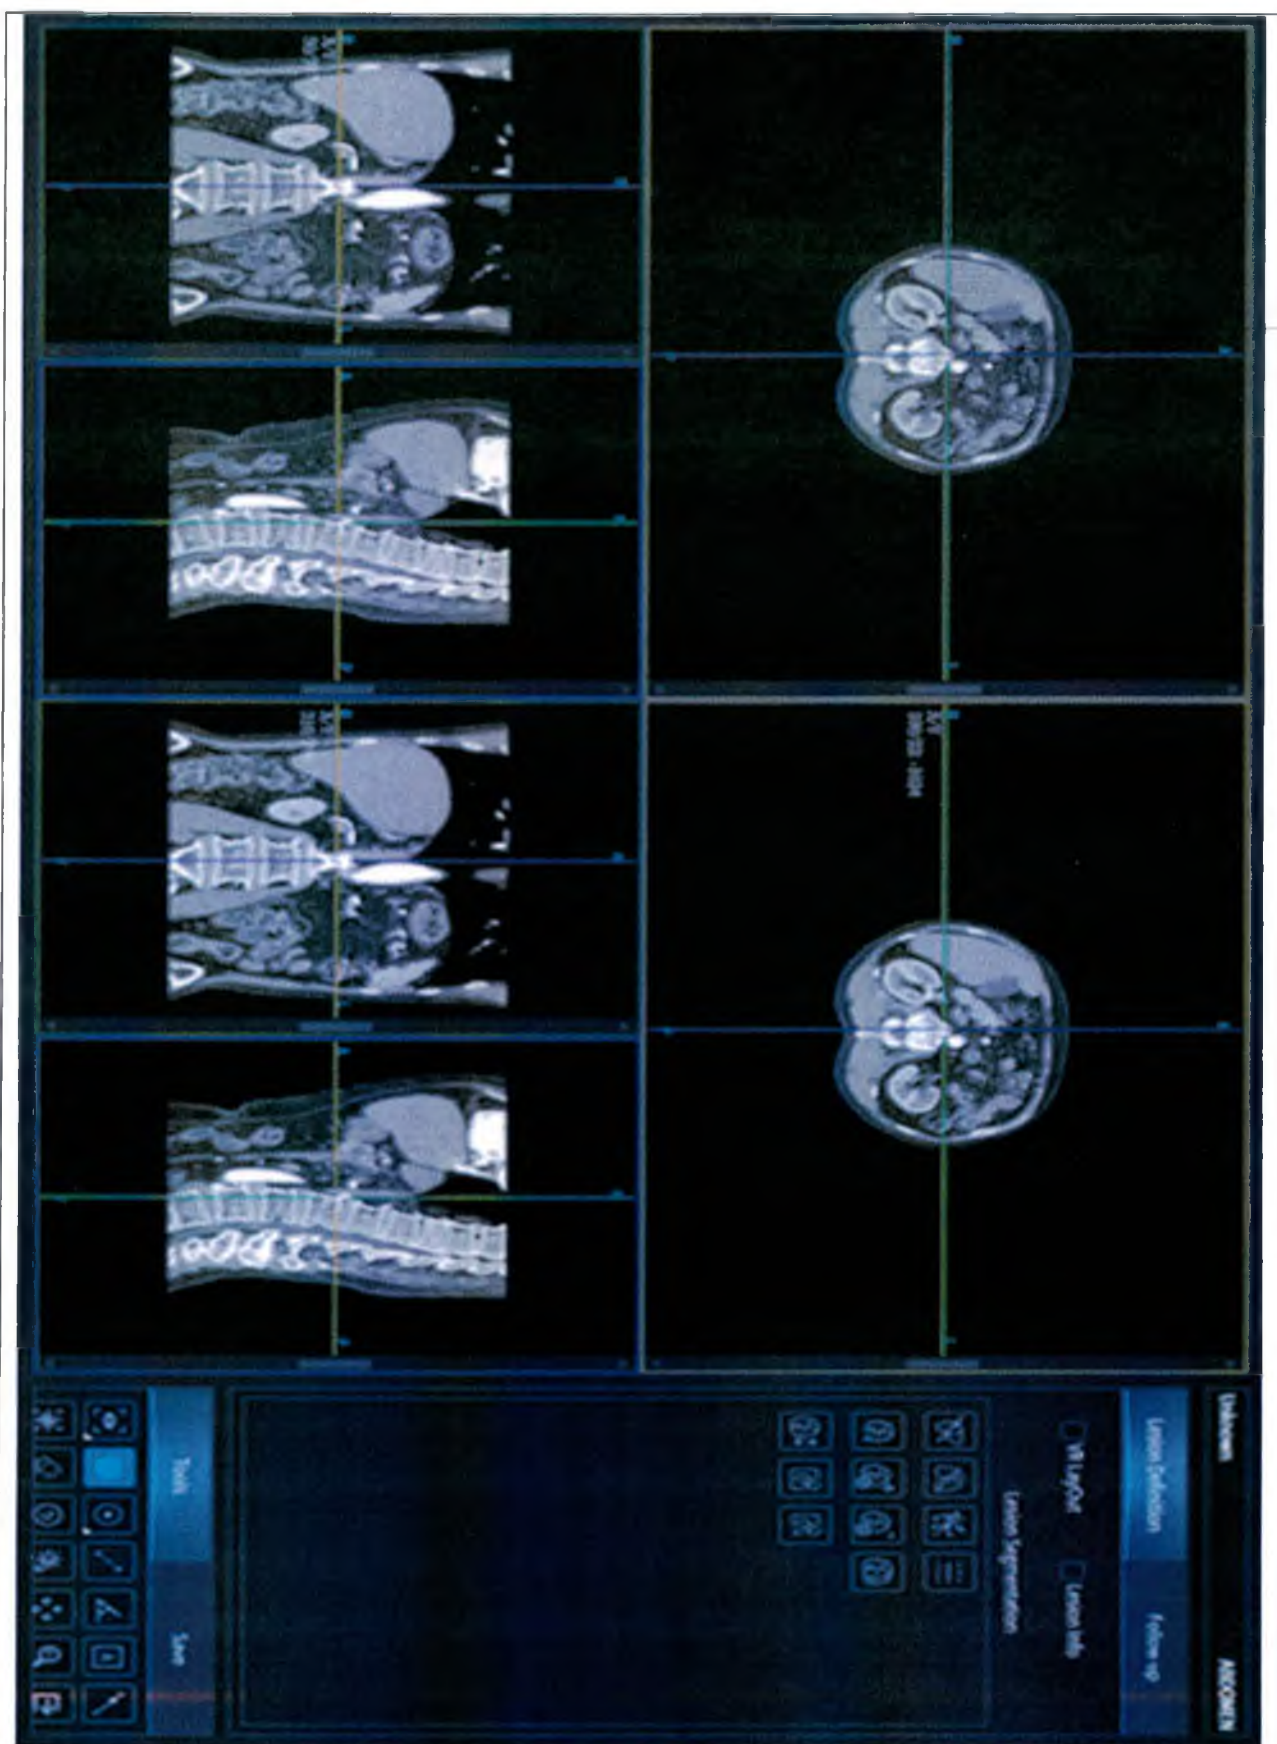


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
 - для онкологической визуализации и оценки объемных образований.

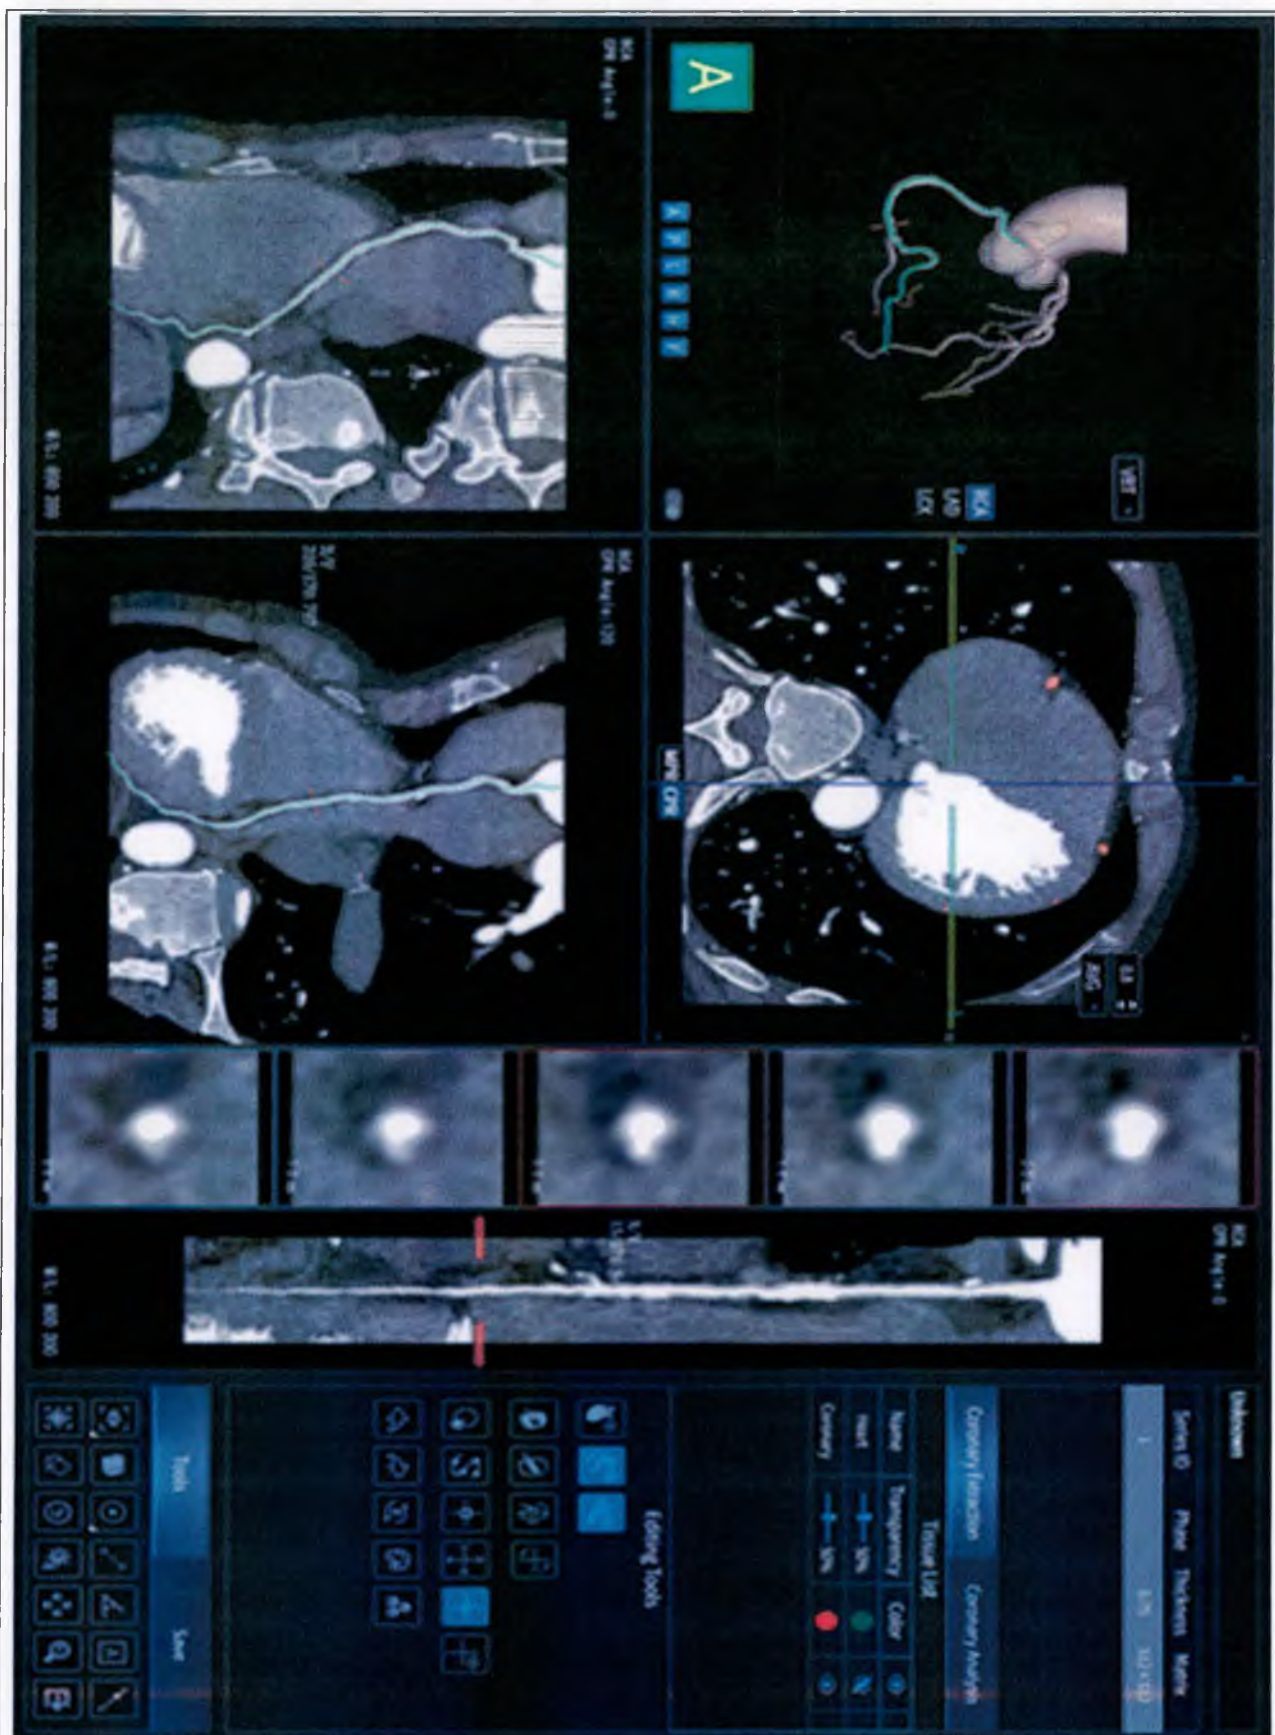


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа сердца и коронарных сосудов.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для урологической визуализации.

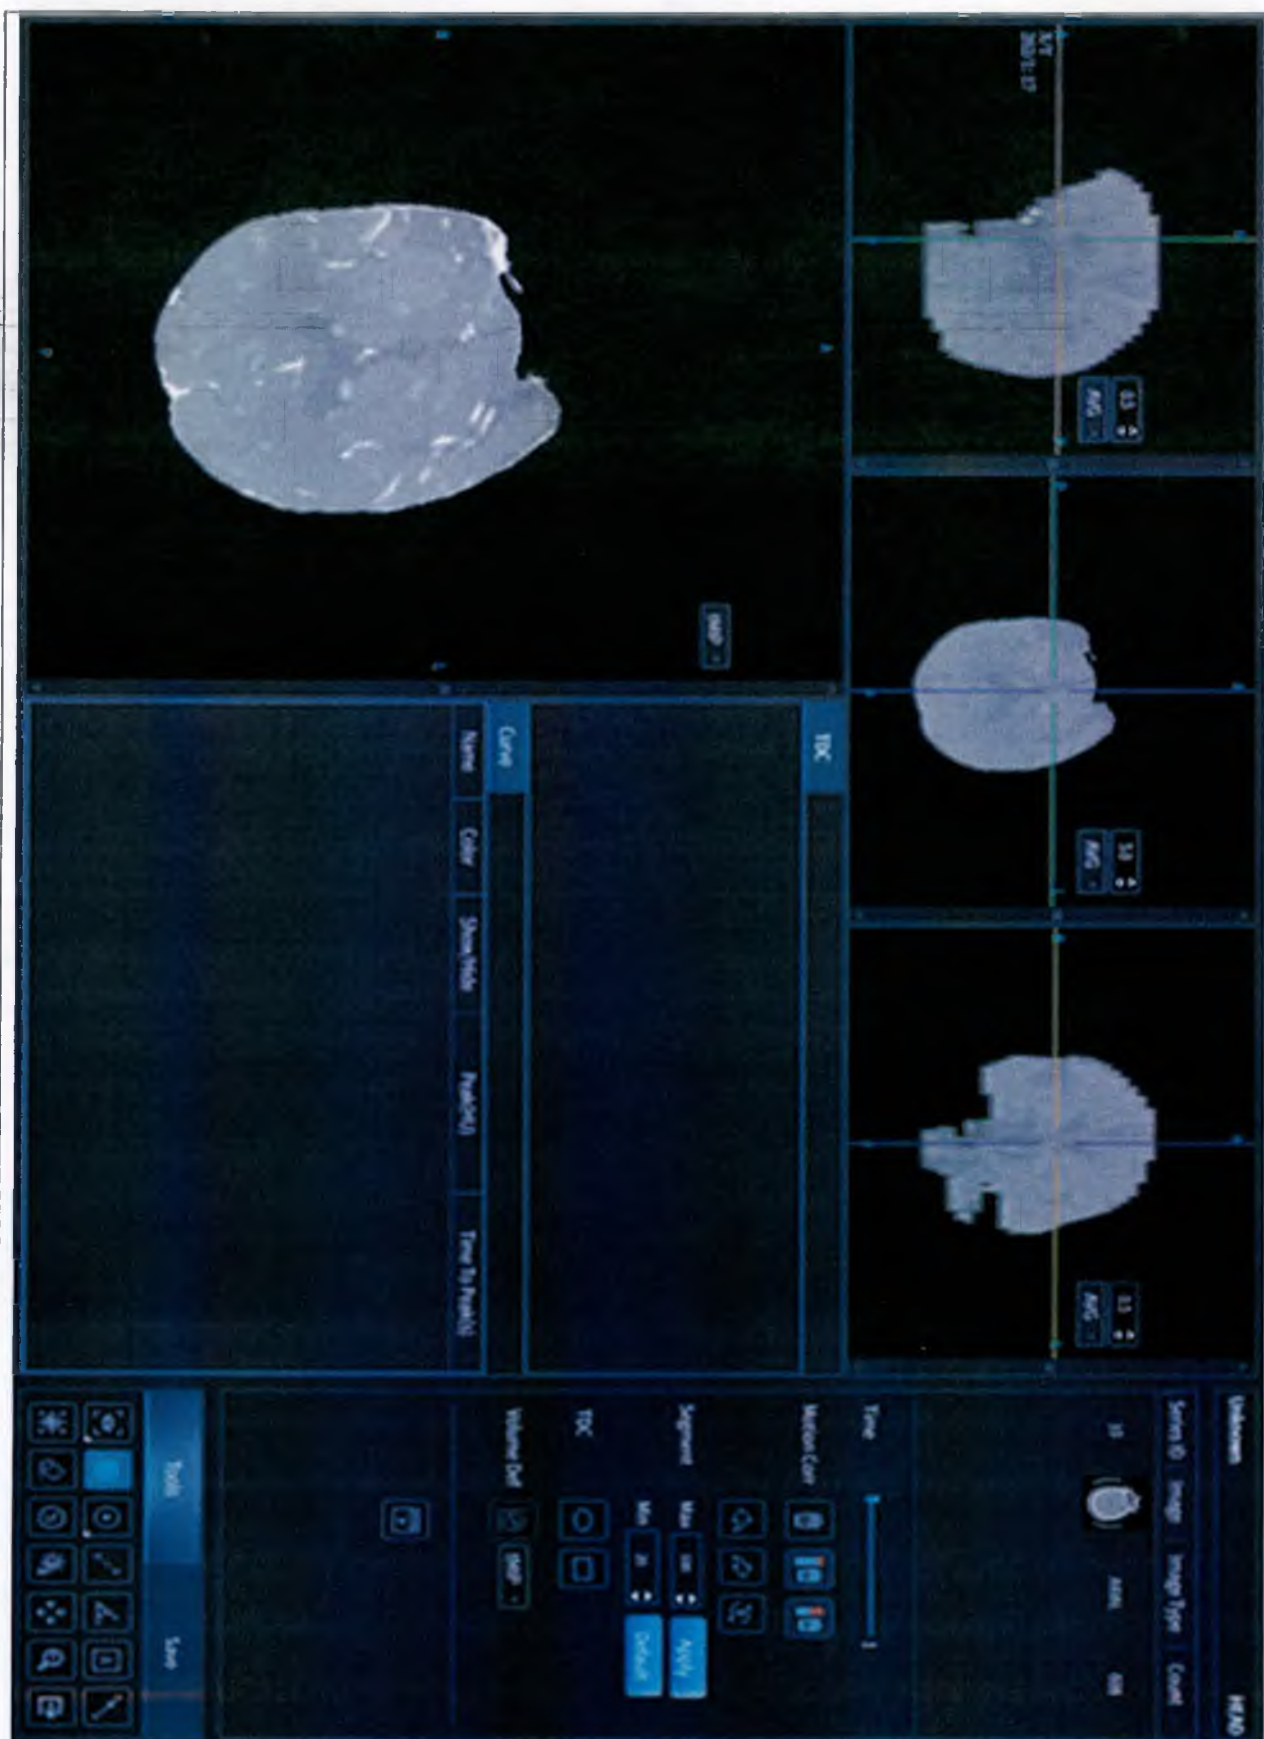

Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для 4D динамической визуализации.

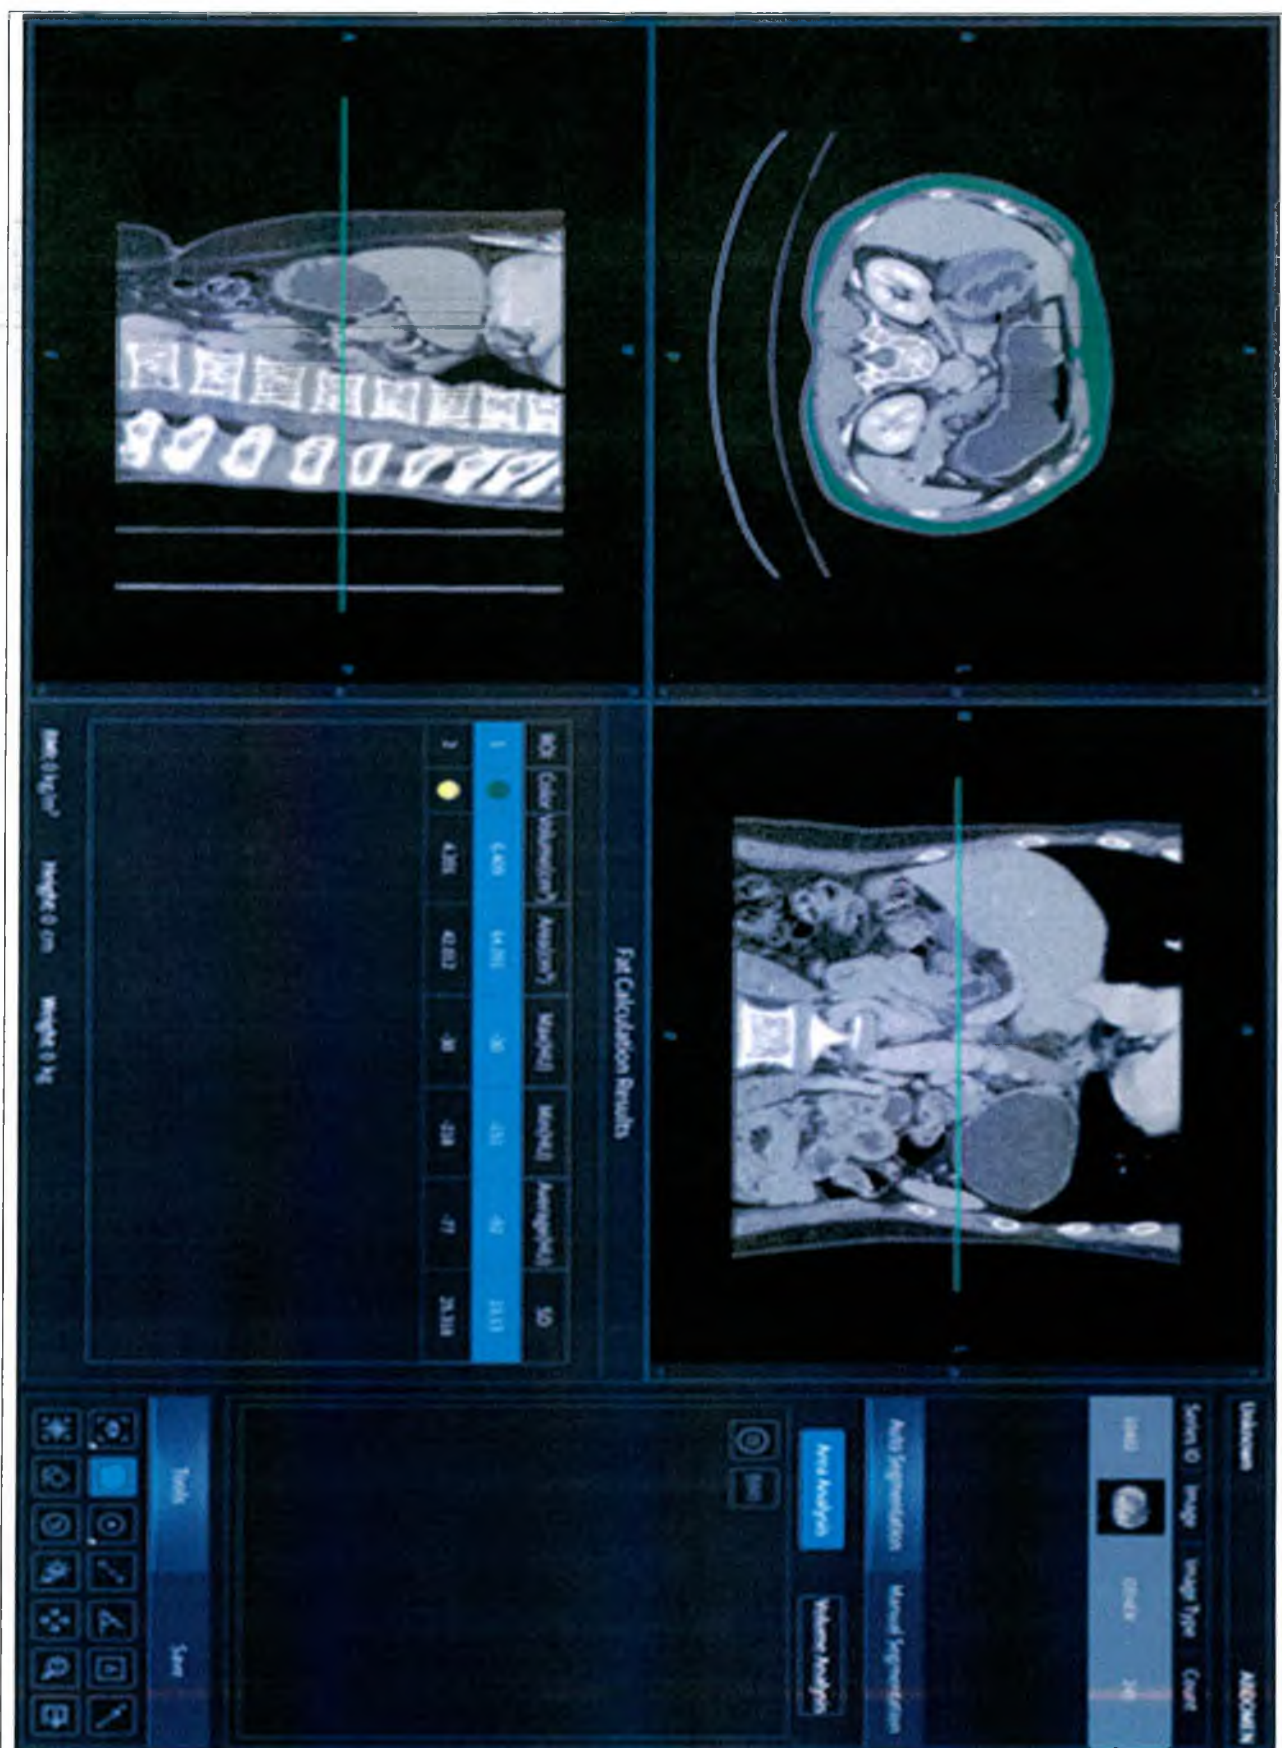


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:


- для оценки жировой ткани.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа печени.

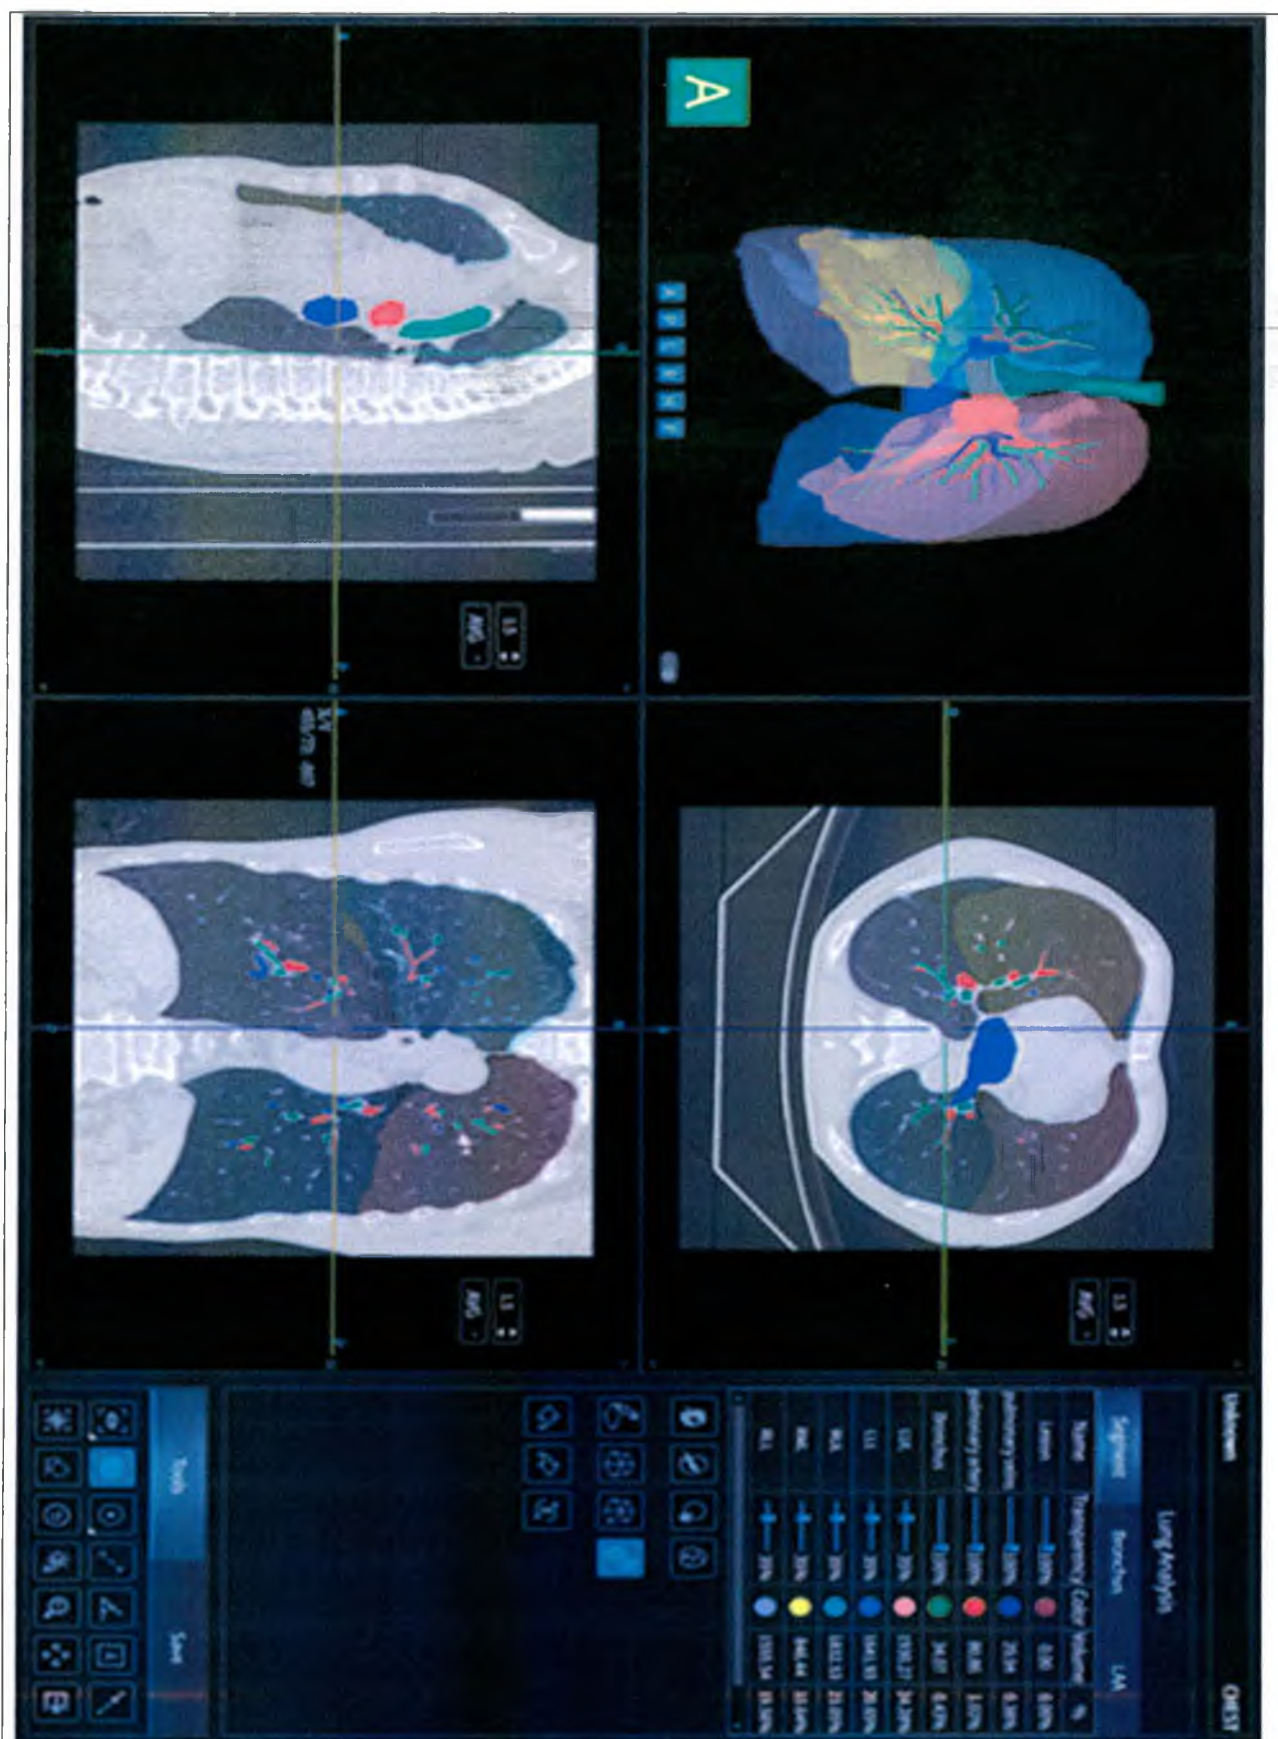

Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа легких.

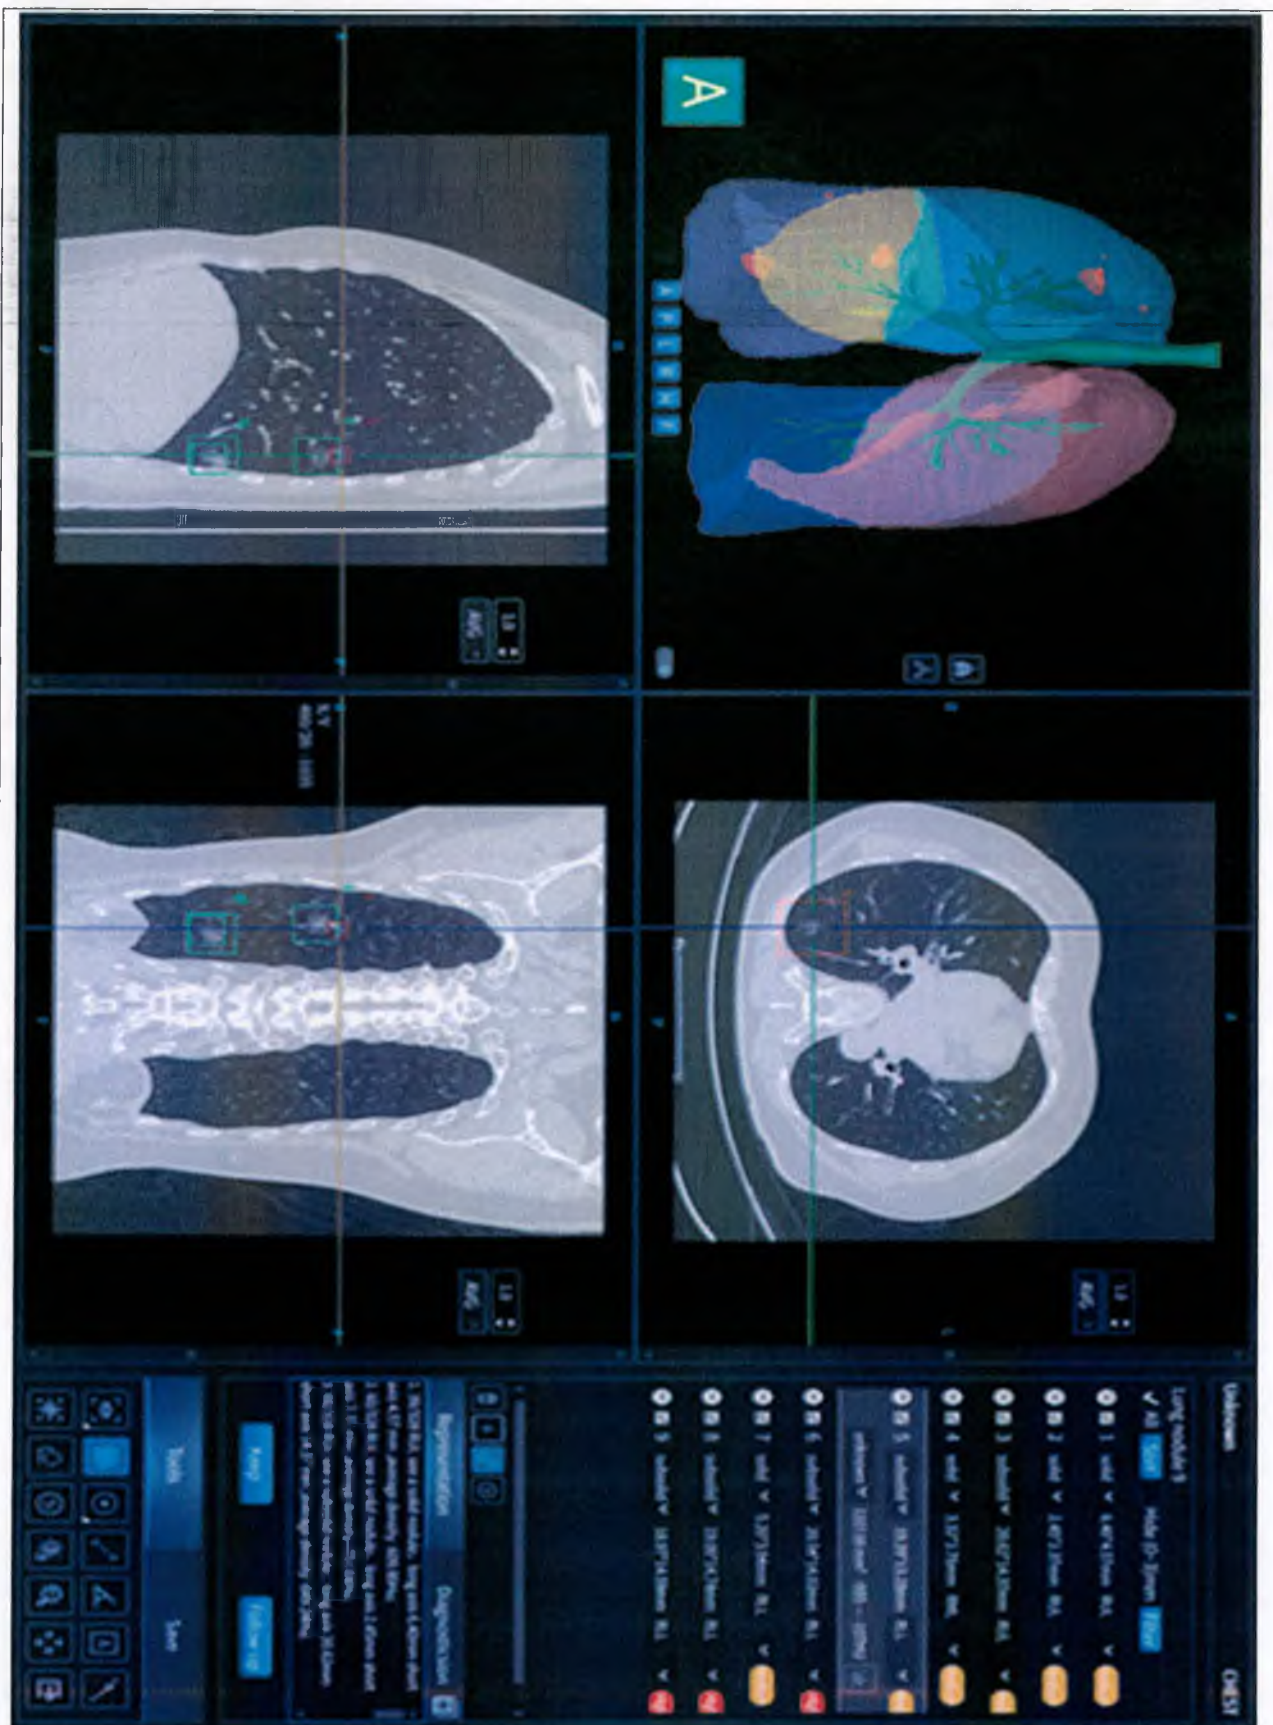


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа узелковых образований легких.

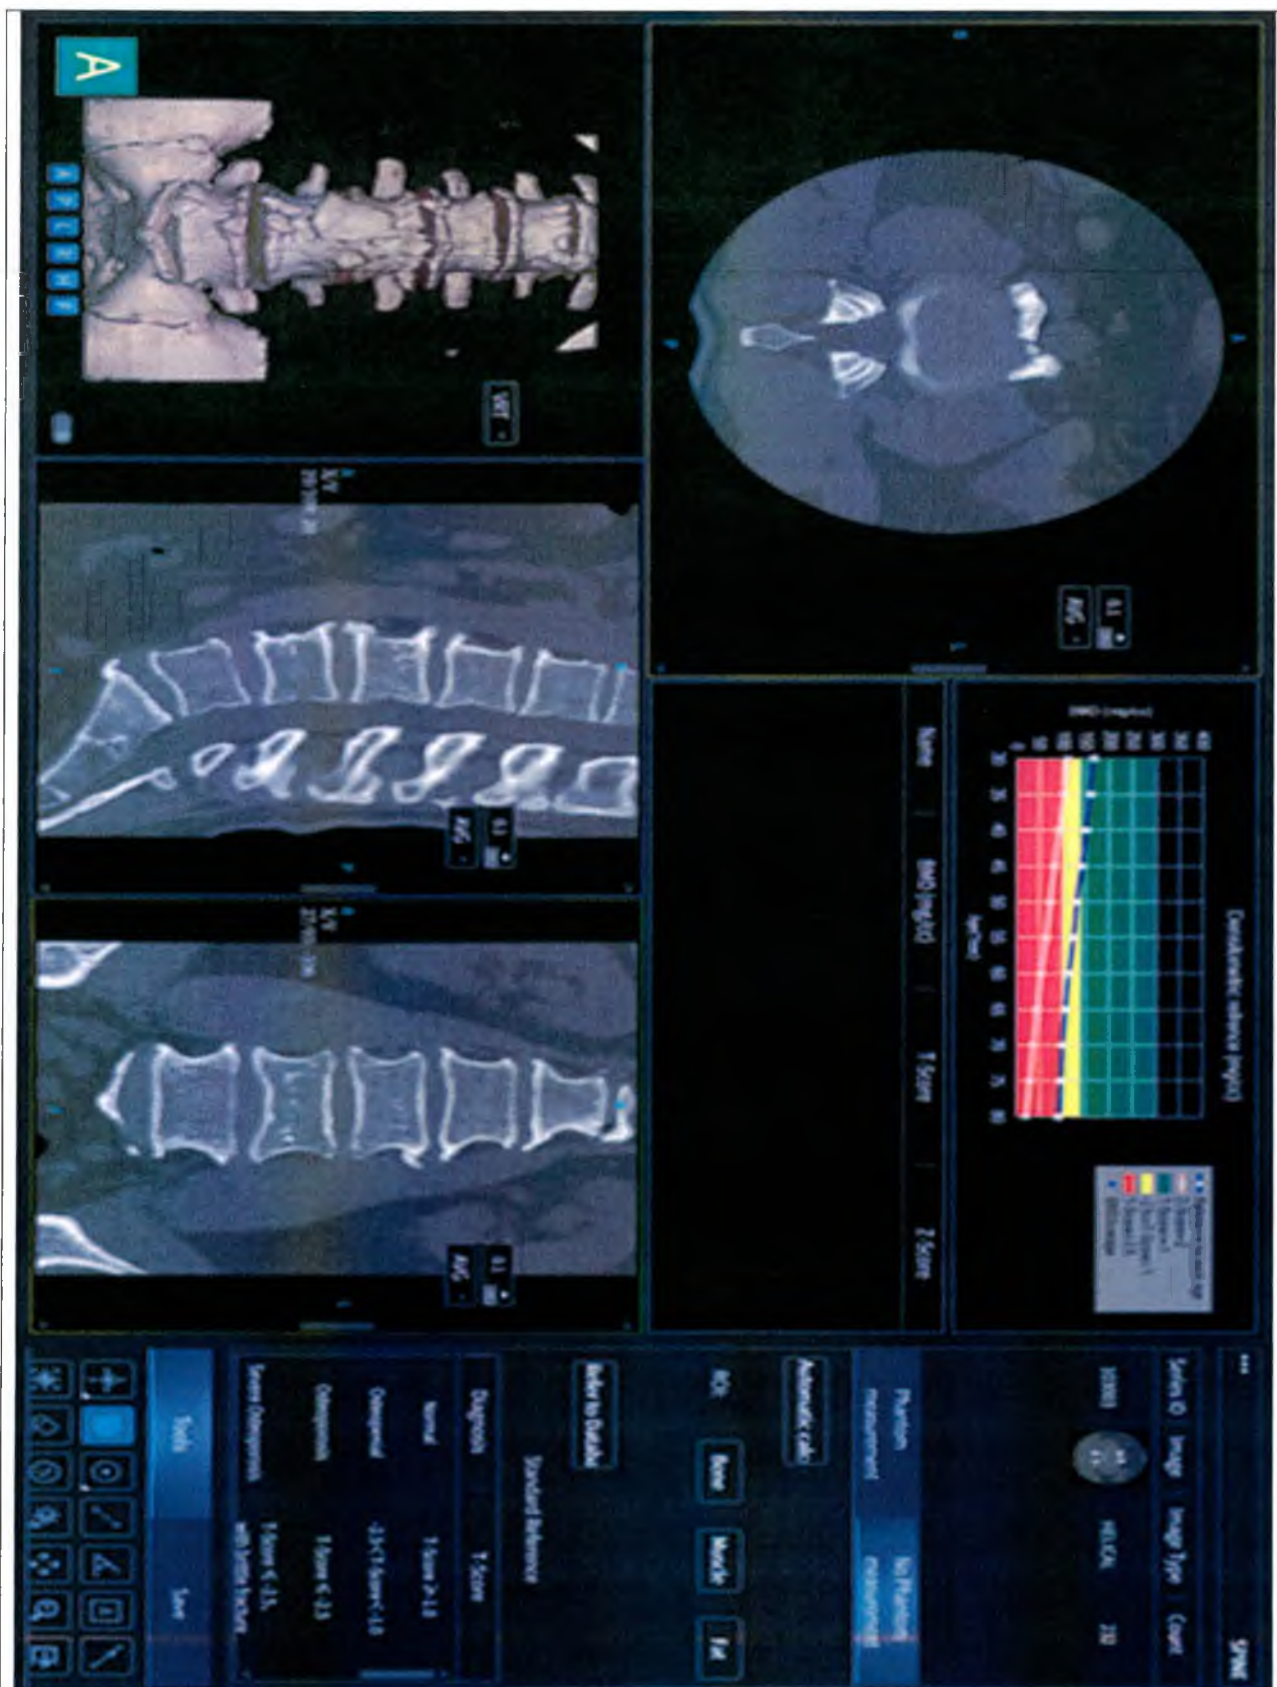


Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для оценки плотности костной ткани.

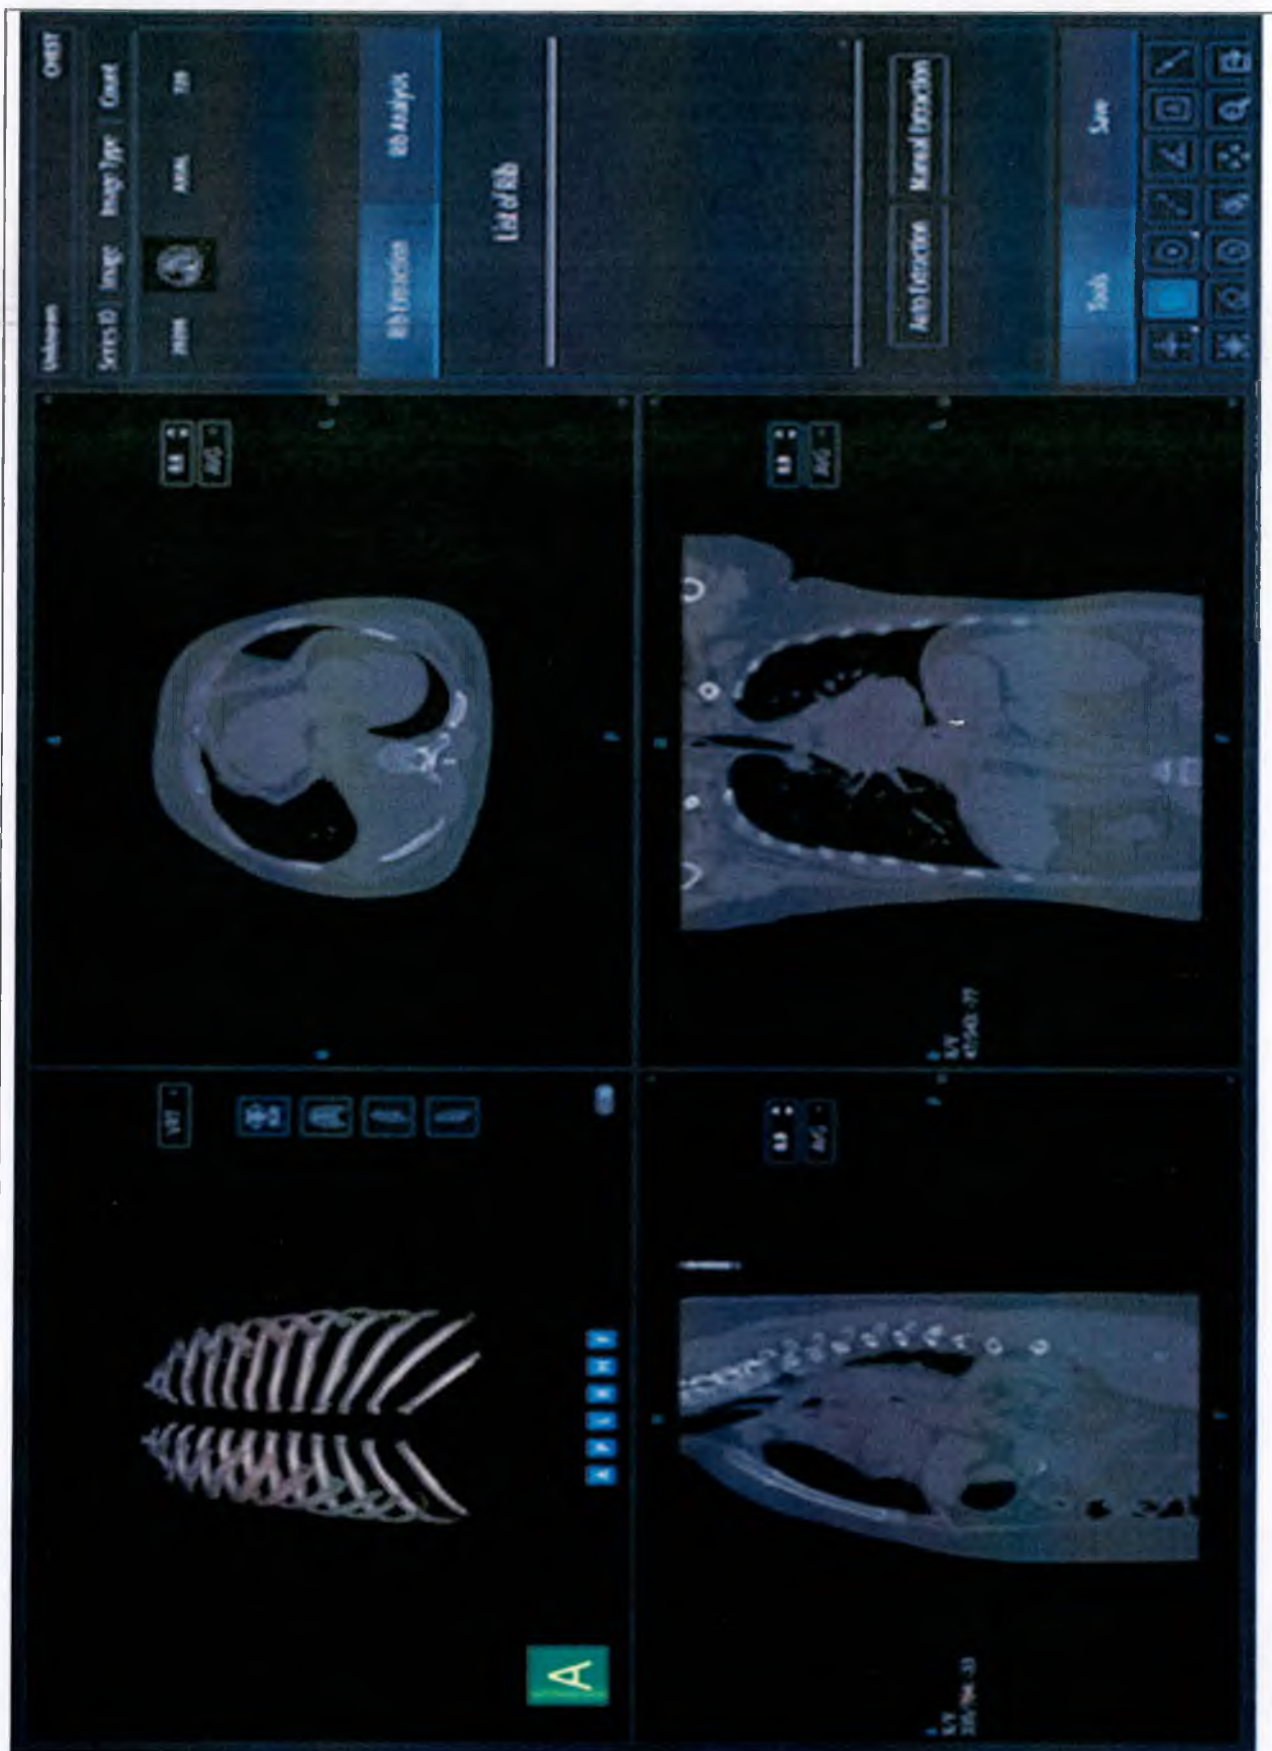

Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа ребер.

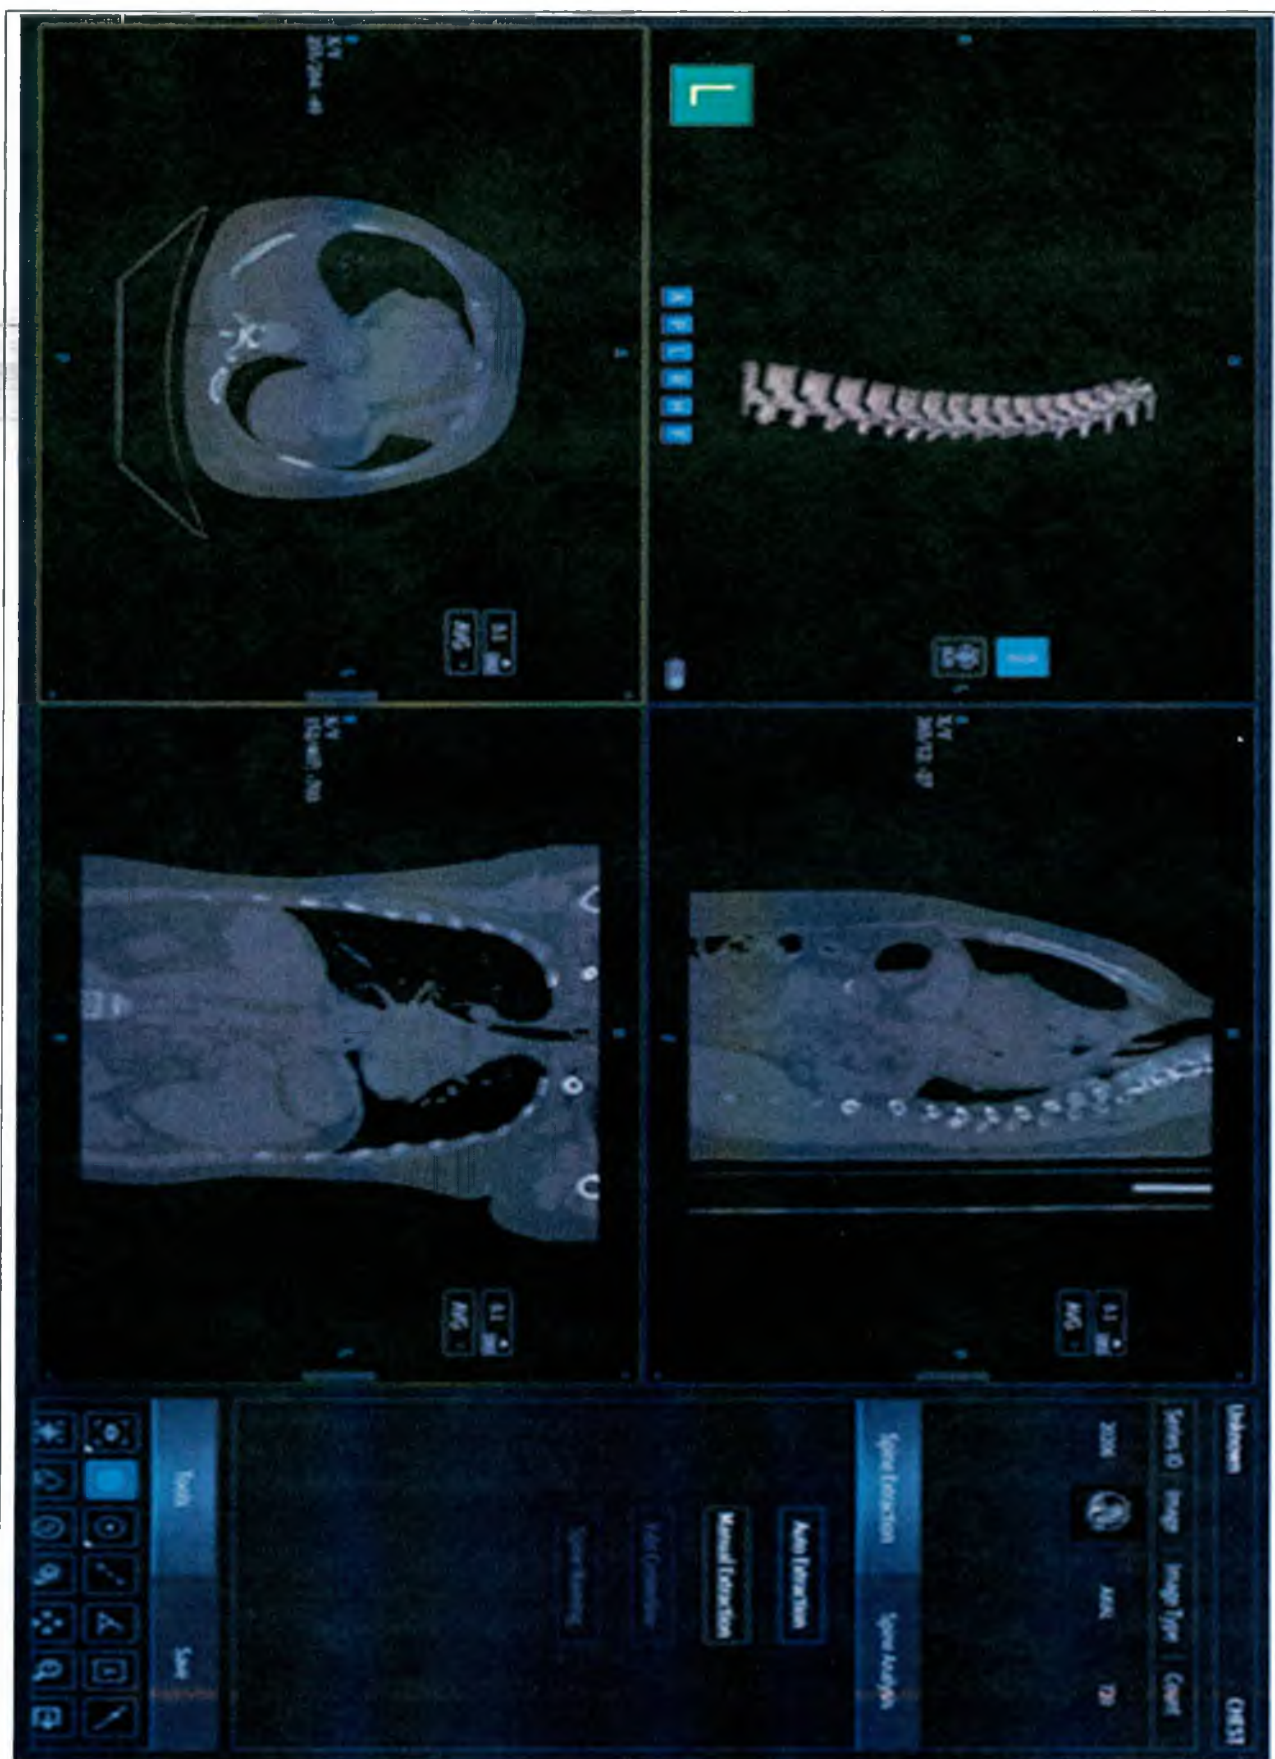

Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для визуализации позвоночника.



Фото внешнего вида упаковки составной части системы

Product Name: X-ray Computed Tomography System

Model:



MinFound Medical Systems Co., Ltd.




No.851, Yinhai Road, Xiasha Street, Qiantang District,
Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R. China



MedNet EC-REP C IIb GmbH

Borkstrasse 10 • 48163 Münster • Germany



Макет маркировки транспортной упаковки

MinFound

**X-ray Computed
Tomography System**

Model: ScintCare Blue 755

Input Voltage: 3N~ 380V/400V, 50/60Hz

Momentary power: 50KVA

Continuous power: 20KVA

X-ray output: 0-32KW



MinFound Medical Systems Co., Ltd.



No.851, Yinhai Road, Xiasha Street, Qiantang District,
Hangzhou City, 310018 Zhejiang, P.R. China



MedNet EC-REP C IIb GmbH

Borkstrasse 10 • 48163 Münster • Germany



Оригинальная маркировка (проект)

Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare Blue 755 с принадлежностями.

**Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare Blue
755 с принадлежностями**

Производитель: МинФаунд MinFound Medical
Медикал Системс Systems Co., Ltd
Ко., Лтд
Страна происхождения: Китай China

**Уполномоченный
представитель
производителя в РФ:** АО «Р-Фарм»
123154, Москва,
ул. Берзарина, д. 19, корп. 1,
тел. 8-495-956-79-37
факс: 8-495-956-79-38
e-mail: info@rpharm.ru

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Макет маркировки на русском языке
Система рентгеновской компьютерной томографии ScintCare Blue 755 с принадлежностями

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 62
документа листах

