СЕВЕРОК

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»

_____Мартовицкий Д.В.

«19» февраля 2024 г.

Сейф-холодильник медицинский СТЛ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ССТЛ. 78066655.001. РЭ

ТУ 9452-002-78066655-2015

Фарм-Сиб

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

Московская область, г. Талдом
2024

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п.	Наименование раздела	Стр.
1	Общие указания	3
2	Назначение и Устройство	4
3	Технические характеристики	5
4	Комплектность	5
5	Условия эксплуатации	5
6	Общий вид	6
7	Установка и ввод в эксплуатацию	9
8	Требования по технике безопасности	11
9	Маркировка и предупреждающие надписи	12
10	Упаковка	12
11	Порядок работы: открывание и закрывание двери	13
12	Порядок работы: установка и регулировка температуры	14
13	Требования по размещению объектов хранения	15
14	Уход и дезинфекция сейф-холодильника	16
15	Техническое обслуживание	17
16	Ремонт в условиях эксплуатации	17
17	Возможные неисправности и рекомендации по их устранению	18
18	Транспортирование и хранение	19
19	Утилизация	19
20	Перечень применяемых национальных стандартов	20
21	Гарантийные обязательства	20
22	Учет технического и гарантийного обслуживания	20

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1 • ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за выбор продукции компании ООО «Фарм-Сиб»!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством на
СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(далее сейф-холодильник).

- Сейф-холодильник должен вводится в эксплуатацию уполномоченными инженером
- Соблюдайте инструкции, в особенности, правила техники безопасности
- Храните руководство вместе с паспортом на изделие
- Данное руководство может применяться для всех моделей Сейфов-холодильников медицинских СТЛ
- Изготовитель имеет право внесения изменений в конструкцию, внешний вид, электрическую и гидравлическую схему сейф-холодильника, не ухудшающие его технические характеристики, без предварительного уведомления.

Условные обозначения:

ВНИМАНИЕ!	Предупреждение об опасности! Неосторожное обращение может привести к порче изделия
ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО!	Предупреждение об опасности! Неосторожное обращение может привести к тяжелым травмам

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ является медицинским изделием, предназначенным для использования медицинскими, фармацевтическими и другими специалистами для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа объектов хранения: лекарственных средств (в том числе наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий.

Предназначен для применения медицинским работником, мед. сестрой или уполномоченным сотрудником в лечебно-профилактических учреждениях, в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

Устройство сейфов-холодильников СТЛ	
Корпус	• многослойный, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому; • корпуса I, III, IV класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-2017; • внутренняя часть корпуса теплоизолирована
Дверь	многослойная, фиксируется в корпусе по всему периметру выдвижными ригелями, которые приводятся в действие ручкой на лицевой поверхности сейфа-холодильника
Замки	• один или два замка повышенной секретности; • фиксируют в закрытом состоянии механизм выдвижения ригелей
Принадлежность: анкерные болты	для надежной фиксации сейфа-холодильника к полу
Принадлежность: полки/метабоксы	• полки – для размещения объектов хранения; • метабоксы – для повышения вместимости объектов хранения и рационального использования камеры сейфа-холодильника
Холодильная система	располагается в верхней и/или в нижней части корпуса и имеет защитный кожух с отверстиями для циркуляции воздуха
Холодильная камера	облицована панелями из нержавеющей стали или пластиком
Охлаждение	осуществляется посредством работы встроенного холодильного агрегата
Циркуляция воздуха	в охлаждаемом объёме – принудительная
Поддержание температуры	Автоматическое, обеспечивается контроллером с цифровой индикацией и электронными температурными датчиками
Освещение	камера оборудована подсветкой
Доп. оснащение[1]	• устройство для опечатывания; • возможность подключения звуковой сигнализации; • датчик открывания двери; • счетчик циклов открывания двери; • поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией; • звуковая индикация открывания двери; • звуковая индикация падения напряжения

[1] Наличие доп. оснащения указывается в паспорте изделия.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3 • ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Диапазон поддержания температуры в холодильной камере, °С	от +2,0 до +18,0
Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм	по паспорту изделия
Масса, кг	
Объем холодильной камеры, дм^3(л)	
Потребляемая мощность, Вт	
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Питание от однофазной сети переменного тока • напряжением, В • частотой, Гц	 220±22 50
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА не более	65
Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, мес.	12
Срок службы, лет	10

4 • КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество, штук
1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ	1
2. Руководство по эксплуатации	1
3. Паспорт на изделие	1
4. Упаковка	1
5. Принадлежности:	
• анкерный болт М8, 120 мм	2
• ключи к механическим замкам сейфа	по паспорту изделия
• полки/метабоксы	по паспорту изделия

5 • УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Рабочий диапазон при температуре окружающего воздуха[1], °С	от +10 до +25
Относительная влажность воздуха при значениях температуры 25°С, %, не более	60
Атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

[1] Для стабильного поддержания температурного режима в холодильной камере сейфа-холодильника, задаваемая на контроллере температура не должна превышать значение температуры воздуха внешней среды.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

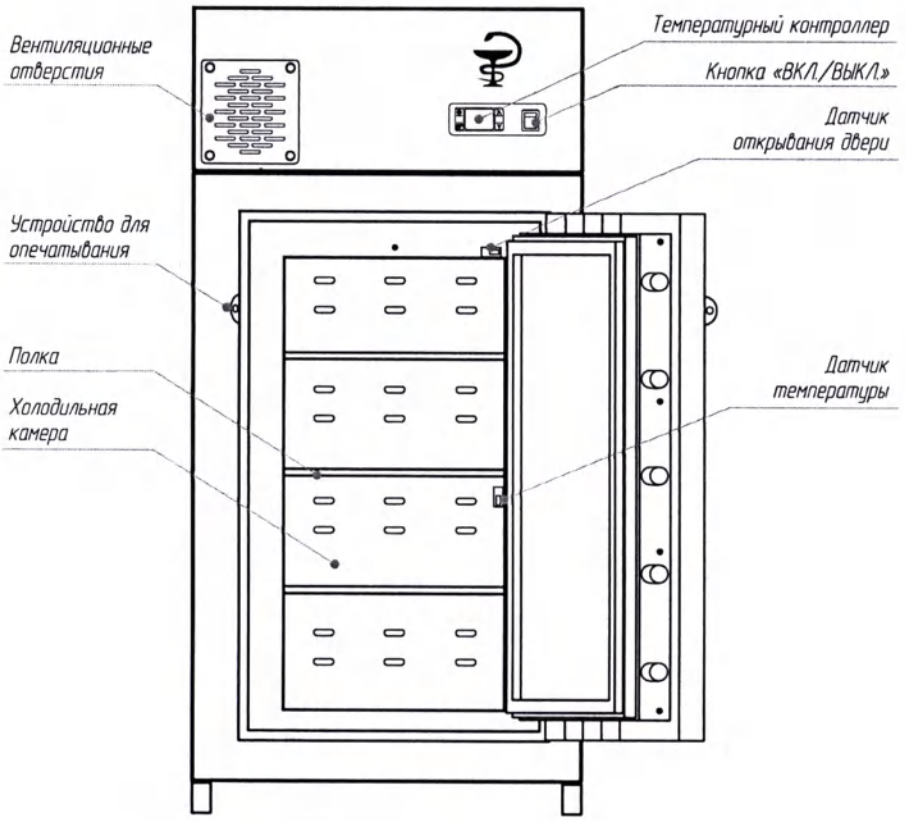

Рисунок 1. Общий вид сейф-холодильника СТЛ, лицевая сторона

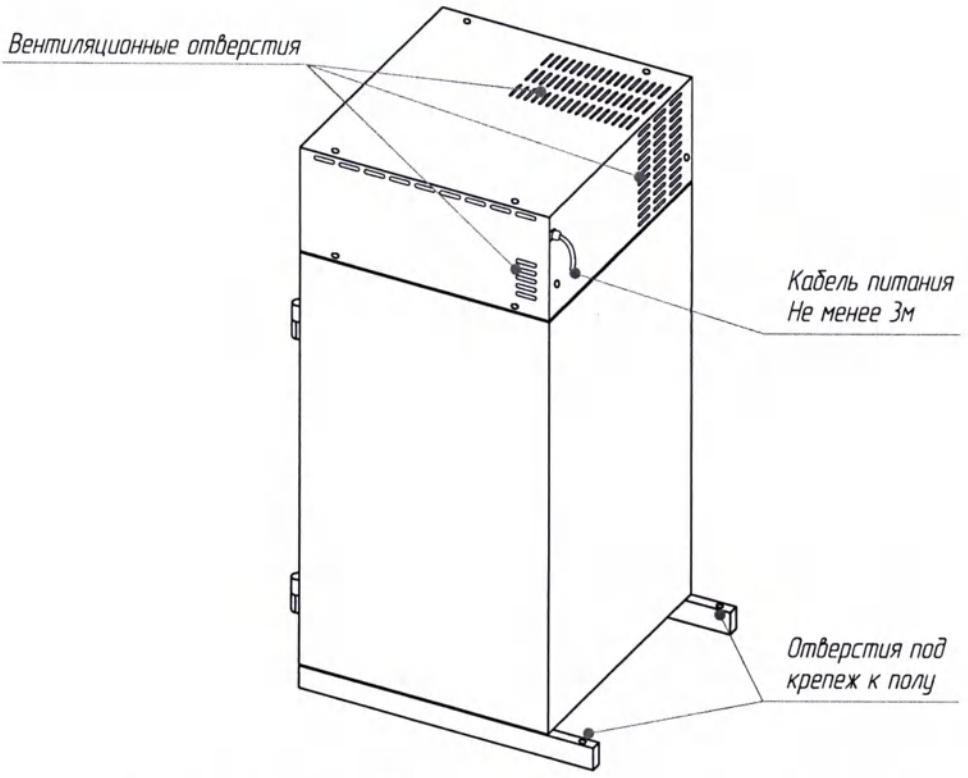

Рисунок 2. Общий вид сейф-холодильника СТЛ, тыльная сторона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

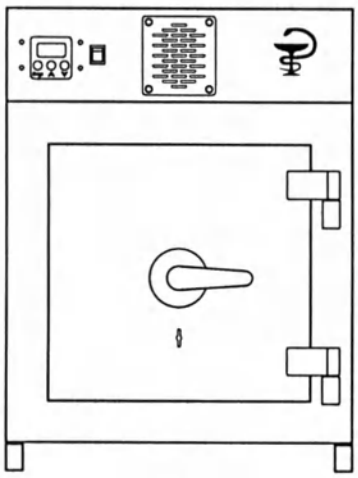

а)

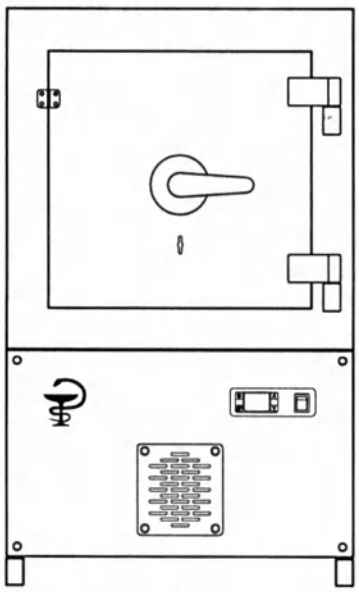

б)

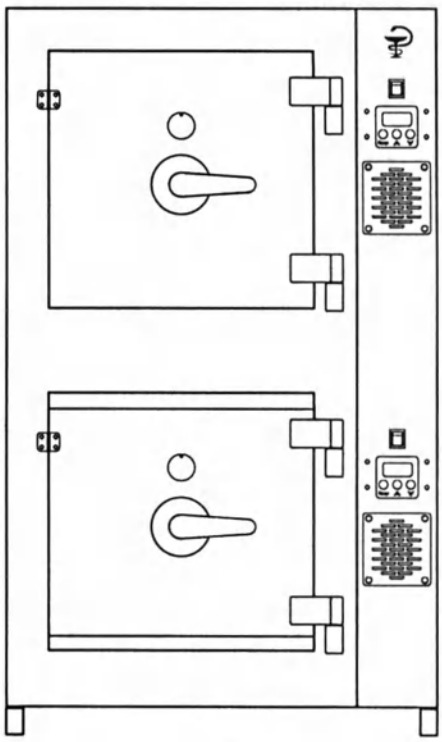

в)

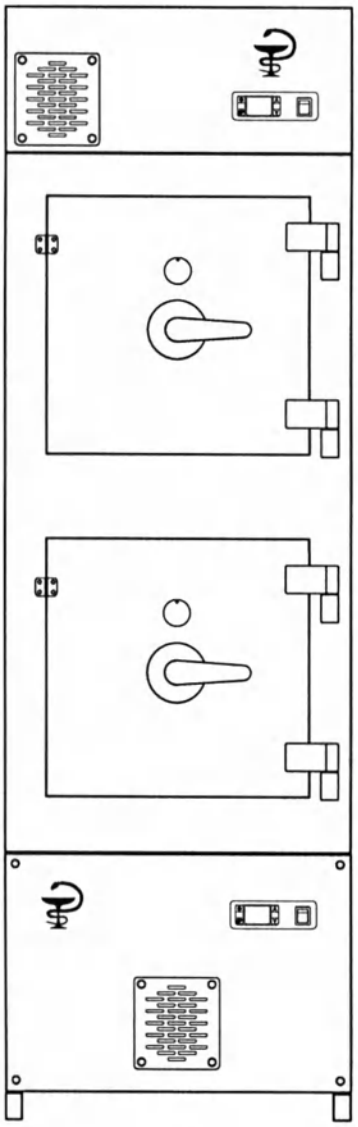

г)

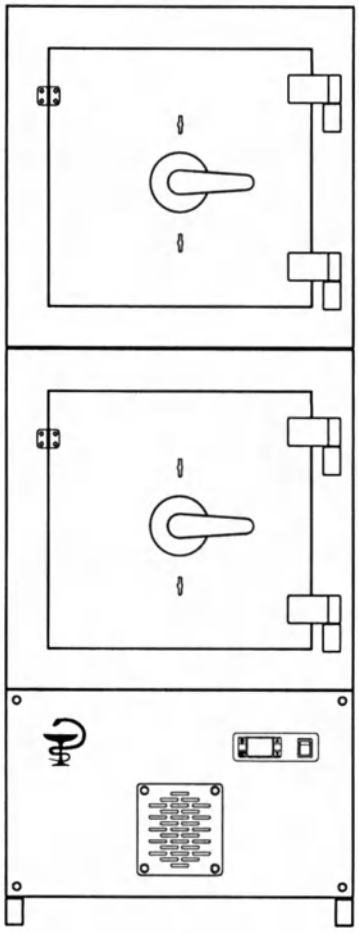

д)

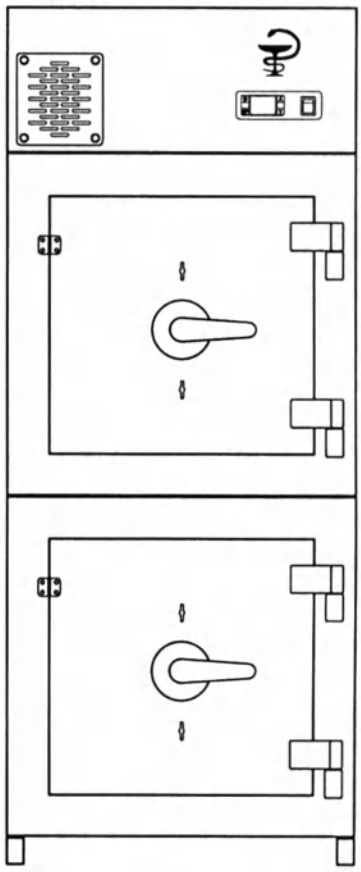

е)

Рисунок 3. Общий вид моделей сейф-холодильников СТЛ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

СЕЙФЫ-ХОЛОДИЛЬНИКИ СТЛ, ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

№ группы	Наименование группы и перечень исполнений
1	СТЛ I класса устойчивости к взлому компрессионные однокамерные: СТЛ-1101, СТЛ-1102, СТЛ-1103, СТЛ-1104, СТЛ-1105, СТЛ-1106, СТЛ-1107
2	СТЛ I класса устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные: СТЛ-1151, СТЛ-1152, СТЛ-1153, СТЛ-1154, СТЛ-1155, СТЛ-1156
3	СТЛ III класса устойчивости к взлому компрессионные однокамерные: СТЛ-3101, СТЛ-3102, СТЛ-3103, СТЛ-3104, СТЛ-3105, СТЛ-3106, СТЛ-3107, СТЛ-3108, СТЛ-3109, СТЛ-3110
4	СТЛ III класса устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные: СТЛ-3151, СТЛ-3152, СТЛ-3153, СТЛ-3154, СТЛ-3155
5	СТЛ IV класса устойчивости к взлому компрессионные однокамерные: СТЛ-4101, СТЛ-4102, СТЛ-4103, СТЛ-4104, СТЛ-4105, СТЛ-4106, СТЛ-4107, СТЛ-4108, СТЛ-4109, СТЛ-4110, СТЛ-4111, СТЛ-4112, СТЛ-4113
6	СТЛ IV класса устойчивости к взлому термоэлектрические однокамерные: СТЛ-4151, СТЛ-4152, СТЛ-4153, СТЛ-4154, СТЛ-4155
7	СТЛ I класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой: СТЛ-1201, СТЛ-1202, СТЛ-1203, СТЛ-1204
8	СТЛ I класса устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой: СТЛ-1251, СТЛ-1252, СТЛ-1253, СТЛ-1254, СТЛ-1255
9	СТЛ III класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой: СТЛ-3201, СТЛ-3202, СТЛ-3203, СТЛ-3204, СТЛ-3205
10	СТЛ III класса устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой: СТЛ-3251, СТЛ-3252, СТЛ-3253, СТЛ-3254
11	СТЛ IV класса устойчивости к взлому компрессионные двухкамерные с одной охлаждаемой камерой: СТЛ-4201, СТЛ-4202, СТЛ-4203, СТЛ-4204, СТЛ-4205, СТЛ-4206
12	СТЛ IV класса устойчивости к взлому термоэлектрические двухкамерные с одной охлаждаемой камерой: СТЛ-4251, СТЛ-4252, СТЛ-4253, СТЛ-4254

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

№ группы	Наименование группы и перечень исполнений
13	СТЛ I класса устойчивости к взлому Компрессионные Двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами: СТЛ-1221, СТЛ-1222, СТЛ-1223
14	СТЛ I класса устойчивости к взлому Термоэлектрические Двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами: СТЛ-1261, СТЛ-1262, СТЛ-1263
15	СТЛ III класса устойчивости к взлому Компрессионные Двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами: СТЛ-3221, СТЛ-3222, СТЛ-3223, СТЛ-3224
16	СТЛ III класса устойчивости к взлому Термоэлектрические Двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами: СТЛ-3261, СТЛ-3262, СТЛ-3263
17	СТЛ IV класса устойчивости к взлому Компрессионные Двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами: СТЛ-4221, СТЛ-4222, СТЛ-4223, СТЛ-4224, СТЛ-4225, СТЛ-4226, СТЛ-4227, СТЛ-4228
18	СТЛ IV класса устойчивости к взлому Термоэлектрические Двухкамерные с двумя охлаждаемыми камерами: СТЛ-4261, СТЛ-4262, СТЛ-4263

7 • УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Погрузочно-разгрузочные работы	Не допускается подвергать сейф-холодильник ударным нагрузкам. При проведении погрузочно-разгрузочных работ применять рохлы/тележки с учетом веса изделия. Для подъема между этажами рекомендовано использовать грузовой лифт.
Проверка упаковки	Внимательно проверить транспортную упаковку при получении сейф-холодильника. **При наличии повреждений, не вскрывать и обратиться к поставщику!**
Снятие упаковки **ВНИМАНИЕ!**	Осторожно вскрыть транспортную упаковку, не допуская толчков и ударов. Убедиться в комплектности сейф-холодильника. **Кантовать сейф-холодильник запрещается!**
Проверка изделия	Проверить отсутствие видимых повреждений. **При наличии повреждений корпуса, ключей, силового провода использованию не подлежит!**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Требования к месту установки ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО! ВНИМАНИЕ!	Перед установкой сейф-холодильника в место использования, убедитесь в соответствии допустимой нагрузки на межэтажное перекрытие. Запрещено устанавливать на деревянное покрытие. **Сейф-холодильник должен устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к розетке для включения/отключения от сети.** **Не устанавливать сейф-холодильник в помещениях с повышенной влажностью. Опасность поражения электрическим током.** **Во избежание риска поражения электрическим током сейф-холодильник должен присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.** При установке сейф-холодильника необходимо соблюсти допустимые зазоры для воздухообмена. Расстояние от задней стенки до стены должно составлять минимум 15 см. При установке двух сейф-холодильников рядом с другими холодильными устройствами, расстояние между ними должно быть минимум 30 см! **Не устанавливайте сейф-холодильник вблизи источников теплового излучения (газовых и электрических плит, батарей отопления, и т. п.)!** **Место установки сейф-холодильника не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей!**
Установка в место использования	Установите сейф-холодильник в место постоянного использования на ровную прочную поверхность и прикрепите к полу двумя анкерными болтами, входящими в комплект поставки, предварительно сделав разметку относительно крепежных отверстий. Сейф-холодильник следует эксплуатировать в электросети с УЗО, имеющим значения параметров не хуже: диапазон номинальных напряжений 220–240 В, переменный ток частотой 50 Гц, номинальная мощность нагрузки не менее 1,3 кВт, время срабатывания по току утечки до 3 мА – не более 1 сек.
Стабилизация температуры	Сейф-холодильник, находившийся на холоде, перед включением в электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 6 часов.
Первичная уборка	Тщательно протрите марлевой салфеткой, смоченной тёплой водой внутренние поверхности и принадлежности сейф-холодильника. Затем протрите сейф-холодильник насухо.
Подключение к сети питания	Подключите кабель питания сейф-холодильника к однофазной электрической сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, снабжённой автоматической системой защиты от токов короткого замыкания многократного действия с заземлением (максимальный ток нагрузки не более 6А).
Выход на рабочий режим	Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть составляет не более 60 мин и зависит от модели.
Мониторинг рабочего режима	В сейф-холодильник должны обязательно закладываться дублирующие автономные термометры, термоиндикаторы или терморегистраторы, которые являются средствами измерения (СИ) в соответствии с требованиями разделов главы XLVIII «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических препаратов. Требования к оборудованию для хранения ИЛП». СанПиН 3.3686-21 Так же сейф-холодильник может быть оборудован встроенным датчиком контроля температуры, который так же должен быть СИ в соответствии с ГОСТ Р 57266-2016.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8 • ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ в соответствии с ГОСТ Р 31508-2012 относится к 1 классу потенциального риска применения.

Степень защиты от поражения электрическим током выполнена по классу 1.

Запрещается эксплуатация сейф-холодильника в условиях с повышенной опасностью, характеризующихся химически активной средой, в котором постоянно или длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию и токопроводящие части электрооборудования.

Сейф-холодильник следует эксплуатировать в электросети с УЗО, имеющим значения параметров не хуже: диапазон номинальных напряжений 220–240 В, переменный ток частотой 50 Гц, номинальная мощность нагрузки не менее 1,3 кВт, время срабатывания по току утечки до 3 мА – не более 1 сек.

ВНИМАНИЕ! ОСТОРОЖНО!

Во избежание риска поражения электрическим током сейф-холодильник должен присоединяться только к сетевому питанию, имеющему защитное заземление.

После включения сейф-холодильника в сеть запрещается прикасаться одновременно к корпусу и к устройствам, имеющим естественное заземление (газопроводная плита, радиатор отопления, водопроводный кран и др.).

ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте вентиляционные отверстия (см. рисунок 1 и 2) для циркуляции воздуха в верхней части сейф-холодильника! Это может стать причиной выхода из строя сейф-холодильника.

Не допускается разбирать и нарушать конструкцию сейф-холодильника во время его работы!

Отключайте сейф-холодильник от электрической сети вовремя:

- уборки внутри холодильной камеры и наружных поверхностей;
- устранения любых неисправностей.

Сейф-холодильник предназначен для использования в базовой электромагнитной обстановке. Электромагнитная совместимость (ЭМС) обеспечивается выполнением требований ГОСТ МЭК 61326-1-2014:

ВНИМАНИЕ!

- **Сейфы-холодильники требуют применения специальных мер для обеспечения ЭМС и должны быть установлены и введены в эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС.**
- **Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на СХ.**
- **Использование принадлежностей, преобразователей и кабелей, не указанных в перечне, за исключением преобразователей и кабелей, поставляемых изготовителем сейф-холодильника в качестве сменных частей для внутренних деталей, может привести к увеличению электромагнитной эмиссии или снижению помехоустойчивости сейф-холодильника.**

ВНИМАНИЕ!

При нарушении правил эксплуатации, указанных в данном руководстве, возможно ухудшение защиты при работе сейф-холодильника.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9 • МАРКИРОВКА И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ

На передней панели сейфа-холодильника нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и его наименование.

На тыльной панели сейфа-холодильника нанесены: наименование предприятия-изготовителя; обозначение технических условий; наименование исполнения сейфа-холодильника; индивидуальный серийный номер; класс устойчивости к взлому; номинальное напряжение сети; номинальная частота питающей сети; потребляемая мощность при номинальном режиме работы; обозначение степени защиты, обеспечиваемой оболочкой по ГОСТ 14254-2015; масса сейфа-холодильника; химическое название или номер хладагента, общая масса хладагента (для компрессионной холодильной системы); год и месяц выпуска; наименование страны изготовления; предупредительная надпись: «Ремонтные работы проводить, предварительно отключив от электропитания».

Маркировка выполнена способом, обеспечивающим устойчивость надписей к воздействующим факторам внешней среды в процессе эксплуатации.

На каждом ящике для транспортирования наклеен ярлык, выполненный печатным способом. На ярлыке указаны: наименование изготовителя и (или) его товарный знак; обозначение технических условий; наименование исполнения сейфа-холодильника; год и месяц упаковывания; наименование страны изготовления.

На ящике для транспортирования нанесены по трафарету или штемпелеванием черной водостойкой краской информационные надписи и манипуляционные знаки:

	– «Верх»		– «Хрупкое. Осторожно»
	– «Беречь от влаги»		– «Штабелировать запрещается»

10 • УПАКОВКА

Эксплуатационные и товаросопроводительные документы вкладываются в пакет из полиэтиленовой пленки.

Ключи и болты анкерные упакованы в бумагу и закреплены на сейф-холодильнике.

Сейф-холодильник упакован в вспененный полиэтилен и оборачивается пленкой полиэтиленовой. Транспортируется в дощатом ящике с обшивкой из фанеры.

Положение сейфа-холодильника в транспортном ящике фиксируется с помощью метизов.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Дверь сейф-холодильника оборудована ригельным запирающим механизмом и ключевыми сувальдными замками.

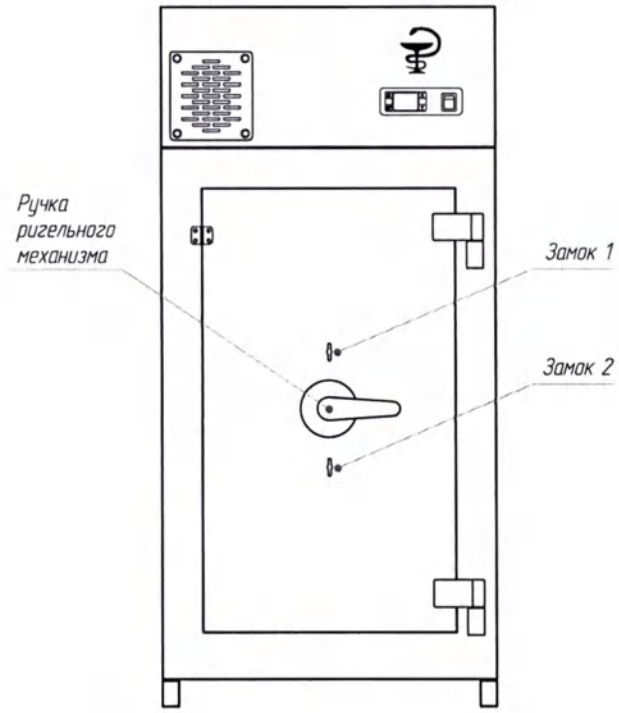

Рисунок 4. Общий вид расположения замков и ручки ригельного механизма для сейф-холодильника с двумя замками.

для ОТКРЫВАНИЯ сейфа-холодильника (с двумя замками):

1) вставьте оба ключа в замки. Номер замка должен соответствовать номеру ключа;
2) без усилий поверните ключи по часовой стрелке до упора (примерно на 160°);
3) поверните ручку ригельного механизма по часовой стрелке до упора;
4) откройте дверь, потянув ручку ригельного механизма на себя.

ВНИМАНИЕ!

**Не вытаскивать ключи при открытых замках!
Это может повести к поломке ключей!**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

для ЗАКРЫВАНИЯ сейфа-холодильника (с двумя замками):

1) закройте дверь и поверните ручку ригельного механизма против часовой стрелки до упора;
2) потяните ручку на себя и убедитесь, что дверь не открывается;
3) без усилий поверните оба ключа в замках против часовой стрелки до упора (примерно на 160°);
4) вынуть ключ. Дверь заперта!

ВНИМАНИЕ!

На замке установлена защита от выбивания, не допускайте ударов по ключу! Не роняйте ключи на пол!

- Дверь сейфа-холодильника весьма массивная – во избежание травм не допускайте попадания пальцев в зону прихлопа во время закрывания!
- В комплект поставки сейф-холодильника входит комплект ключей на каждый замок. По соображениям безопасности запасные ключи могут быть изготовлены только после предъявления подлинного ключа. Это предписание издано, чтобы исключить возможность заказа ключа неуполномоченным лицом при помощи номера ключа.
- Видимые на ключе цифры не являются номером ключа, а обозначают его идентификационный номер для внутризаводского производства. На основании этого номера запасной ключ изготовить невозможно.
- Храните свои ключи внимательно и аккуратно – при их утере сейф-холодильник придется открывать силой, что связано с большими затруднениями.
- Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за утерю ключей и возможные неполадки в функционировании замков, возникающих из-за применения избыточной силы или ненадлежащего обращения.

12 • ПОРЯДОК РАБОТЫ: УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Управление и автоматическое поддержание температуры внутри сейф-холодильника обеспечивается электронным температурным контроллером с двумя датчиками.

Заводская настройка температуры в охлаждаемом объёме холодильной камеры установлена на + 4,0 °С.

Заводская установка обеспечивает динамическое поддержание температуры в холодильной камере в диапазоне от +2,0 °С до +8,0 °С.

для УСТАНОВКИ в холодильной камере ДРУГОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

- нажмите на контроллере кнопку «SET» и удерживайте ее в течение 1-2 секунд. На дисплее контроллера появится мигающее значение установленного Изготовителем значения температуры;
- затем нажатием кнопки ВВЕРХ (▲) и ВНИЗ (▼) на контроллере выставите необходимую температуру;
- для сохранения нового заданного значения температуры нажмите кнопку «SET» и удерживайте ее в течение 1–2 секунд. Новая установленная температура будет отображаться на дисплее контроллера.

В случае возникновения каких-либо нарушений в работе сейф-холодильника на дисплее контроллера будут отображаться предупреждающие сигналы. Их перечень, значения и способы устранения приведены в разделе: «ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термолабильные лекарственные средства, вещества и препараты, и т. п., имеющие строго определённые температурные условия хранения, предназначенные для хранения в сейф-холодильнике, должны иметь герметичную упаковку или должны быть упакованы таким образом, чтобы исключить непосредственный контакт с внутренней облицовкой сейф-холодильника.

Расстояние между стенками холодильной камеры и лекарственными средствами, расположенными на полках или метабоксах, должно составлять не менее 3 см.

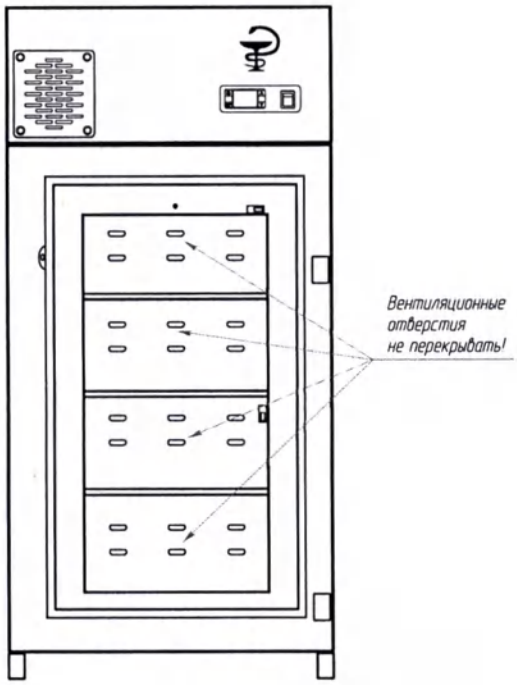

Рисунок 5. Расположение вентиляционных отверстий (каналов).

ВНИМАНИЕ!

При загрузке лекарственных средств в холодильную камеру сейф-холодильника не допускается закрытие вентиляционных каналов, расположенных в задней части холодильной камеры!

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

14 • УХОД И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

Для уборки и обслуживания сейф-холодильника его необходимо отключить от электрической сети и убрать лекарственные средства из холодильной камеры.

Очистка поверхностей холодильной камеры и наружных поверхностей сейф-холодильника проводиться протиранием мягкой влажной салфеткой без использования абразивных чистящих средств. Салфетка должна быть отжата.

Дезинфекция проводится двухкратным протиранием поверхностей холодильной камеры и наружных поверхностей сейф-холодильника антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом.

После очистки и дезинфекции поверхности холодильной камеры, полок или метабоксов, наружные поверхности сейфа-холодильника протереть сухой мягкой салфеткой.

В целях обеспечения работоспособности и безопасности сейф-холодильника строго соблюдайте следующие требования:

При очистке и дезинфекции сейф-холодильника нельзя применять какие-либо абразивные порошки, пасты, щелочные и кислотные растворы!

! В процессе эксплуатации или чистки сейф-холодильника не допускайте попадания внутрь влаги.

1) при случайном попадании влаги в зону вентиляционных отверстий немедленно отключить сейф-холодильник от электросети, вынув штепсельную вилку из розетки;
2) соберите влагу мягкой салфеткой;
3) дать возможность влажным поверхностям высохнуть.

ВКЛЮЧАТЬ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК В ЭЛЕКТРОСЕТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ВЛАГИ!

! В процессе эксплуатации или уборки помещения, не допускайте попадания влаги на компрессор, пускозащитное реле, электропроводку и другие токоведущие элементы, расположенные в зоне вентиляционных отверстий.

1) при случайном попадании влаги на указанные выше части, немедленно отключите сейф-холодильник от электросети, вынув штепсельную вилку из розетки;
2) соберите влагу мягкой салфеткой;
3) дайте возможность увлажнённым поверхностям окончательно высохнуть.

ВКЛЮЧАТЬ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК В ЭЛЕКТРОСЕТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ ВЛАГИ!

! Не реже 2-х раз в год очищайте от грязи и пыли с помощью пылесоса с сухой мягкой щеткой зону вентиляционных отверстий.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА В ЗОНЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ОТВЕРТИЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

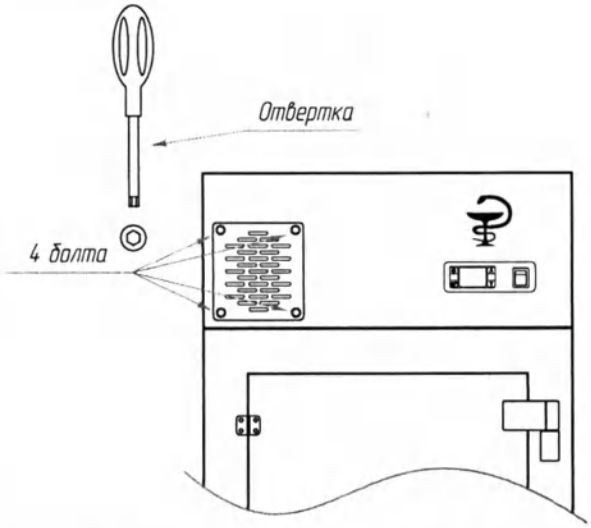

Рисунок 6. Очистка отверстий вентиляционной решетки.

1) с помощью отвертки открутить 4 болта и снять переднюю решетку, как показано на рисунке;
2) очистить пылесосом с мягкой щеткой зону вентиляционного отверстия;
3) установить решетку на место и зафиксировать ее 4 болтами

15 • ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед началом технического обслуживания отключить сейф-холодильник от электрической сети.

Технический осмотр сейф-холодильника производится уполномоченными сотрудниками потребителя не реже 2 раз в год и включает в себя оценку работоспособности, осмотр целостности сейф-холодильника, очистку конденсатора пылесосом.

В случае обнаружения в процессе эксплуатации сейф-холодильника неисправностей необходимо обратиться к Изготовителю или в уполномоченный региональный сервисный центр.

16 • РЕМОНТ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ремонт сейф-холодильника в течение гарантийного срока производится сервисной службой ООО «Фарм-Сиб» или уполномоченными региональными сервисными центрами www.termoseif.ru.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Сейф-холодильник, включенный в электросеть, не работает (не светится экран контроллера)	Нет напряжения в электросети.	Проверьте наличие напряжения в розетке электросети
	Вилка питания не подключена к электрической розетке или нет контакта штепсельной вилки с розеткой.	Подключите штепсельную вилку к электрической розетке. Обеспечьте контакт штепсельной вилки с розеткой.
Сейф-холодильник, включенный в электросеть, не работает (при этом экран контроллера светится)	Не работает компрессор.	Обратитесь в сервисную службу.
Сейф-холодильник часто включается и выключается или работает непрерывно в течение слишком длительного периода времени.	Внутри или снаружи слишком высокая температура.	Увеличьте время на стабилизацию температуры в камере
	Сейф-холодильник работал в течение длительного периода времени и не вышел на рабочий режим.	Незагруженный сейф-холодильник выдержать во включенном состоянии в течение 60 мин до достижения заданного режима.
		При загрузке в сейф-холодильник препаратов комнатной температуры с большой теплоемкостью для их полного охлаждения может потребоваться от 8 до 24 часов.
	Дверь слишком часто открывалась или была открыта в течение длительного времени.	Не открывайте дверь слишком часто. Дождитесь пока в закрытом сейф-холодильнике стабилизируется температура.
	Установлена слишком низкая температура.	Установите более высокую температуру, пока не будет достигнута удовлетворительная температура холодильной камеры.
	Уплотнитель двери загрязнён, изношен или порван.	Вымойте уплотнитель двери или замените его обратившись в сервисную службу.
	Не обеспечивается необходимая циркуляция.	Обеспечьте достаточную вентиляцию воздуха. Для правильной циркуляции воздушного потока внутри холодильной камеры и поддержания температуры в заданном диапазоне расстояние между стенками холодильной камеры и лекарственными средствами, расположенными на полках, должно составлять не менее 3 см. **ВНИМАНИЕ! При загрузке лекарственных средств в холодильную камеру сейф-холодильника не допускается закрытие вентиляционных каналов, расположенных в задней части холодильной камеры!**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Повышенный шум при работе сейф-холодильника	Сейф-холодильник неправильно установлен.	Установите сейф-холодильник в соответствие с настоящим Руководством по эксплуатации.
Появление постороннего запаха в сейф-холодильнике	Нерегулярная или недостаточно тщательная уборка холодильной камеры. Отключенный сейф-холодильник длительное время находился при плотно закрытой двери.	Проведите дополнительную тщательную уборку с дезинфекцией холодильной камеры и проветрите ее в течение 3–4 часов.
Не удается открыть сейфовые замки.	Неисправность механизмов замков.	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее контроллера мигает или постоянно горит символ «E0»	Неисправность управляющего температурного датчика.	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее контроллера мигает символ «E1»	Неисправность датчика испарителя.	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее контроллера мигает символ звуковой сигнализации и появляется звуковой сигнал через 2 мин	Открыта или неплотно закрыта дверь сейф-холодильника.	Проверьте и закройте дверь сейф-холодильника.
	Неисправность датчика открытия двери	Обратитесь в сервисную службу.
На дисплее контроллера мигают другие неописанные символы	Неисправность электрических или электронных компонентов	Обратитесь в сервисную службу.

18 • ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование сейф-холодильника производится любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
- Транспортирование сейф-холодильника допускается только в вертикальном положении с учетом маркировки «Верх» в таре, обеспечивающей проведение механизированных погрузочно-разгрузочных работ.
- Во время транспортирования и хранения сейф-холодильник должен быть защищен от влаги.
- Транспортирование и хранение допускается только в один ярус.
- Во время транспортирования и перемещения сейф-холодильник не кантовать.
- Транспортирование и хранение сейф-холодильника осуществляется при температуре от +5 °C до +40 °C.

19 • УТИЛИЗАЦИЯ

Сейфы-холодильники СТЛ относятся к отходам класса А, в соответствии с классификацией СанПиН 2.1.3684-21 и по составу приближены к ТКО. Бывшие в употреблении сейфы-холодильники после окончания срока службы должны быть утилизированы в соответствии с действующими на момент утилизации государственными правилами и нормами.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

20 • ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

1. Технические условия ТУ 9452-002-78066655-2015 «Сейфы-холодильники медицинские СТЛ».

2. ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования.

3. ГОСТ 31508-2012 Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования.

4. ГОСТ Р 50862-2017 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому».

5. ГОСТ IEC 61010-1-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования.

6. ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования.

7. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

21 • ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие сейф-холодильника техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения сейф-холодильника – 12 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации сейф-холодильника – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

В случае выхода из строя сейф-холодильника в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования Изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт.

Гарантия Изготовителя не распространяется в случае:

- нарушения правил установки, ухода и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- нарушения правил транспортирования и хранения;
- ремонта неуполномоченными лицами;

Изготовитель не несёт ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший при выходе сейф-холодильника из строя. В случае неисправности сейф-холодильника владелец самостоятельно обеспечивает сохранность товара.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Фарм-Сиб», ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Замечания, предложения, пожелания по качеству сейф-холодильника СТЛ, запросы на дополнительную информацию по использованию можно направлять по электронной почте **main@farmsib.ru** или по тел. +7 (495) 221-67-40 доб.140. Адрес в сети интернет: **https://termoseif.ru**

22 • УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО И ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Характер работ	Исполнитель (организация, должность, фамилия, подпись, печать)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 20 (двадцати) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1101)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1101.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1101 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1101 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	905x 450 x 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	120
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	10
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1101 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1102)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1102.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1102 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1102 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм	905х 450 х 395
Масса, кг	120
Внутренний объем камеры, л	12
Потребляемая мощность, Вт	110
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1102 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открывания двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1103)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1103.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1103 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1103 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1076х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	120
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1103 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	Индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (два) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1104)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1104.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1104 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1104 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1316х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	130
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	30
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1104 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1105)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1105.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1105 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1105 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1560х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	140
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	40
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1105 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1106)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1106.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1106 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1106 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1150x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	140
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	50
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1106 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 3/5 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1107)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1107.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1107 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1107 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1378х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	150
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	70
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1107 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 5/7 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1151)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1151.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1151 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1151 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	730х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	100
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1151 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1152)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1152.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1152 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1152 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	730х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	100
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	10
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1152 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	ация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).
2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

   В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.
3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.
4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.
5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.
6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.
2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.
3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.
4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1153)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1153.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1153 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1153 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	730х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	100
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	12
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1153 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1154)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1154.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1154 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1154 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	905х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	120
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1154 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1155)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1155.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1155 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1155 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	867x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	130
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1155 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1156)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1156.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1156 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1156 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	937х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	130
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	30
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1156 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1201)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1201.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1201 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1201 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1385х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	150
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	13,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ±20%	30,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1201 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	[illegible]ция падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1202)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1202.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1202 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1202 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1385х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	150
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	13,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ±20%	40,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1202 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — нет/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — нет/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1203)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1203.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1203 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1203 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1435х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	170
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	56,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1203 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
[illegible]	[illegible]ция падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (два) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1204)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1204.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1204 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1204 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1670х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	55
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1204 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2камера) — 2/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2камера) — 5/3 ШТ.

4. *ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ*

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1221)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1221.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1221 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1221 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1626х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	13,2
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	13,2
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1221 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры [illegible] цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней и верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1222)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1222.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1222 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1222 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1676х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,2
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,2
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1222 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней и верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1223)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1223.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1223 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1223 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1632х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32,4
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32,4
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1223 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней и верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1251)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1251.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1251 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1251 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1210х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	160
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	13,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	30,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1251 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — нет/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	ция падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1252)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1252.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1252 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1252 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1210х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	160
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	13,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	40,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1252 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — нет/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1253)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1253.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1253 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1253 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1315х 450 х 395
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	160
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	13,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	50,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1253 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — нет/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1254)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1254.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1254 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1254 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1170х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	16,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	58
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1254 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1255)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1255.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1255 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1255 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1330x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	26,8
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	58
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1255 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 2/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 4/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	[illegible] ия падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1261)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1261.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1261 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1261 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1080х 650 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,8
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1261 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры [illegible] с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1262)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1262.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1262 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1262 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1080х 740 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	280
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25,7
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25,7
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1262 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры [illegible] цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-1263)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.1263.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1263 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1263 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1180х 740 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	300
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35,3
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35,3
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	240
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	I класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-1263 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 3/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры [illegible] с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замком.

В закрытом состоянии замок сейф-холодильника блокирует механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3101)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3101.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3101 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3101 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	950x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	140
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	10
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3101 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	[illegible]зация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (Два) листах

Директор ООО «ФармСиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3102)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3102.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3102 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3102 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм	950х 510 х 510
Масса, кг	170
Внутренний объем камеры, л	18
Потребляемая мощность, Вт	130
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3102 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическому замку сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открывания двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
[illegible]	ция падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3103)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3103.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3103 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3103 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1170х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	180
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	30
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3103 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3104)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3104.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3104 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3104 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1340х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	40
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3104 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 3/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (два) листах

Директор ООО «Фарм Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3105)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3105.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3105 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3105 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1560х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	220
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	50
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3105 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 4/5 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3106)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3106.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3106 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3106 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1085х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	240
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	60
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3106 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/5 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3107)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3107.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3107 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3107 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1265х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	260
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	80
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3107 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 3/7 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	ация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «ФармСиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3108)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3108.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3108 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3108 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1655х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	350
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	120
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3108 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 5/10 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3109)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3109.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3109 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3109 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1545х 850 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	400
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	180
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3109 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 4/9 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3110)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3110.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3110 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3110 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1885x 850 x 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	500
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	240
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3110 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 6/12 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	[illegible]ция падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3151)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3151.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3151 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3151 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	900х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	150
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	15
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3151 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3152)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3152.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3152 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3152 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	900х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	170
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3152 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	я падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3153)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3153.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3153 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3153 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	900x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	180
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	28
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3153 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (два) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3154)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3154.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3154 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3154 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1012х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3154 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3155)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3155.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3155 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3155 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1087x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	40
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3155 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3201)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3201.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3201 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3201 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1435х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	31,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3201 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 2/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 3/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3202)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3202.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3202 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3202 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1435х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	41,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3202 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 2/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 3/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3203)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3203.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3203 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3203 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1435х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,2
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	56,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3203	1 ШТ.
2.	Руководство по эксплуатации	1 ШТ.
3.	Паспорт на изделие	1 ШТ.
4.	Упаковка	1 ШТ.
5.	Принадлежности:	1 ШТ.
	- анкерный болт М8, 120 мм	2 ШТ.
	- комплект ключей к механическим замкам сейфа	2 ШТ.
	- полки (1 камера /2 камера)	4/1 ШТ.
	- метабоксы (1 камера /2 камера)	4/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3204)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3204.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3204 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3204 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1645х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	300
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	30
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	56
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3204 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 4/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 4/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3205)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3205.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3205 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3205 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1835x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	300
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	40
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	56
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3205 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 4/3 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 4/6 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (Два) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3221)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3221.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3221 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3221 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1635х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	350
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3221 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки/ — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3222)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3222.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3222 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3222 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1635х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	350
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3222 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	[illegible]ия падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3223)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3223.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3223 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3223 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1635х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	350
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32,5
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32,5
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3223 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 2/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 3/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	[illegible]кация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3224)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3224.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3224 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3224 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1850х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32,5
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	53,5
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3224	1 ШТ.
2.	Руководство по эксплуатации	1 ШТ.
3.	Паспорт на изделие	1 ШТ.
4.	Упаковка	1 ШТ.
5.	Принадлежности:	1 ШТ.
	- анкерный болт М8, 120 мм	2 ШТ.
	- комплект ключей к механическим замкам сейфа	2 ШТ.
	- полки (1 камера/ 2 камера)	2/4 ШТ.
	- метабоксы (1 камера/ 2 камера)	3/5 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3251)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3251.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3251 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3251 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1170х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	16
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	34
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3251 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3252)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3252.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3252 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3252 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1170x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	16
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	54
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3252 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки — 1/3 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3253)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3253.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3253 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3253 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1375х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	260
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	16
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	84
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3253 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/4 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/5 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	[illegible]ация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3254)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3254.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3254 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3254 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1595х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	280
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	16
Внутренний объем неохлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	114
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3254	1 ШТ.
2.	Руководство по эксплуатации	1 ШТ.
3.	Паспорт на изделие	1 ШТ.
4.	Упаковка	1 ШТ.
5.	Принадлежности:	1 ШТ.
	- анкерный болт М8, 120 мм	2 ШТ.
	- комплект ключей к механическим замкам сейфа	2 ШТ.
	- полки	1/5 ШТ.
	- метабоксы (1 камера/ 2 камера)	2/7 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3261)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3261.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3261 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3261 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1080х 650 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	400
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,8
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3261 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	я падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (Два) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3262)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3262.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3262 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3262 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1080x 740 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25,7
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25,7
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3262 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
[illegible]	[illegible] падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (Два) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-3263)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.3263.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3263 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3263 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1180х 740 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35,5
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35,3
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	240
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	III класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-3263 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 3/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 1 (одна) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4101)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4101.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4101 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4101 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1075х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	15
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4101 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4102)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4102.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4102 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4102 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1075x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	220
Внутренний объем охлажаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4102 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4103)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4103.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4103 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4103 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1075х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	220
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4103 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
[illegible]	[illegible] падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4104)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4104.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4104 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4104 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1075х 510 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	220
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	30
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4104 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4105)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4105.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4105 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4105 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	930x 600 x 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	40
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4105 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах.

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4106)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4106.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4106 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4106 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	930x 600 x 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	45
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4106 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4107)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4107.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4107 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4107 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	980х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	260
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	50
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4107 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 3/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4108)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4108.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4108 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4108 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1065х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	260
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	60
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4108 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 3/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. СТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На ___2___(___двух___) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4109)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4109.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4109 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4109 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1175х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	260
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	70
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4109 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 3/5 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
[illegible]	[illegible] падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4110)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4110.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4110 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4110 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1355x 600 x 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	280
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	90
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4110 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 4/7 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4111)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4111.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4111 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4111 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1670х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	330
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	120
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4111 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 5/9 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры [illegible] цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4112)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4112.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4112 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4112 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1475 x 850 x 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	400
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	170
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4112 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 4/7 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4113)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4113.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4113 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4113 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1885 x 850 x 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	240
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	250
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4113 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 6/11 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4151)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4151.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4151 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4151 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	900 x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	200
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	15
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4151 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки — 1 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4152)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4152.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4152 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4152 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	900 x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	220
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4152 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 1/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
[illegible]	[illegible] падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4153)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4153.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4153 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4153 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	900 x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	220
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	28
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4153 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4154)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4154.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4154 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4154 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1087 x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	240
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	40
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4154 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 3/5 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4155)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4155.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4155 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4155 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1220 x 510 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	250
Внутренний объем охлаждаемой камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	52
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4155 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 1 ШТ.
   - полки/метабоксы — 3/6 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (два) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4201)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4201.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4201 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4201 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1277х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	280
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4201 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/ 2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/ 2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры фровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4202)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4202.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4202 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4202 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1277х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	280
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	50
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4202 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры [illegible] цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4203)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4203.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4203 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4203 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1277х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	330
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	82
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4203 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4204)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4204.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4204 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4204 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1460х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	350
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	118
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4204 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4205)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4205.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4205 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4205 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1610х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	380
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	148
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4205 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/5 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4206)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4206.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4206 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4206 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1810х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	500
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	186
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4206 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/4 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/7 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4221)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4221.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4221 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4221 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1632х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4221 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры [illegible] фровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4222)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4222.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4222 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4222 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1632х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4222 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Дверь сейф-холодильника фиксируется к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудована замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4223)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4223.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4223 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4223 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1632х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32,5
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32,5
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4223 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4224)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4224.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4224 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4224 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1850х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	500
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32,5
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	53,5
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4224	1 ШТ.
2.	Руководство по эксплуатации	1 ШТ.
3.	Паспорт на изделие	1 ШТ.
4.	Упаковка	1 ШТ.
5.	Принадлежности:	1 ШТ.
	- анкерный болт М8, 120 мм	2 ШТ.
	- комплект ключей к механическим замкам сейфа	2 ШТ.
	- полки (1 камера/2 камера)	1/2 ШТ.
	- метабоксы (1 камера/2 камера)	2/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4225)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4225.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4225 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4225 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1800х 850 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	530
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	54
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	54
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4225 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4226)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4226.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4226 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4226 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1930х 850 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	550
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	54
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	92
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4226 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4227)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4227.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4227 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4227 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1930х 850 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	600
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	54
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	106
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	250
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4227 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/4 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4228)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4228.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4228 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4228 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	2045x 850 x 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	650
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	54
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	126
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	*250*
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4228 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/3 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 1/6 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней и нижней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка компрессионного типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4251)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4251.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4251 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4251 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1217х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	280
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	20
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	50
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	100
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4251 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — нет/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4252)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4252.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4252 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4252 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1217х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	300
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	68
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4252 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4253)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4253.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4253 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4253 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1217х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	300
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	81
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4253	1 ШТ.
2.	Руководство по эксплуатации	1 ШТ.
3.	Паспорт на изделие	1 ШТ.
4.	Упаковка	1 ШТ.
5.	Принадлежности:	1 ШТ.
	- анкерный болт М8, 120 мм	2 ШТ.
	- комплект ключей к механическим замкам сейфа	2 ШТ.
	- полки (1 камера/2 камера)	1/1 ШТ.
	- метабоксы (1 камера/2 камера)	2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
	[illegible] падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4254)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4254.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4254 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4254 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1400х 600 х 555
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	330
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	32
Внутренний объем неохлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	118
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	60
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4254 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В верхней части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4261)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4261.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4261 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4261 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1080x 650 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,8
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	18,8
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	150
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	30
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4261 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 1/1 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
Д.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4262)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4262.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4262 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4262 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1080х 740 х 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	450
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25,7
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	25,7
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	200
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.	Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4262	1 ШТ.
2.	Руководство по эксплуатации	1 ШТ.
3.	Паспорт на изделие	1 ШТ.
4.	Упаковка	1 ШТ.
5.	Принадлежности:	1 ШТ.
	- анкерный болт М8, 120 мм	2 ШТ.
	- комплект ключей к механическим замкам сейфа	2 ШТ.
	- полки (1 камера/2 камера)	1/1 ШТ.
	- метабоксы (1 камера/2 камера)	3/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.
В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

На 2 (двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Фарм-Сиб»
А.В. Мартовицкий
«19» февраля 2024 г.

КОПИЯ ВЕРНА
Директор Мартовицкий Д.В.

СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ СТЛ
(исполнение СТЛ-4263)

ПАСПОРТ ССТЛ.78066655.4263.001 ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4263 (далее по тексту – сейф-холодильник) предназначен для хранения при определенных температурных условиях с защитой от свободного доступа к объектам хранения: лекарственным средствам (в т.ч. – наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и их прекурсоров), лекарственных препаратов или фармацевтических субстанций, а также биологических материалов и медицинских изделий в служебных, складских или подсобных помещениях медицинских и фармацевтических организаций, научно-исследовательских институтов и других профильных учреждений.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4263 по ТУ 9452-002-78066655-2015

Наименование параметра, единицы измерения	Значение
Внешние размеры (В*Ш*Г), мм, допустимые отклонения ± 20%	1180x 650 x 510
Масса, кг, допустимые отклонения ± 20%	500
Внутренний объем охлаждаемой 1 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35,3
Внутренний объем охлаждаемой 2 камеры, л, допустимые отклонения ± 20%	35,3
Потребляемая мощность, Вт, допустимые отклонения ± 20%	240
Время установления рабочего режима в незагруженном состоянии с момента включения в сеть, минут не более	40
Класс устойчивости ко взлому, ГОСТ 50862	IV класс

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Сейф-холодильник медицинский СТЛ, исполнение СТЛ-4263 — 1 ШТ.
2. Руководство по эксплуатации — 1 ШТ.
3. Паспорт на изделие — 1 ШТ.
4. Упаковка — 1 ШТ.
5. Принадлежности: — 1 ШТ.
   - анкерный болт М8, 120 мм — 2 ШТ.
   - комплект ключей к механическим замкам сейфа — 2 ШТ.
   - полки (1 камера/2 камера) — 2/2 ШТ.
   - метабоксы (1 камера/2 камера) — 3/3 ШТ.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

№	Вид дополнительного оснащения	Отметка о наличии
1.	Устройство для опечатывания	
2.	Датчик открывания двери	
3.	Звуковая индикация открытой двери	
4.	Разъем для подключения звуковой сигнализации	
5.	Счетчик циклов открывания двери	
6.	Поверенный прибор контроля и учета температуры рабочей камеры с цифровой индикацией	
7.	Звуковая индикация падения напряжения	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕЙФ-ХОЛОДИЛЬНИКА

5.1. Корпус сейф-холодильника представляет собой многослойный корпус, состоящий из стальных стенок и специальных элементов, препятствующих взлому. Внутренняя часть корпуса и дверь сейф-холодильника облицованы панелями из нержавеющей стали и утеплены теплоизоляционным материалом (панелями из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм).

5.2. Двери сейф-холодильника фиксируются к корпусу по всему периметру выдвижными ригелями и оборудованы замками.

В закрытом состоянии замки сейф-холодильника блокируют механизм выдвижения ригелей, который приводится в действие рукоядкой на лицевой поверхности сейф-холодильника.

5.3. В боковой части сейф-холодильника монтируется холодильная установка термоэлектрического типа, которая обеспечивает поддержание температуры в охлаждаемом объеме камеры в пределах от +2 °С до +18 °С.

5.4. Для анкерного крепления сейф-холодильника к полу, на тыльной стороне корпуса имеются два крепления с отверстиями.

5.5. Дезинфекцию сейф-холодильника проводят двукратным протиранием его внутренних и наружных поверхностей антисептической салфеткой, смоченной этиловым или изопропиловым спиртом с интервалом между протиранием 10-15 минут.

5.6. Сейф-холодильник следует эксплуатировать с УЗО с параметрами: напряжение питания сети переменного тока (220±10%)В, частота питающей сети (50±1) Гц.

6. СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Срок службы сейф-холодильника 10 лет, в том числе 1 год хранения в упаковке изготовителя от +5 °С до +40 °С (отапливаемое помещение). Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей инструкции по эксплуатации.

6.2. Утилизация упаковки и самого изделия проводится в соответствии с СанПин 2.1.3684-21 и Руководством по эксплуатации.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

6.4. Гарантированный срок эксплуатации – 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сейф-холодильник изготовлен ООО «Фарм-Сиб» 141950, Россия, Московская область, г. Талдом, село Темпы, ул. Вокзальная, д.1С, стр. 2, помещ. 2, тел / факс: (495) 221-67-40, e-mail: main@farmsib.ru, сайт: http://www.termoseif.ru

Серийный номер _____ Дата изготовления _____

М.П. ОТК _____

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

на 2 (Двух) листах

Директор ООО «Фарм-Сиб» _____ Мартовицкий Д.В.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU