



## **Фотографические изображения**

**Реагент Ventana PD-L1 (SP263) Assay для качественного обнаружения лиганда-1 белка программируемой смерти Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) иммуногистохимическим анализом в in vitro диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark**

**2023**

Реагент Ventana PD-L1 (SP263) Assay для качественного обнаружения лиганда-1 белка программируемой смерти Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) иммуногистохимическим анализом в *in vitro* диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark (общий вид)

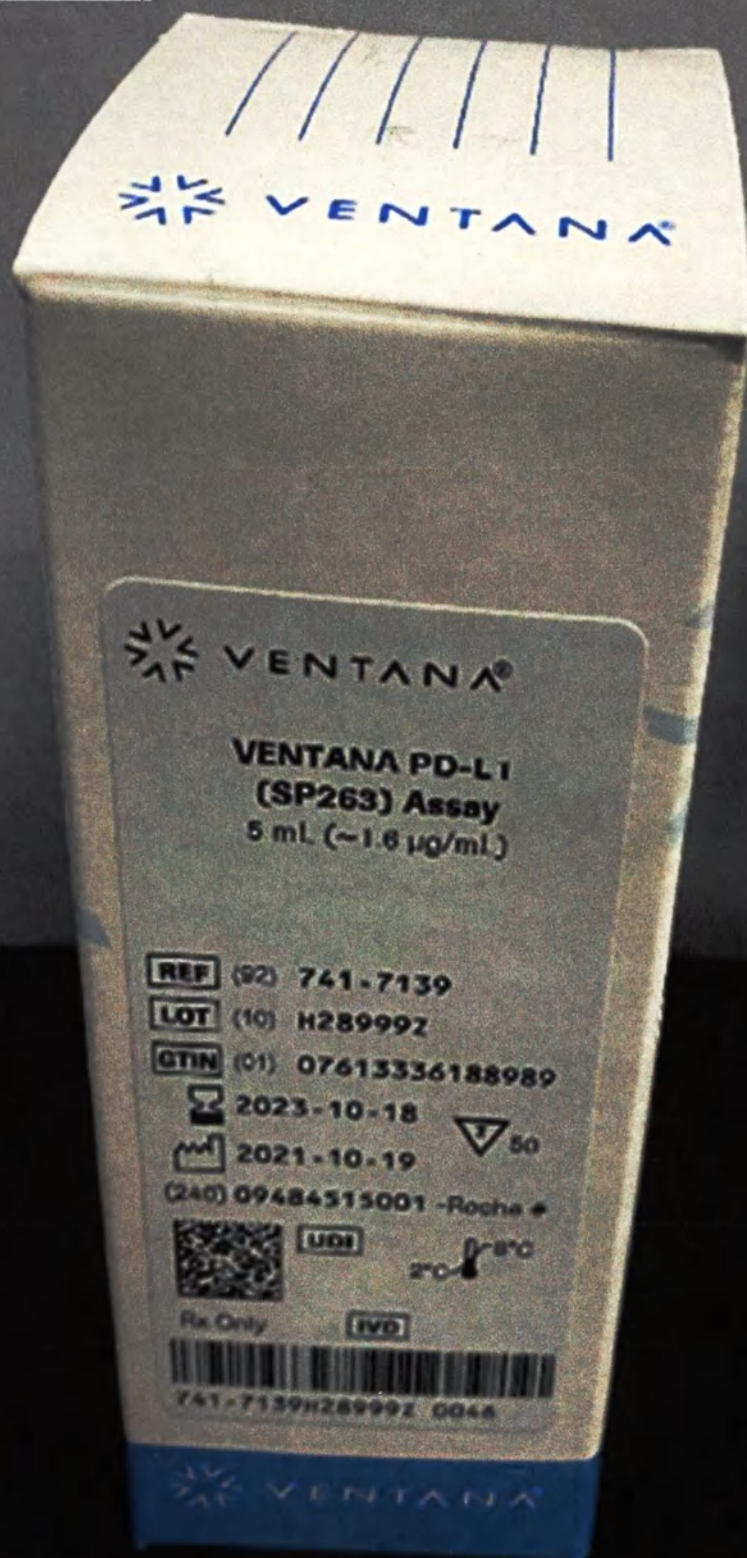

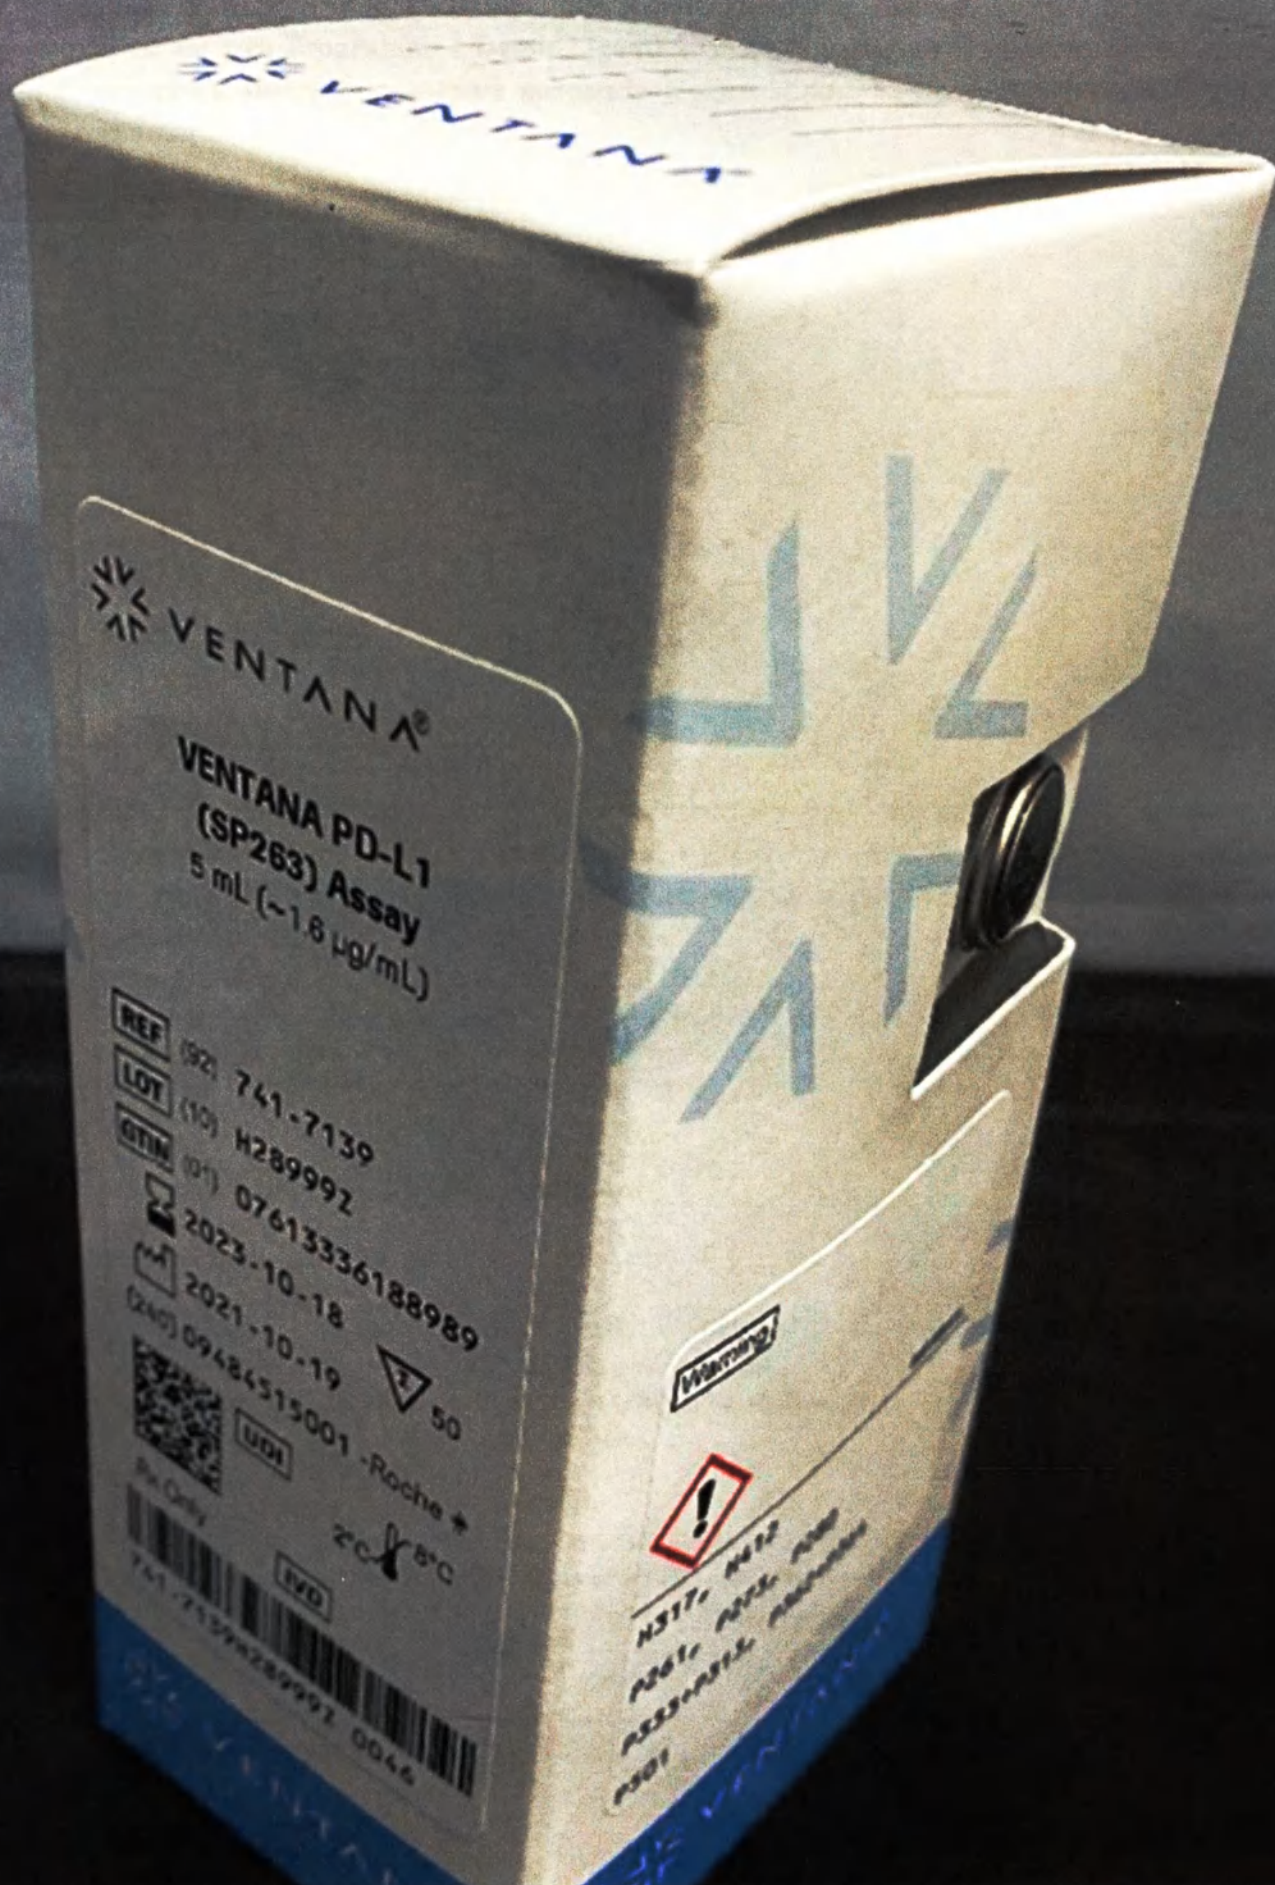

Реагент Ventana PD-L1 (SP263) Assay для качественного обнаружения лиганда-1 белка программируемой смерти Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) иммуногистохимическим анализом в in vitro диагностике к иммуностейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark: маркировка картонной упаковки

Реагент Ventana PD-L1 (SP263) Assay для качественного обнаружения лиганда-1 белка программируемой смерти Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) иммуногистохимическим анализом в in vitro диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark: маркировка тонной упаковки



Реагент Ventana PD-L1 (SP263) Assay для качественного обнаружения лиганда-1 белка программируемой смерти Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) иммуногистохимическим анализом в in vitro диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark: макет маркировки на русском языке

«Реагент Ventana PD-L1 (SP263) Assay для качественного обнаружения лиганда-1 белка программируемой смерти Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) иммуногистохимическим анализом в in vitro диагностике к иммуноштейнерам автоматическим серии Ventana BenchMark»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7620 от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Ventana Medical Systems, Inc.», («Вентана Медикал Системс, Инк.»), 1910 East Innovation Park Drive, Tucson, AZ 85755 USA, США

Изделие предназначено для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: [moscow.reception2\\_dia@roche.com](mailto:moscow.reception2_dia@roche.com)

Кат.номер 09484515001 (741-7139)

VENTANA®

PD-L1 (SP263) Assay  
5 mL (~1.6 µg/mL)

41-7139 2023-10-

1999Z

613336188989

50

2°C

V-PDL1 (SP263) W



SN 1309

Реагент Ventana PD-L1 (SP263) Assay  
для качественного обнаружения  
лиганда-1 белка программируемой  
смерти Programmed Death Ligand 1  
(PD-L1) иммуногистохимическим  
анализом в in vitro диагностике к  
иммуноштейнерам автоматическим  
серии Ventana BenchMark:

кит Ventana PD-L1 (SP263) Assay для качественного обнаружения лиганда-1 белка программируемой  
смерти Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) иммуногистохимическим анализом в in vitro диагностике к  
опухолей перам автоматическим серни Ventana BenchMark: маркировка дозатора



Ventana Medical Systems, Inc.  
1910 E. Innovation Park Drive  
Tucson, Arizona 85705 USA



VENTANA®

VENTANA PD-L1 (SP263) Assay

5 mL (~1.6 µg/mL)



UDI



REF

(92) 741-7139



2099-11-15

LOT

(10) A99999

GTIN

(01) 07613336188989



IVD



50

2°C 8°C

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
6 листа (ов)



по доверенности  
от 30.01.2004 г.

*Востанов Н. Г.*