



The State of Maryland

Office of the Secretary of State

This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America, its territories or possessions.

This Apostille does not certify the content of the document for which it is issued.

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America
This public document
2. has been signed by **Barbara H. Meiklejohn**
3. acting in the capacity of **Clerk of the Circuit Court for Montgomery County**
4. bears the seal/stamp of the **Circuit Court for Montgomery County**

Certified

5. at Annapolis, Maryland
6. the **12th day of February, 2024**
7. by The Secretary of State of Maryland
8. No. 21073
9. Seal



10. Signature

Secretary of State

State of Maryland, Montgomery County, Set.

In the Office of the Clerk of the Circuit Court for Montgomery County

I, Barbara H. Meiklejohn, Clerk of the Circuit Court for Montgomery County, Maryland, a court of record, hereby certify that **DILIS GEORGE** was a commissioned/ appointed and qualified Notary Public commencing on the 25th day of April, 2018.



In Testimony Whereof, I have hereunto set my hand and affixed the seal of the Circuit Court for Montgomery County this 12th day of February, 2024.

Barbara H. Meiklejohn

Clerk of the Circuit Court for Montgomery County

CERTIFICATION

Montgomery County:


To Whome It May Concern:

I, Angelo Barberic, certify that it is a true and correct copy of a document in the possession of CAIRE Inc.

Signatory


Angelo Barberic

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me, a notary public for state of Maryland, this 2nd day of February 2024.



Dilis George

Notary public of Maryland

My Commission Expires May 22, 2024



УТВЕРЖДАЮ/APPROVE


CAIRE Inc. / КАИРИ Инк.
(Organization / Организация)

2200 Airport Industrial Drive, Suite
500, Ball Ground, GA 30107, USA /
2200 Аэропорт Промышленный, Помещение
500, Балл Граунд, штат Джорджия 30107, США
(Address / Адрес)

Chief Regional Manager /
Главный Региональный Менеджер
(Occupation / Должность)

Angelo Barberic / Анджело Барберик
(Name Surname / Имя Фамилия)

02.02.2024 г.
(Date / Дата)





Angelo Barberic
(signature / подпись) / (Stamp / М.П.)

МАРКИРОВКА УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Концентратор кислородный медицинский портативный
Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями

МАРКИРОВКА УПАКОВКИ медицинского изделия
Редакция 2

Маркировка индивидуальной упаковки, пример

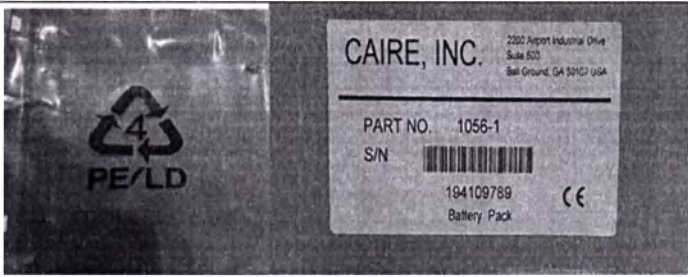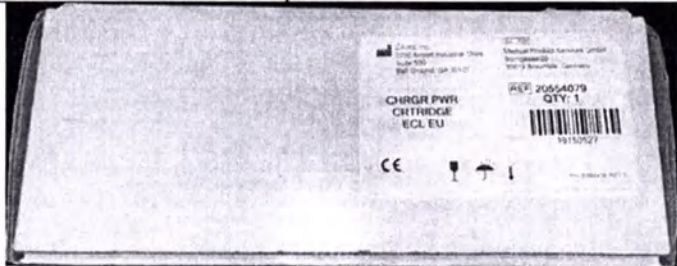Компоненты	Индивидуальная упаковка (материал)	Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки	Условные обозначения
1. Концентратор кислородный	Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США	—	—
2. Батарея съемная аккумуляторная	Двойная: 1. Пакет: Полиэтилен низкой плотности, марки IB - 205 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США 2. Коробка: картонная коробка марки 501371, производитель Essentra Packaging Ireland Ltd (Эссентра Пэкэджинг Айрленд Лтд.), Дублин, Ирландия.		 Перерабатываемый пластик. Полиэтилен низкой плотности  Номер партии  Серийный номер  Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/ЕЕС о медицинском оборудовании
3. Зарядное устройство настольное	Двойная: 1. Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США 2. Коробка: картонная коробка марки J, производства ТХИММ Паскагинг Системс ГмбХ (THIMM Packaging Systems GmbH), Германия		 Изготовитель  Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/ЕЕС о медицинском оборудовании  Хрупкое, обращаться осторожно  Не допускать воздействия влаги  Температурный диапазон  Уполномоченный представитель в Европейском сообществе  Номер по каталогу  Количество
4. Тележка транспортная	Пакет: Полиэтилен высокой	—	—

МАРКИРОВКА УПАКОВКИ медицинского изделия
Редакция 2

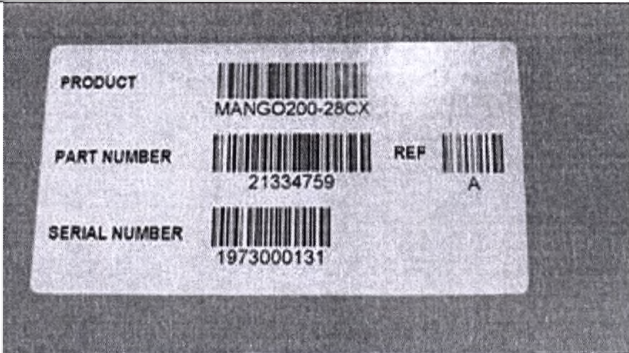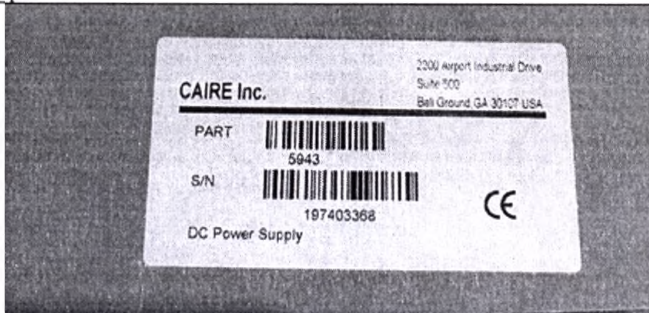Компоненты	Индивидуальная упаковка (материал)	Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки	Условные обозначения								
	плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США										
5. Зарядное устройство универсальное	Двойная: 1. Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США 2. Коробка: Картонная коробка марки 501371, производитель Essentra Packaging Ireland Ltd (Эссентра Пэкэджинг Айрленд Лтд.), Дублин, Ирландия.	 Коробка	<table><tr><td>PRODUCT</td><td>Изделие</td></tr><tr><td>PART NUMBER</td><td>Номер партии</td></tr><tr><td>SERIAL NUMBER</td><td>Номер серии</td></tr><tr><td>REF</td><td>Номер по каталогу</td></tr></table>	PRODUCT	Изделие	PART NUMBER	Номер партии	SERIAL NUMBER	Номер серии	REF	Номер по каталогу
PRODUCT	Изделие										
PART NUMBER	Номер партии										
SERIAL NUMBER	Номер серии										
REF	Номер по каталогу										
6. Зарядное устройство (12В)	Двойная: 1. Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США 2. Коробка: Картонная коробка марки 501371, производитель Essentra Packaging Ireland Ltd (Эссентра Пэкэджинг Айрленд Лтд.), Дублин, Ирландия.	 Коробка	<table><tr><td>PART NO</td><td>Номер партии</td></tr><tr><td>S/N</td><td>Серийный номер</td></tr><tr><td>CE</td><td>Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/EEC о медицинском оборудовании</td></tr></table>	PART NO	Номер партии	S/N	Серийный номер	CE	Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/EEC о медицинском оборудовании		
PART NO	Номер партии										
S/N	Серийный номер										
CE	Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/EEC о медицинском оборудовании										

МАРКИРОВКА УПАКОВКИ медицинского изделия
Редакция 2

Компоненты	Индивидуальная упаковка (материал)	Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки	Условные обозначения														
7. Адаптер-переходник	Двойная: 1. Бумага: трехслойный профиль марки В, производитель Синсинчай Индастриал Трэйд Ко. Лтд. (Xingxingcai Industrial Trade Co., Ltd), Китай 2. Пленка: Полиэтилентерефталат, марки WP56152, производитель Пулиси Пластик Материал Ко. Лтд. (Pulisi Plastic Material Co., Ltd), Китай	International Traveller's Plug Suitable for 160 countries ACP5-G4 New! Retractable Third Pin 3rd pin for the ANZ plug used to engage the safety shutter on Australian, NZ & China socket Dependent Shutter only engage to proper 2-pins insertion and shut off any improper and foreign insertion. Ground Breaking! Organizer compact for carry along Patented Design Лицевая сторона: International Traveller's Plug Universal Receptacles Adjustable Pins Plug Adapter Antistatic Carry Along Patented Design Оборотная сторона:	<table><tr><td>CE</td><td>Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/ЕЕС о медицинском оборудовании</td></tr><tr><td></td><td>Директива по отходам электрического и электронного оборудования WEEE</td></tr><tr><td>ACP5-G4</td><td>Модель</td></tr></table> <table><tr><td>Suitable for 160 countries</td><td>Подходит для 160 стран</td></tr><tr><td>Retractable third pin</td><td>Выдвижной третий штифт</td></tr><tr><td>Retractable third pin. 3rd pin for ANZ plug used to engage the safety shutter on Australian, NZ & China socket</td><td>Выдвижной третий штырь. Третий контакт для вилки ANZ используется для включения защитной шторки на австралийских, новозеландских и китайских розетках.</td></tr><tr><td>Dependent Shutter only engage to proper 2-pins insertion, and shut off any improper and foreign insertion</td><td>Зависимый затвор срабатывает только при правильной установке двух штифтов и перекрывает любую неправильную установку</td></tr></table>	CE	Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/ЕЕС о медицинском оборудовании		Директива по отходам электрического и электронного оборудования WEEE	ACP5-G4	Модель	Suitable for 160 countries	Подходит для 160 стран	Retractable third pin	Выдвижной третий штифт	Retractable third pin. 3rd pin for ANZ plug used to engage the safety shutter on Australian, NZ & China socket	Выдвижной третий штырь. Третий контакт для вилки ANZ используется для включения защитной шторки на австралийских, новозеландских и китайских розетках.	Dependent Shutter only engage to proper 2-pins insertion, and shut off any improper and foreign insertion	Зависимый затвор срабатывает только при правильной установке двух штифтов и перекрывает любую неправильную установку
CE	Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/ЕЕС о медицинском оборудовании																
	Директива по отходам электрического и электронного оборудования WEEE																
ACP5-G4	Модель																
Suitable for 160 countries	Подходит для 160 стран																
Retractable third pin	Выдвижной третий штифт																
Retractable third pin. 3rd pin for ANZ plug used to engage the safety shutter on Australian, NZ & China socket	Выдвижной третий штырь. Третий контакт для вилки ANZ используется для включения защитной шторки на австралийских, новозеландских и китайских розетках.																
Dependent Shutter only engage to proper 2-pins insertion, and shut off any improper and foreign insertion	Зависимый затвор срабатывает только при правильной установке двух штифтов и перекрывает любую неправильную установку																
8. Кабель сетевой (220В)	Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США	—	—														


МАРКИРОВКА УПАКОВКИ медицинского изделия
Редакция 2

Компоненты	Индивидуальная упаковка (материал)	Фотографическое изображение маркировки индивидуальной упаковки	Условные обозначения
Принадлежности:			
1. Сумка для аксессуаров	Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США	—	—
2. Сумка для переноски	Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США	—	—
3. Защитный чехол	Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США	—	—
4. Адаптер для увлажнителя	Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США	—	—
5. Фильтр воздухозаборника	Пакет: Полиэтилен высокой плотности, марки IB - 203 X, производитель: УЛИНЕ (ULINE), США	—	—

Маркировка транспортной упаковки, пример

Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки	Условные обозначения
	



МАРКИРОВКА УПАКОВКИ медицинского изделия
Редакция 2

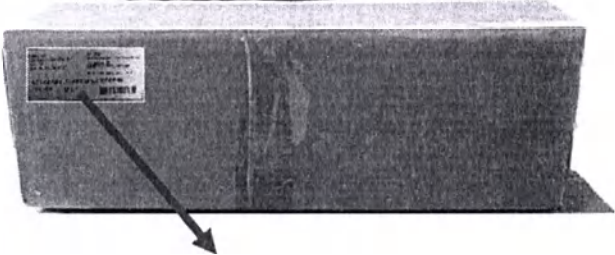Фотографическое изображение маркировки транспортной упаковки	Условные обозначения																												
1 место 	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/EEC о медицинском оборудовании</td></tr> <tr> <td></td><td>Серийный номер</td></tr> <tr> <td></td><td>Уполномоченный представитель в Европейском сообществе</td></tr> <tr> <td></td><td>Этой стороной вверх</td></tr> <tr> <td></td><td>Хрупкий, обращаться с осторожностью</td></tr> <tr> <td></td><td>Не допускать воздействия влаги</td></tr> <tr> <td></td><td>Ограничение по штабелированию</td></tr> <tr> <td></td><td>Обратитесь к инструкции по применению</td></tr> <tr> <td></td><td>Температурный диапазон</td></tr> <tr> <td></td><td>Максимальная влажность воздуха</td></tr> <tr> <td></td><td>Диапазон атмосферного давления</td></tr> <tr> <td></td><td>Изготовитель</td></tr> <tr> <td></td><td>Литий-ионные батареи, содержащиеся в оборудовании или упакованные с оборудованием</td></tr> <tr> <td></td><td>Номер детали</td></tr> </table>		Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/EEC о медицинском оборудовании		Серийный номер		Уполномоченный представитель в Европейском сообществе		Этой стороной вверх		Хрупкий, обращаться с осторожностью		Не допускать воздействия влаги		Ограничение по штабелированию		Обратитесь к инструкции по применению		Температурный диапазон		Максимальная влажность воздуха		Диапазон атмосферного давления		Изготовитель		Литий-ионные батареи, содержащиеся в оборудовании или упакованные с оборудованием		Номер детали
	Данное устройство соответствует требованиям директивы 93/42/EEC о медицинском оборудовании																												
	Серийный номер																												
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе																												
	Этой стороной вверх																												
	Хрупкий, обращаться с осторожностью																												
	Не допускать воздействия влаги																												
	Ограничение по штабелированию																												
	Обратитесь к инструкции по применению																												
	Температурный диапазон																												
	Максимальная влажность воздуха																												
	Диапазон атмосферного давления																												
	Изготовитель																												
	Литий-ионные батареи, содержащиеся в оборудовании или упакованные с оборудованием																												
	Номер детали																												

МАРКИРОВКА УПАКОВКИ медицинского изделия
Редакция 2

Фотографическое изображение
маркировки транспортной упаковки

2 место

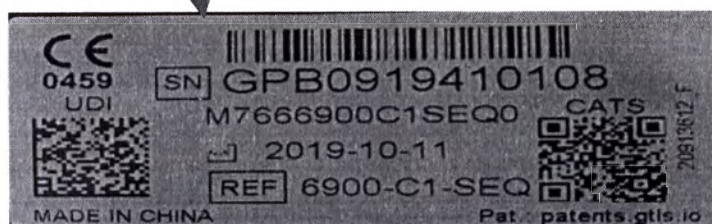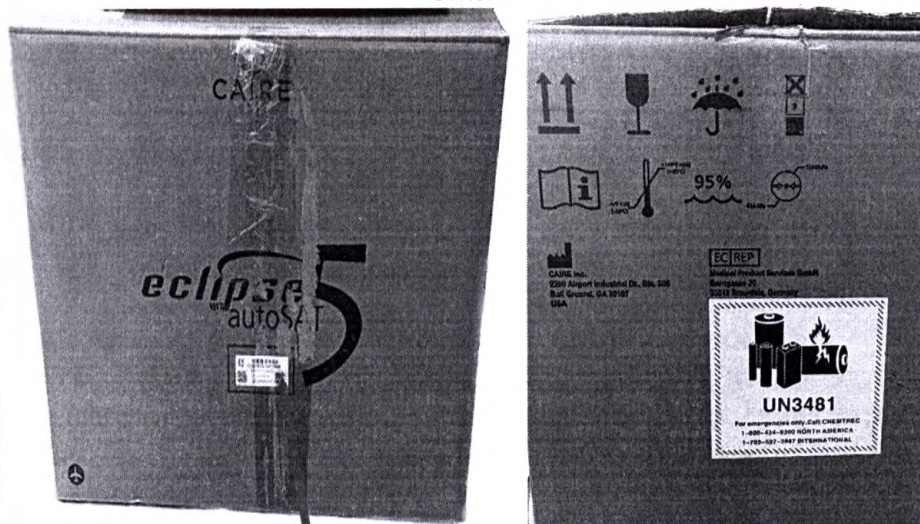

Условные обозначения

REF	Номер по каталогу
REF	
QTY	Количество в упаковке
QTY	
W	Дата изготовления
W	
UDI	Уникальный идентификатор изделия
UDI	

Маркировка транспортной упаковки дополнительно для рынка РФ

Стикер для рынка РФ

Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями		
1. Концентратор кислородный - 1 шт.; 2. Батарея съемная аккумуляторная - 1 шт.; 3. Зарядное устройство настольное - 1 шт.; 4. Тележка транспортная - 1 шт.; 5. Зарядное устройство универсальное - 1 шт.; 6. Зарядное устройство (12В) - 1 шт.; 7. Адаптер-переходник - 1 шт.; 8. Кабель сетевой (220В) - 1 шт.; 9. Руководство пользователя по эксплуатации медицинского изделия - 1 шт. Принадлежности: 1. Сумка для аксессуаров - 1 шт.; 2. Сумка для переноски - 1 шт.; 3. Защитный чехол - 1 шт.; 4. Адаптер для увлажнителя - 1 уп., в составе: - Резинка крепления увлажнителя - 1 шт.; - Трубка соединительная - 1 шт.; 5. Фильтр воздухозаборника - 1 шт.;		
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «ЛайфКор Интернешнл» 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 13, корп. 3, пом. V.		
Условия хранения: Температура воздуха, °C: от -20 до +60 Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата, %: от 0 до 95 Атмосферное давление, кПа: 90 ± 15	Условия транспортирования: Температура воздуха, °C: от -20 до +60 Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата, %: не более 95 (при 25 °C) Атмосферное давление, кПа: 90 ± 15 Продолжительность не дольше 48 часов	Условия эксплуатации: температура и влажность окружающей среды: от +10° C до +40° C Влажность воздуха (относительная), без образования конденсата, %: 10 – 95% при температуре 28°C
Концентратор Эклипс 5 подлежит утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б.		
Регистрационное удостоверение № *****Дата*****	Знак подтверждения соответствия (при наличии)	

ШТАТ МЭРИЛЕНД

СЕКРЕТАРЬ ШТАТА

Настоящий Апостиль недействителен на территории Соединенных Штатов Америки, их территориях или владениях.
Апостиль не удостоверяет содержание документа, для которого он был выдан.

АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Соединенные Штаты Америки
Настоящий официальный документ
2. был подписан **Барбарой Х. Мейклджон,**
3. выступающей в качестве **Секретаря Окружного суда округа Монтгомери,**
4. скреплен печатью/штампом **Окружного суда округа Монтгомери**

Удостоверено

5. в г. Аннаполис, Мэриленд
6. **12 февраля 2024 г.**
7. Секретарем штата Мэриленд
8. № **21073**
9. Печать: *Печать:* Печать офиса Секретаря штата Мэриленд
10. Подпись: */подпись/* *Секретарь штата*

Штат Мэриленд, округ Монтгомери

В офис Секретаря Окружного суда округа Монтгомери

Я, Барбара Х. Мейклджон, Секретарь Окружного суда округа Монтгомери, штат Мэриленд, суд письменного производства, настоящим удостоверяю, что ДАИЛИС ДЖОРДЖ была назначена государственным нотариусом с 25 апреля 2018 г.

В удостоверение чего ставлю свою подпись и печать
Окружного суда округа Монтгомери сегодня,
12 февраля 2024 г.

/подпись/

Барбара Х. Мейклджон

Секретарь Окружного суда округа Монтгомери

Печать:

Окружной суд округа Монтгомери, штат Мэриленд

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Округ Монтгомери

По месту требования:

Настоящим, я, Анжело Барберик, удостоверяю верную и точную копию документа компании КАИРИ Инк.

Представитель с правом подписи: /подпись/
Анжело Барберик

Подписано под присягой в моём, государственного нотариуса, присутствии сегодня,
2 февраля 2024 г.

/подпись/

Дайлис Джордж

Государственный нотариус штата Мэриленд

Срок действия полномочий истекает 22 мая 2024 г.

/логотип/
КАИРИ-

/подпись/ *Анжело Барберик*

Круглая печать: /КАИРИ ИНК., ДЕЛАВЭР, ПЕЧАТЬ КОРПОРАЦИИ, 1992

ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Перевод данного текста выполнен мной, переводчиком Марковым Александром Александровичем



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого марта две тысячи двадцать четвёртого года.

Я, Литвинова Татьяна Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Якубовой Татьяны Олеговны, свидетельствую подлинность подписи переводчика Маркова Александра Александровича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2171-н/77-2024-21-916.

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Т.Н.Литвинова

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 46 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса



УТВЕРЖДАЮ

ООО «ЛайфКор Интернешнл»

(Организация)

Генеральный директор

(Должность)

Дрыго С.В.

(Ф.И.О)

«12» марта 2024 г.

(Дата)



**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Концентратор кислородный медицинский портативный
Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями**

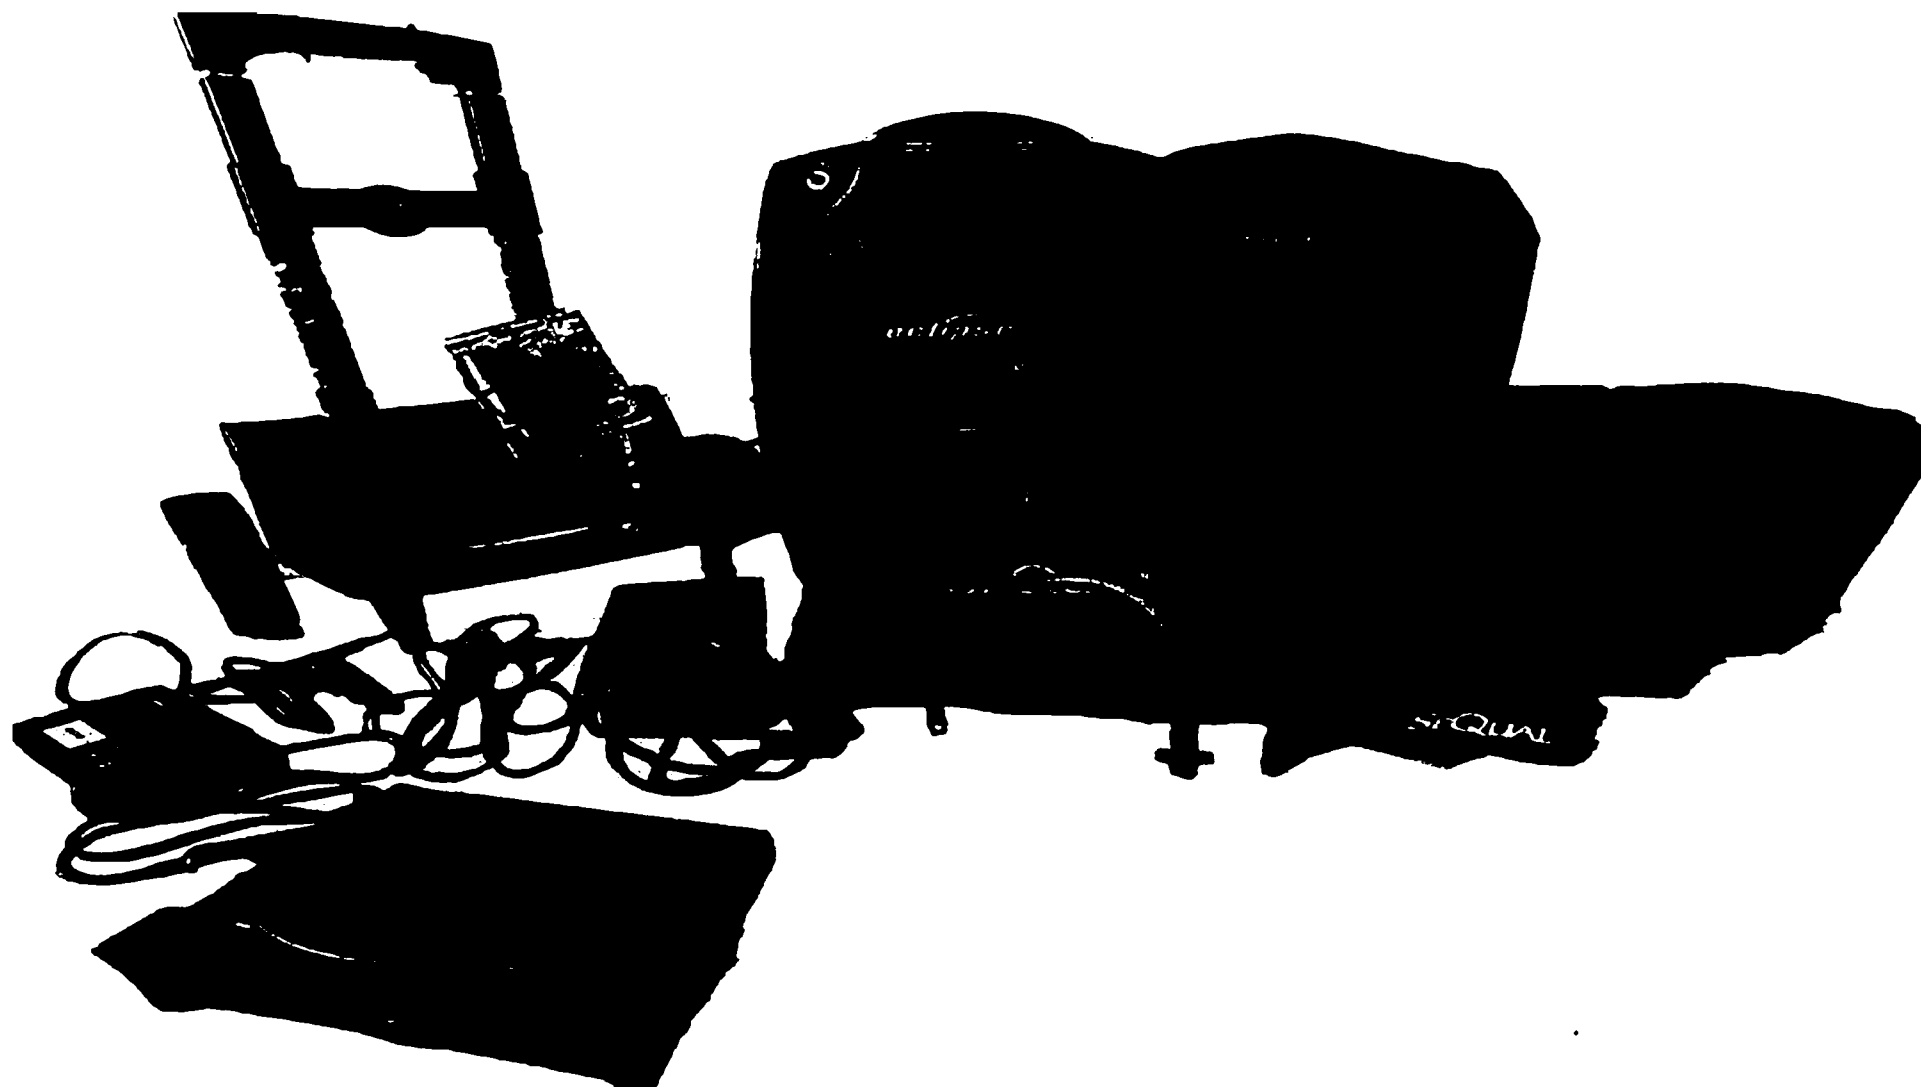


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Общий вид



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Концентратор кислородный, Вид спереди

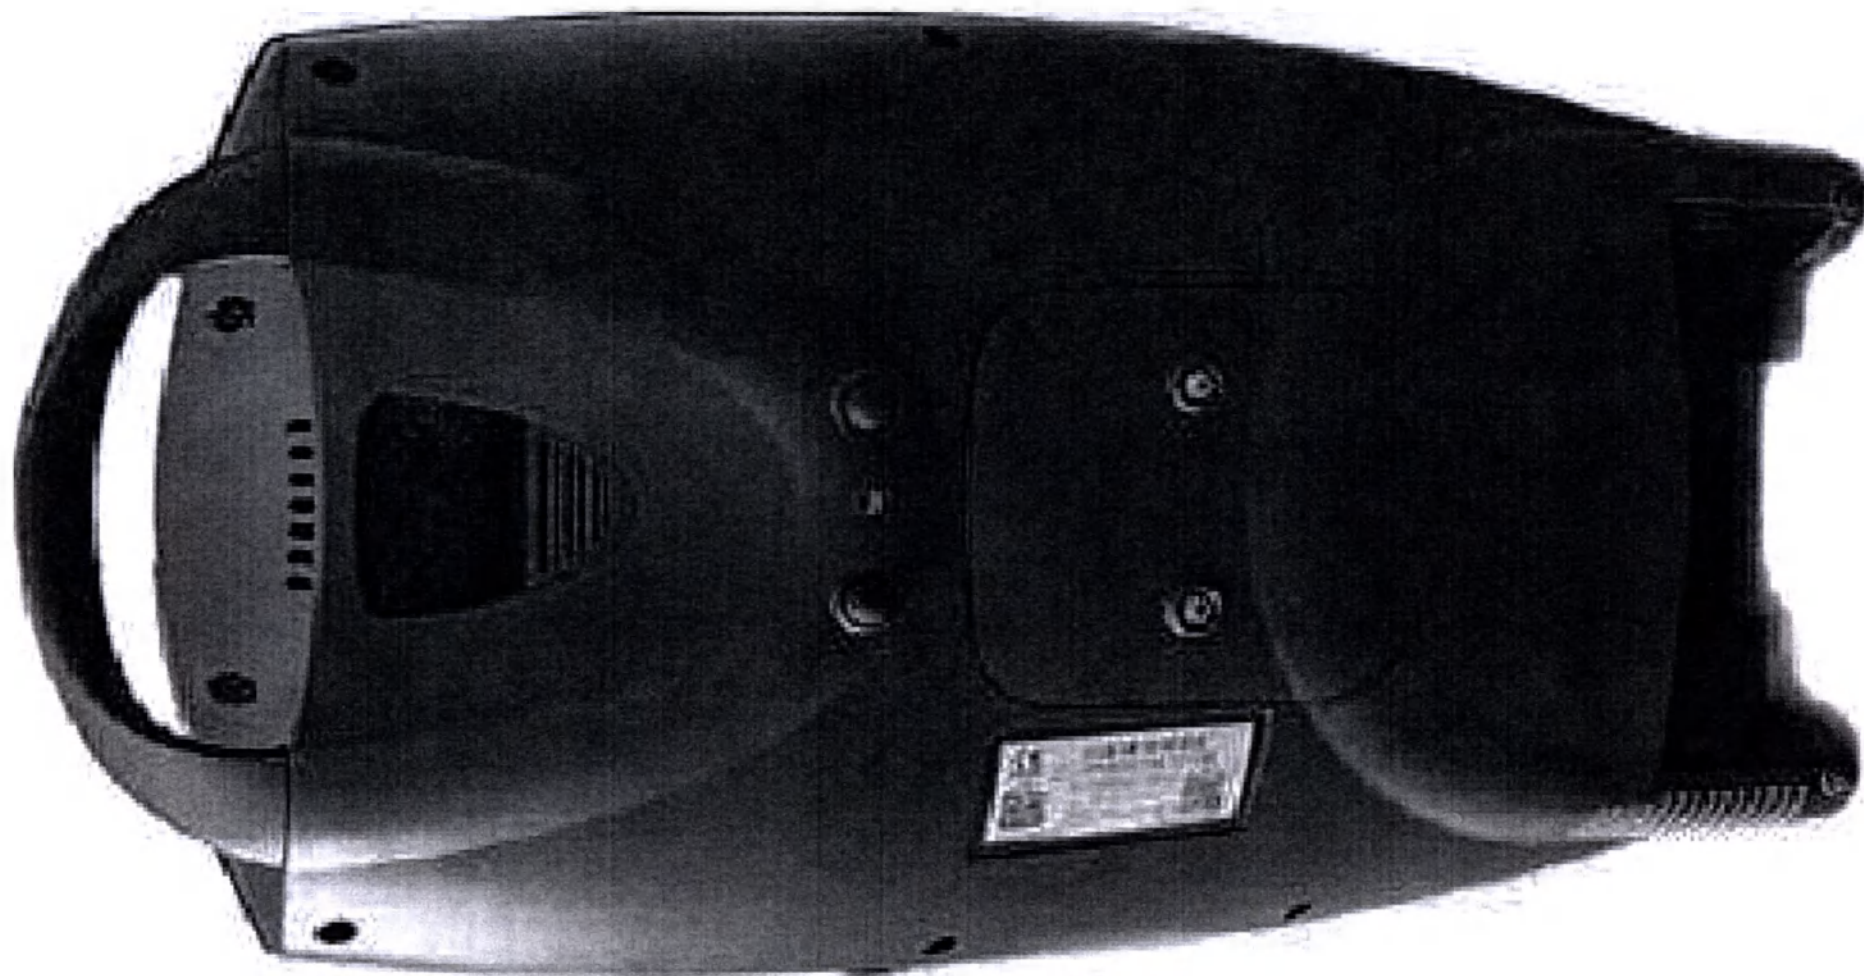


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Концентратор кислородный, Вид сзади


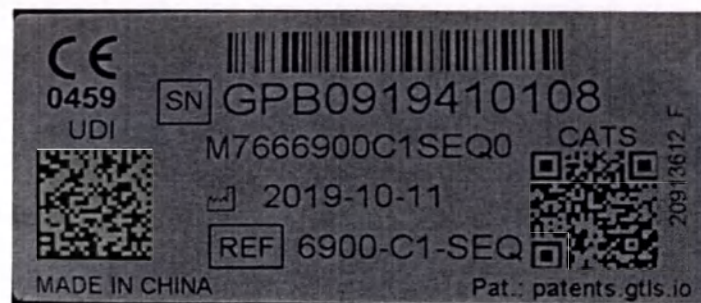


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Концентратор кислородный, Маркировка (пример)



Дисплей с 3 светодиодами (Caire) (панель управления)

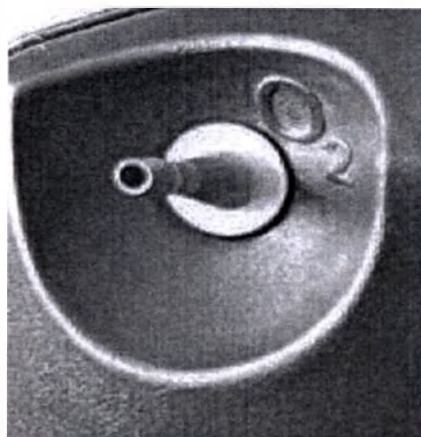

Отверстие выхода кислорода (выходной штуцер)

Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Концентратор кислородный, Дисплей с 3 светодиодами (Caire) (панель управления) и Отверстие выхода кислорода (выходной штуцер)

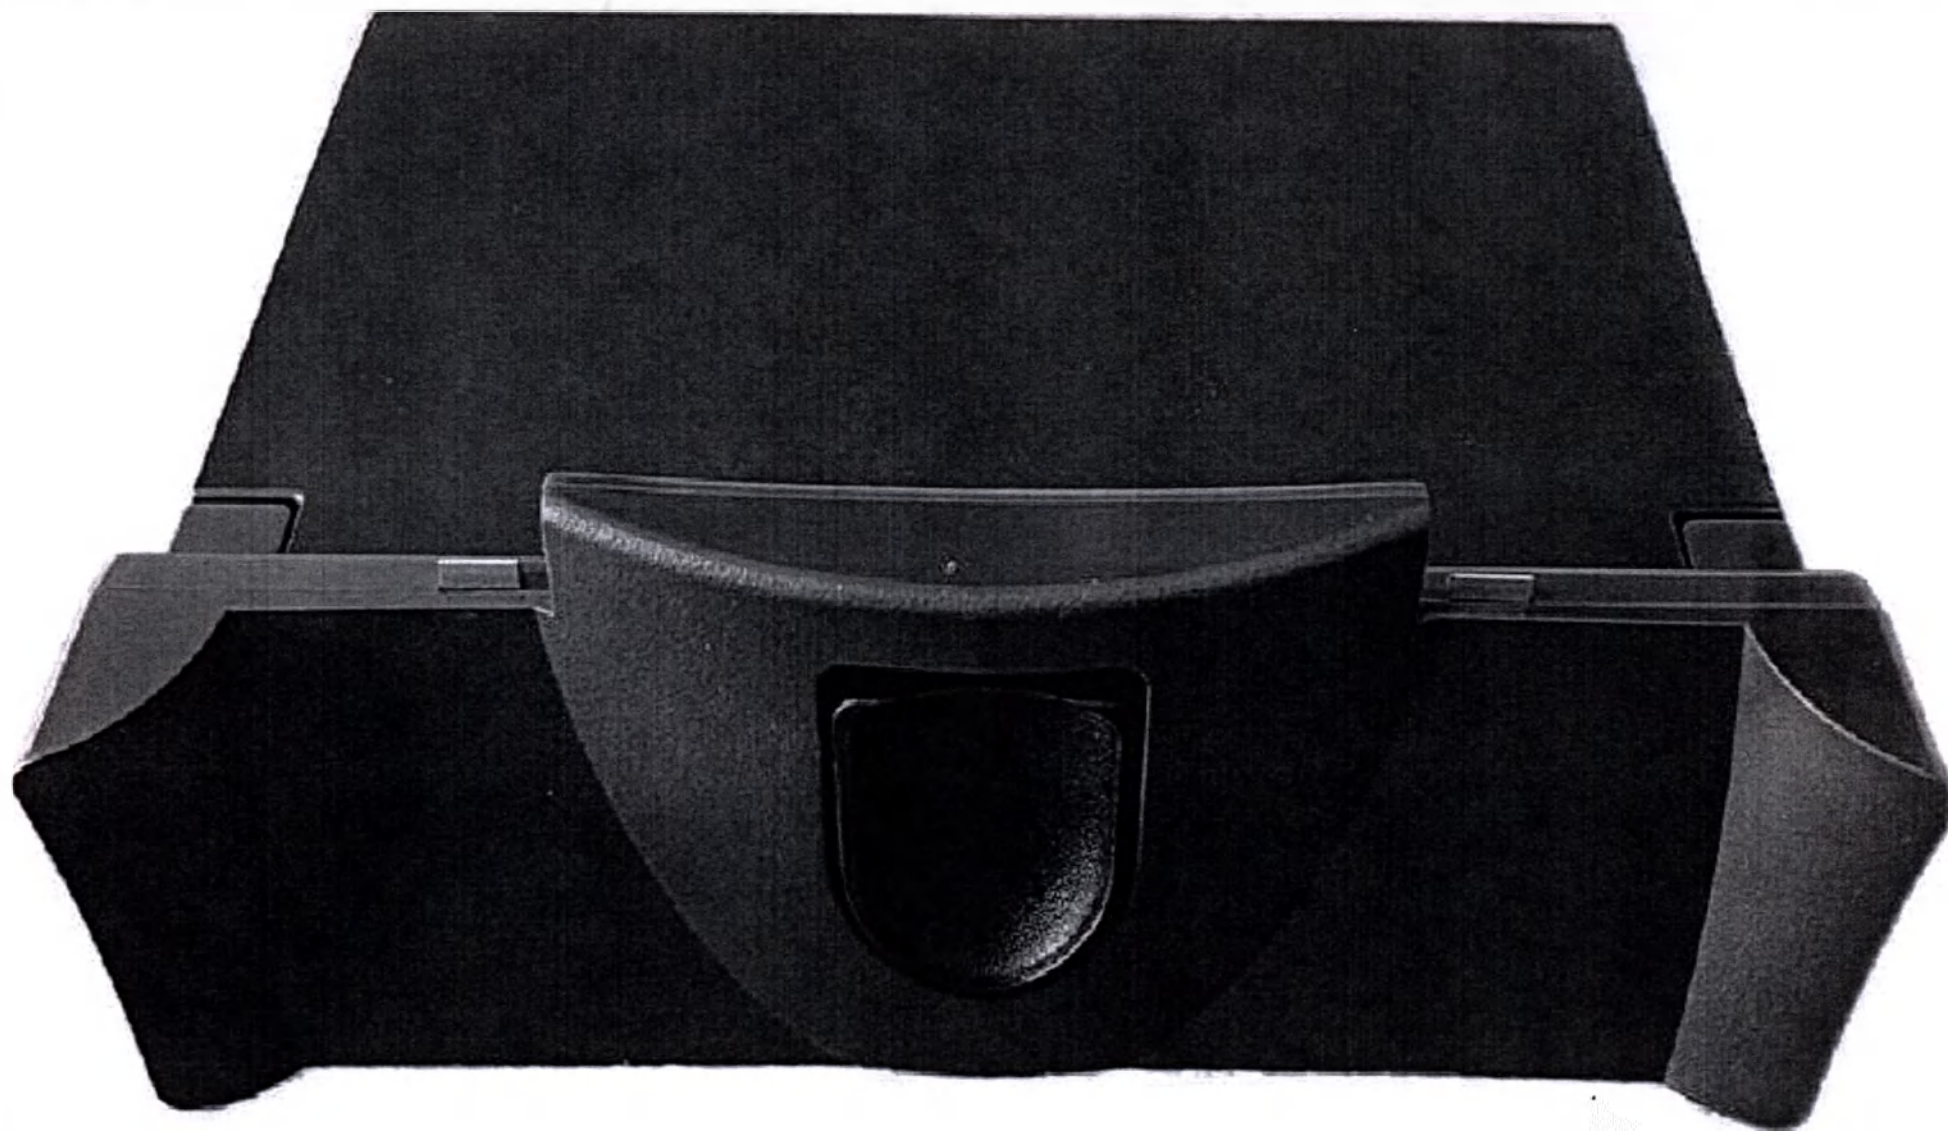


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Батарея съемная аккумуляторная, Вид спереди



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Батарея съемная аккумуляторная, Вид сзади, маркировка (пример)



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство настольное, Вид сверху



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство настольное, Вид сбоку

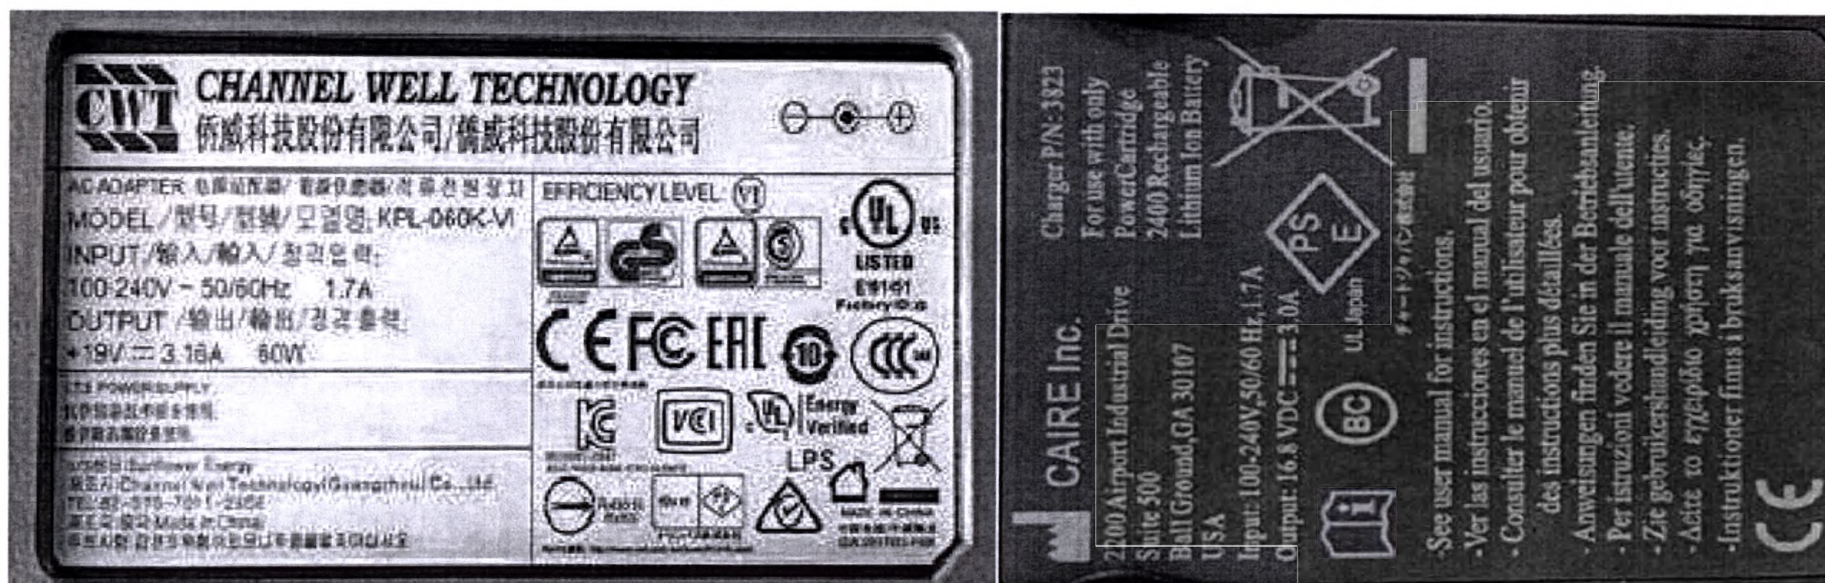


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство настольное, Вид снизу, маркировка (пример)

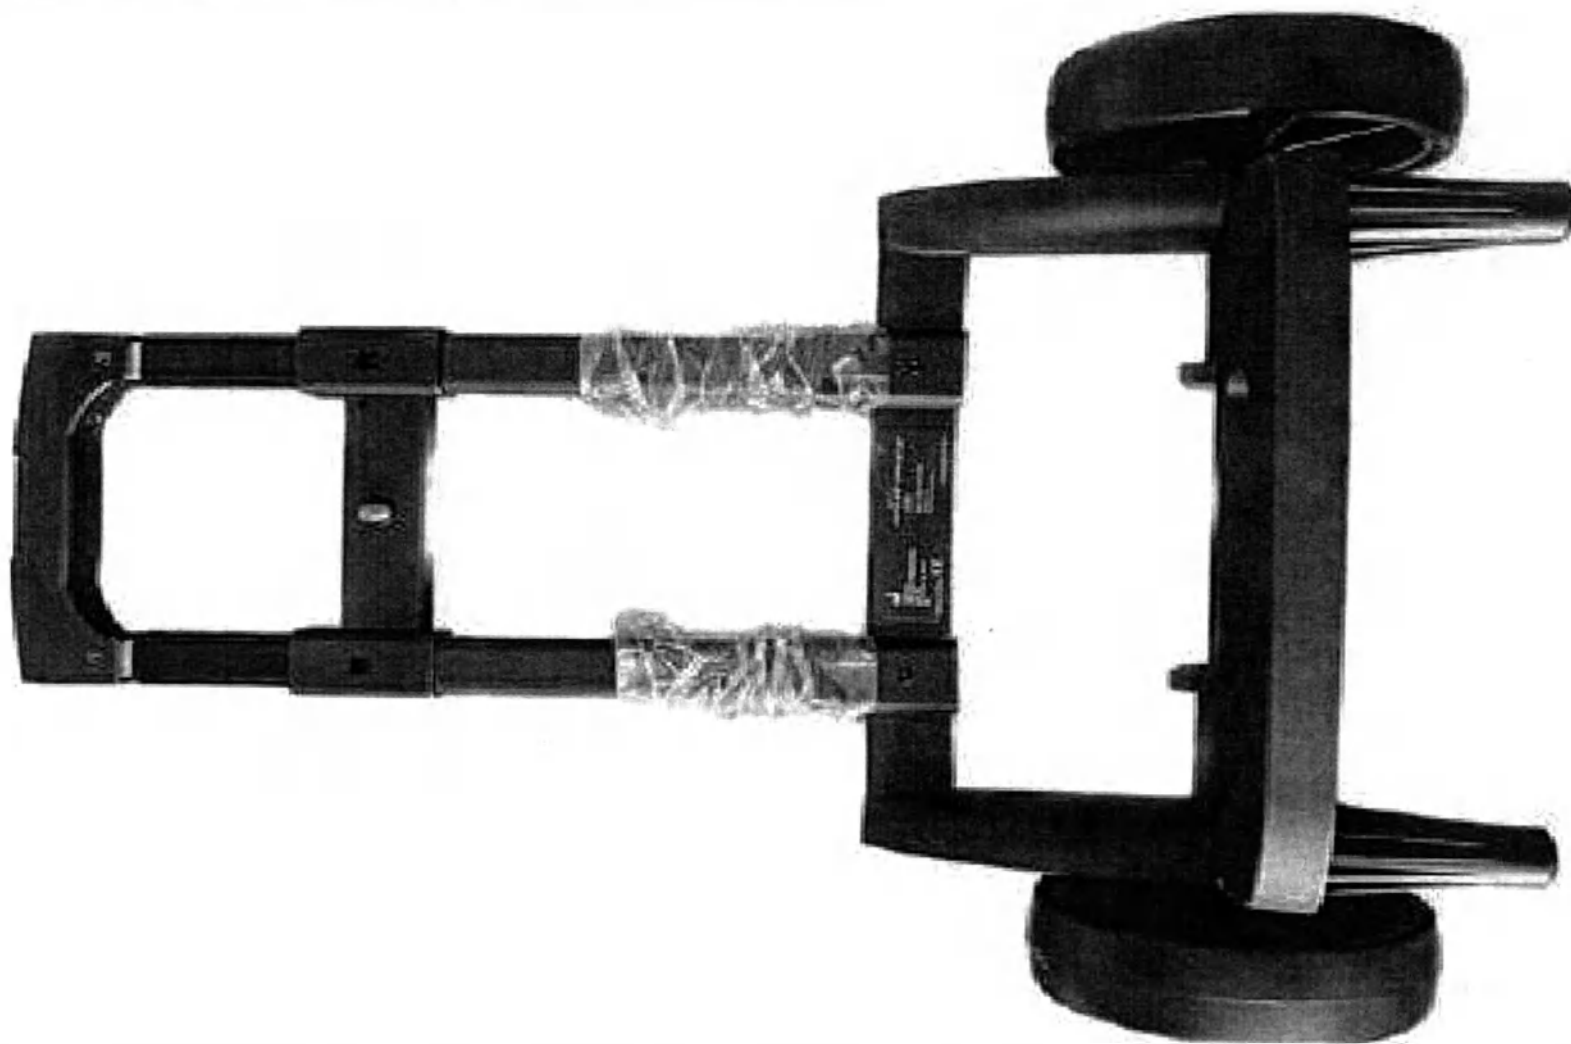


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Тележка транспортная, Вид спереди, маркировка (пример)

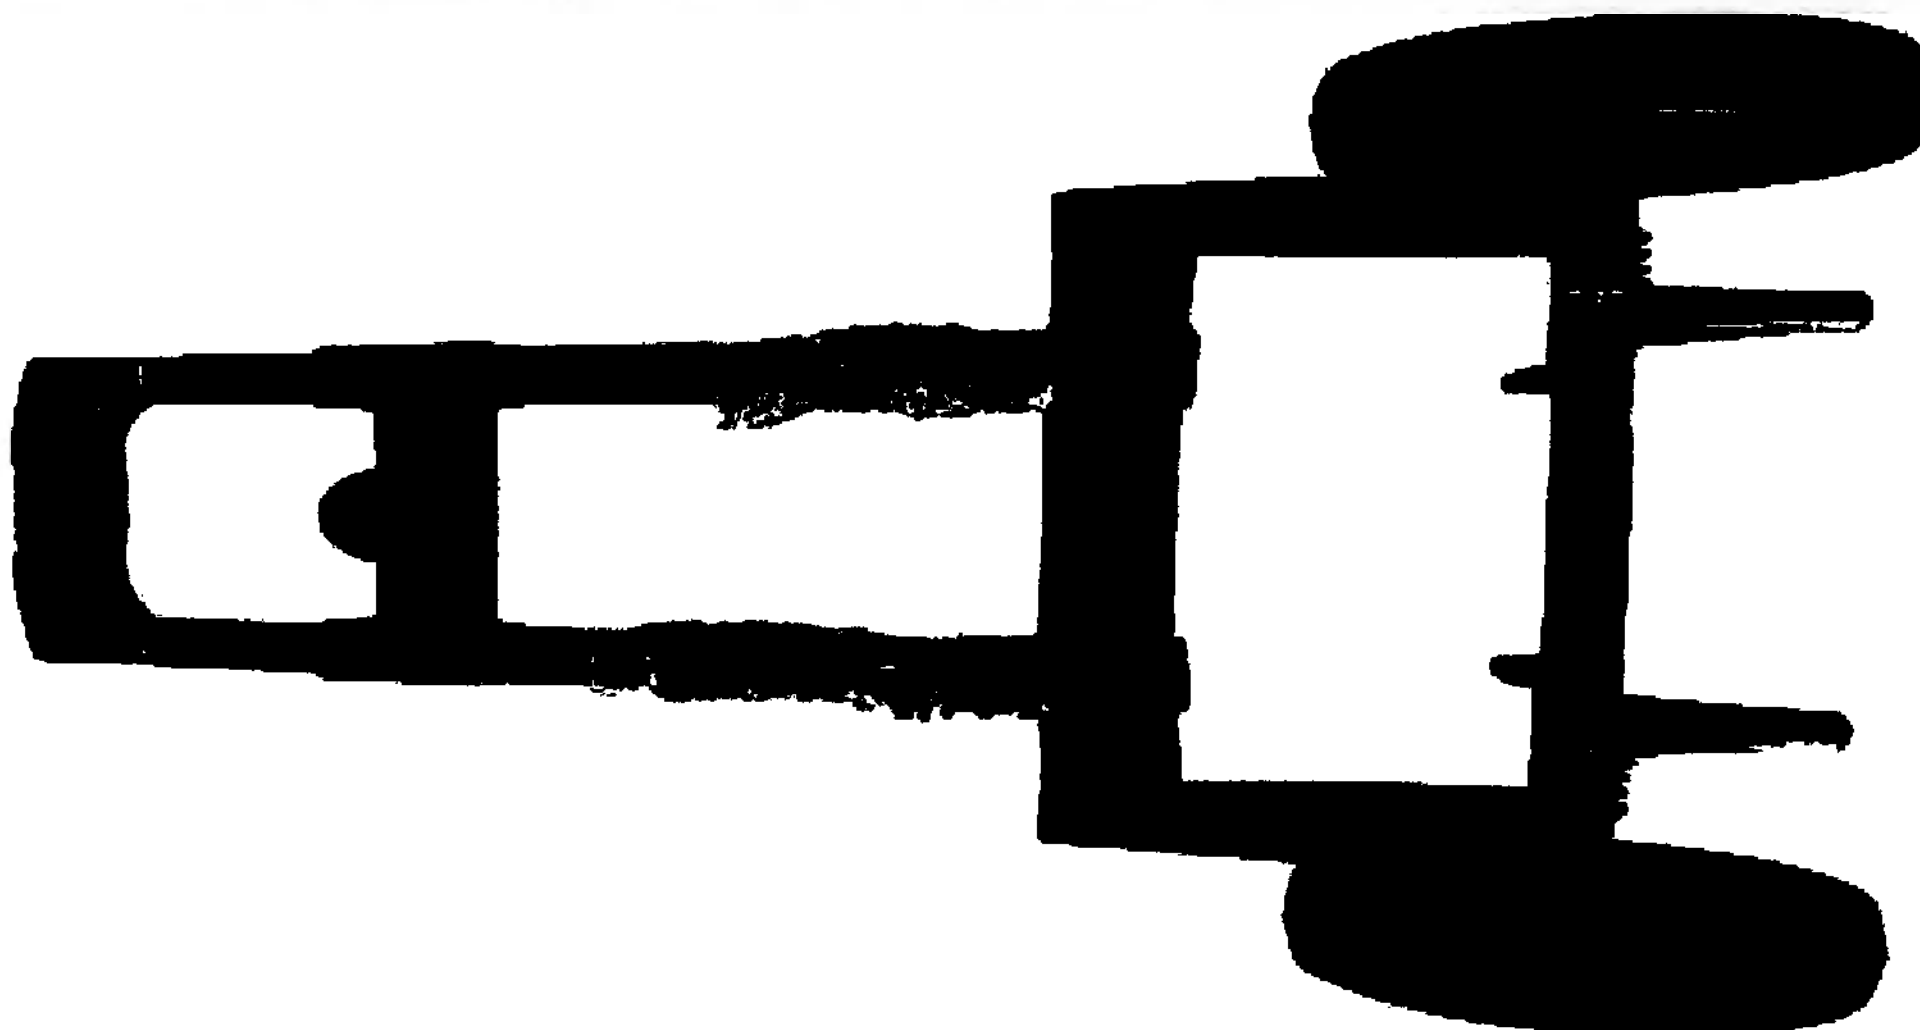


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Тележка транспортная, Вид сзади



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство универсальное, Вид сверху




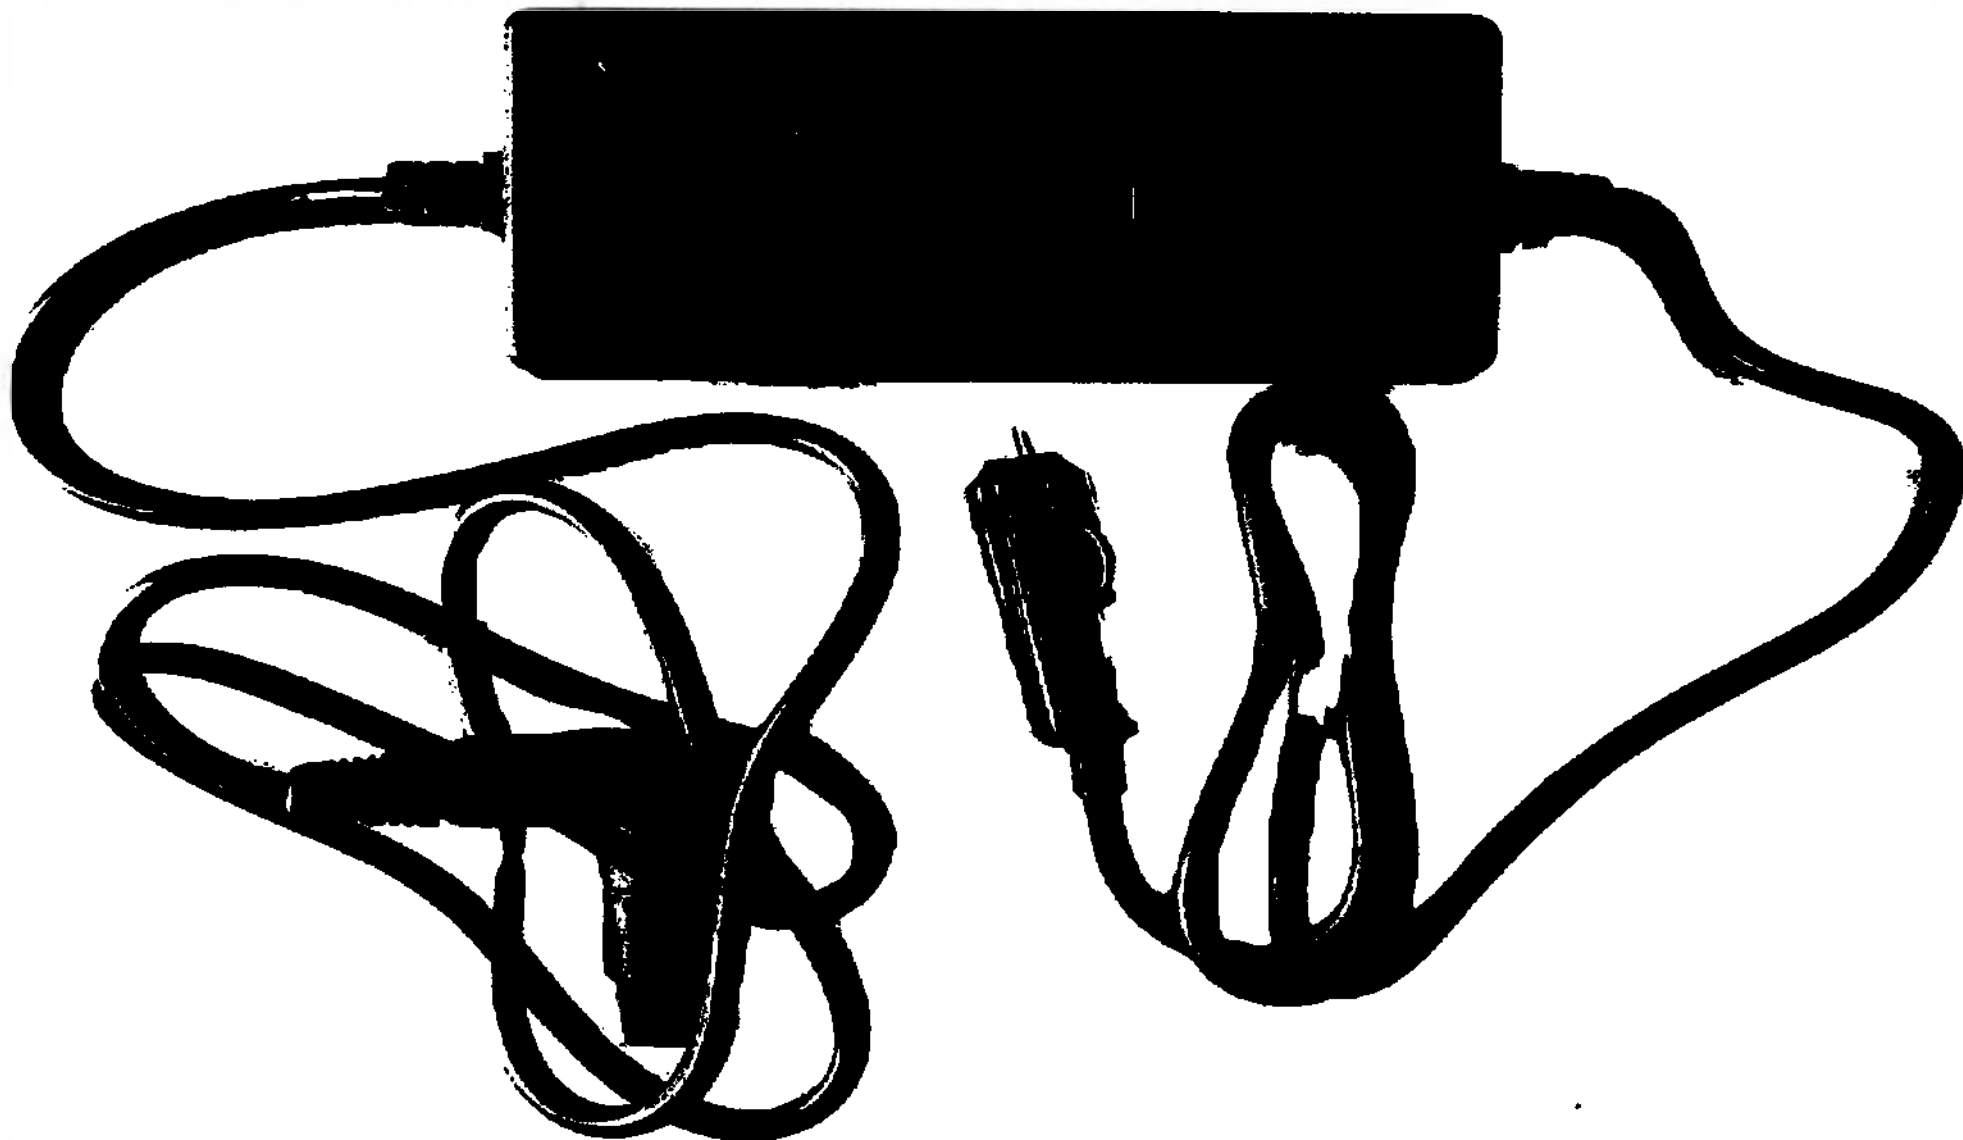



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство (12В), Вид сверху



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство (12В), Вид снизу, маркировка (пример)

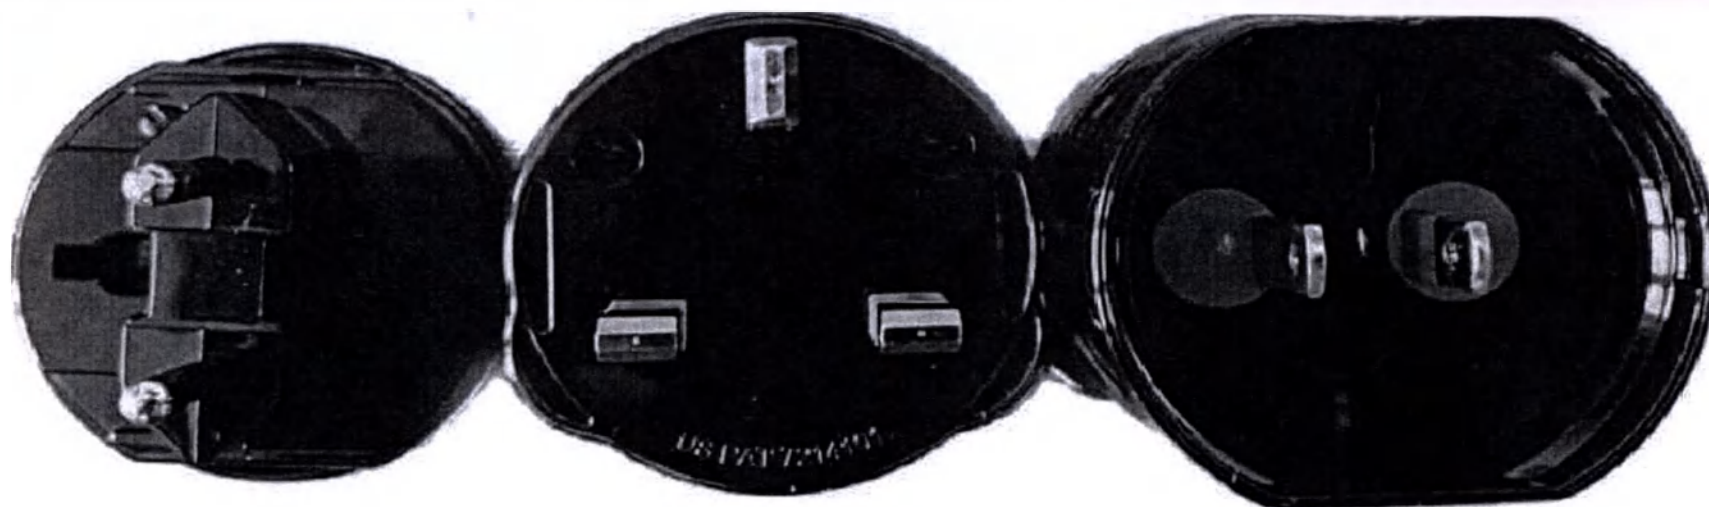

Вид сверху

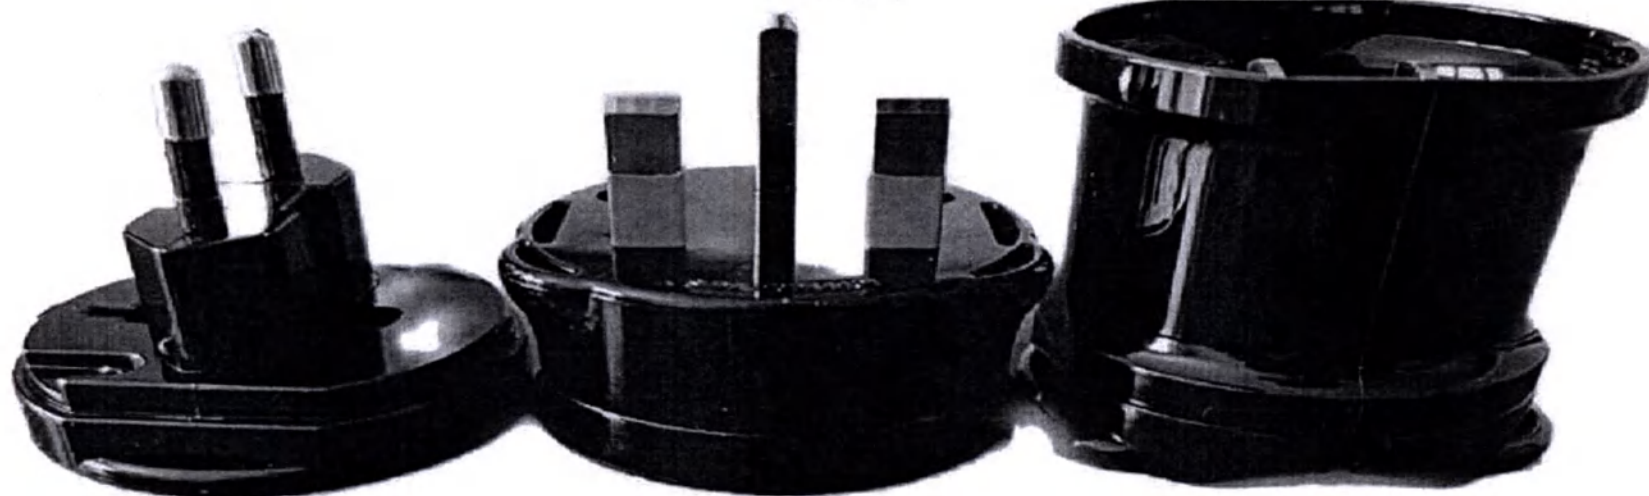

Вид сбоку

Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Адаптер-переходник, В разборе: Вид сверху, Вид сбоку



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Адаптер-переходник, В сборе

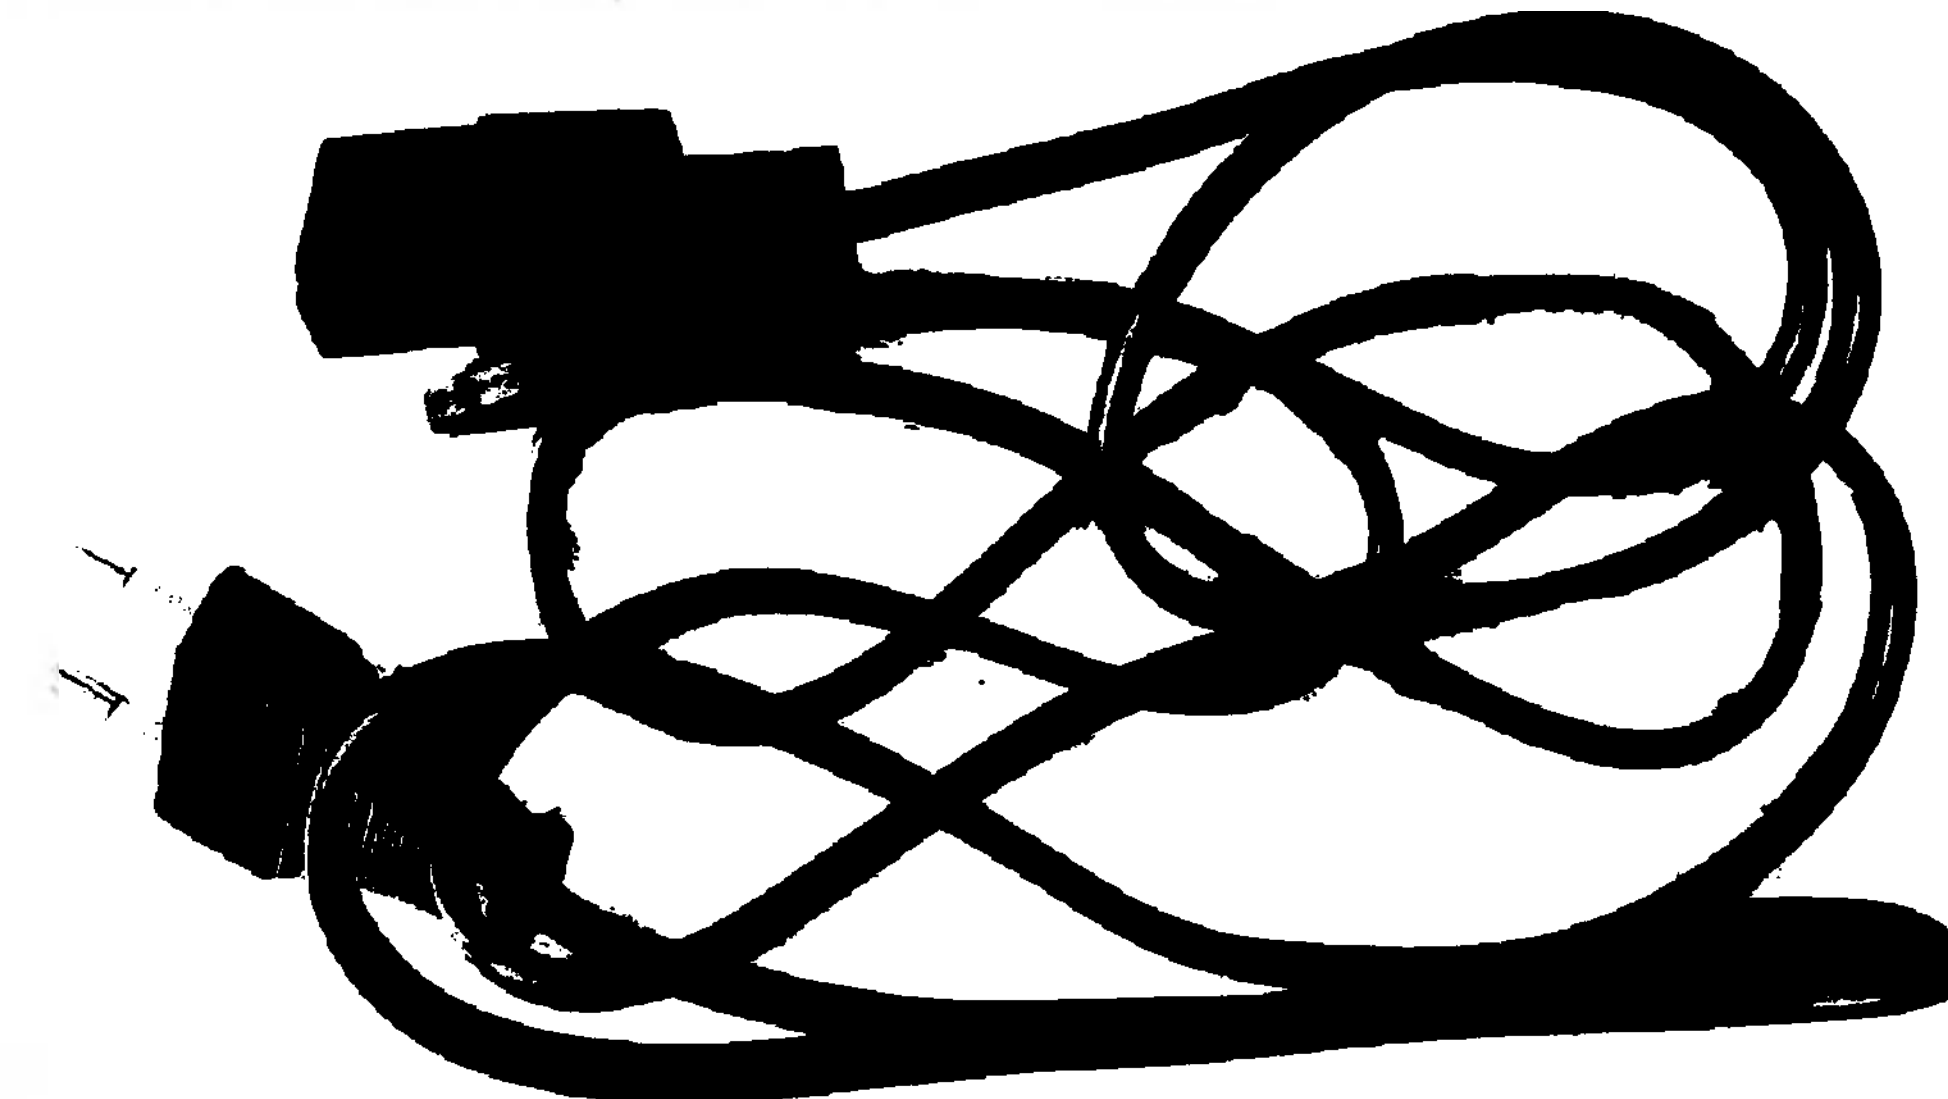


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Кабель сетевой (220В)

Принадлежности:
Вид спереди Вид сзади



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Сумка для аксессуаров, Вид спереди, Вид сзади

Вид спереди



Вид сзади



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Сумка для переноски, Вид спереди, Вид сзади

Вид спереди

Вид сзади



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Защитный чехол, Вид спереди, Вид сзади



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Адаптер для увлажнителя


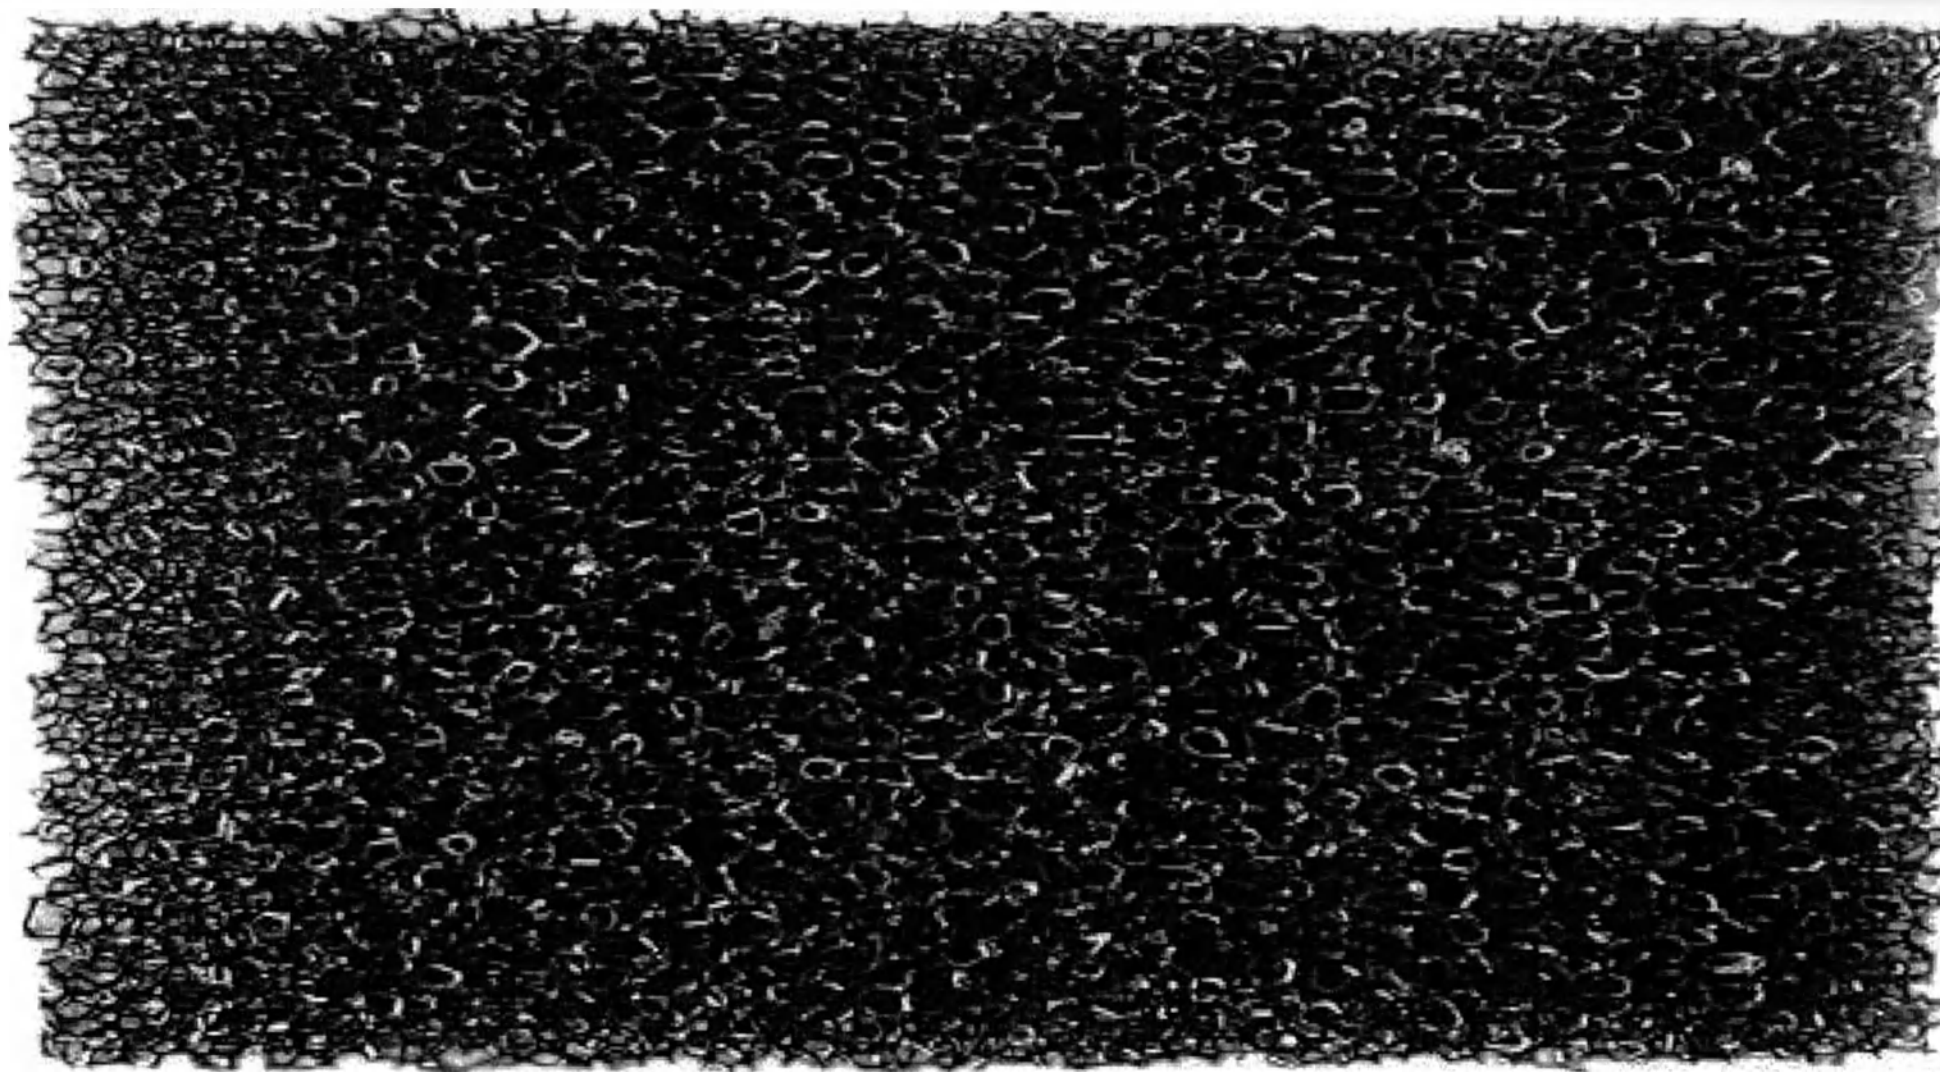



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Фильтр воздухозаборника

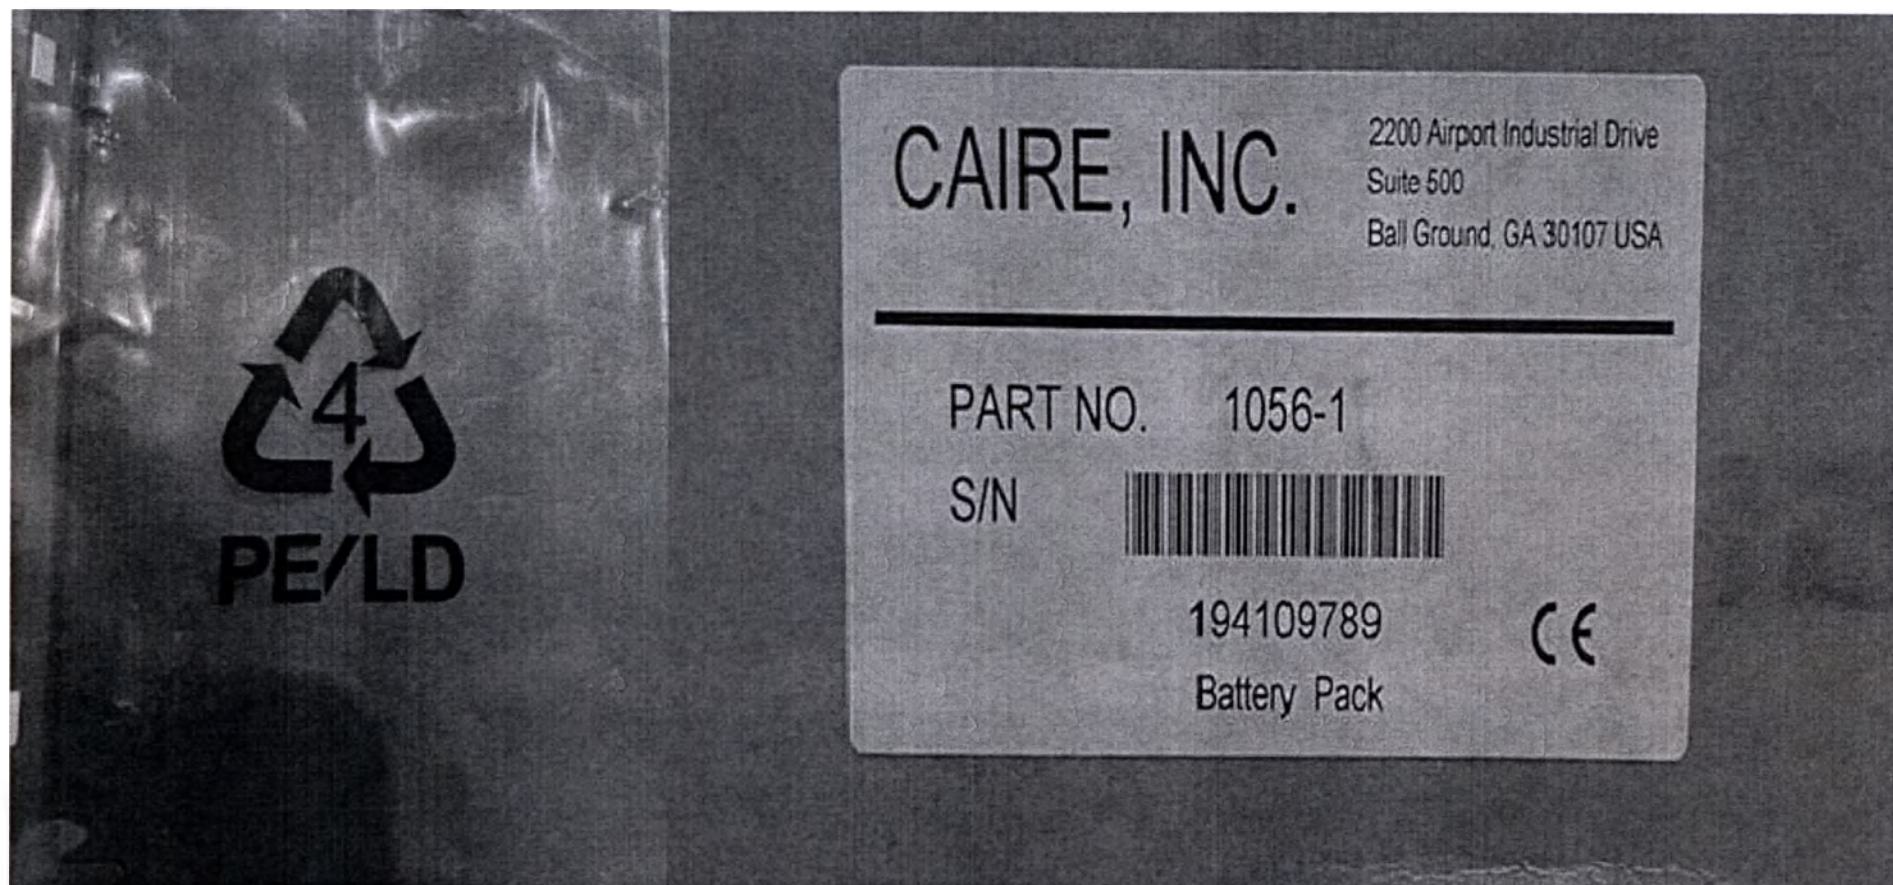

Пакет


Коробка

Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Батарея съемная аккумуляторная, Маркировка индивидуальной упаковки, пример

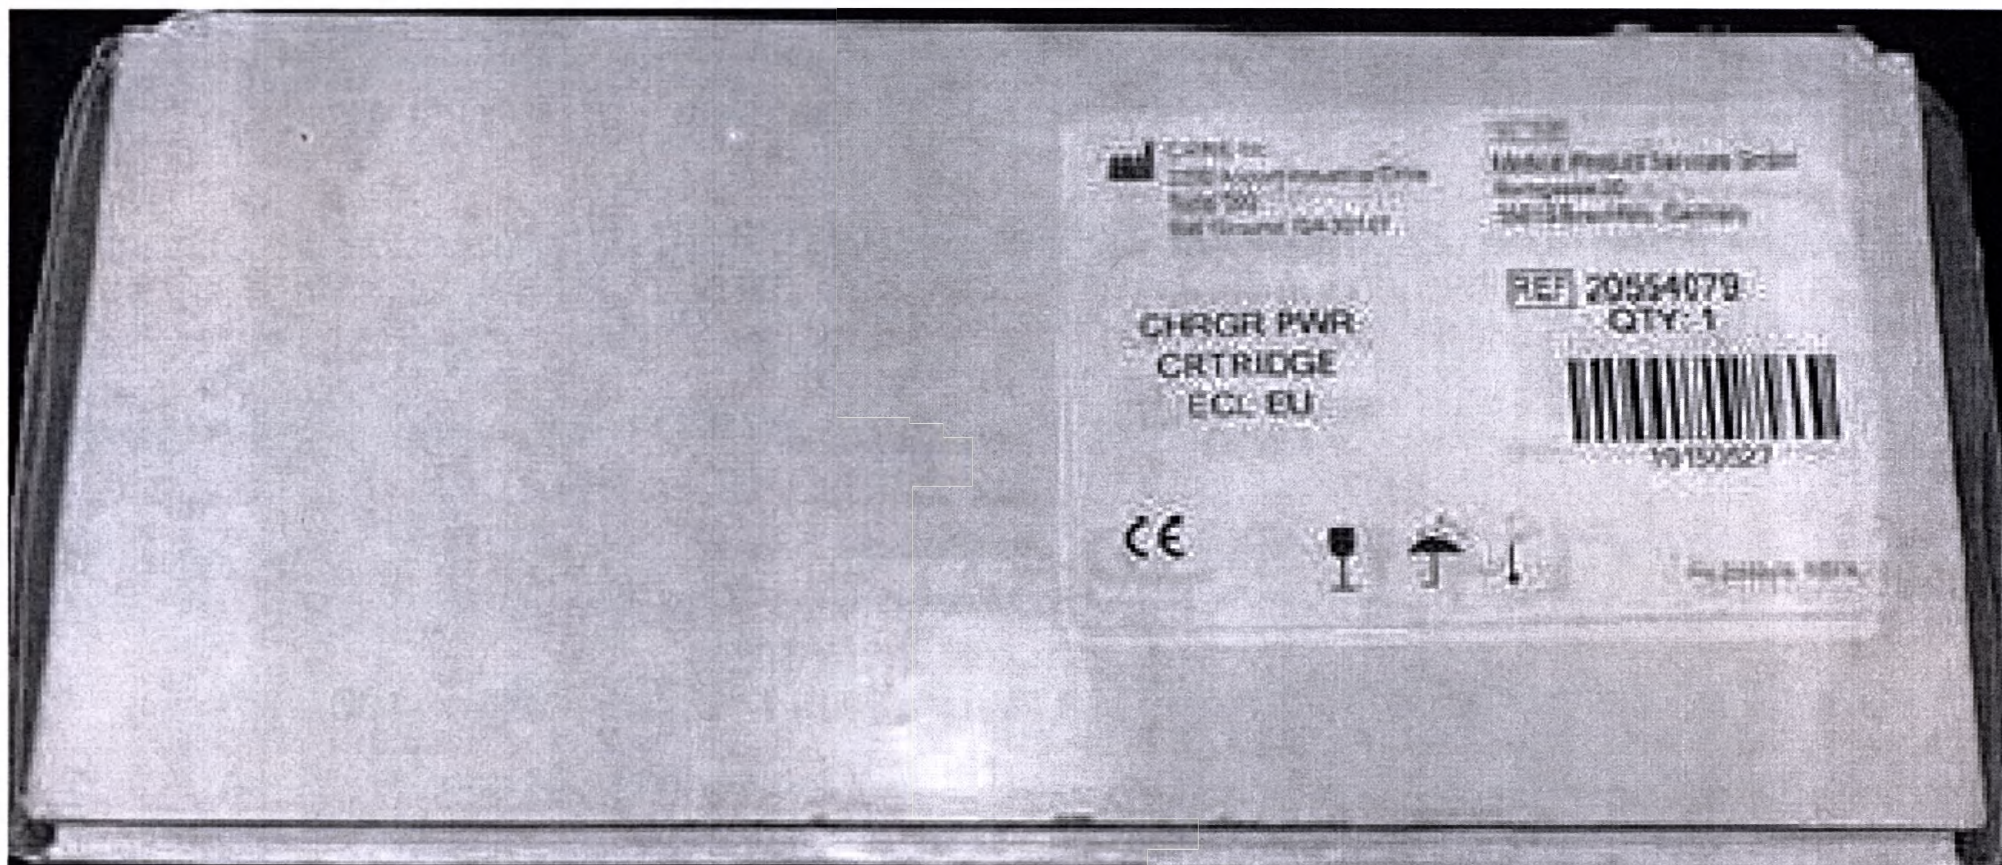


Коробка

Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство настольное, Маркировка индивидуальной упаковки, пример

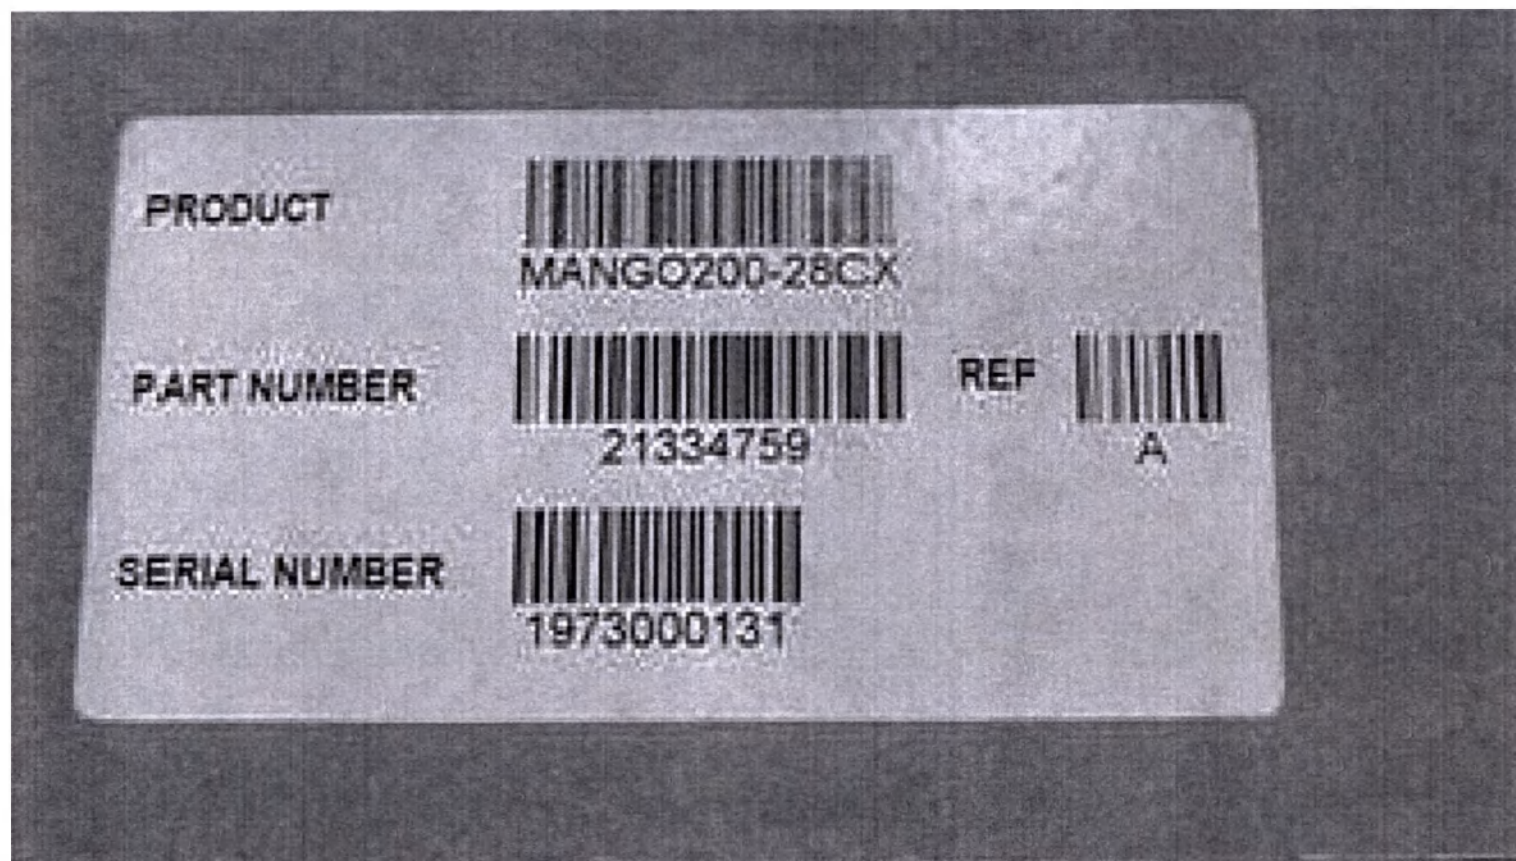

Коробка

Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство универсальное, Маркировка индивидуальной упаковки, пример

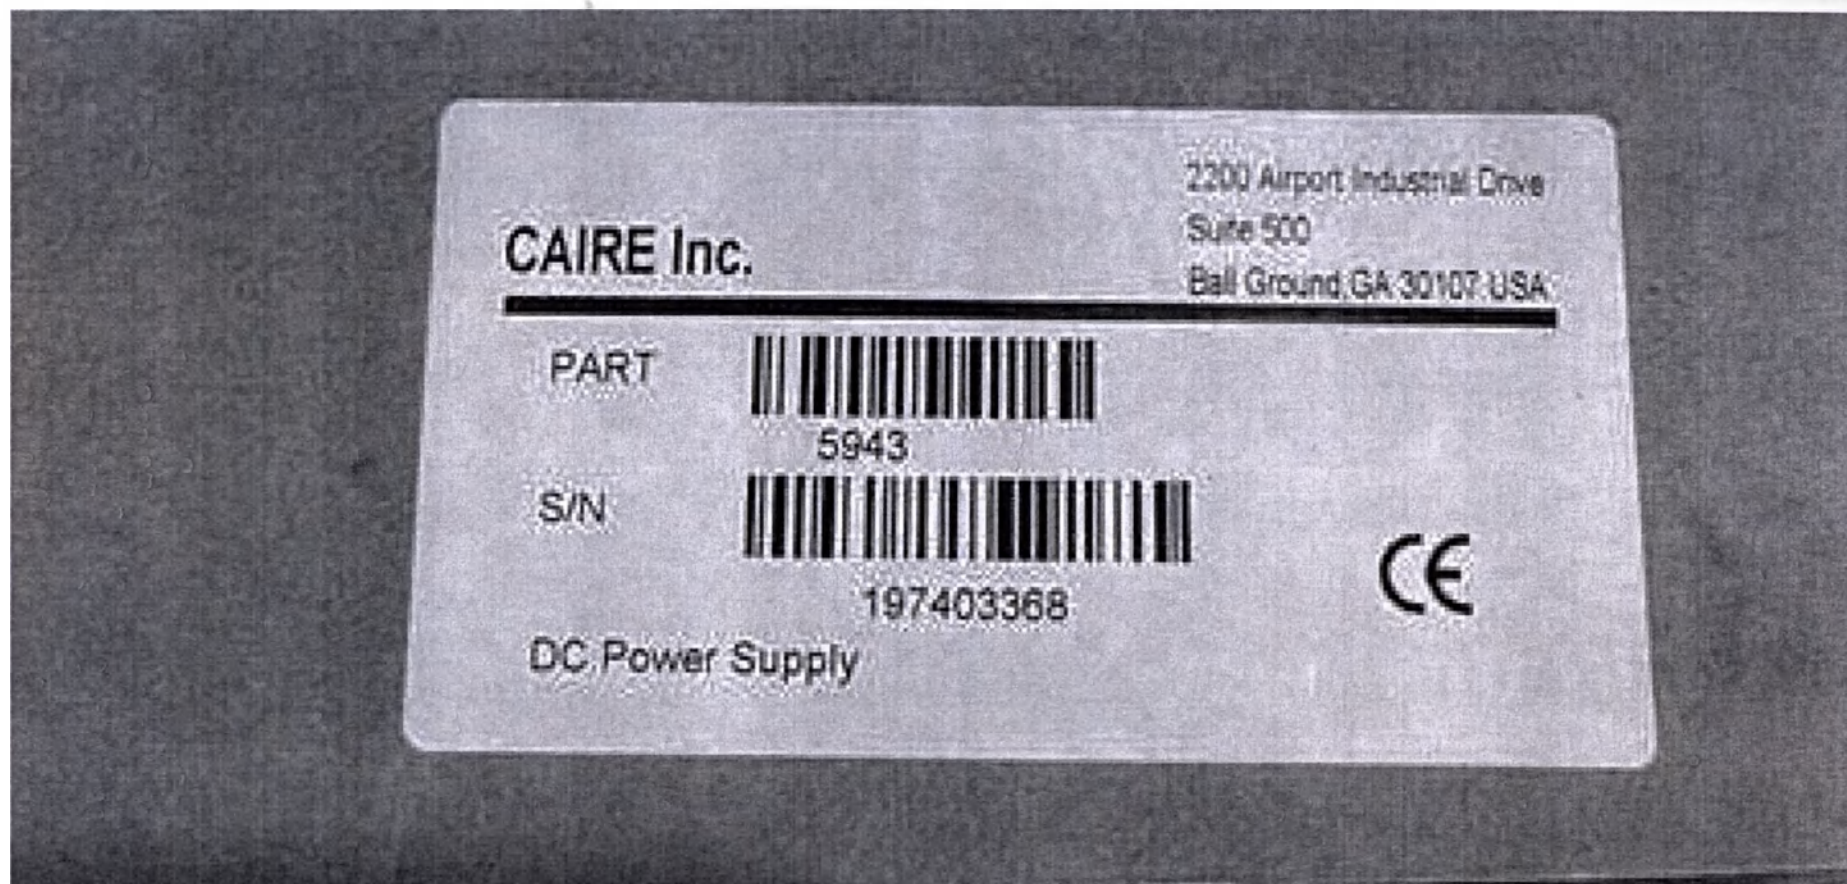

Коробка

Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Зарядное устройство (12В), Маркировка индивидуальной упаковки, пример



Лицевая сторона:



Оборотная сторона:

Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Адаптер-переходник, Маркировка индивидуальной упаковки, пример



Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Маркировка транспортной упаковки, пример - Общий вид


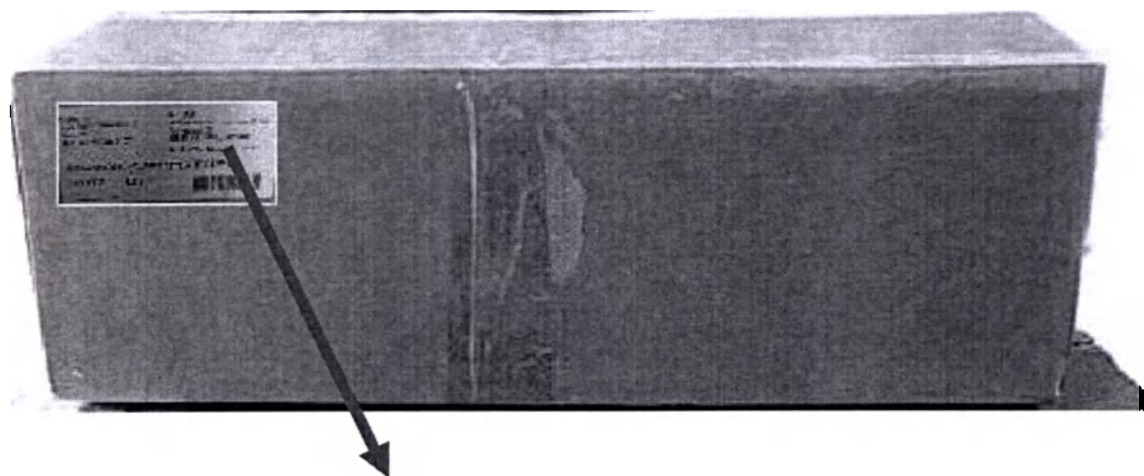


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Маркировка транспортной упаковки, 1 место (пример)

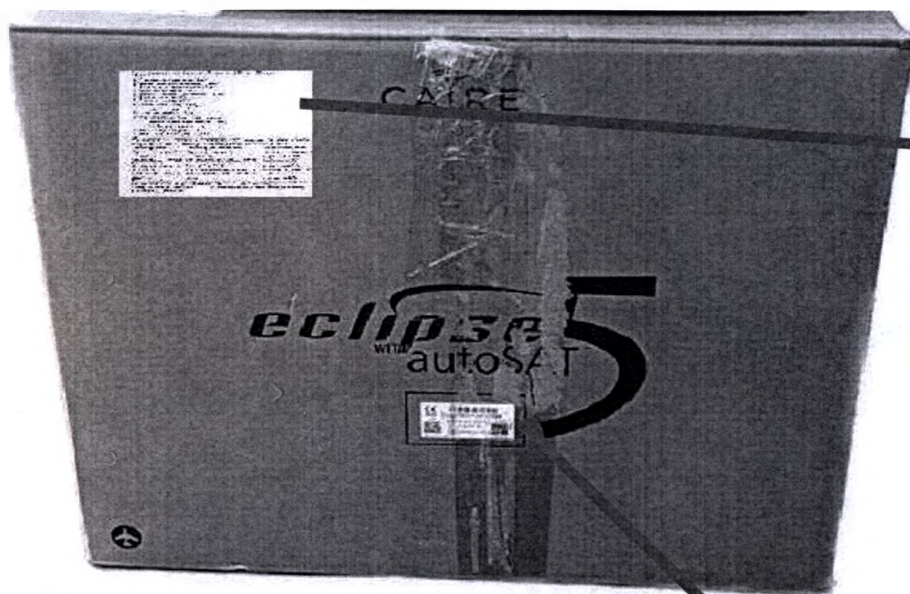

Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями

1. Концентратор кислородный - 1 шт.;
2. Батарея съемная аккумуляторная - 1 шт.;
3. Зарядное устройство настольное - 1 шт.;
4. Тележка транспортная - 1 шт.;
5. Зарядное устройство универсальное - 1 шт.;
6. Зарядное устройство (12В) - 1 шт.;
7. Адаптер-переходник - 1 шт.;
8. Кабель сетевой (220В) - 1 шт.;
9. Руководство пользователя по эксплуатации медицинского изделия - 1 шт.

Принадлежности:

1. Сумка для аксессуаров - 1 шт.;
2. Сумка для переноски - 1 шт.;
3. Защитный чехол - 1 шт.;
4. Адаптер для увлажнителя - 1 уп., в составе:
 - Резинка крепления увлажнителя - 1 шт.;
 - Трубка соединительная - 1 шт.;
5. Фильтр воздухозаборника - 1 шт.;

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «ЛайфКор Интернешнл» 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 13, корп. 3, пом. V.

Условия хранения:	Условия транспортирования:	Условия эксплуатации:
Температура воздуха, °C:	Температура воздуха, °C:	температура и влажность
от -20 до +60	от -20 до +60	окружающей среды:
Влажность воздуха	Влажность воздуха (относительная), без	от +10° C до +40° C
(относительная), без	образования конденсата, %: не более 95	Влажность воздуха
образования конденсата, %:	(при 25 °C)	(относительная), без
от 0 до 95	Атмосферное давление, кПа: 90 ± 15	образования конденсата, %:
Атмосферное давление,	Продолжительность не больше 48 часов	10 - 95% при температуре
кПа: 90 ± 15		28°C

Концентратор Эклипс 5 подлежит утилизации в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.3684-21 по классу Б.

Регистрационное удостоверение № ***** Дата ***** Знак подтверждения соответствия (при наличии)

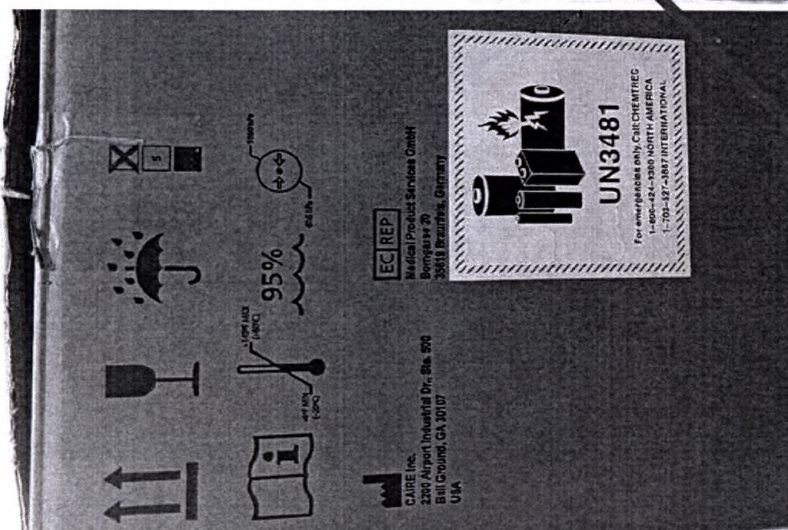


Фото	Концентратор кислородный медицинский портативный Eclipse 5 (Эклипс 5) с принадлежностями
	Маркировка транспортной упаковки, 2 место (пример)

Сшито и заверено печатью 33
(тридцать три) лист 9

ООО «ЛайфКор Интернешнл»
Генеральный директор
Дрыго С.В.

