

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ДЕМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС»




А.А. Иващенко

«04» марта 2024 г.


Фотографические изображения общего вида и макета маркировки медицинского изделия

Упаковочный материал для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-004-76420288-2023


1. Крепированная бумага стандартная DGM Steriguard в листах.

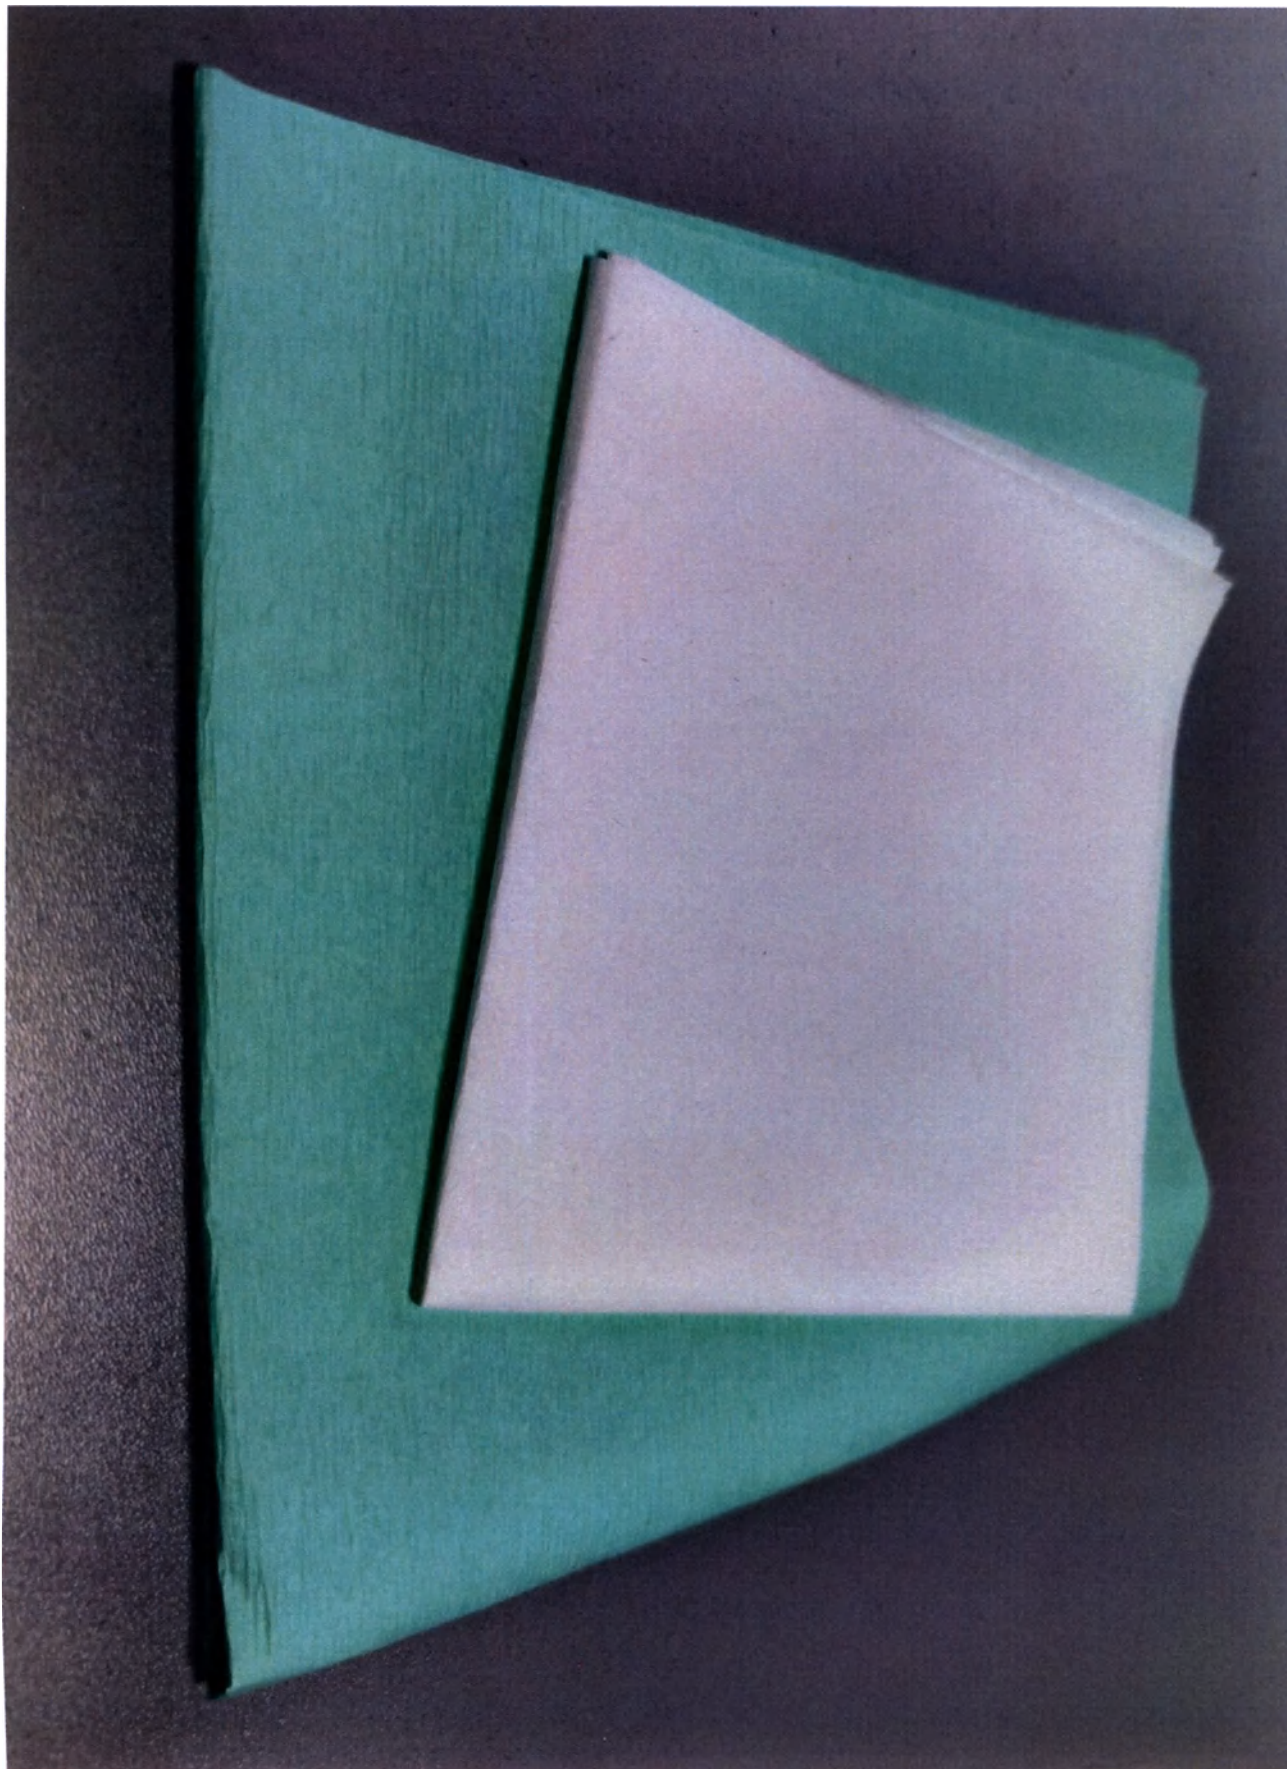

2. Крепированная бумага мягкая DGM Steriguard в листах.

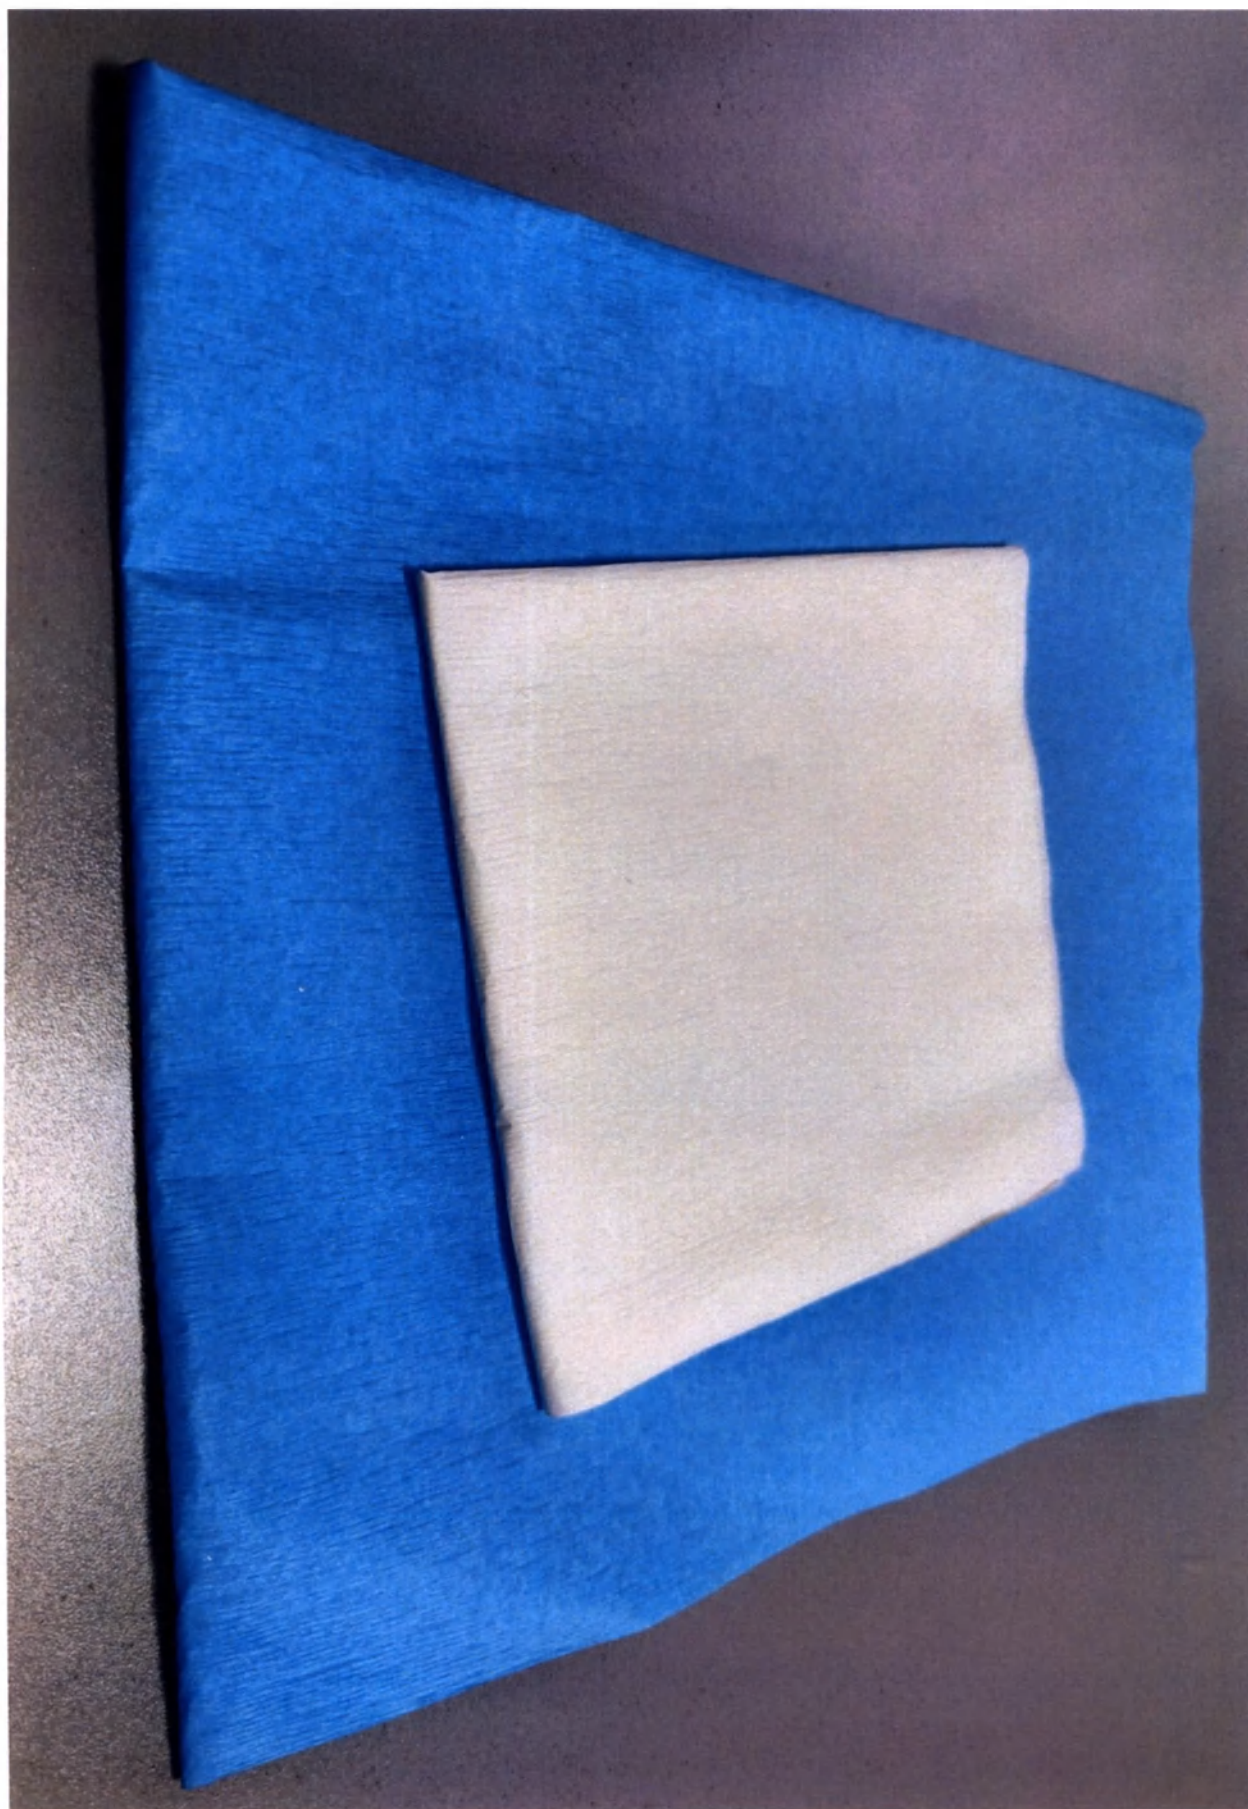

3. Крепированная бумага усиленная DGM Steriguard в листах

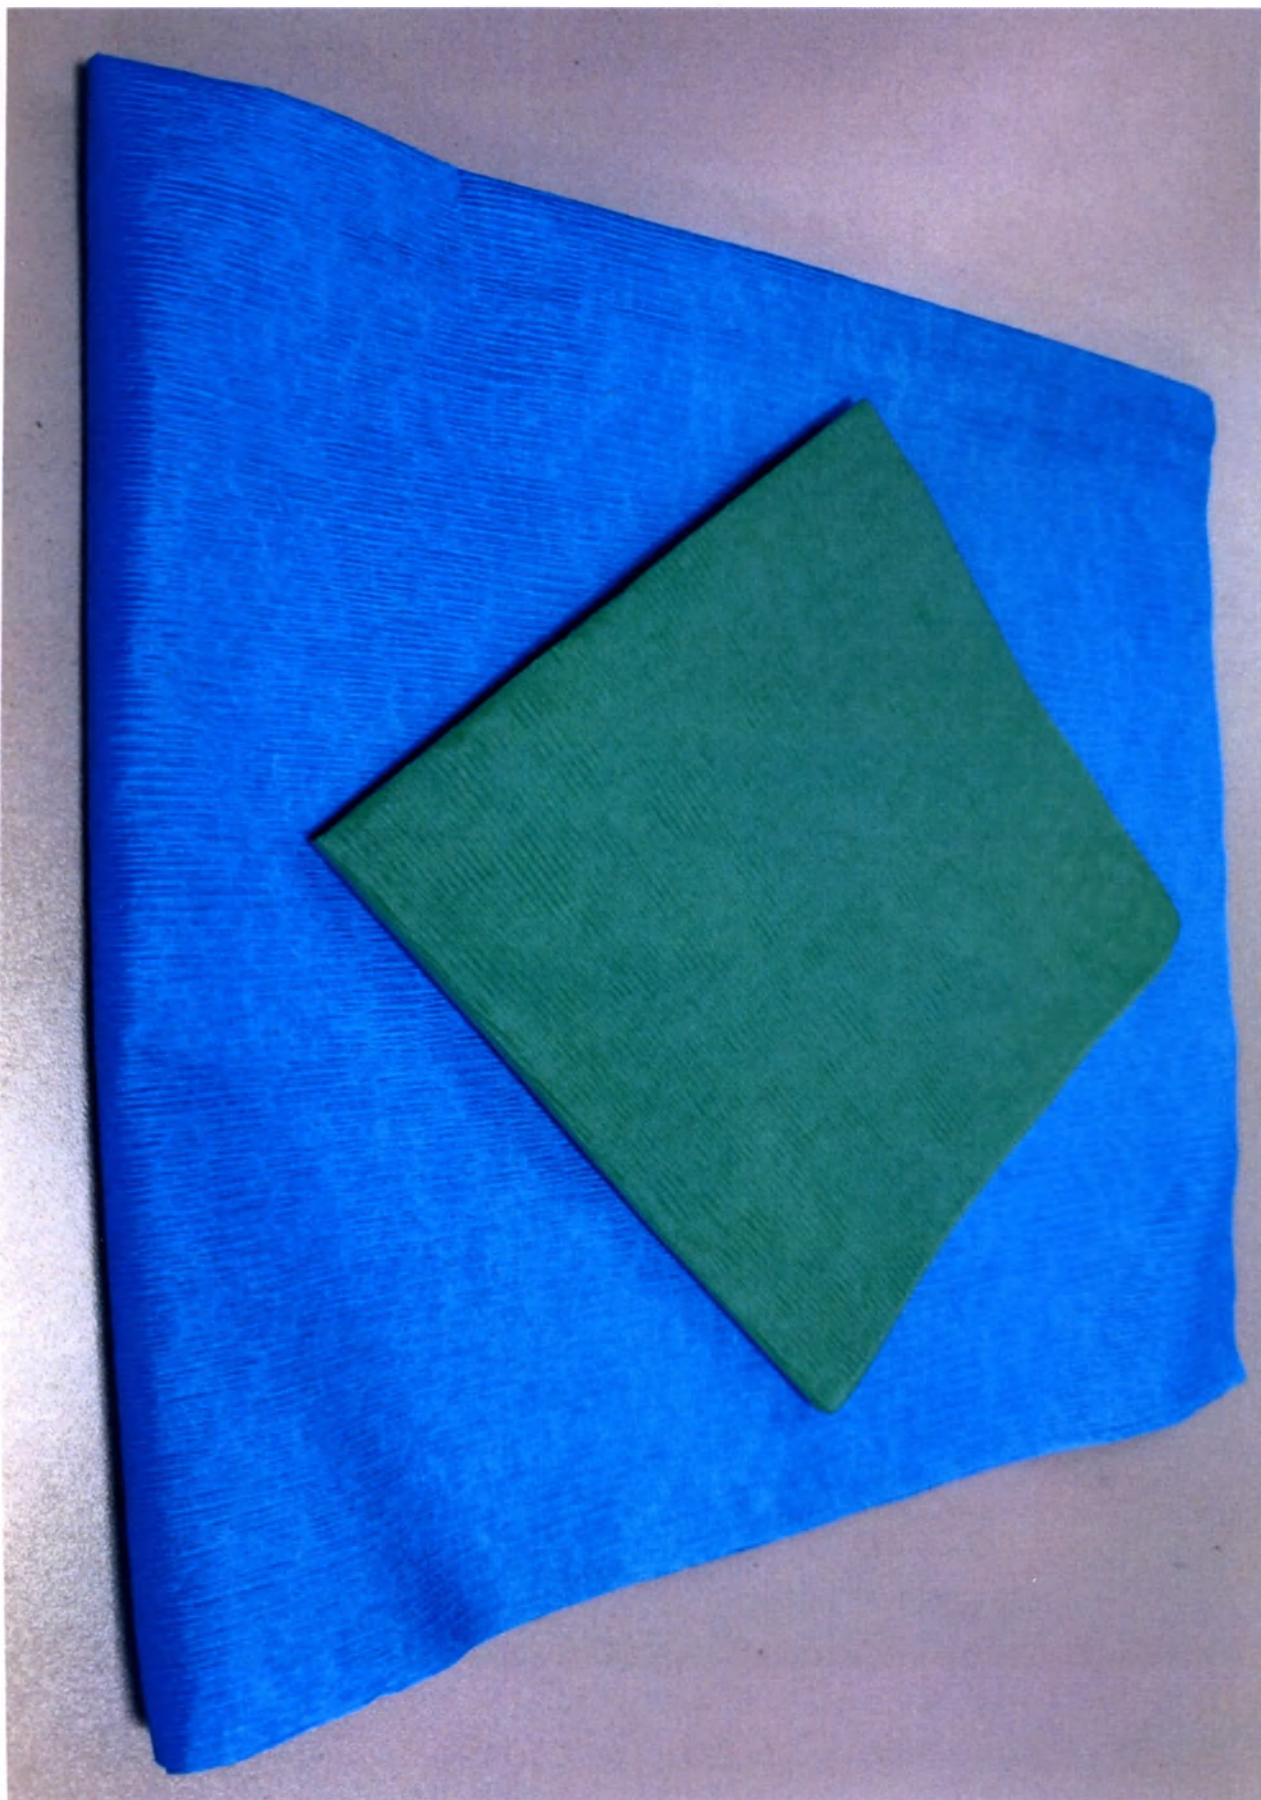

4. Крепированная бумага стандартная DGM Steriguard в рулонах



5. Крепированная бумага мягкая DGM Steriguard в рулонах.




6. Крепированная бумага усиленная DGM Steriguard в рулонах







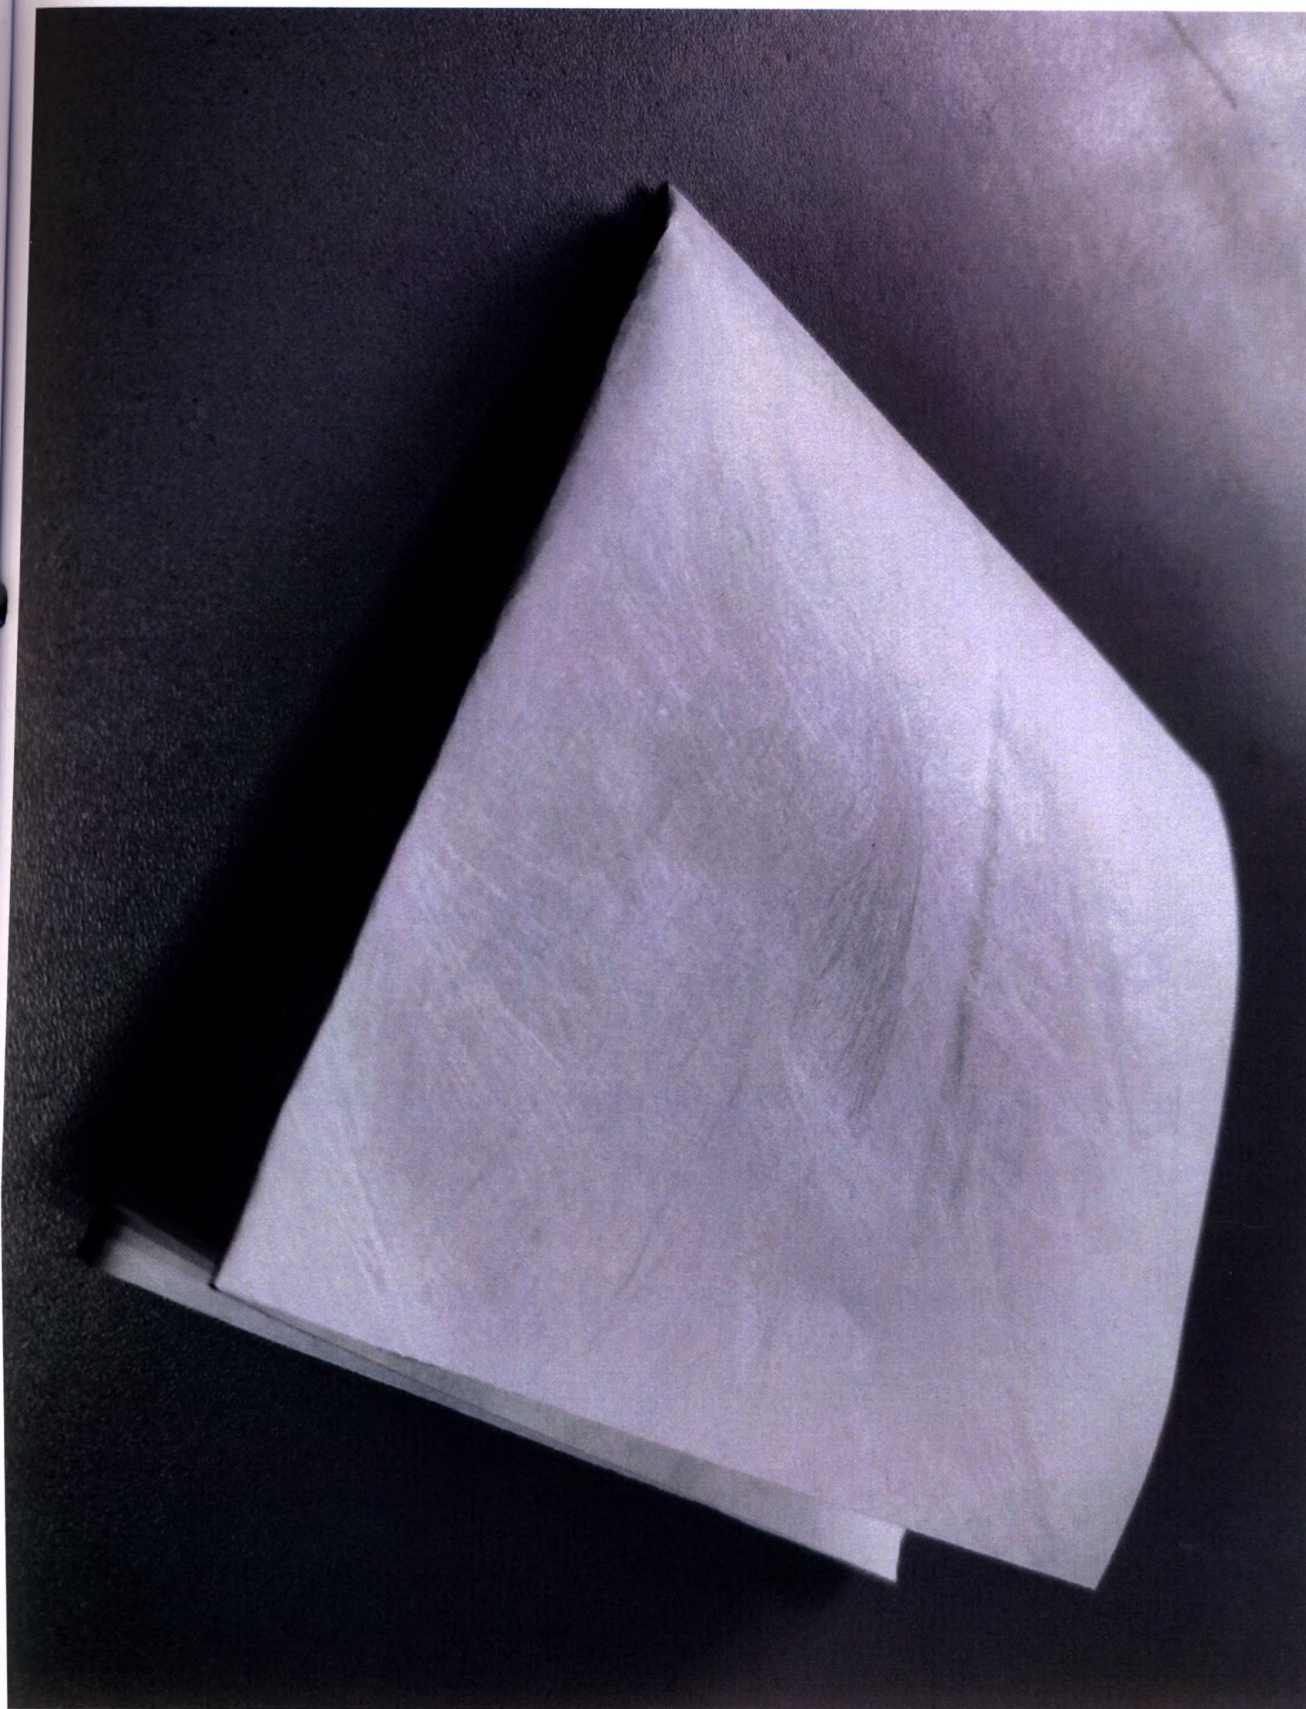


10. Материал Tyvek/Тайвек DGM Steriguard в рулонах









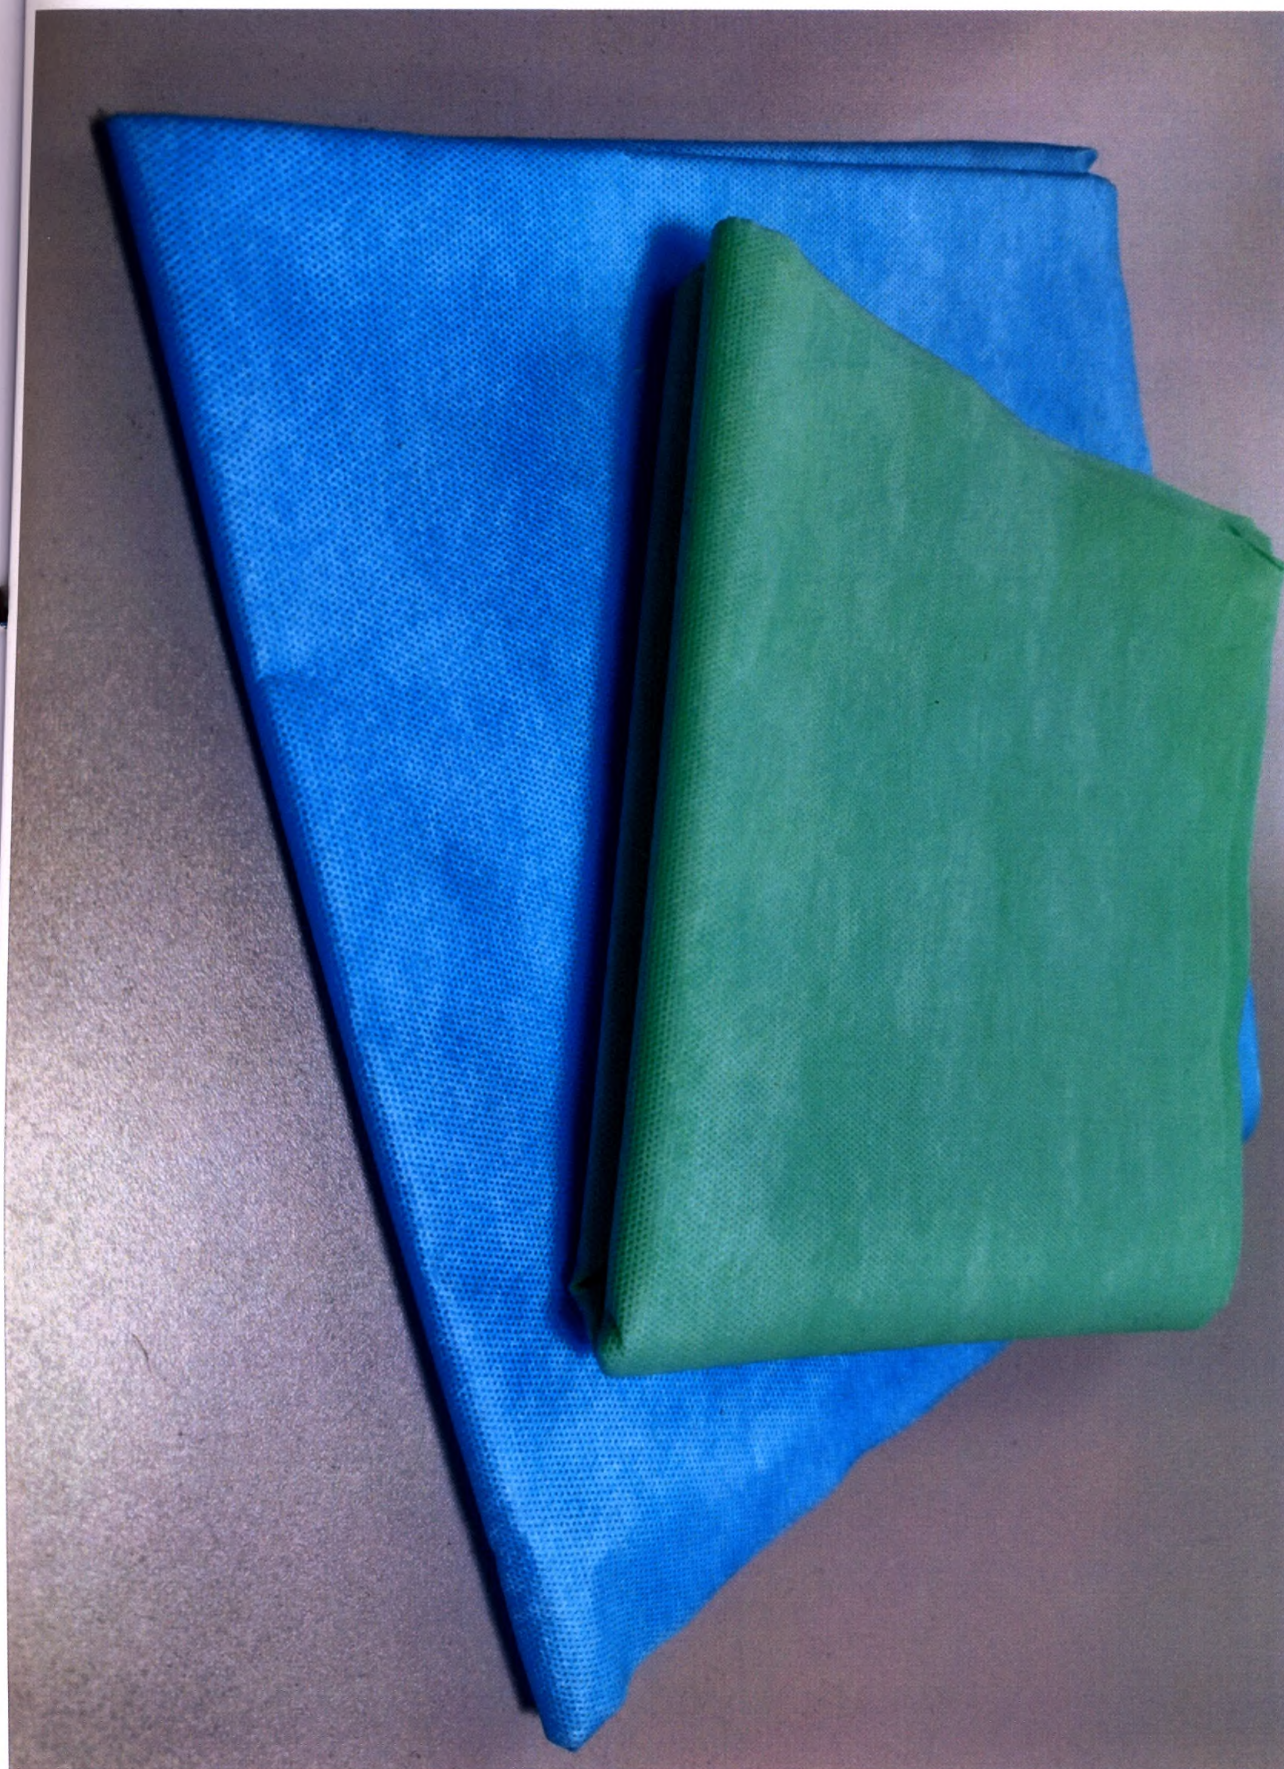



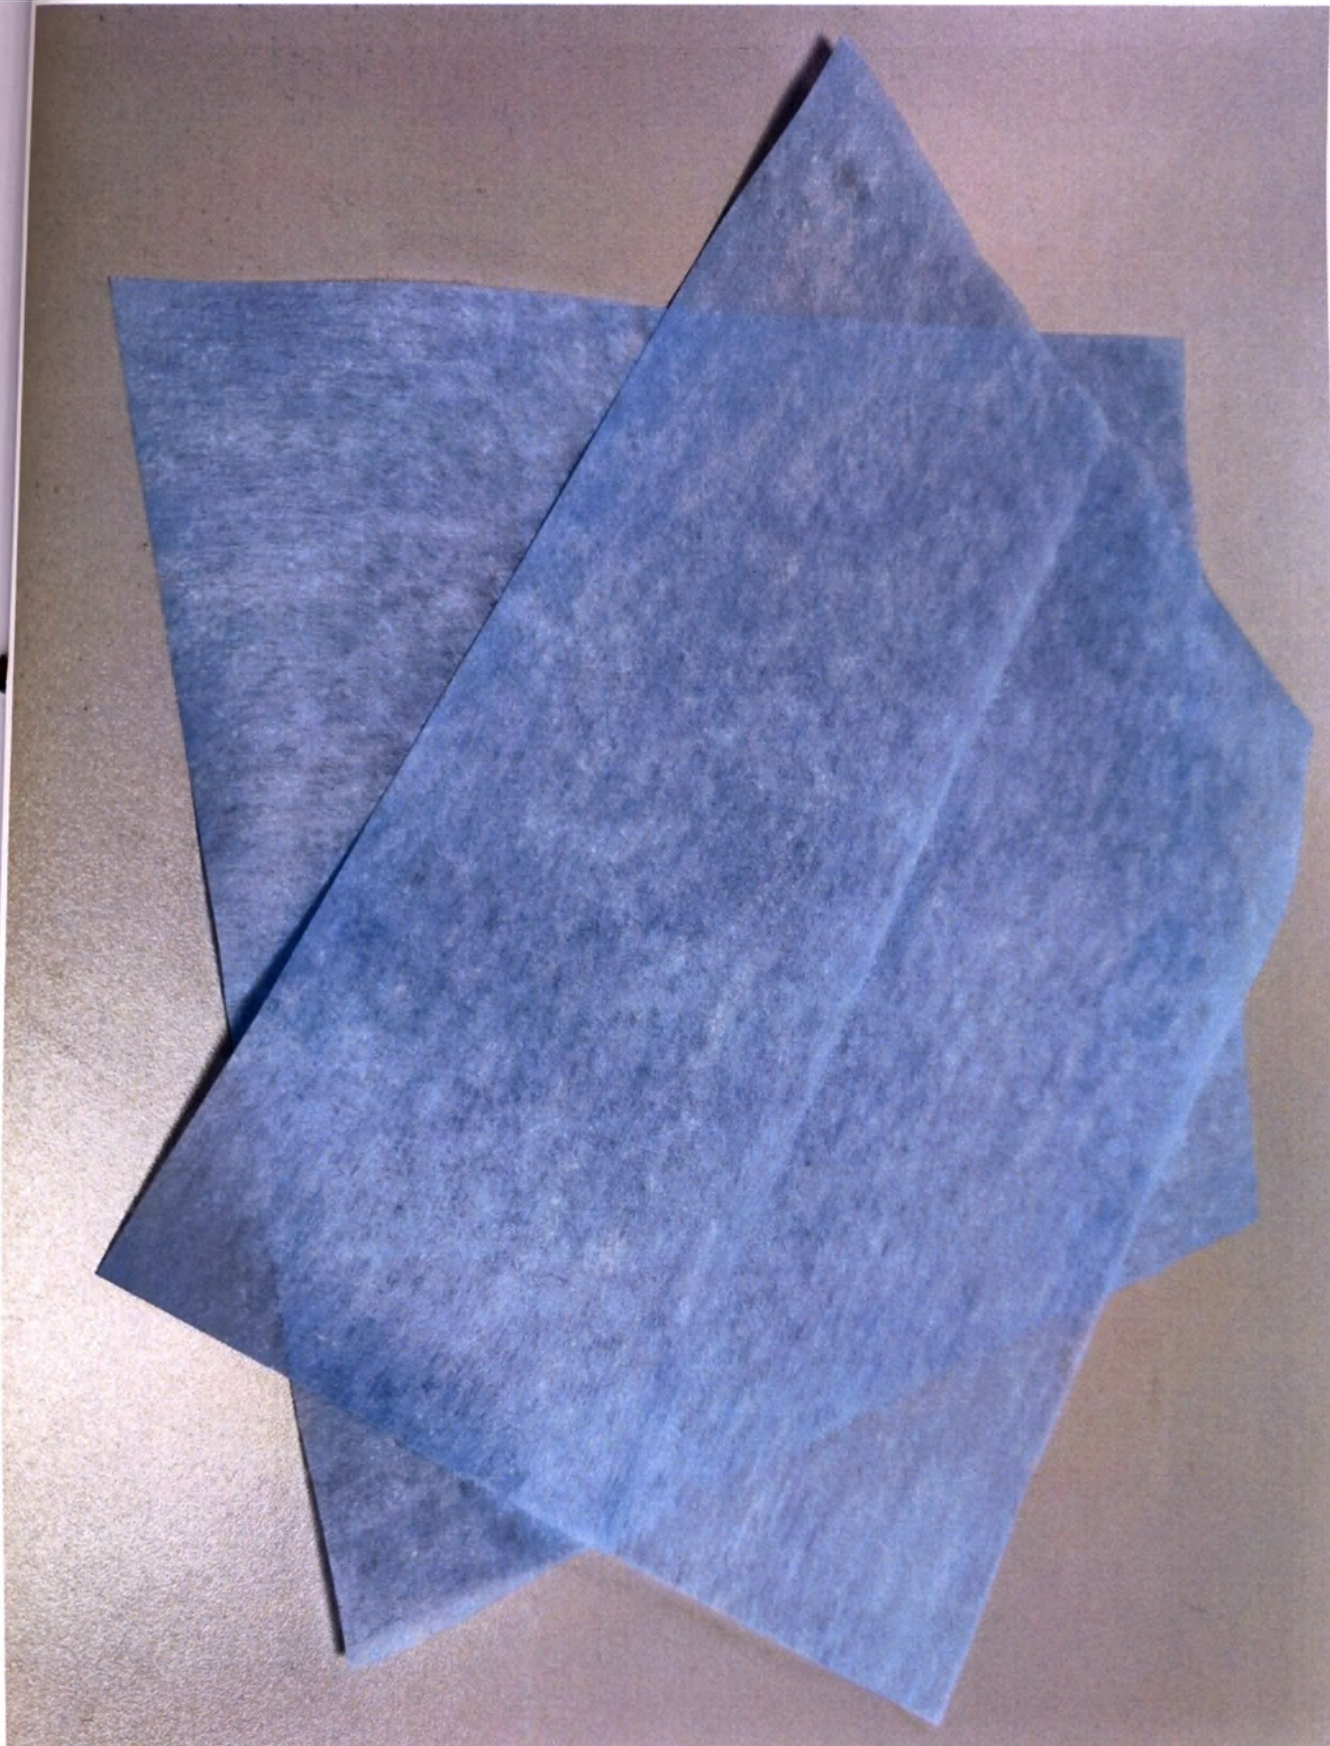


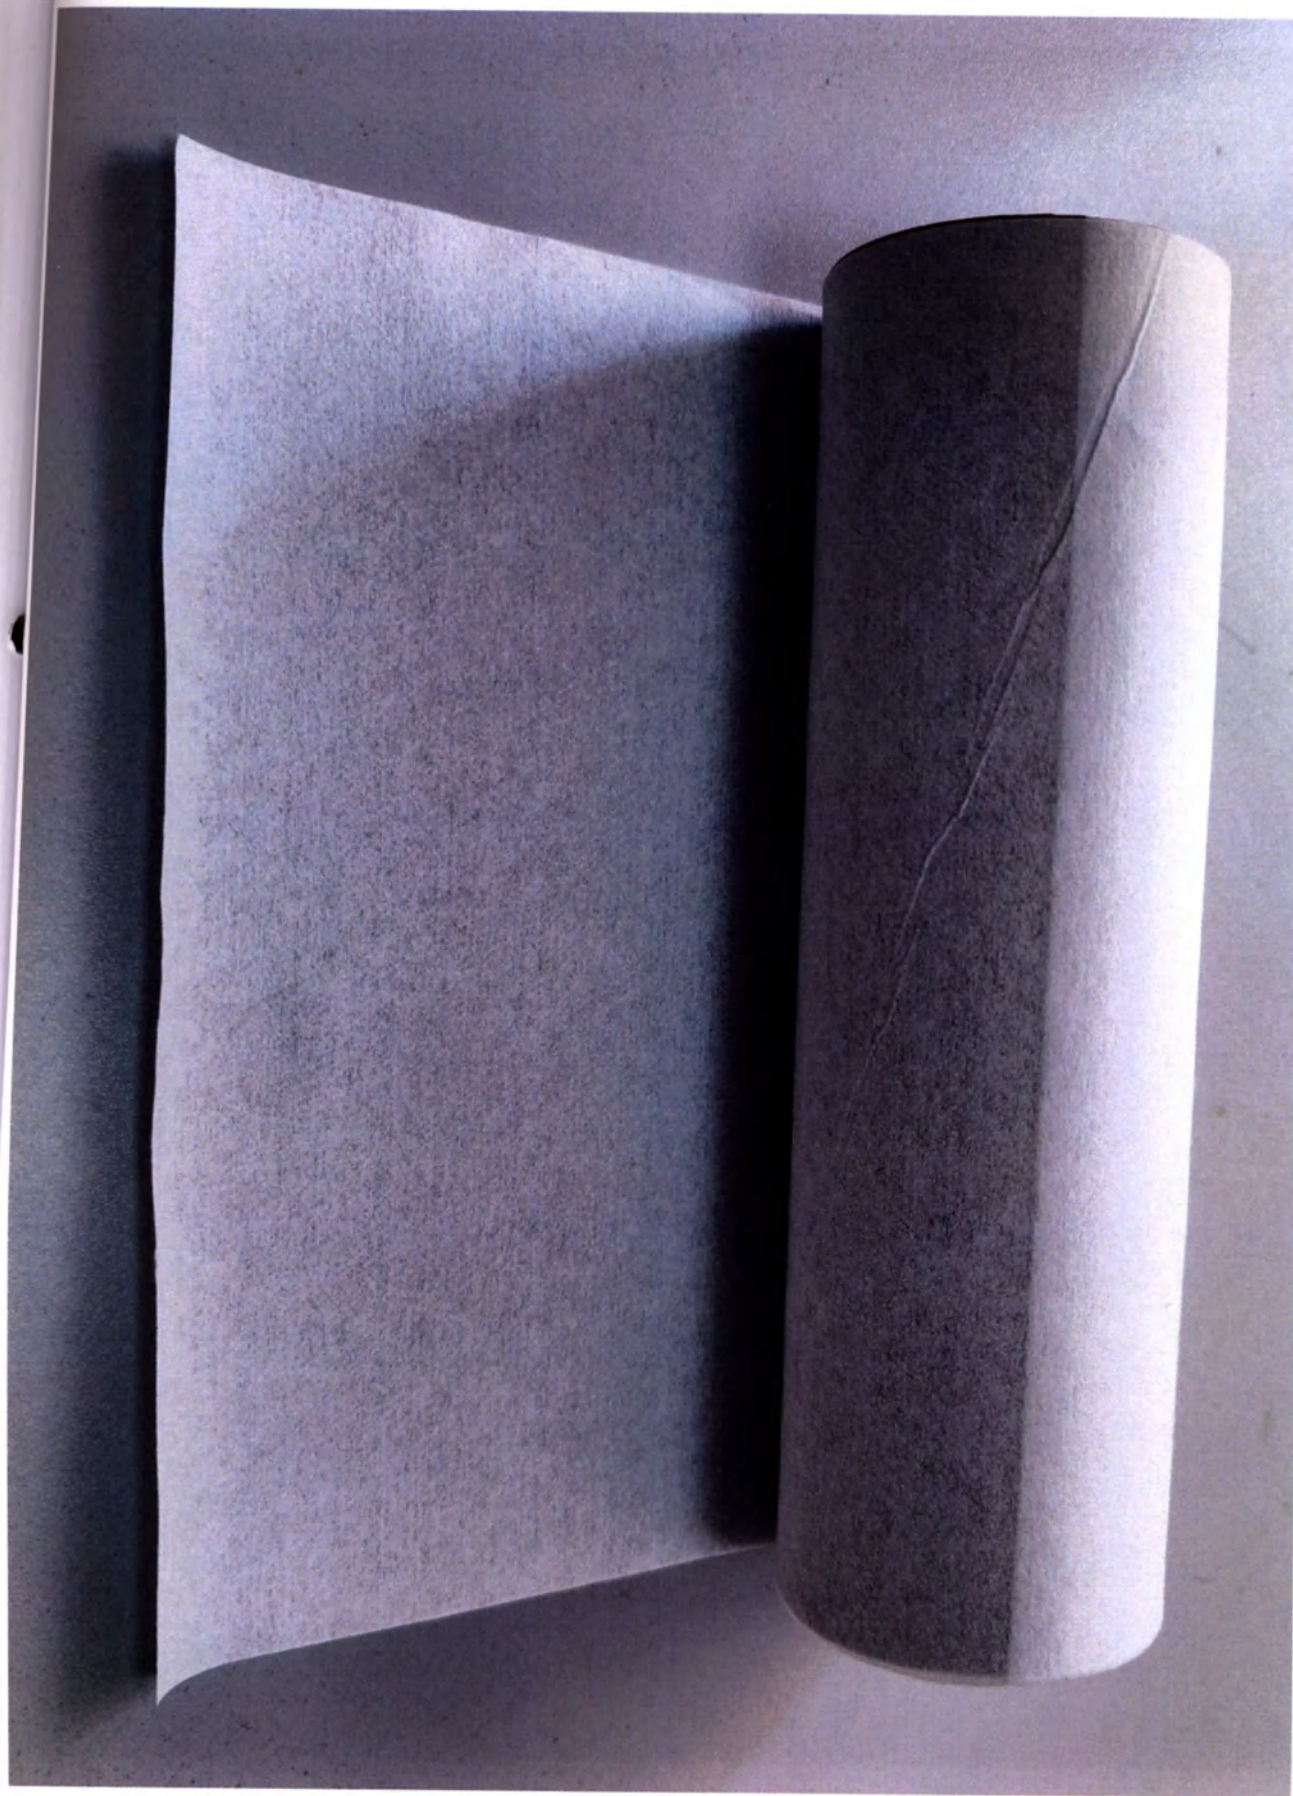







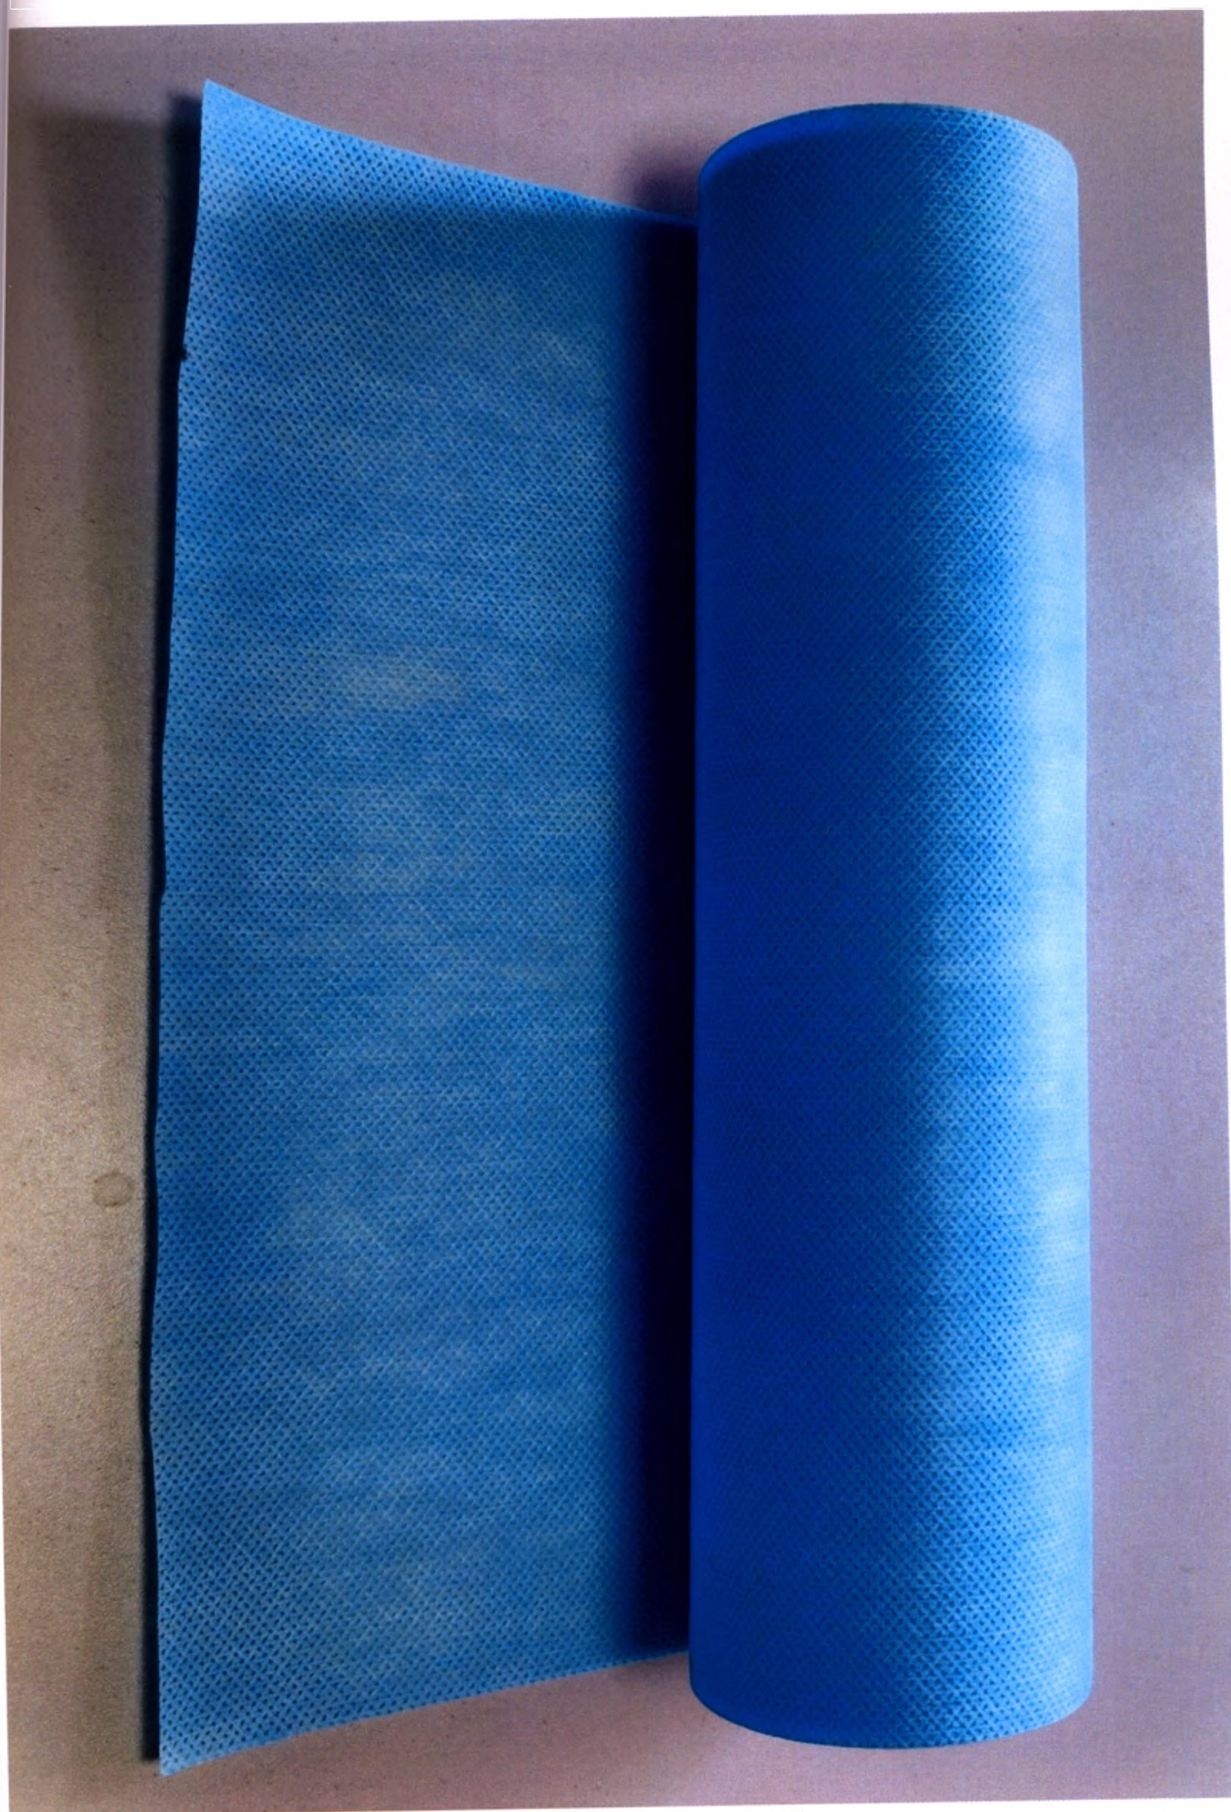









Место нанесения штрих кода/ QR-cod	DGM Steriguard РУ № РЗН от г.
 ****  ****  **** Место штампа ОТК	Упаковочный материал для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-004-76420288-2023,  ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Произведено в России Метод стерилизации Кол-во изделий: *** шт.
      	

Макет транспортной маркировки

Наименование изделия	 Упаковочный материал для стерилизации DGM Steriguard по ТУ 32.50.50-004-76420288-2023
Количество изделий	
	ООО «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС», Россия, 121353, город Москва, ш. Сколковское, д. 25, стр. 1, этаж 2 офис 34 Произведено в России
	
	XX.XX.XX
	XX.XX.XX
Кол-во изделий	*** шт.
Метод стерилизации	
Условия хранения	Хранение упаковочных материалов должно производиться при температуре от +5 °С до + 40 °С и относительной влажности воздуха от 20 % до 80 % без образования конденсации, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
	

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 28 лист(ов)

Генеральный директор ООО "ДГМ ФАРМА-
АППАРАТЕ РУС"

Ивашенко А.А.

"09" 05 2022 г.

