

«УТВЕРЖДАЮ»

Менеджер программ по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

Ю.Н. Дорофеева

«01» апреля 2024 г.



Фотографические изображения

«Томограф компьютерный Revolution Ascend с принадлежностями»

Производства:

«ДжиИ Хэлскеа Джапан Корпорейшн», Япония (GE Healthcare Japan Corporation),

7-127, Asahigaoka 4-chome, Hino-shi, Tokyo 191-8503, Japan



Рис. 2. Транспортная упаковка (стол для пациента VT1700V (GT1700V) или VT2000 (GT2000) или VT2000x (GT2000x))

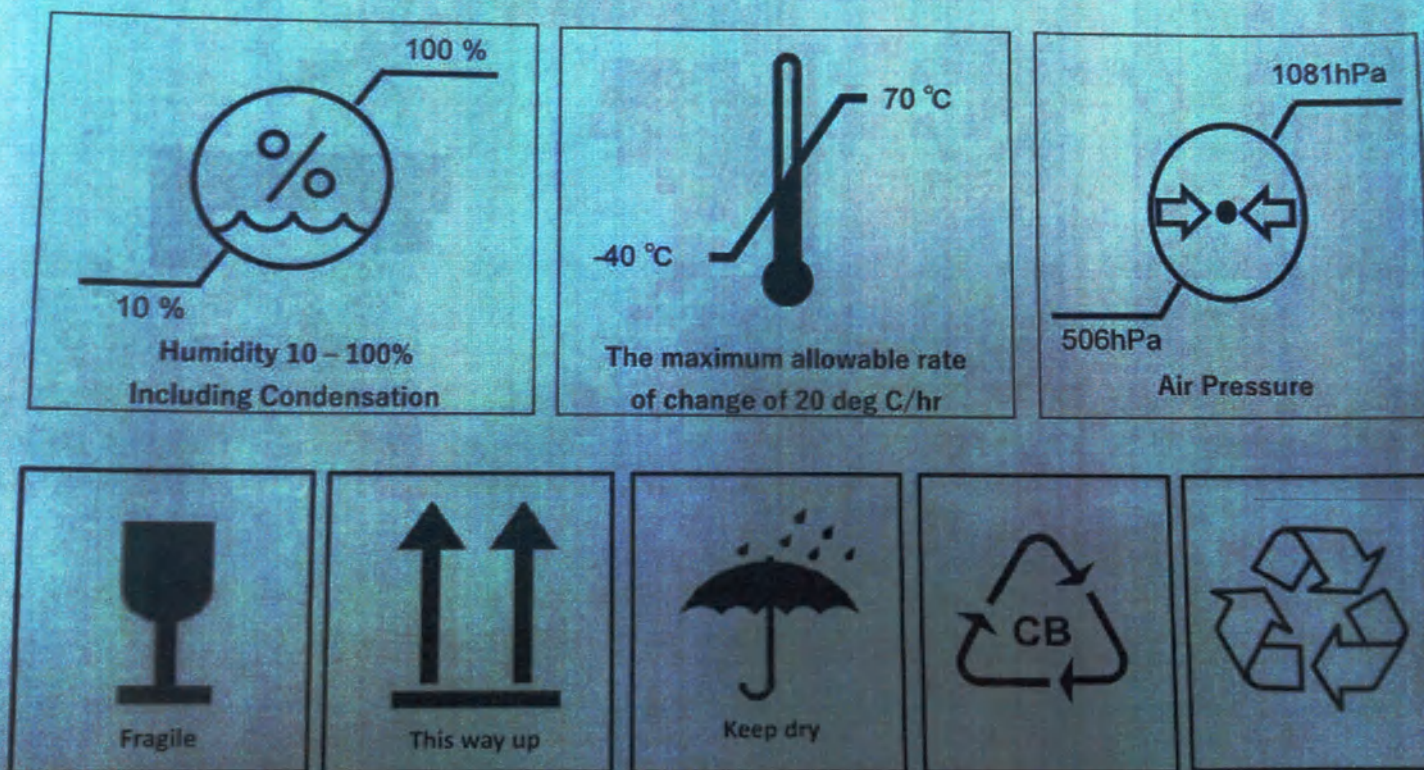


Рис. 4. Маркировка на транспортной упаковке

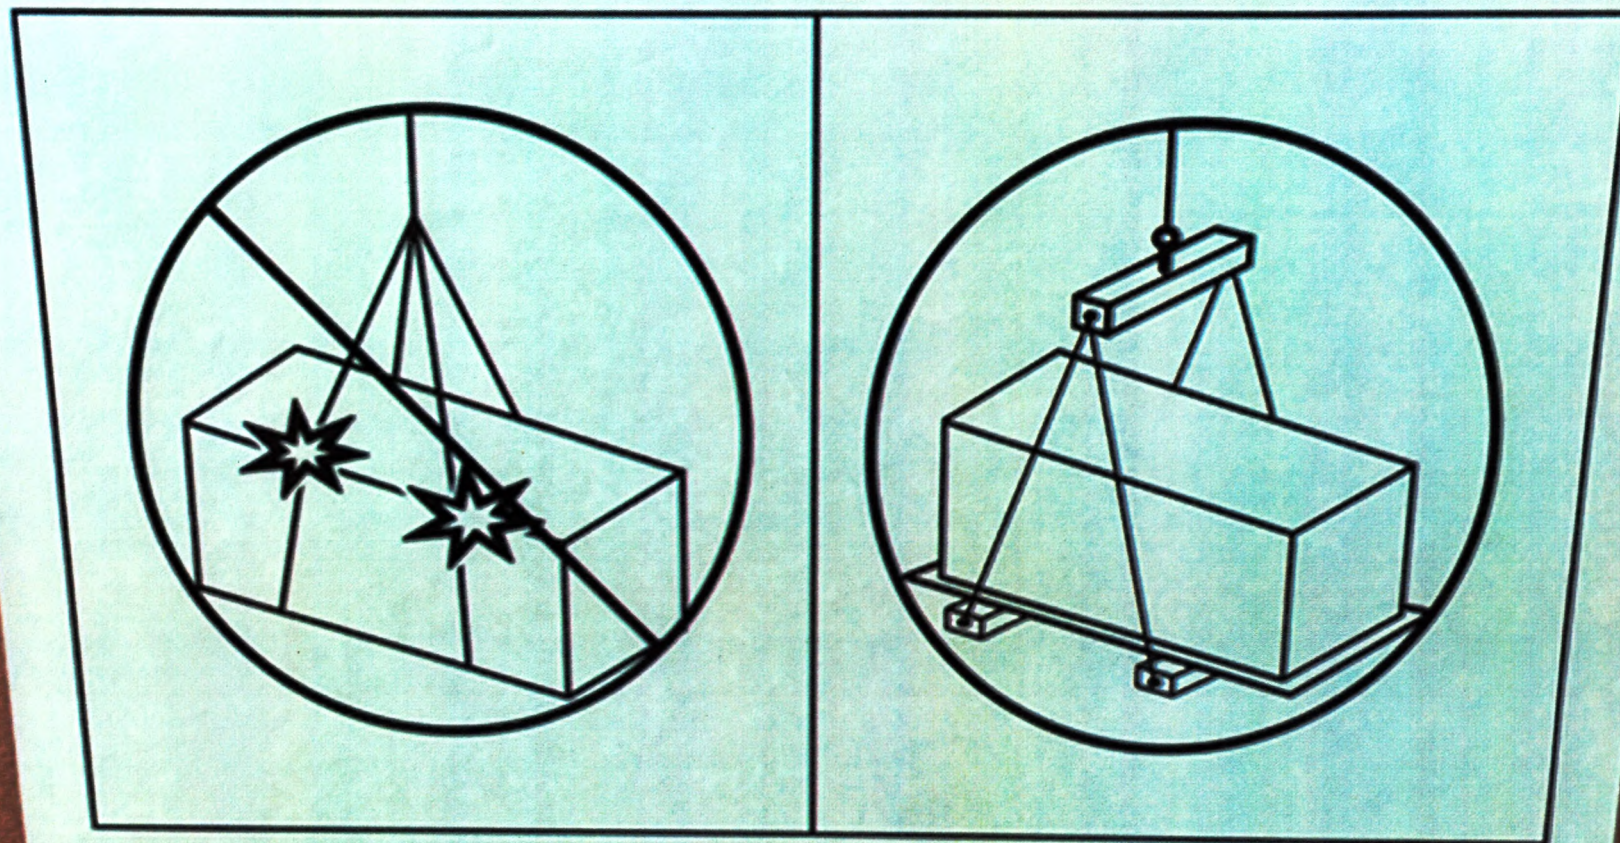


Рис. 5. Маркировка на транспортной упаковке



Рис. 6. Гентри для сканирования – 1 шт.

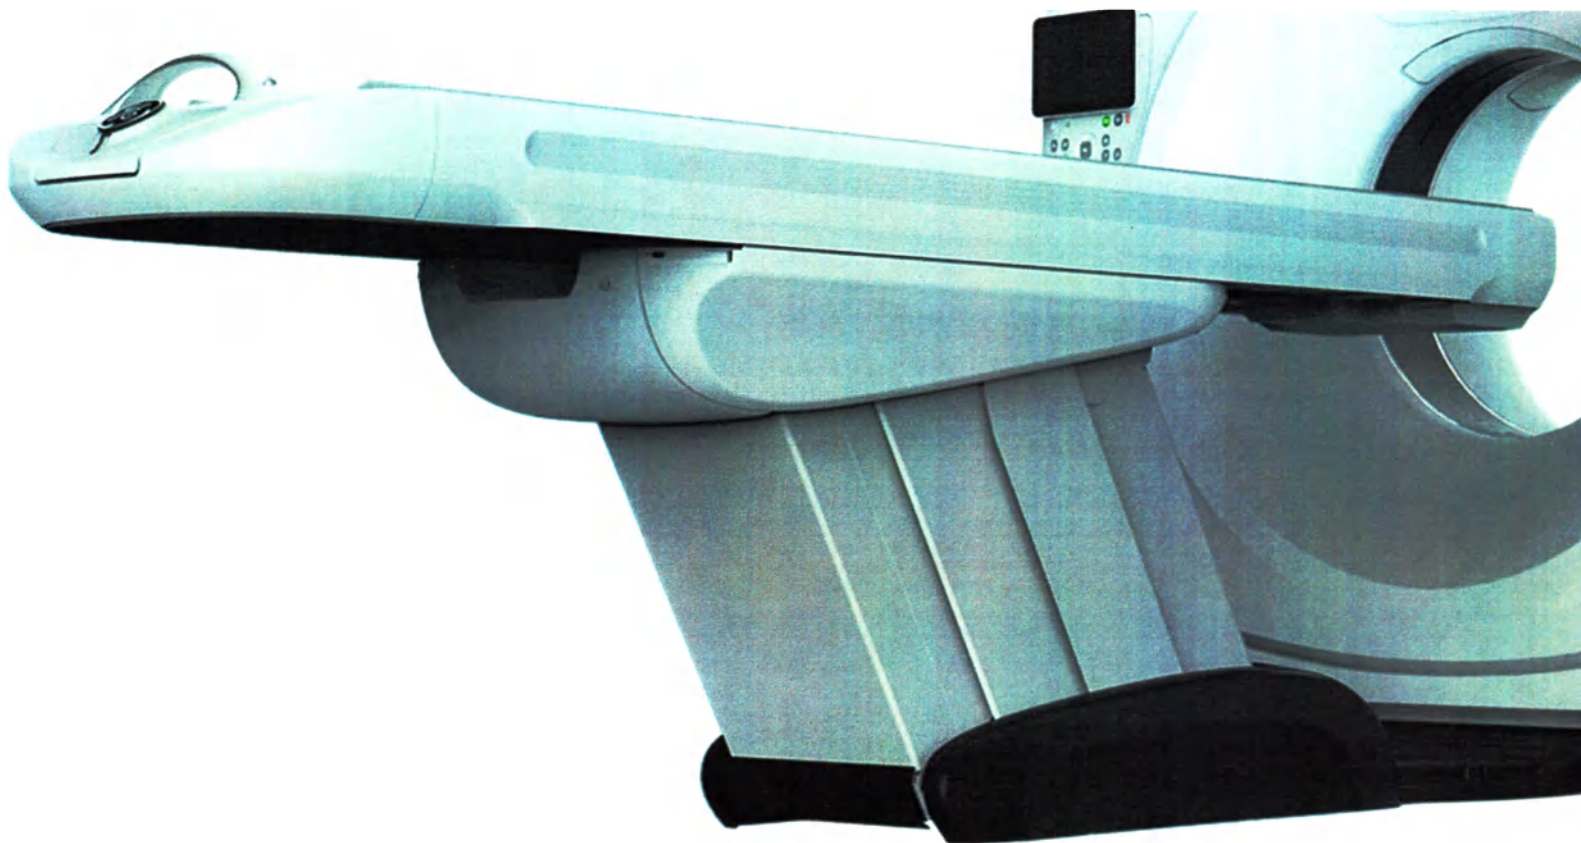


Рис. 7. Стол для пациента VT1700V (GT1700V), или VT2000 (GT2000), или VT2000x (GT2000x) – 1 шт.



Рис. 8. ЖК-мониторы – не более 12 шт. (при необходимости).

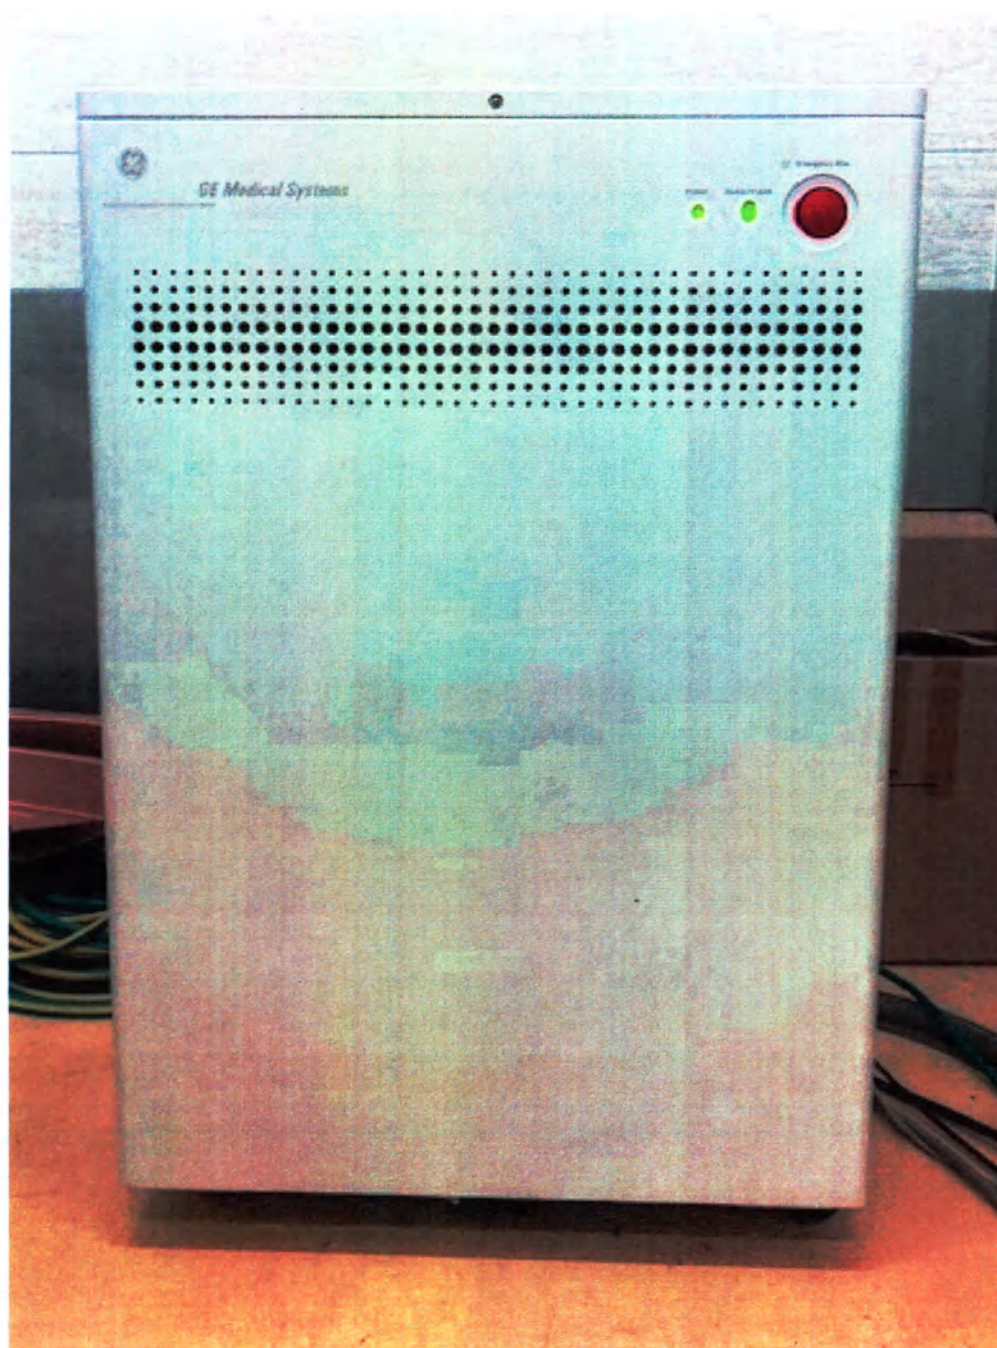


Рис. 9. Силовое распределительное устройство питания – 1 шт. (при необходимости).



Рис. 10. Консоль управления – 1 шт.



Рис. 11. Блок питания консоли – не более 2 шт. (при необходимости)

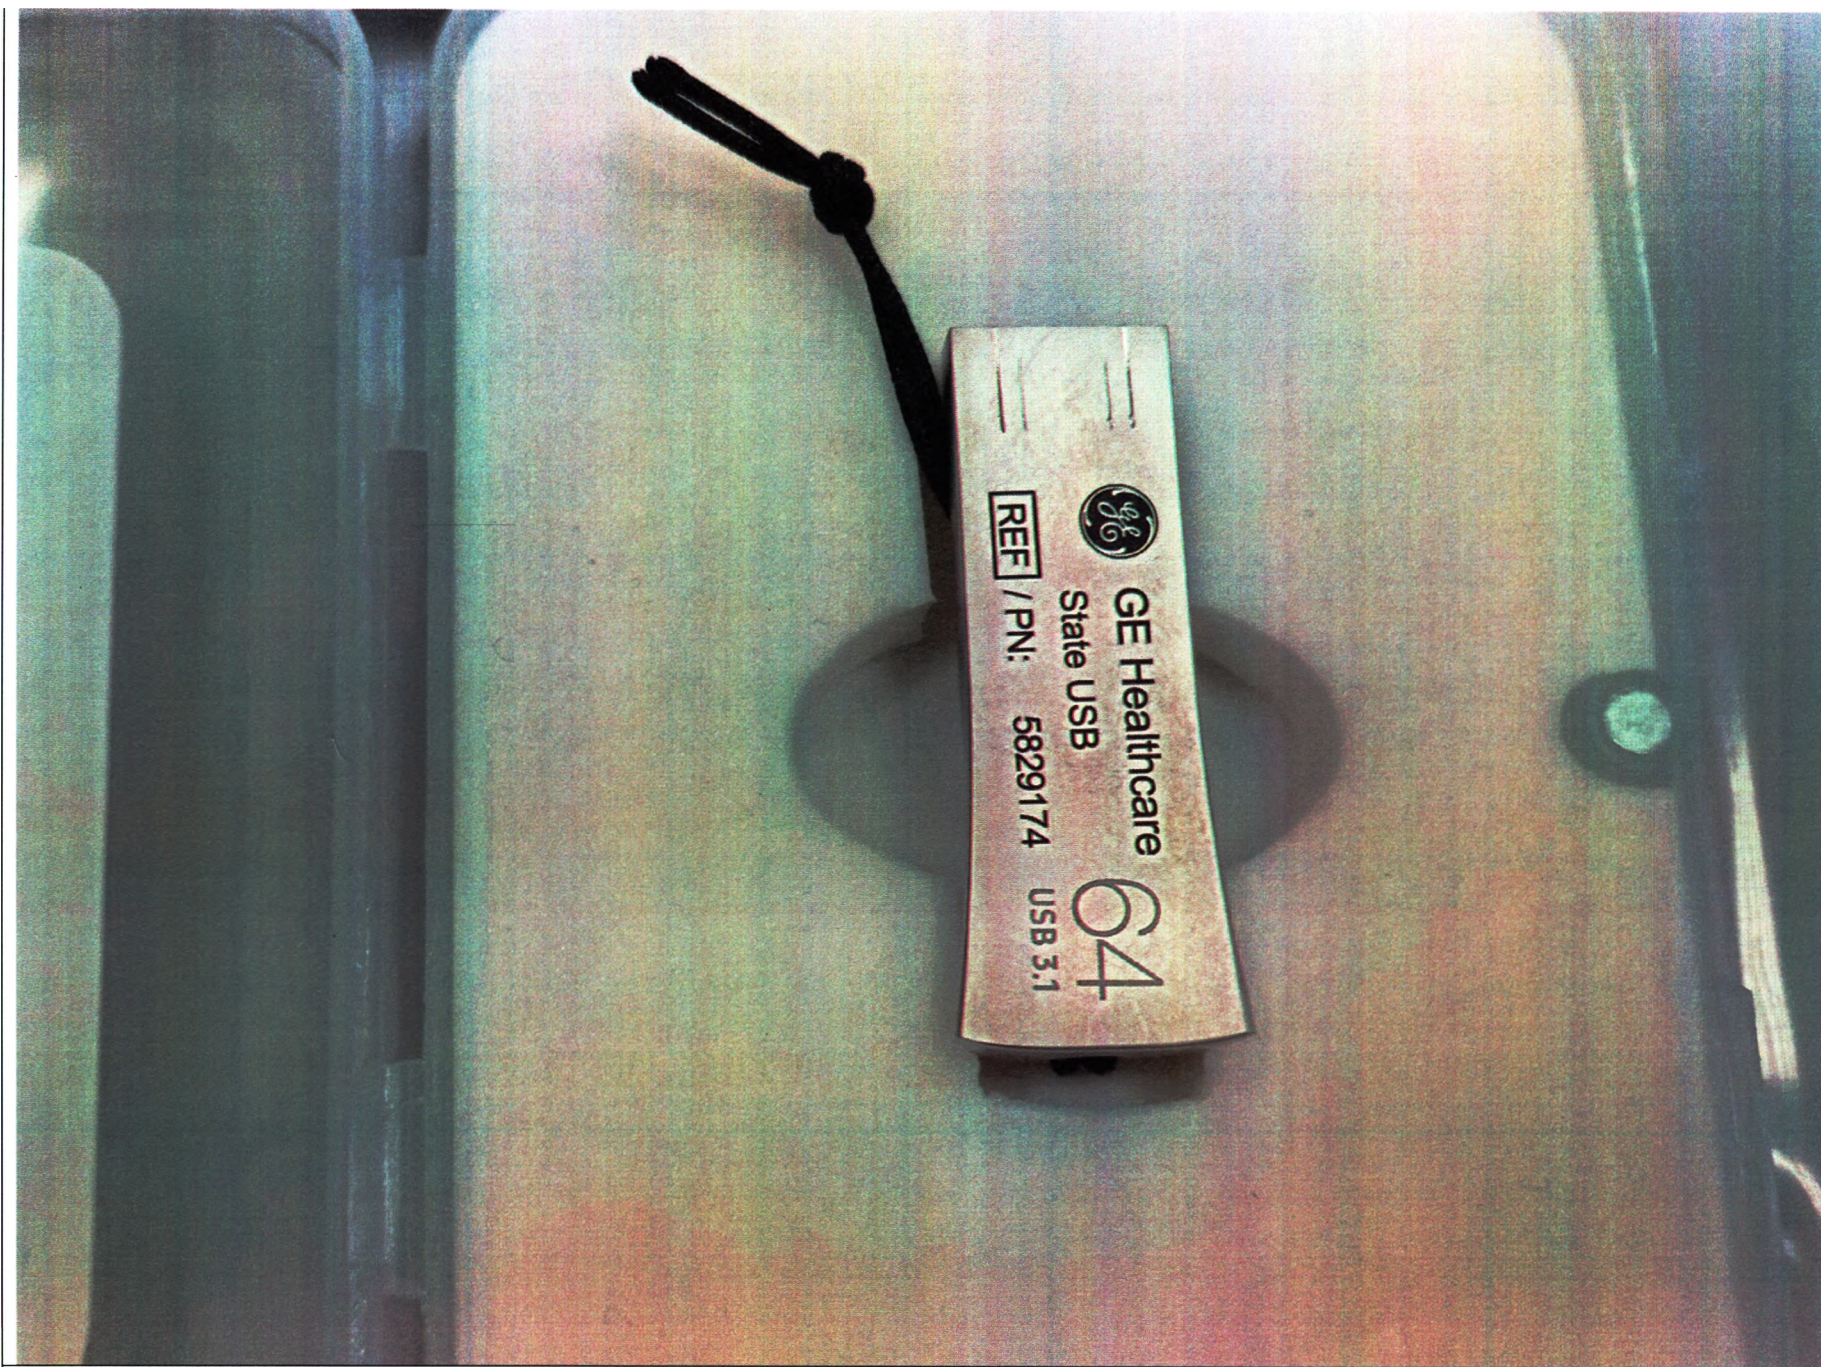


Рис. 12. Документация эксплуатационная - не более 10 шт.



Рис. 13. Пульт управления оператора – 1 шт. (при необходимости).

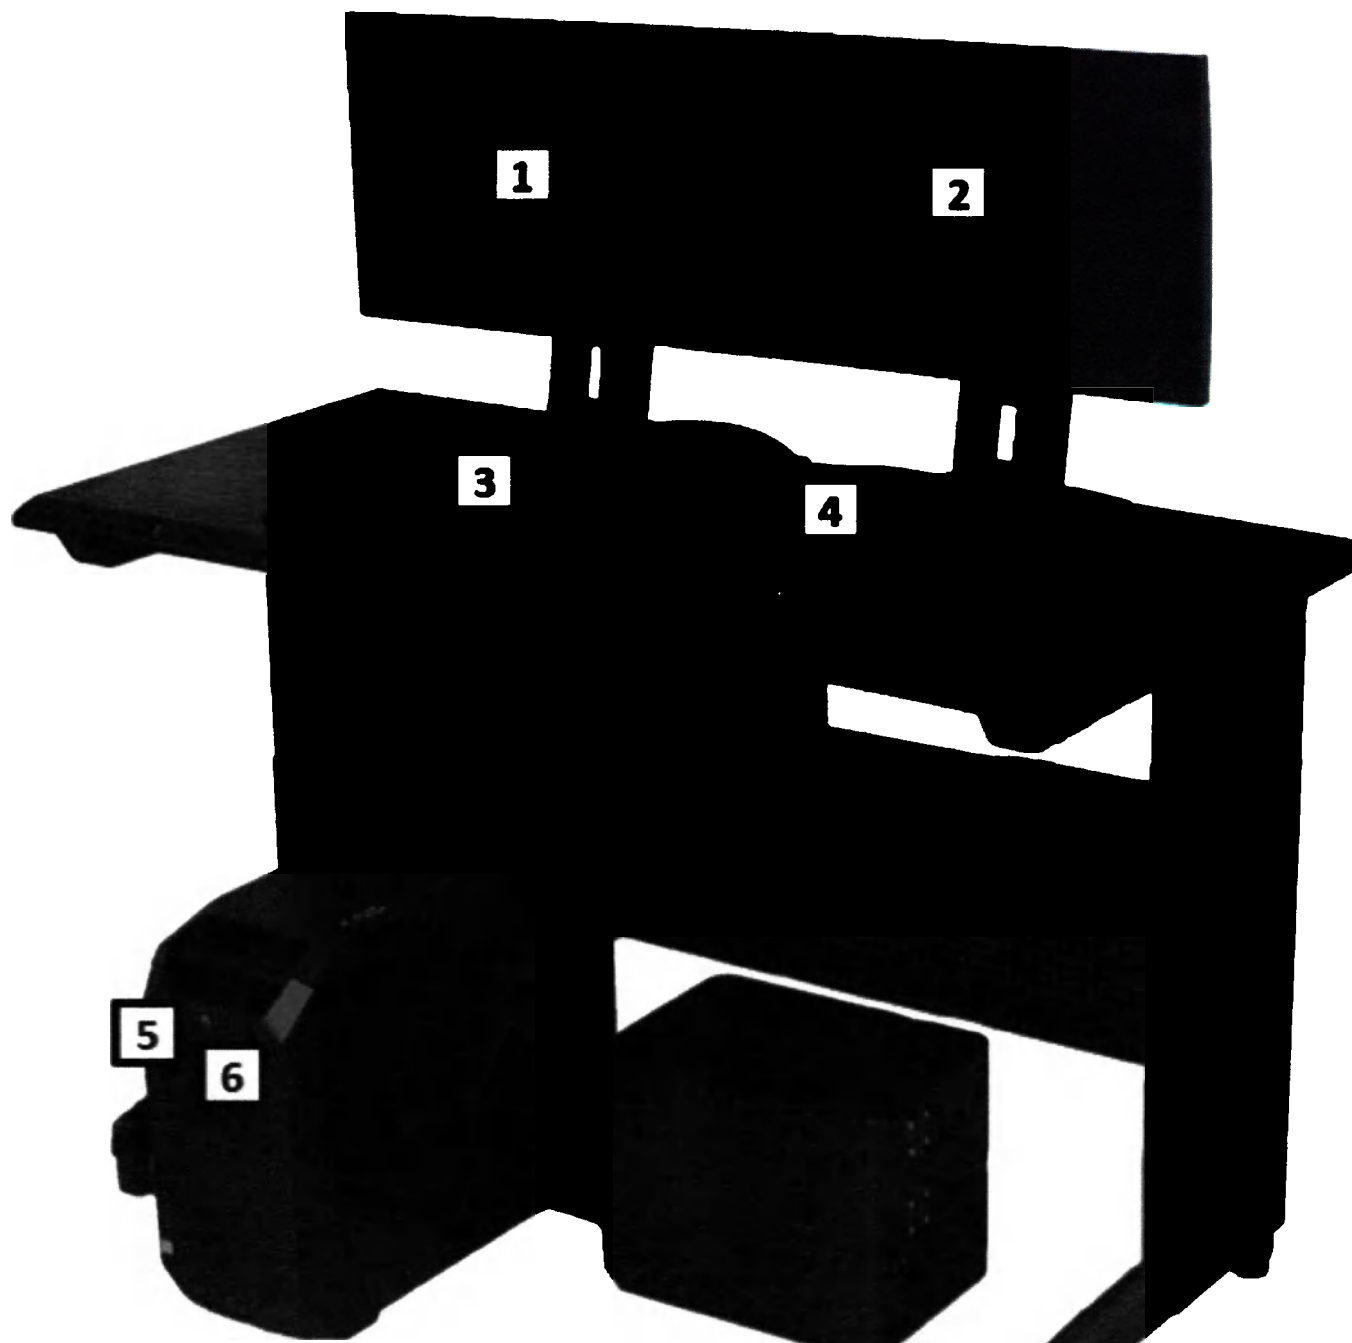


Рис. 14. Рабочее место оператора, в составе: 1- Монитор сканирования, 2 – Монитор отображения, 3 – Пульт управления оператора и клавиатура, 4 – мышь;

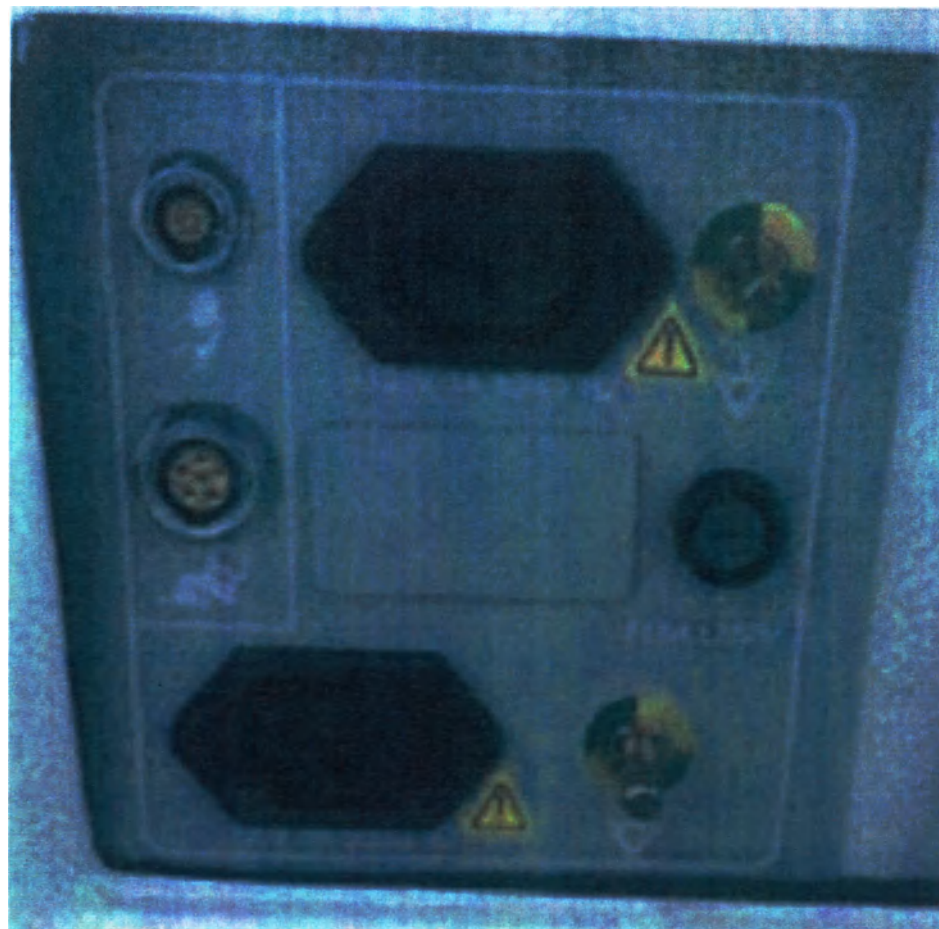


Рис. 15. Панель интерфейсная для подключения к томографу – не более 5 шт. (при необходимости)

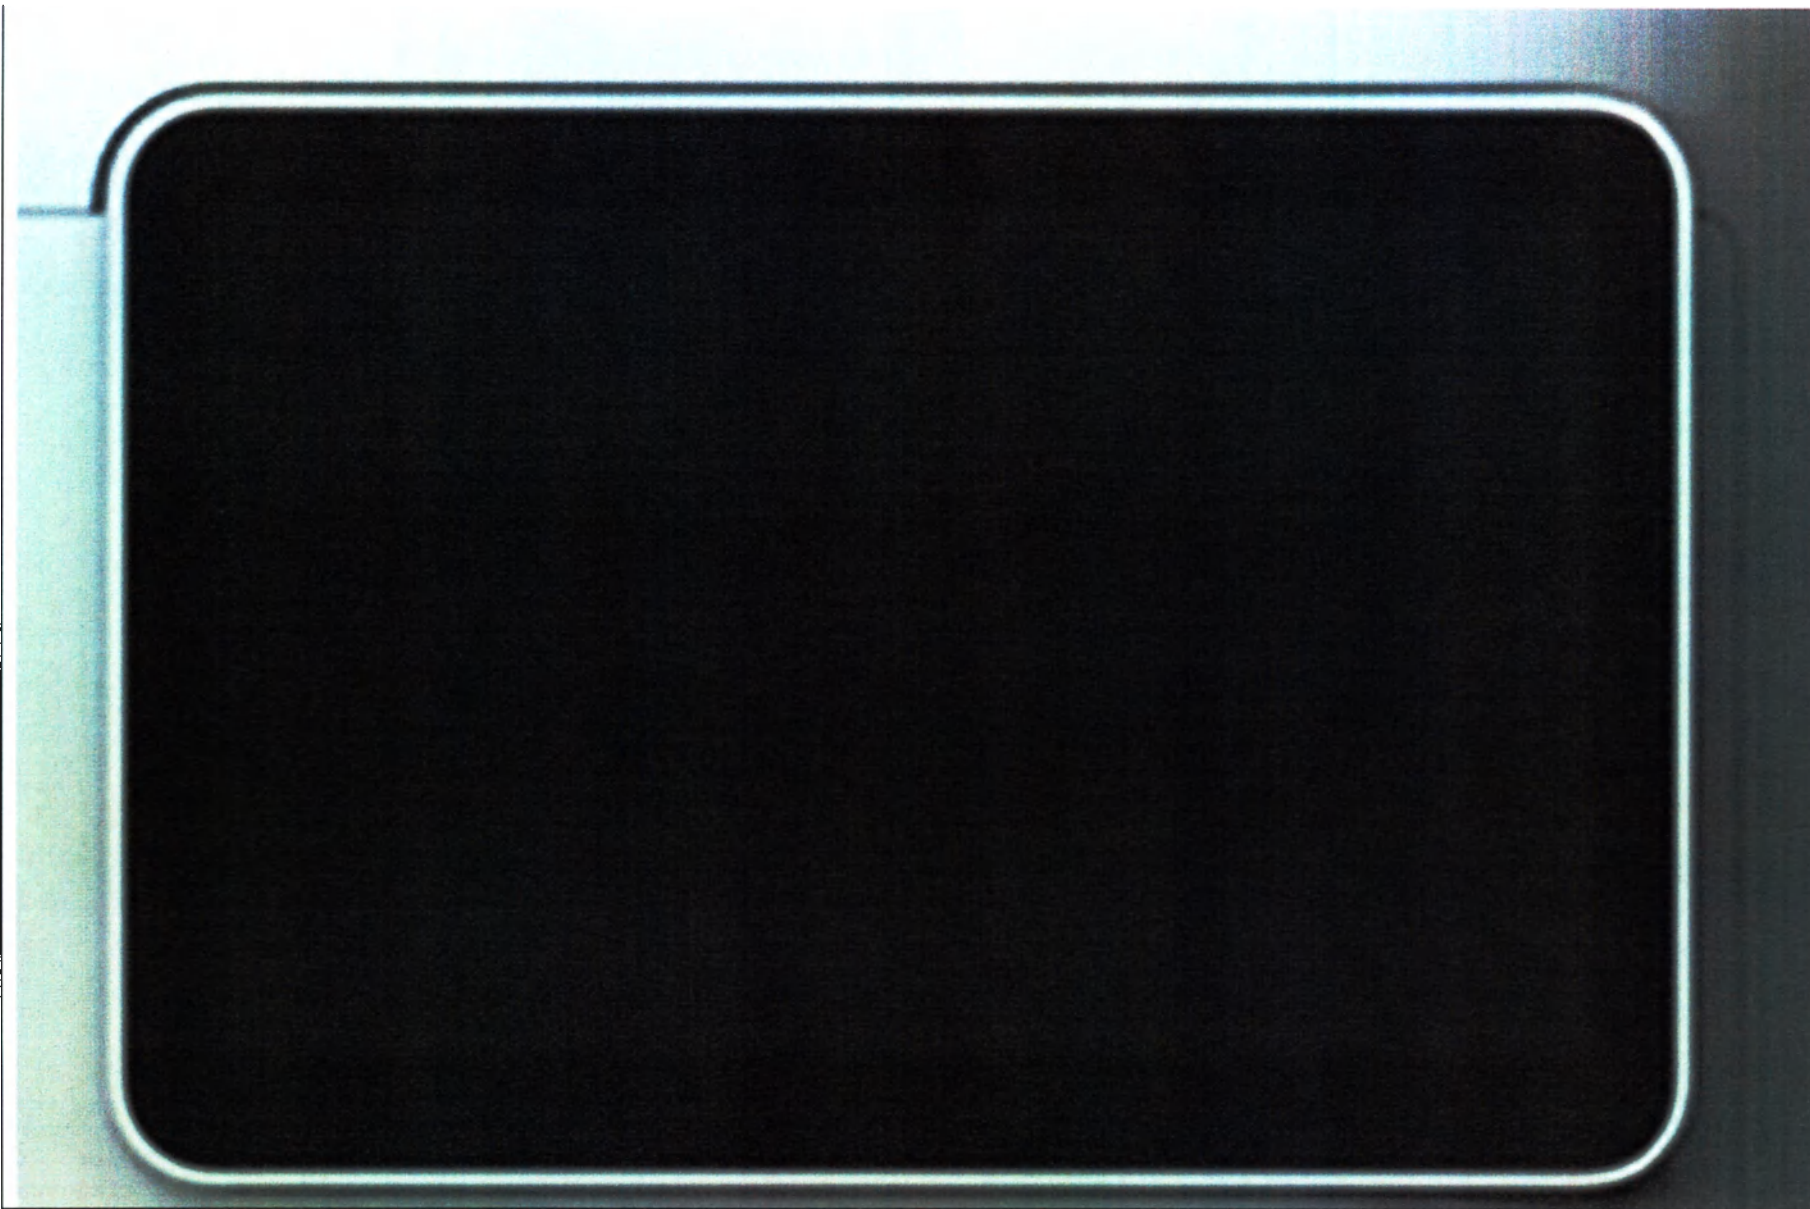


Рис. 16. Экран сенсорный гентри жидкокристаллический – не более 5 шт. (при необходимости).



Рис. 17. Панели управления гентри – не более 5 шт. (при необходимости).

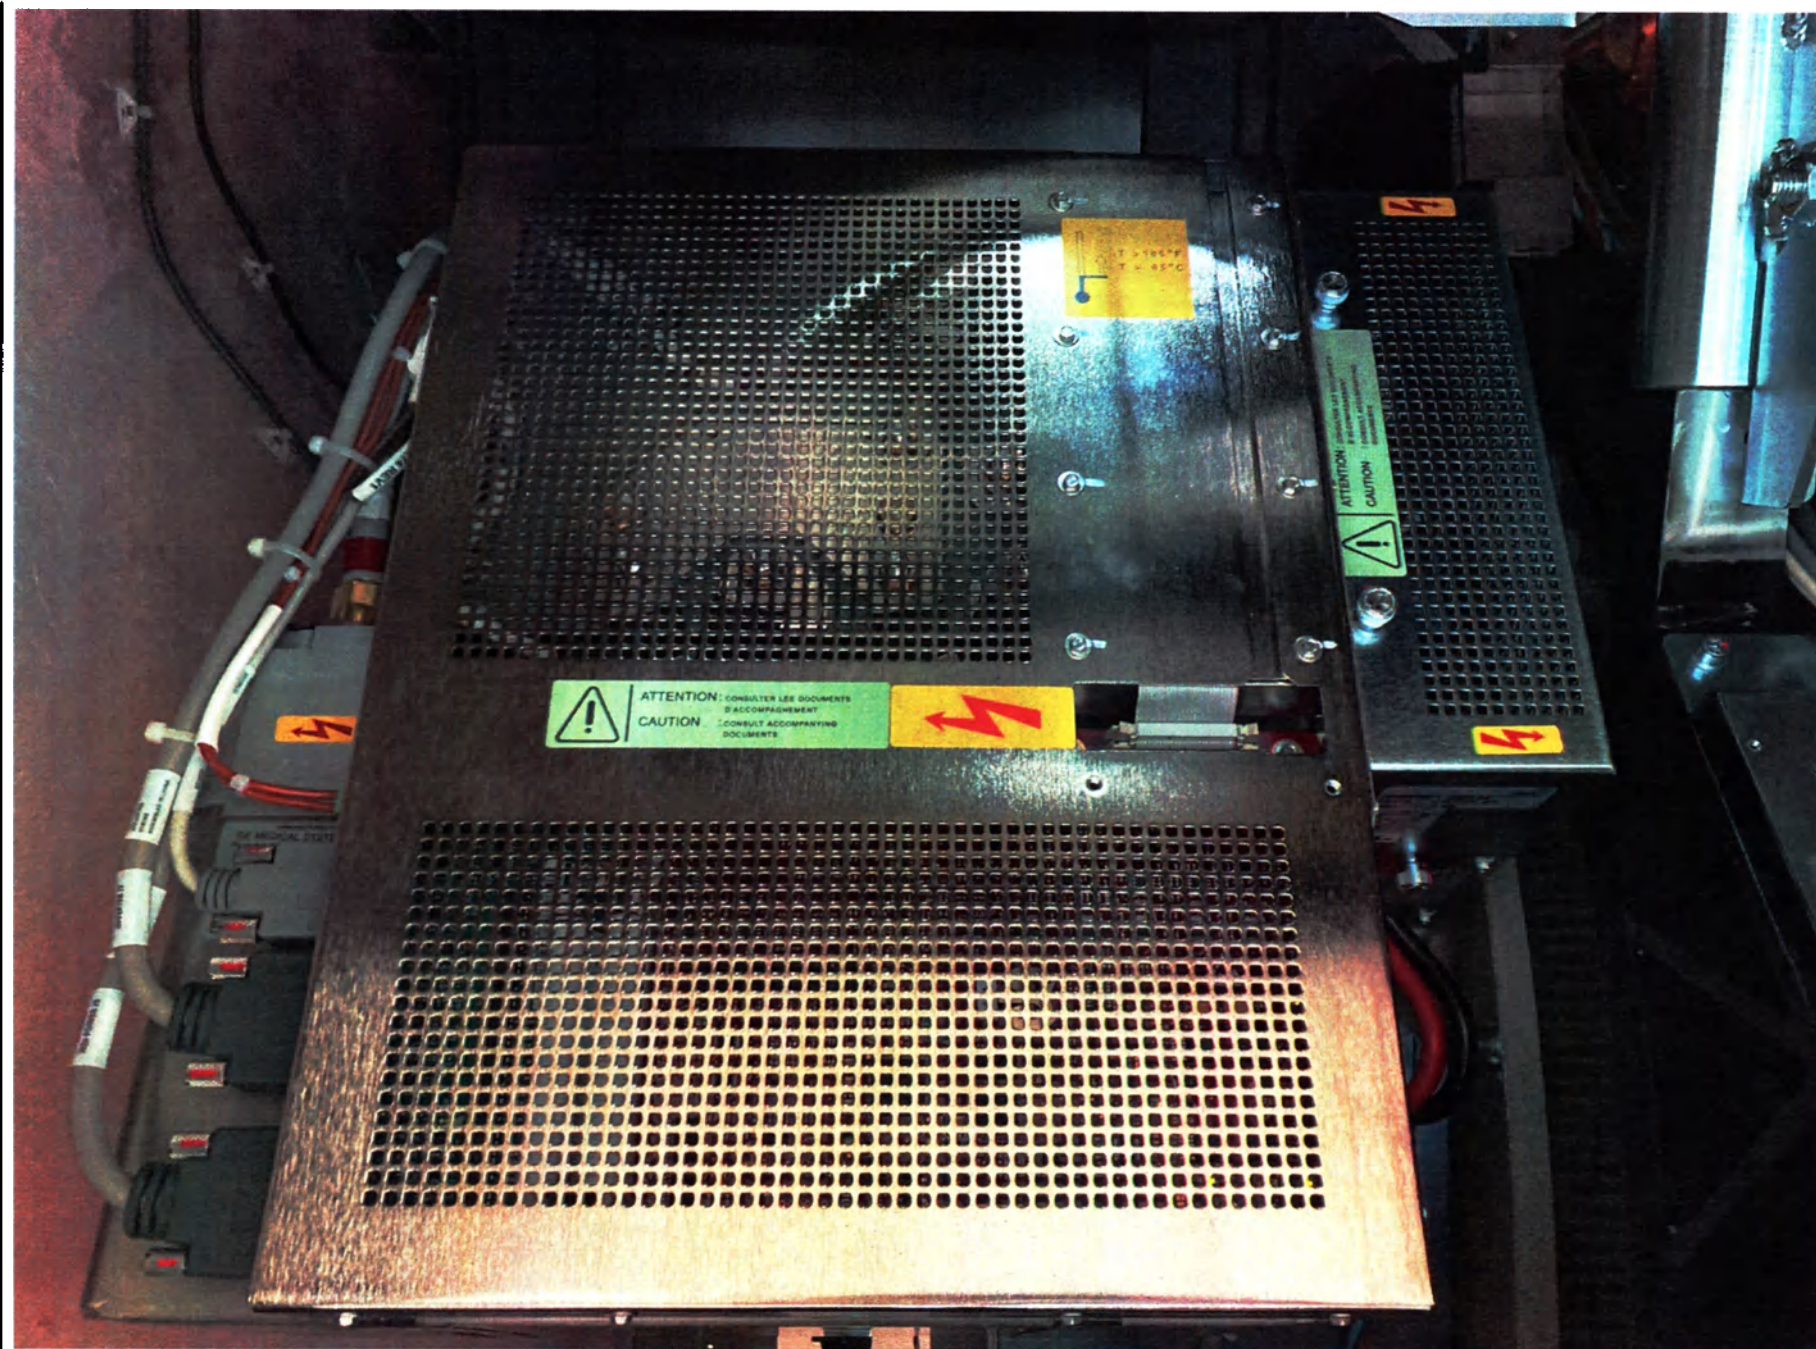


Рис. 18. Генератор рентгеновский высоковольтный – 1 шт. (при необходимости).

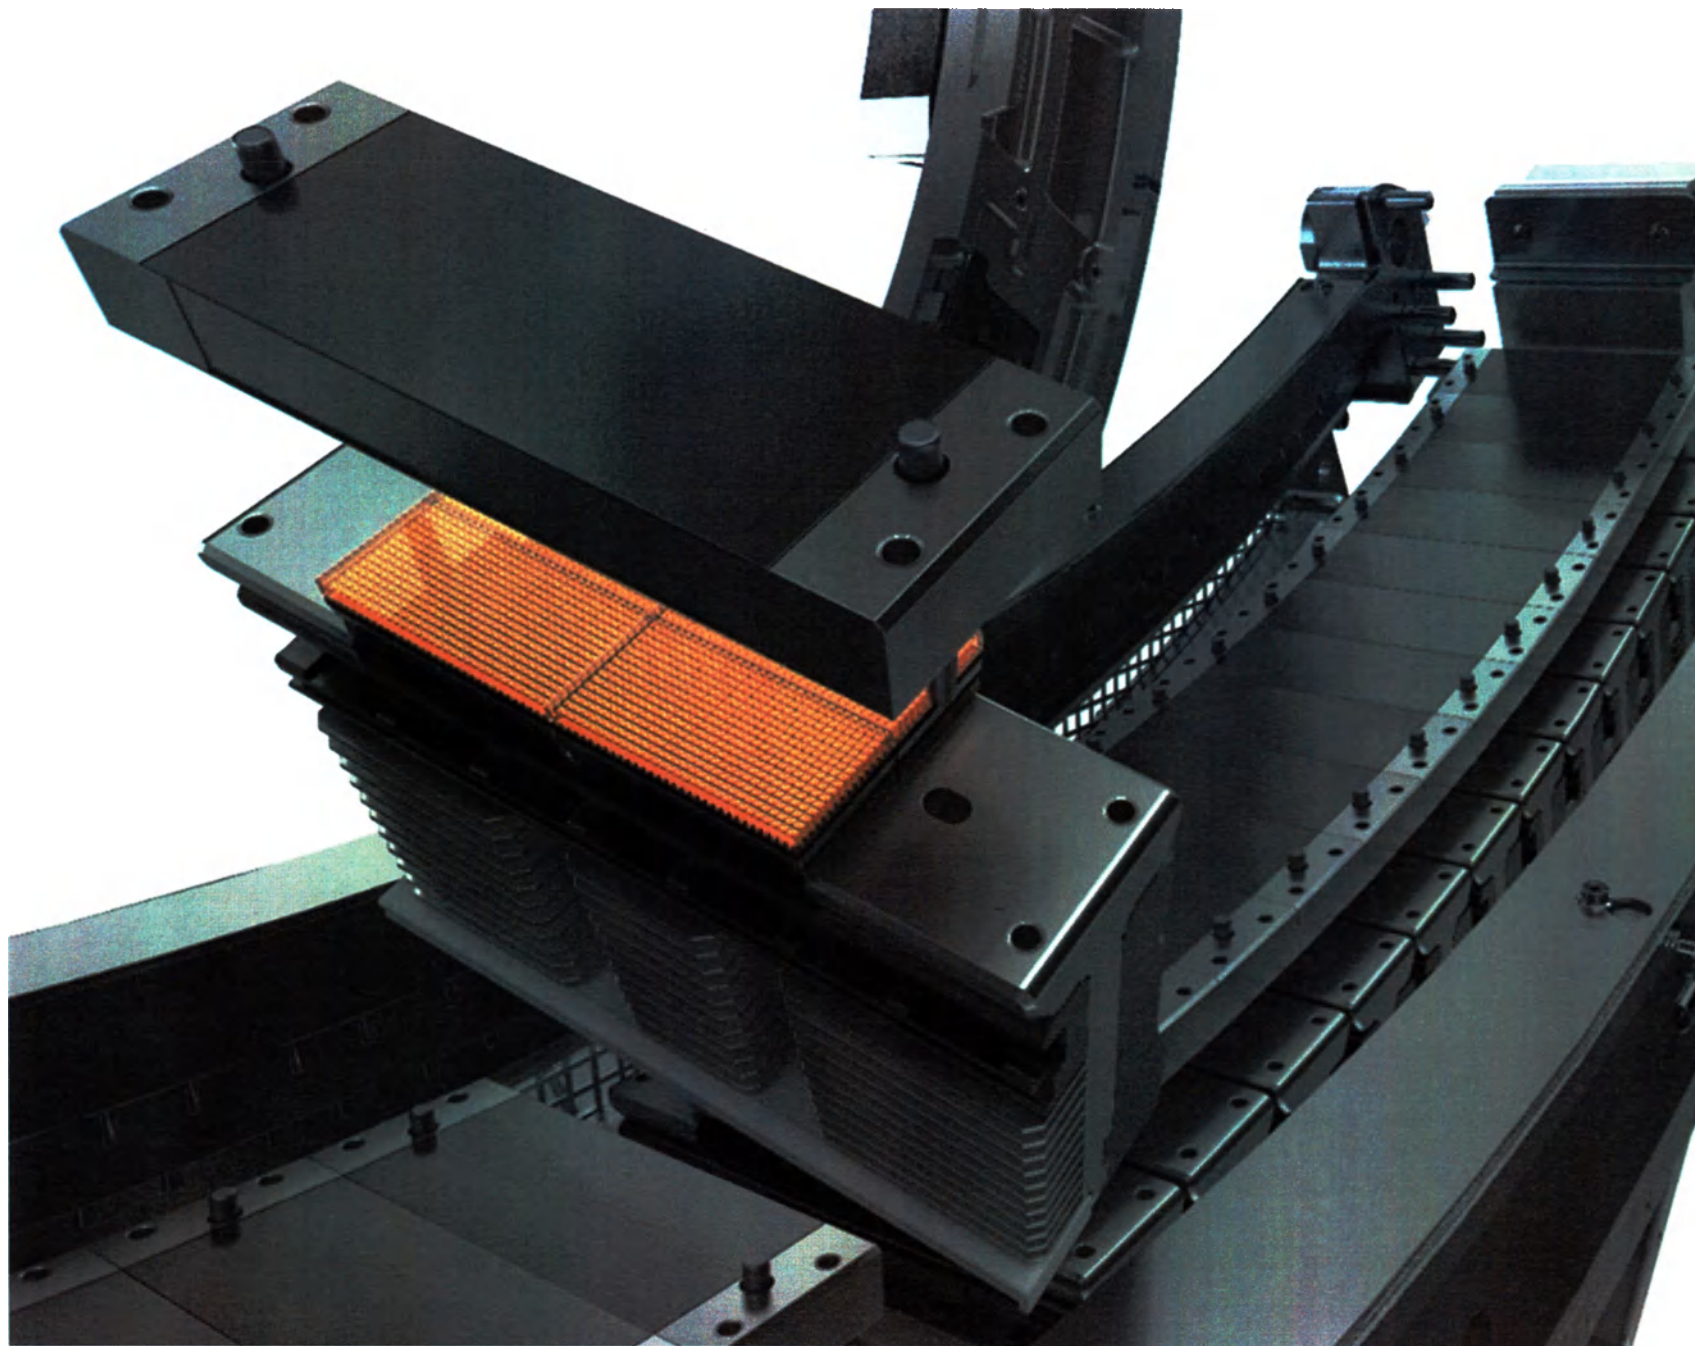


Рис. 19. Детектор рентгеновского излучения – 1 шт. (при необходимости).

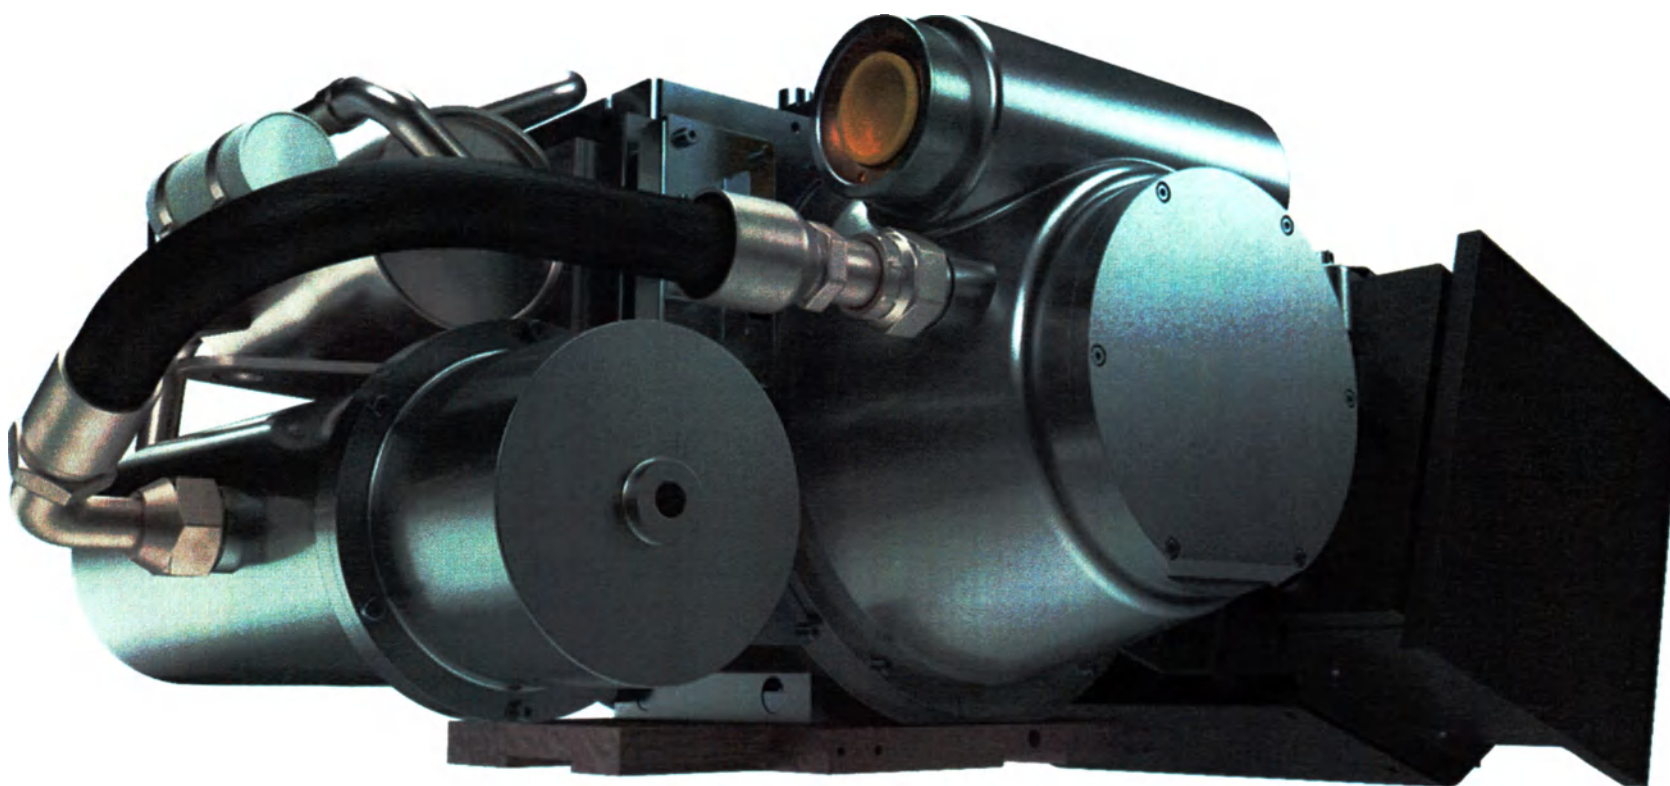


Рис. 20. Рентгеновский излучатель Perforix 40 Plus – 1 шт. (при необходимости).

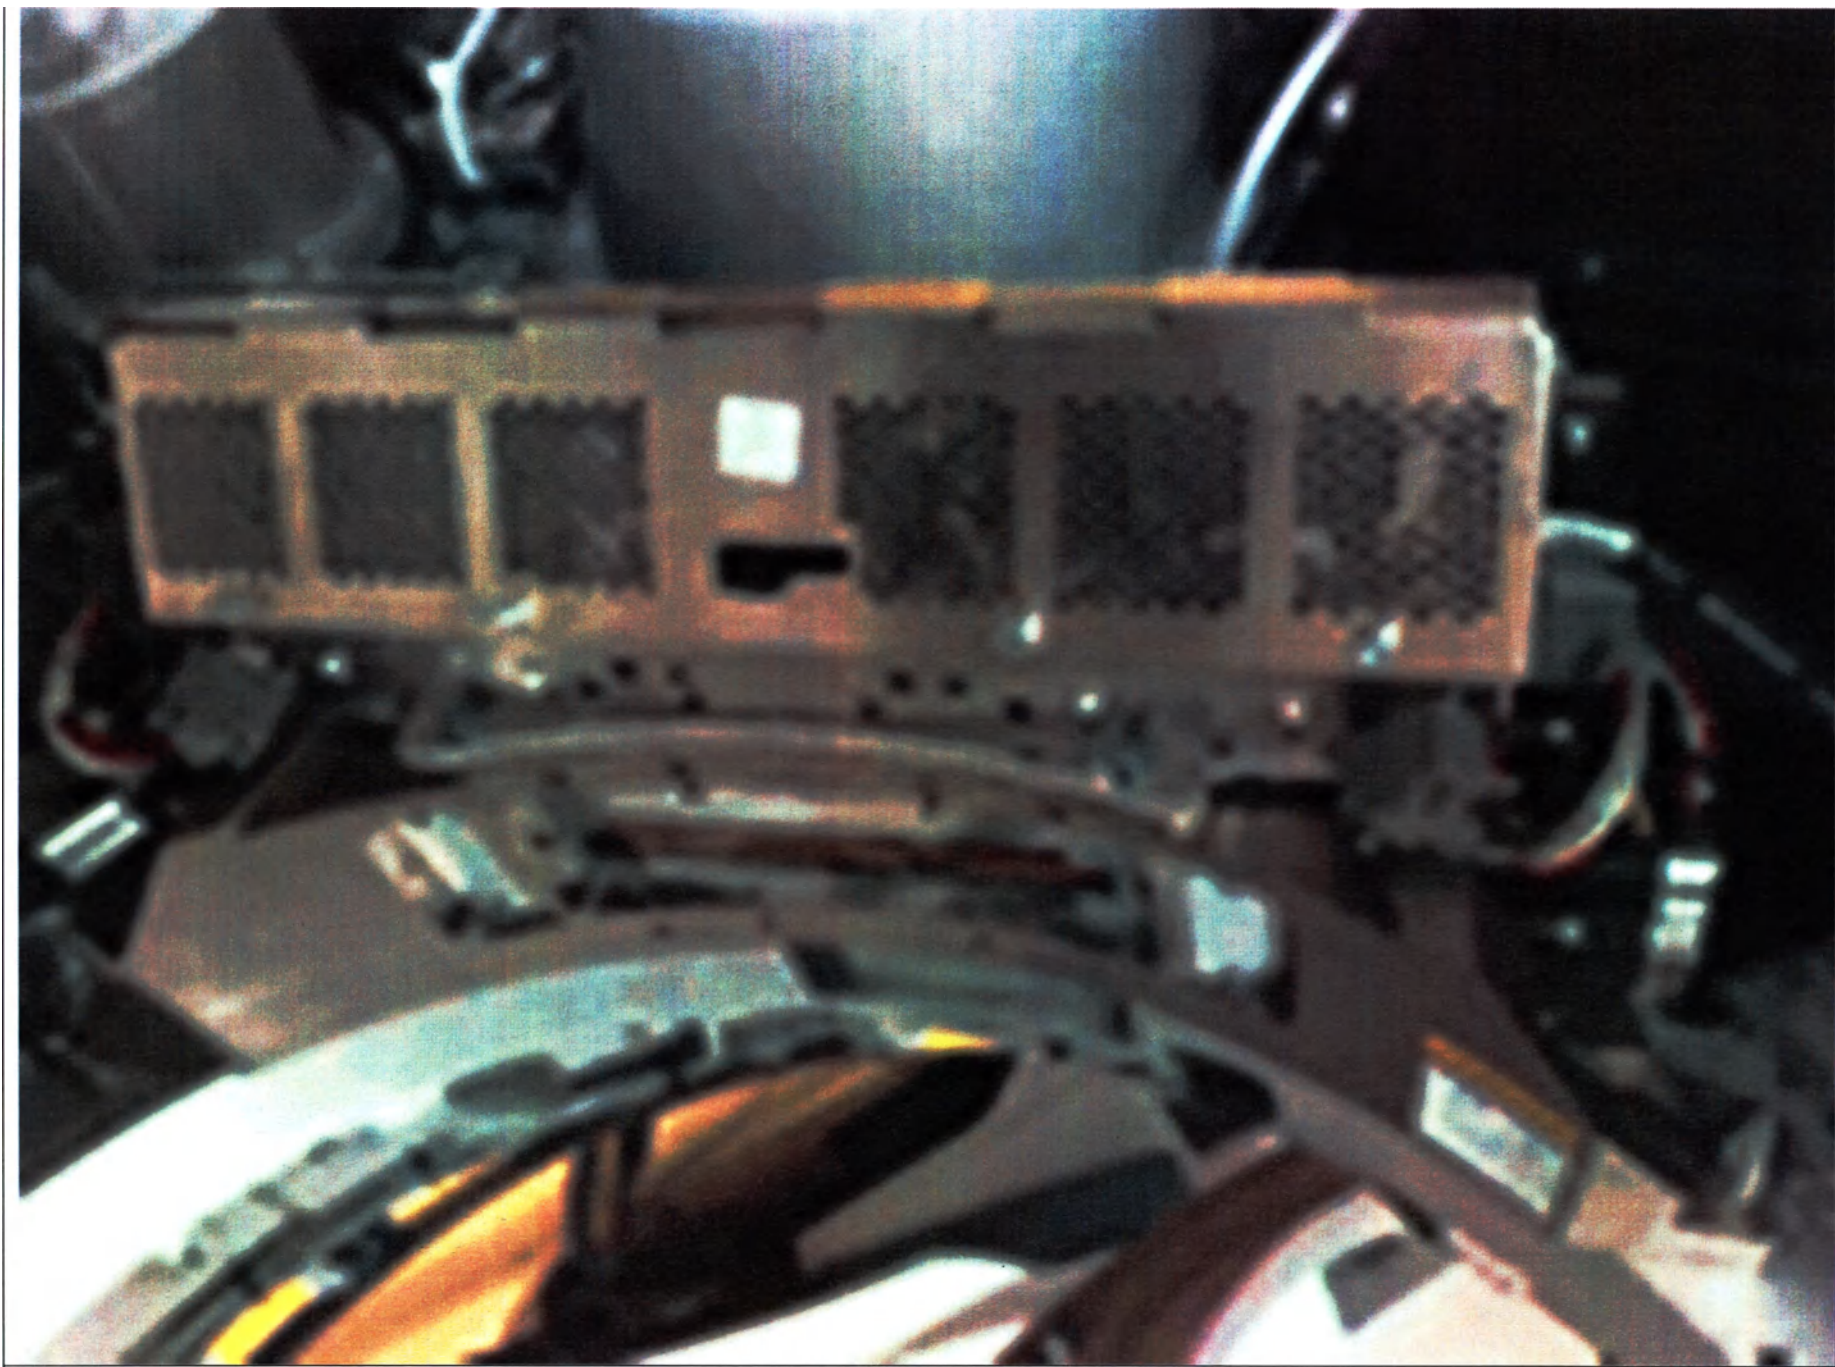


Рис. 21. Коллиматоры – не более 5 шт. (при необходимости)

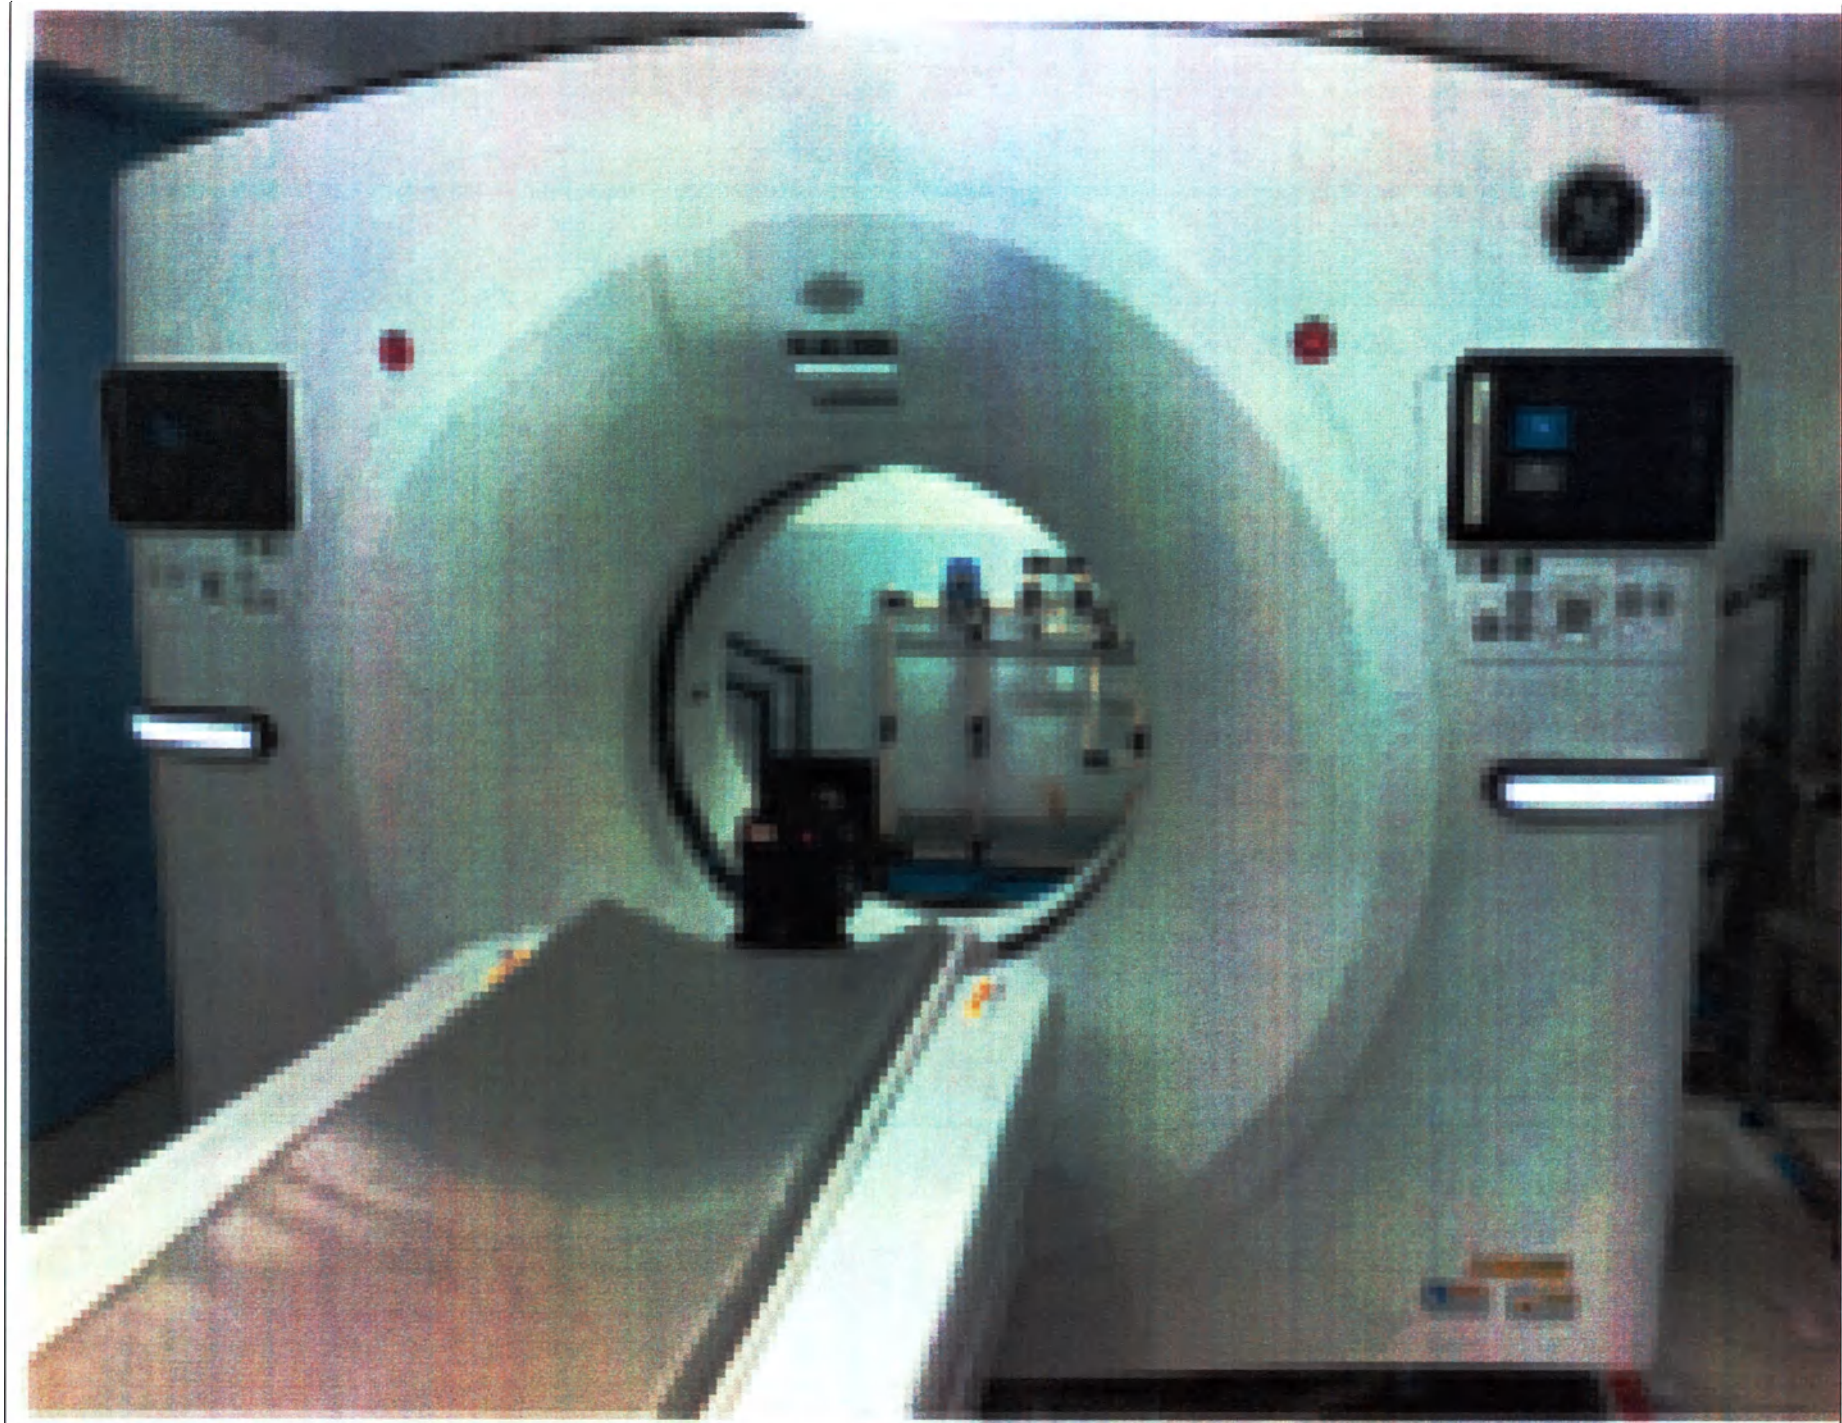


Рис. 22. Крышки защитные – не более 20 шт. (при необходимости)

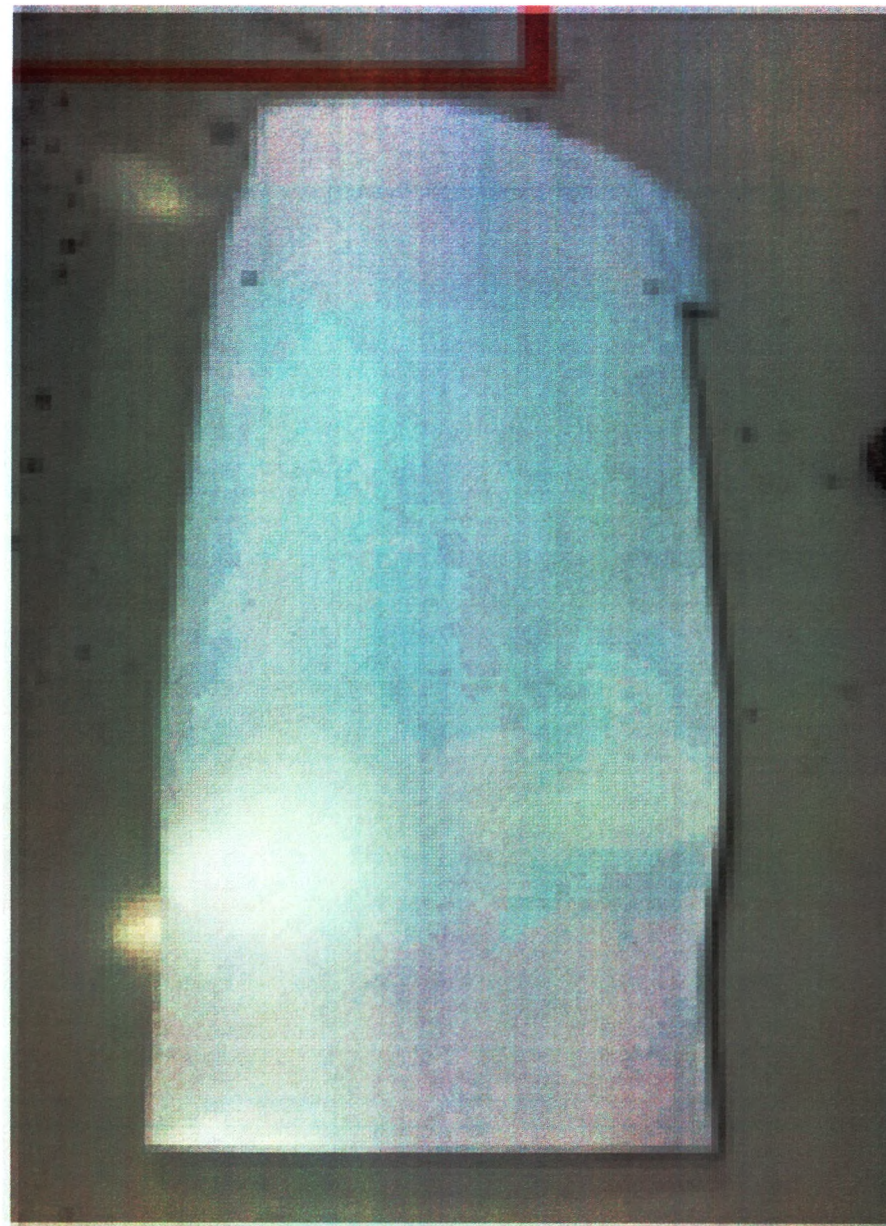
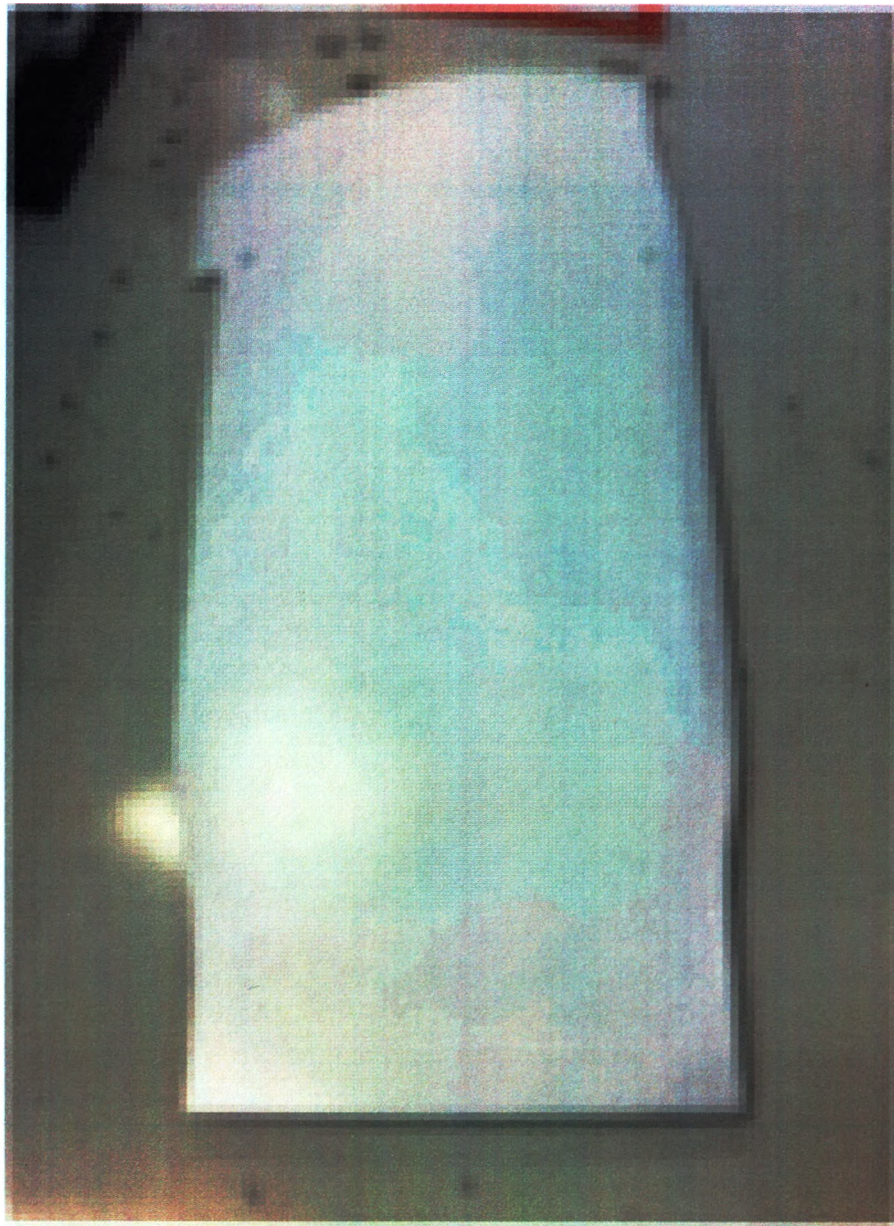


Рис. 23. Крышки декоративные – не более 20 шт. (при необходимости).

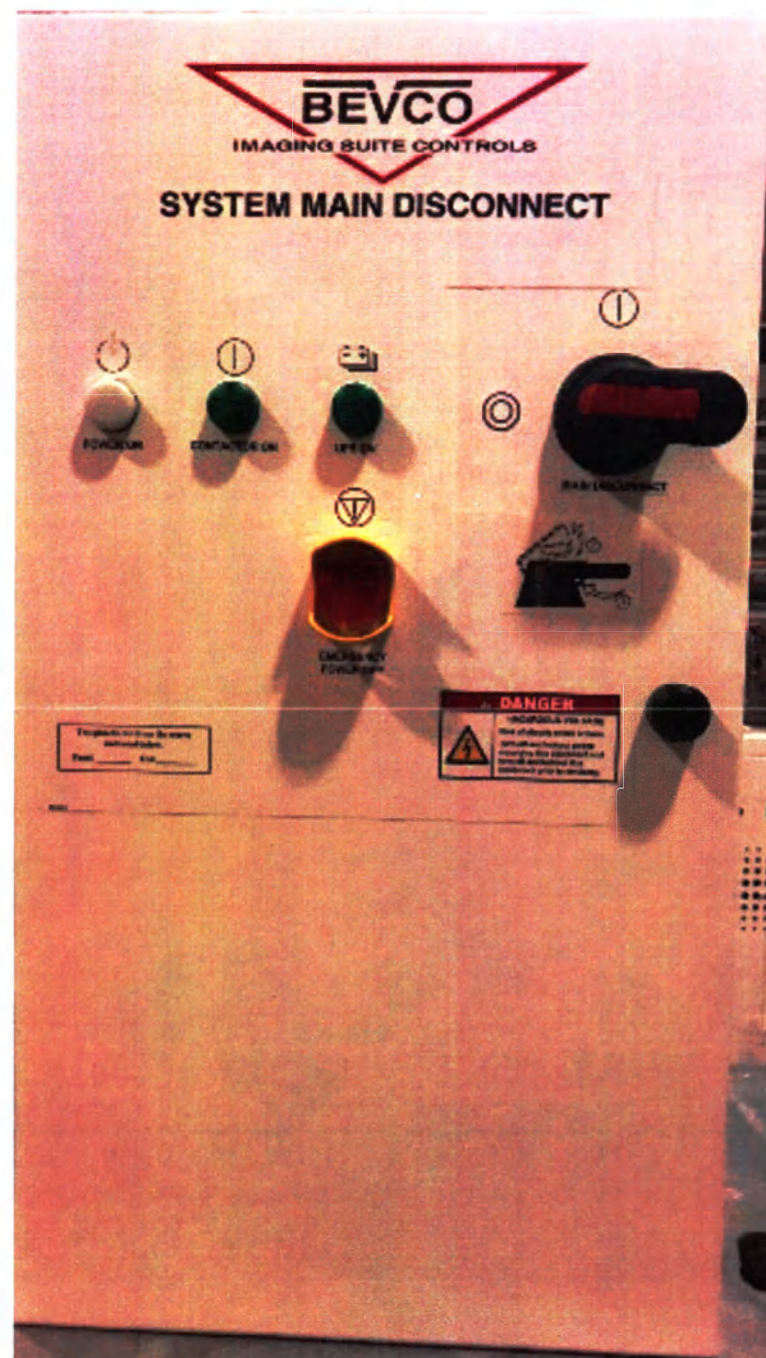


Рис. 24. Щит силовой электрический трехфазный – 1 шт. (при необходимости).



Рис. 25. Кабели – не более 100 шт.

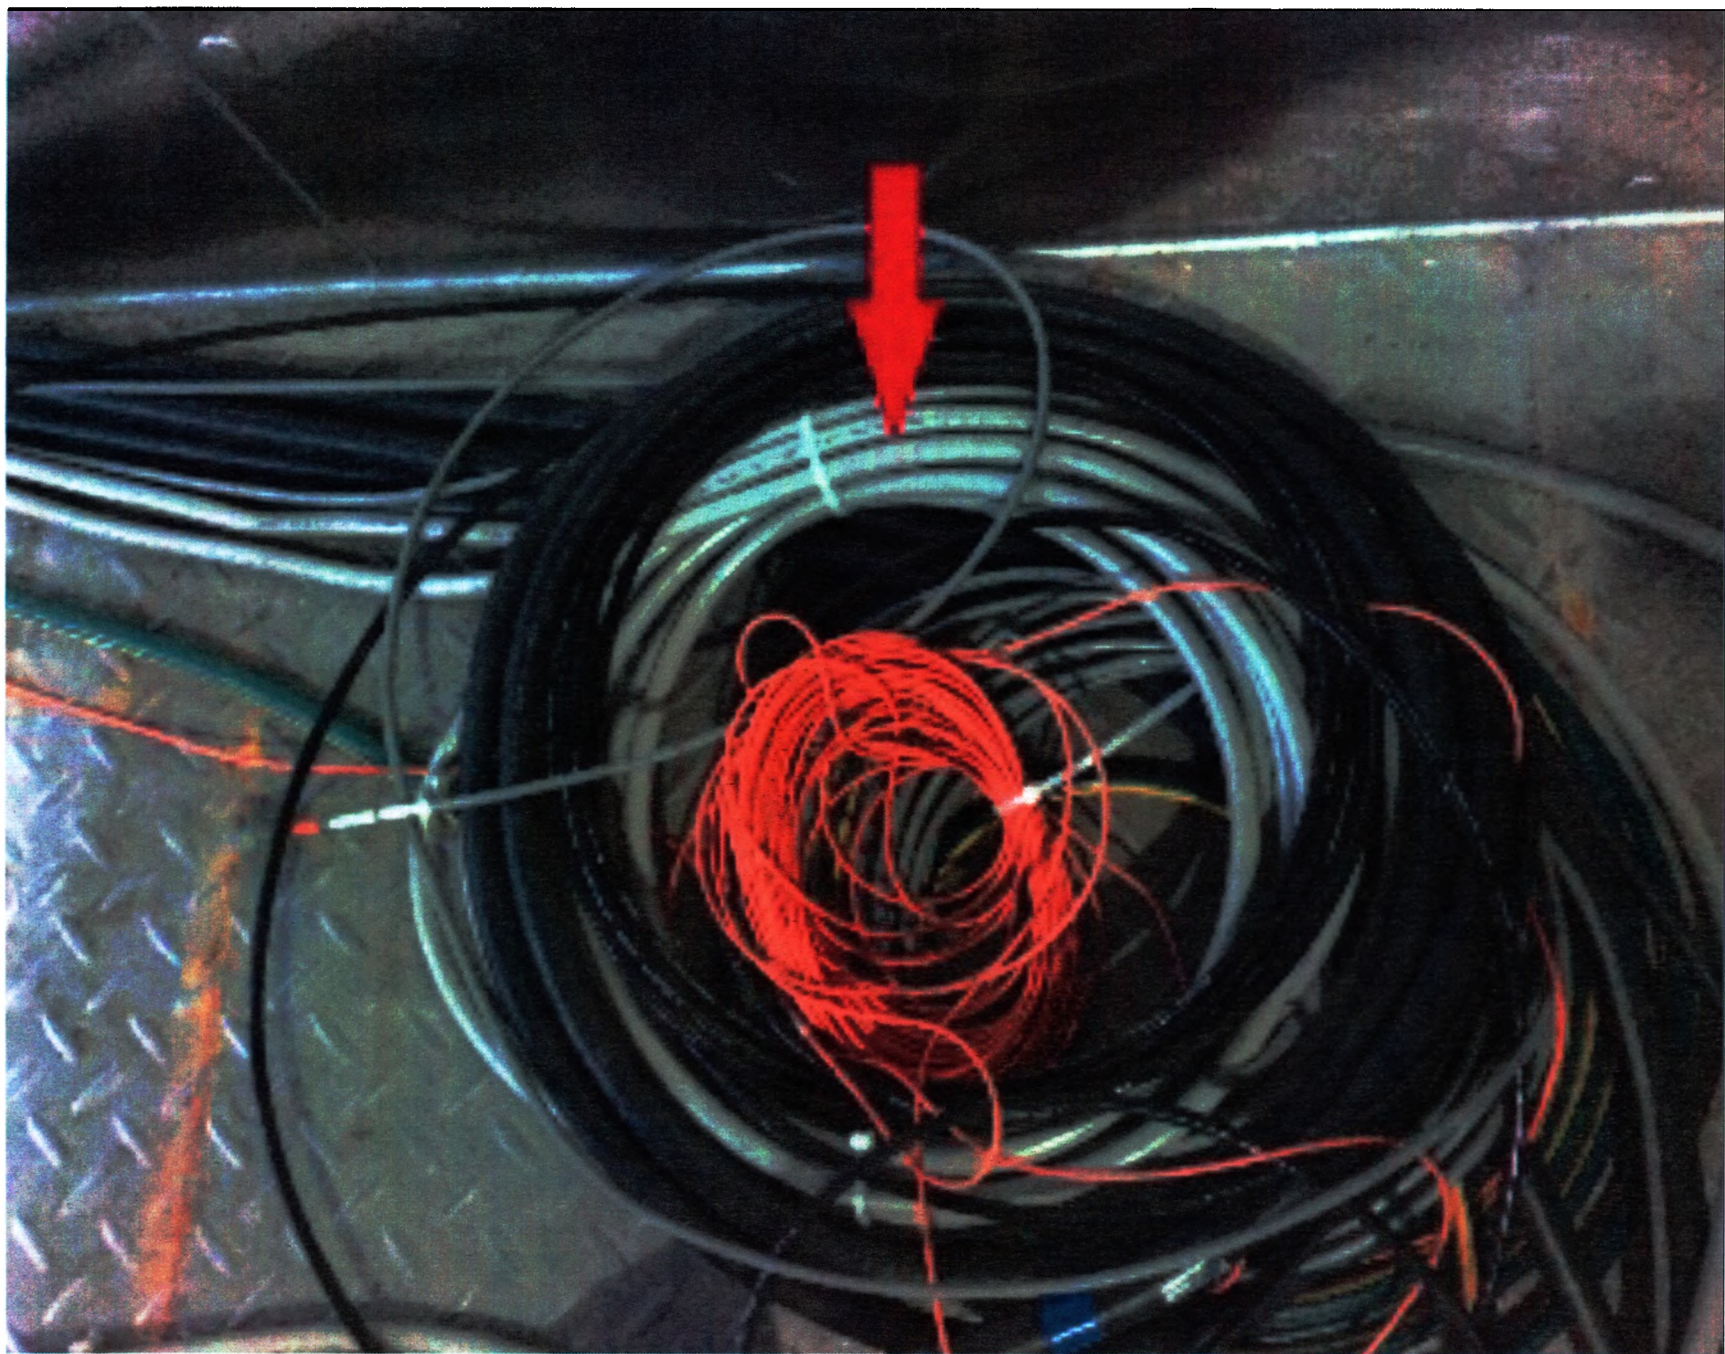


Рис. 26. Кабели питания – не более 100 шт. (при необходимости).

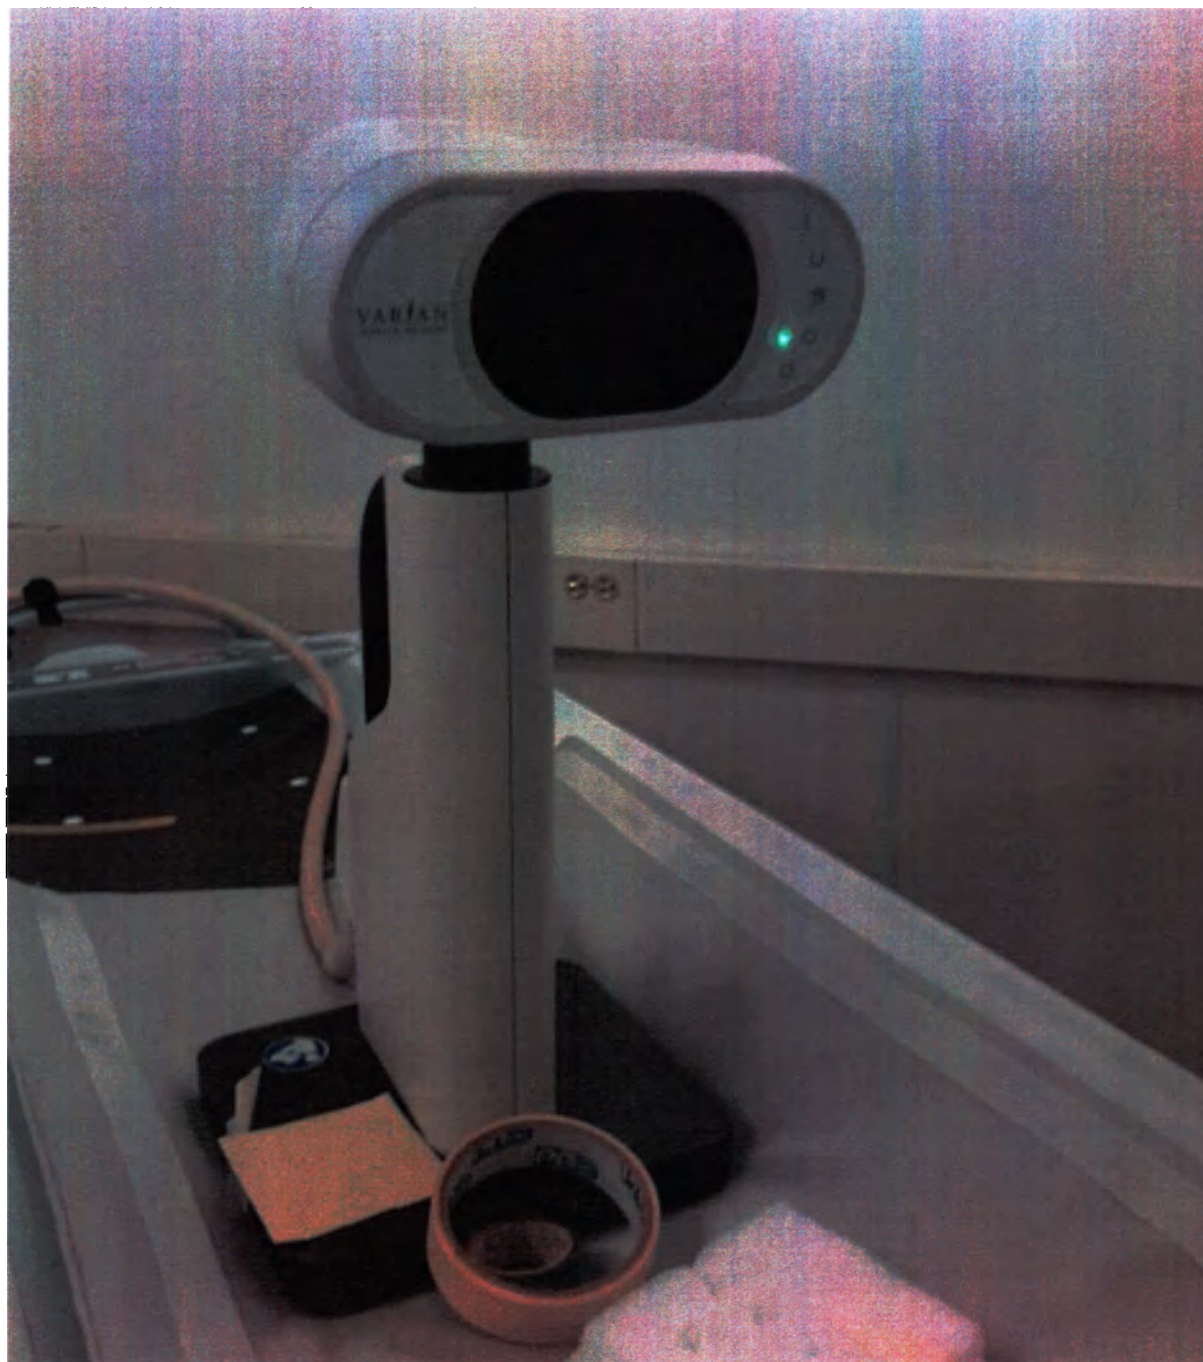


Рис. 27. Система синхронизации с дыханием RGSC с принадлежностями, РУ №РЗН 2019/8648– не более 5 шт. (при необходимости).



Рис. 28. Кардиосинхронизатор медицинский, вариант исполнения 7800 с принадлежностями, РУ №РЗН 2016/4384 – 1 шт. (при необходимости).



Рис. 29. Система инъекционная для КТ MEDRAD Stellant D с рабочей станцией Certegra, РУ №РЗН 2014/1499 - 1 шт. (при необходимости)

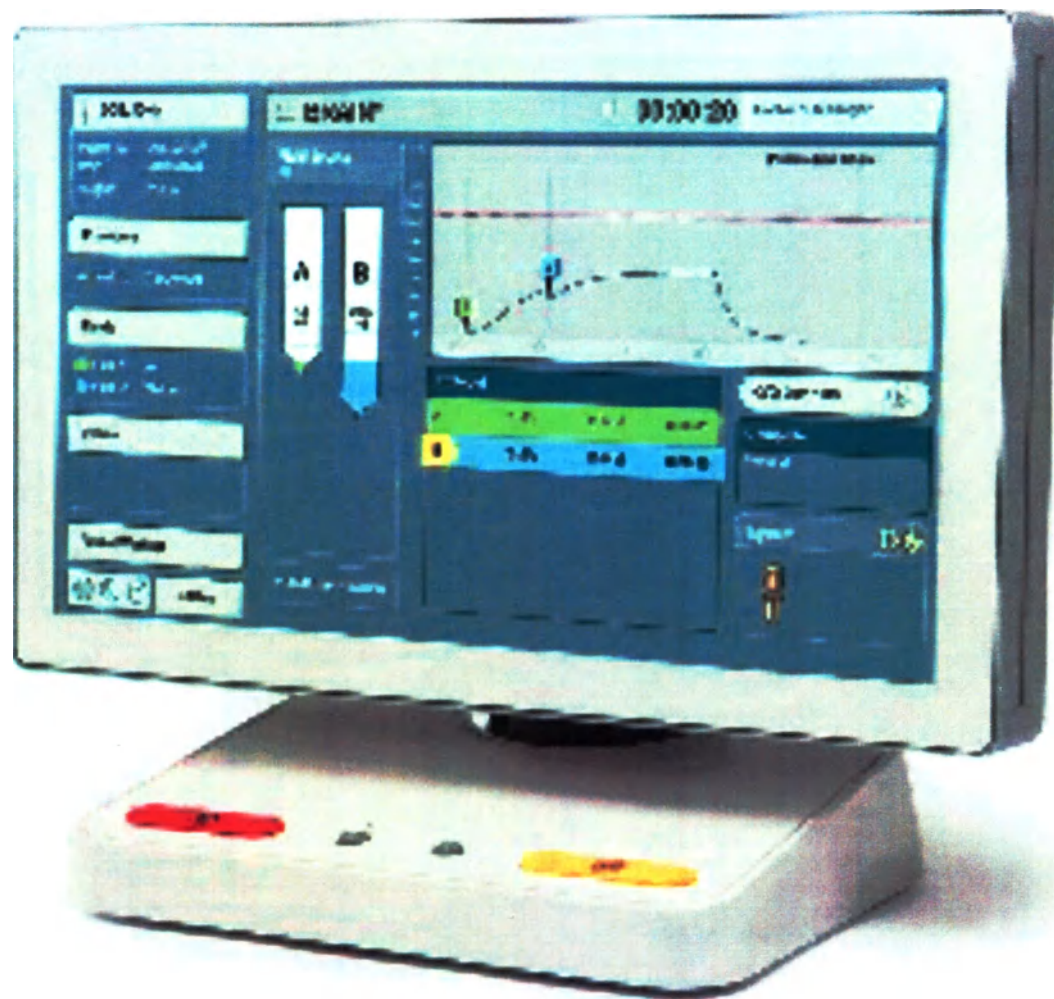


Рис. 30. Система инъекционная для КТ MEDRAD Stellant D с рабочей станцией Certegra, РУ №РЗН 2014/1499 - 1 шт. (при необходимости)



Рис. 31. Система инъекционная для КТ MEDRAD Stellant D с рабочей станцией Certegra, РУ №РЗН 2014/1499 - 1 шт. (при необходимости)



Рис. 32. Система инъекционная MEDRAD Salient с принадлежностями, ПУ №ФСЗ 2012/12881 - 1 шт. (при необходимости)



Рис. 33. Система инъекционная MEDRAD Salient с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2012/12881 - 1 шт. (при необходимости)



Рис. 34. Инжекторы ангиографические для компьютерной и магнитно-резонансной томографии XD, модель: XD 8000 CT Motion с принадлежностями, РУ №РЗН 2015/2800 - 1 шт. (при необходимости)



Рис. 35. Система подачи контрастного вещества SmartShot Alpha с принадлежностями, РУ №РЗН 2016/4501 – 1 шт. (при



Рис. 36. Система подачи контрастного вещества Dual Shot Alpha 7 с принадлежностями, РУ №РЗН 2016/4368 – 1 шт. (при необходимости).



Рис. 37. Инжекторы автоматические для введения контрастного вещества, вариант исполнения: Optivantage DH с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2012/13277 – 1 шт. (при необходимости).



Рис. 38. Шприцы MEDRAD® для рентгеноконтрастных / магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора к системам инъекционным MEDRAD® Stellant Sx, MEDRAD® Stellant D, MEDRAD® Stellant DualFlow, MEDRAD® Stellant D с рабочей станцией Certegra, MEDRAD® Spectris Solaris EP, Mark V ProVis, Vistron CT в наборах, РУ №ФСЗ 2012/12543 – не более 500 шт.
(при необходимости)



Рис. 39. Шприцы MEDRAD® для рентгеноконтрастных / магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора к системам инъекционным MEDRAD® Stellant Sx, MEDRAD® Stellant D, MEDRAD® Stellant DualFlow, MEDRAD® Stellant D с рабочей станцией Certegra, MEDRAD® Spectris Solaris EP, Mark V ProVis, Vistron CT в наборах, РУ №ФСЗ 2012/12543 – не более 500 шт.



Рис. 40. Шприц к инъекционной системе MEDRAD Salient, РУ №ФСЗ 2012/12897 – не более 500 шт. (при необходимости).



Рис. 41. Комплект для нескольких пациентов для системы инъекционной MEDRAD Stellant, РУ №ПЗН 2019/9266 – не более 500 шт. (при необходимости).

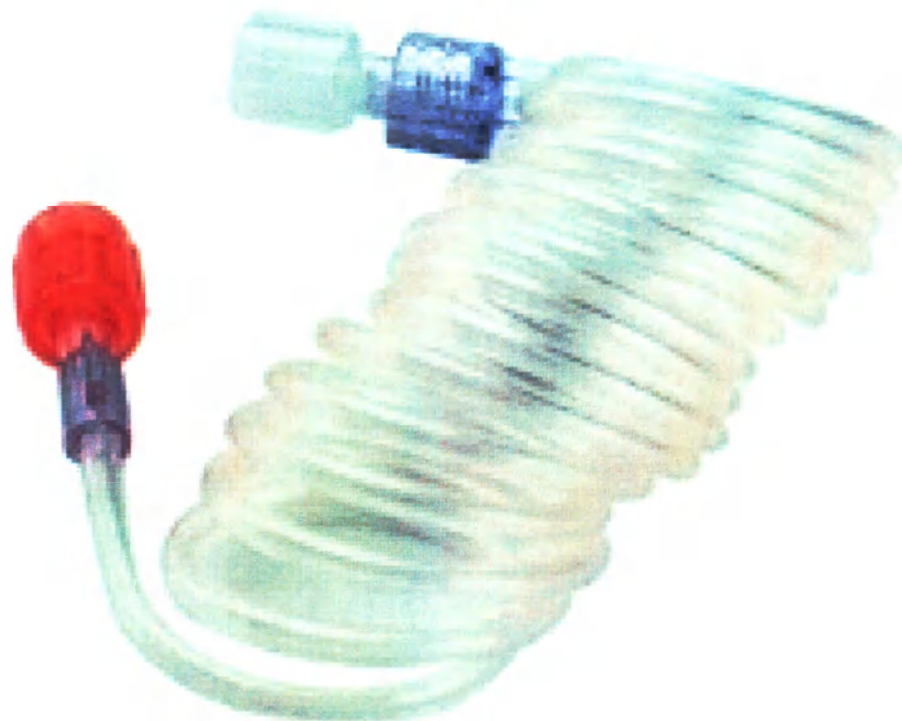


Рис. 42. Наборы вспомогательные полимерные одноразовые стерильные к емкостям полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к системе инъекционной для КТ MEDRAD Stellant (МЕДРАД Стеллант), РУ №ФСЗ 2011/10023 – не более 500 шт. (при необходимости).

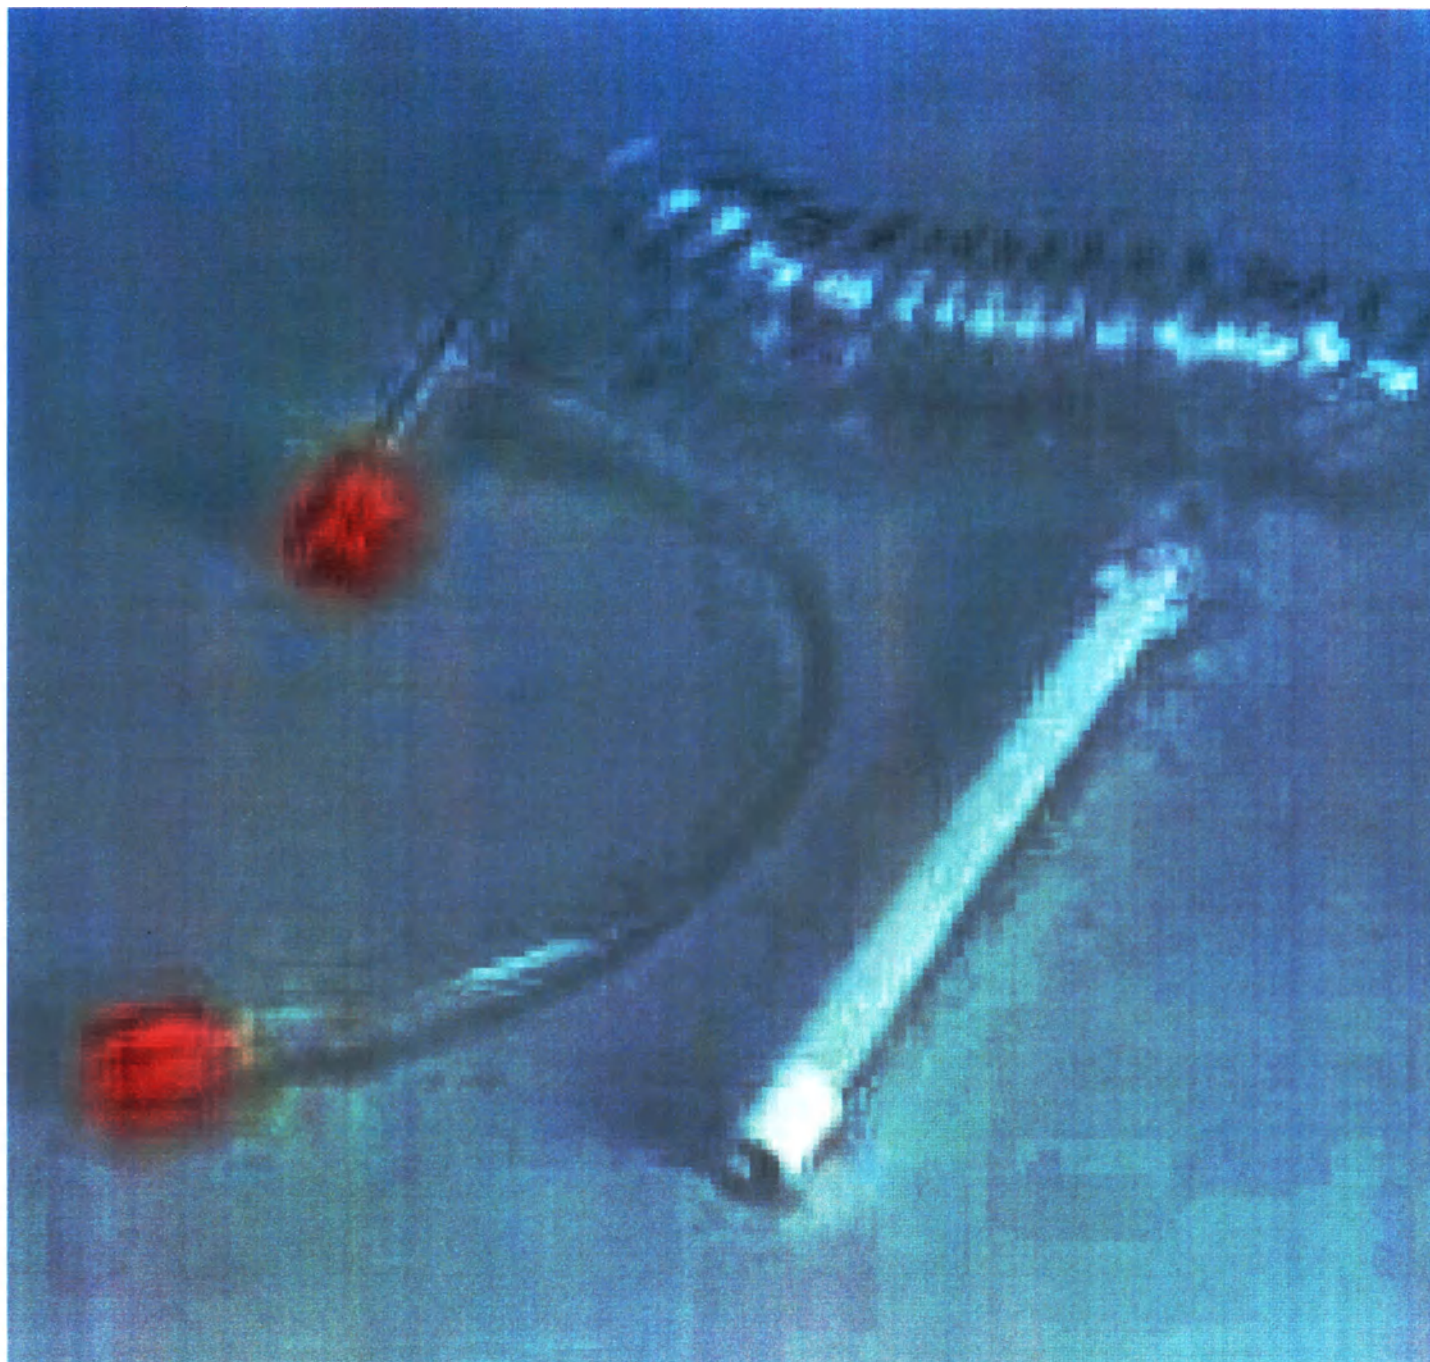


Рис. 43. Наборы вспомогательные полимерные одноразовые стерильные к емкостям полимерным стерильным одноразовым, для рентгеноконтрастных веществ и физиологического раствора к системе инъекционной для КТ MEDRAD Stellant (МЕДРАД Стеллант), РУ №ФСЗ 2011/10023 – не более 500 шт. (при необходимости).



Рис. 44. Трубки удлинительные для системы инъекционной MEDRAD Salient, РУ №ПЗН 2019/9436 – не более 500 шт. (при необходимости).

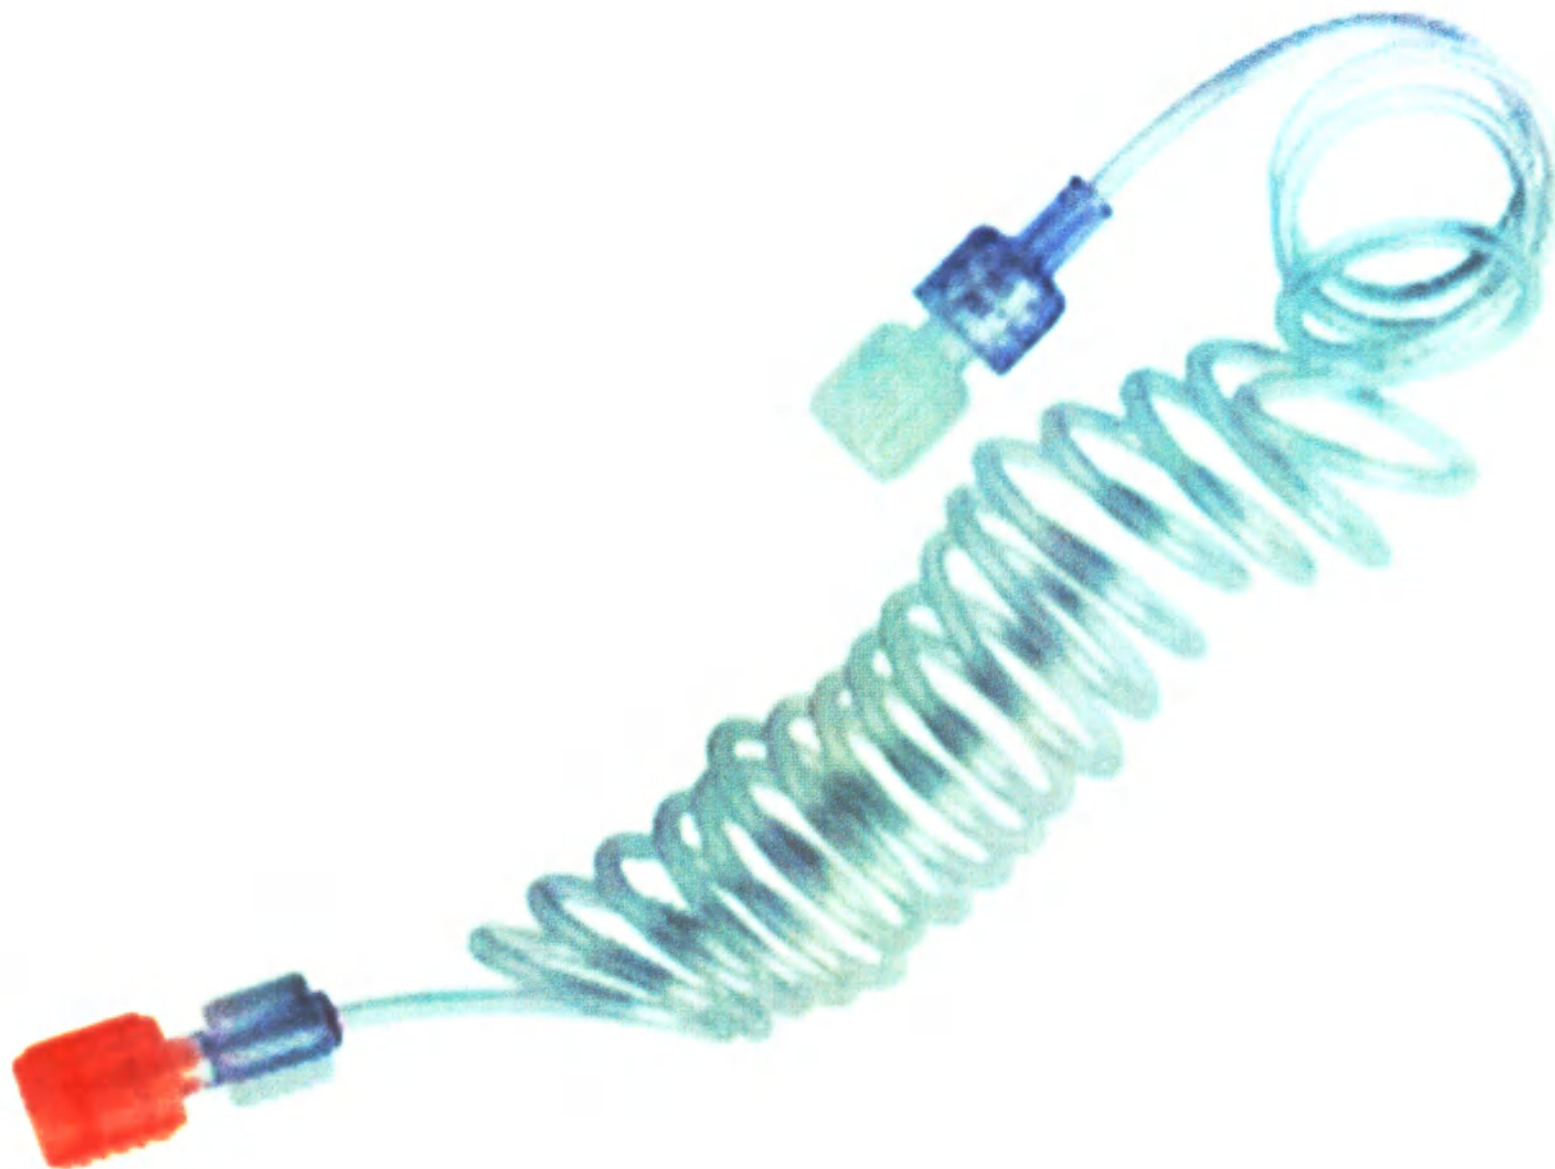


Рис. 45. Трубки удлинительные для системы инъекционной MEDRAD Salient, РУ №ПЗН 2019/9436 – не более 500 шт. (при необходимости).



Рис. 46. Трубка для одного пациента 250 см (SPD 250) для системы инъекционной MEDRAD Stellant, РУ №ПЗН 2019/8840 - не более 500 шт. (при необходимости).



Рис. 47. Программные пакеты управления мощностью на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 5 шт. (при необходимости).

Scanning

123
4640



↑ Patient

SN / Feet First / Supine / On /

Japanese

5.5 CHEST-PEL CE(1Phas...

Scout

Interventional Series C1

Group 1

Scan

5mm AX STD

5mm AX STD CE

Done Scanning

Total Accumulated Dose

DLP (mGy*cm)

5.96

Group 1

60.0s

All Settings

↑ Anatomy Selection

Scan Center Location

S0.000 mm

Number of Images

1921

Gantry Tilt

S0.0°

SFOV

Large Body

DFOV

36.0 cm

A/P center

A0.0 mm

R/L center

R0.0 mm

ⓐ kV and mA Control

kV

120 kV

mA

60 mA

Focal Spot

S

Ⓜ Scan Type

Scan Type

3D Guidance

Rotation Time

3D Guidance

SmartStep

Ⓢ Interventional

Detector Coverage

40 mm

Thickness

2.5 mm

Recon Mode

Overlap

Slice Mode

171

Exposure Time

60.0 s

Bump Distance

1.25 mm

■ Primary Recon

Recon Type

Std

Window Width

400

Window Level

40

Quick Settings

Viewport Orientation



Viewports Order

Image Thickness Configuration



2 Notification Alerts

Projected Dose	CTDIvol	DLP	Dose	Phantom
DLP (mGy*cm)	(mGy)	(mGy*cm)	Efficiency	(cm)
1200.0	300.0	1200.0	91.51%	Body 32

Confirm Settings

Рис. 48. Программные пакеты для интервенционных процедур на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости)

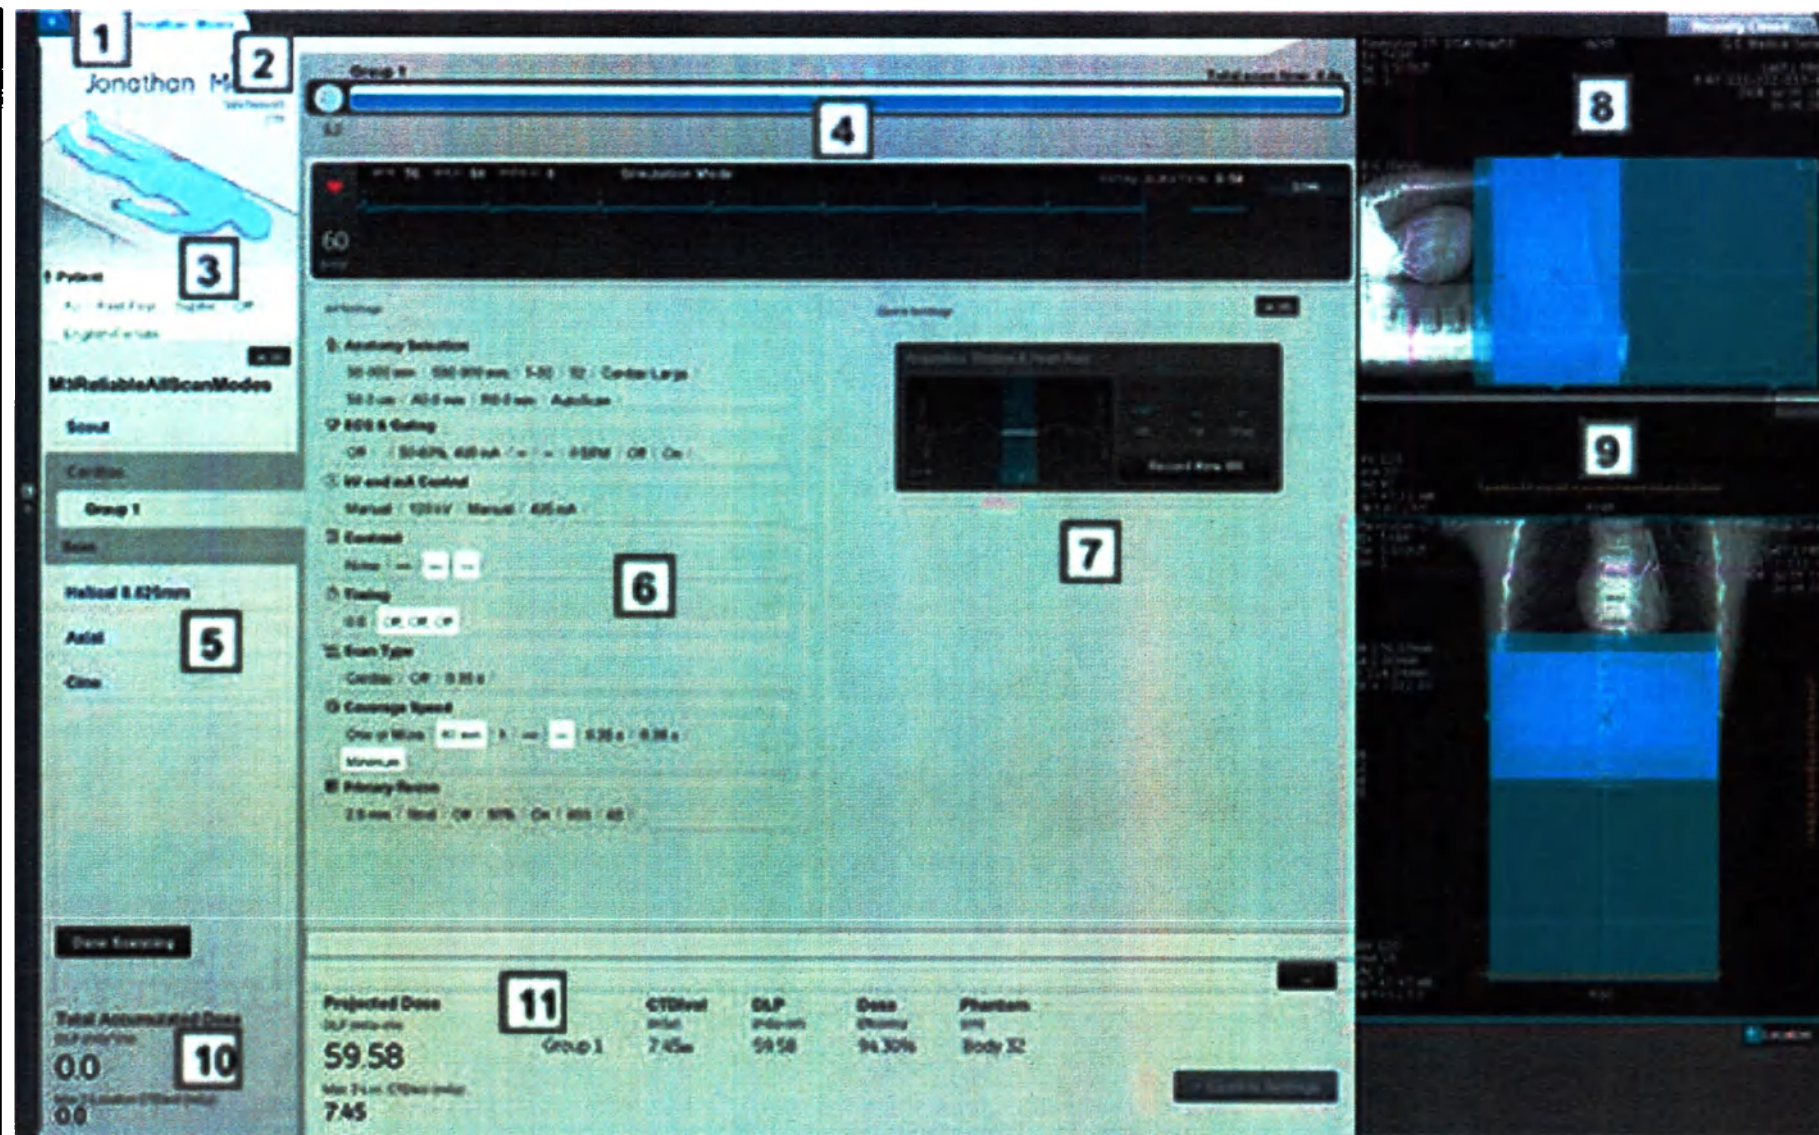


Рис. 50. Программные пакеты сбора данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

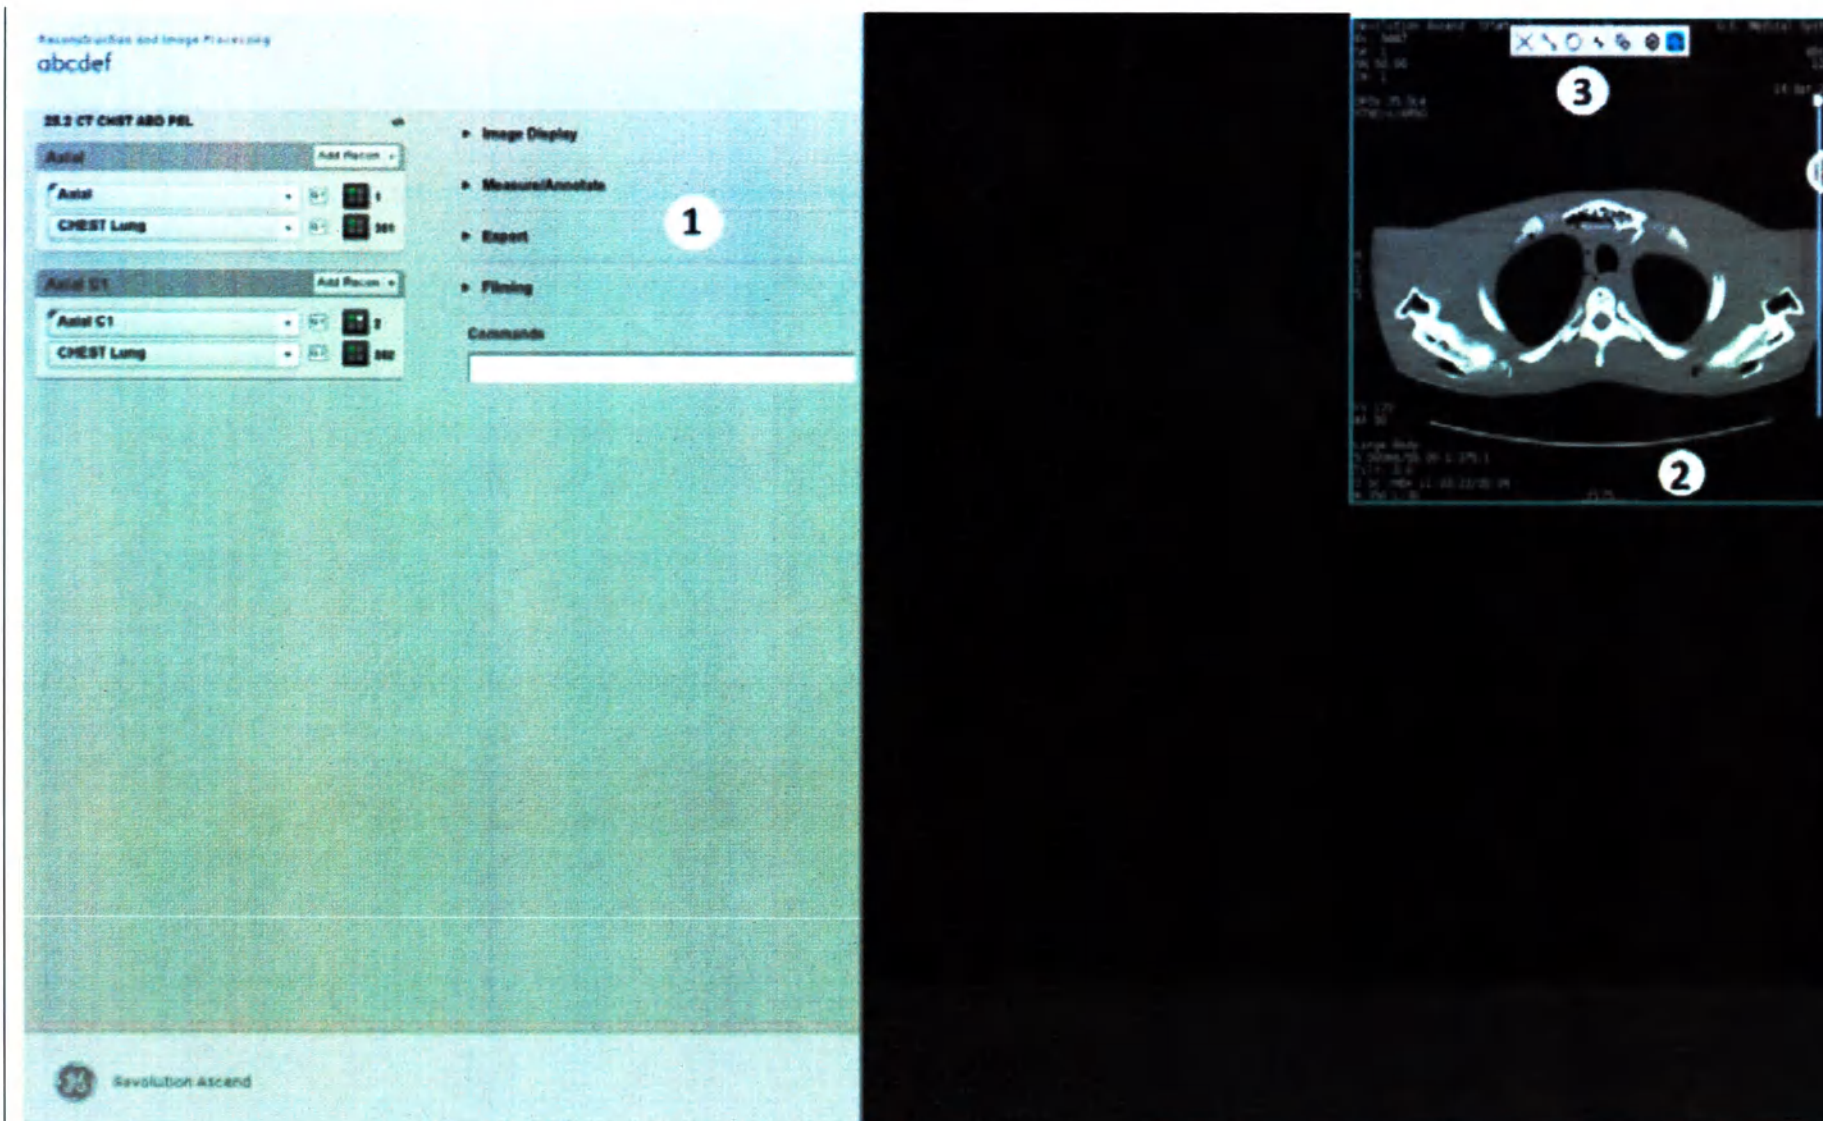


Рис. 51. Программные пакеты для визуализации полученных данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 20 шт. (при необходимости).

Scanning

123
4640



↑ Patient

SN / Feet First / Supine / On / Japanese

5.5 CHEST-PEL CE(1Phas...

Scout

Interventional Series C1

5mm AX STD

Group 1

Scan

5mm AX STD CE

Done Scanning

Total Accumulated Dose
DLP (mGy*cm)
5.96

Agent

IV Contrast Oral Contrast

IV Contrast On

Enhanced Xtream ... On

Contrast Agent

IV iod 300 mgI/ml

IV oip 350 mgI/ml

IV DDD 200 mgI/ml

Agent

Concentration

Add

Contrast Saline

0 ml 0 ml

Get Injector Parameters

Pressure Limit 150 PSI

Contrast Dose

	Inj. Delay	Type	Flow Rate	Volume	Duration
1	0	Contrast	1.0 ml/(s)	95 ml	95.0 s

Add Phase

Total Contrast Volume 95 ml

Cancel Apply

Coverage Speed

40 mm / 1.375:1 / 110.00 mm/s / 0.50 s / 4.22 s

Primary Recon

5.0 mm / 512 / Std / Off / Helical Plus / Off /

5.0000 mm / None / 40% / 300 / 25 / None

Gating And Trace

2 Notification Alerts

	Projected Dose DLP (mGy*cm)	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy*cm)	Dose Efficiency	Phantom (cm)
Group 1	109.07	2.44	109.07	91.51%	Body 32

Confirm Settings

Total Scan Time: 9.6s

mA Table

Maximum Projected NI 4.4

8.0

Prescribed NI

Рис. 52. Программные пакеты управления устройством введения контрастного вещества на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 20 шт. (при необходимости).

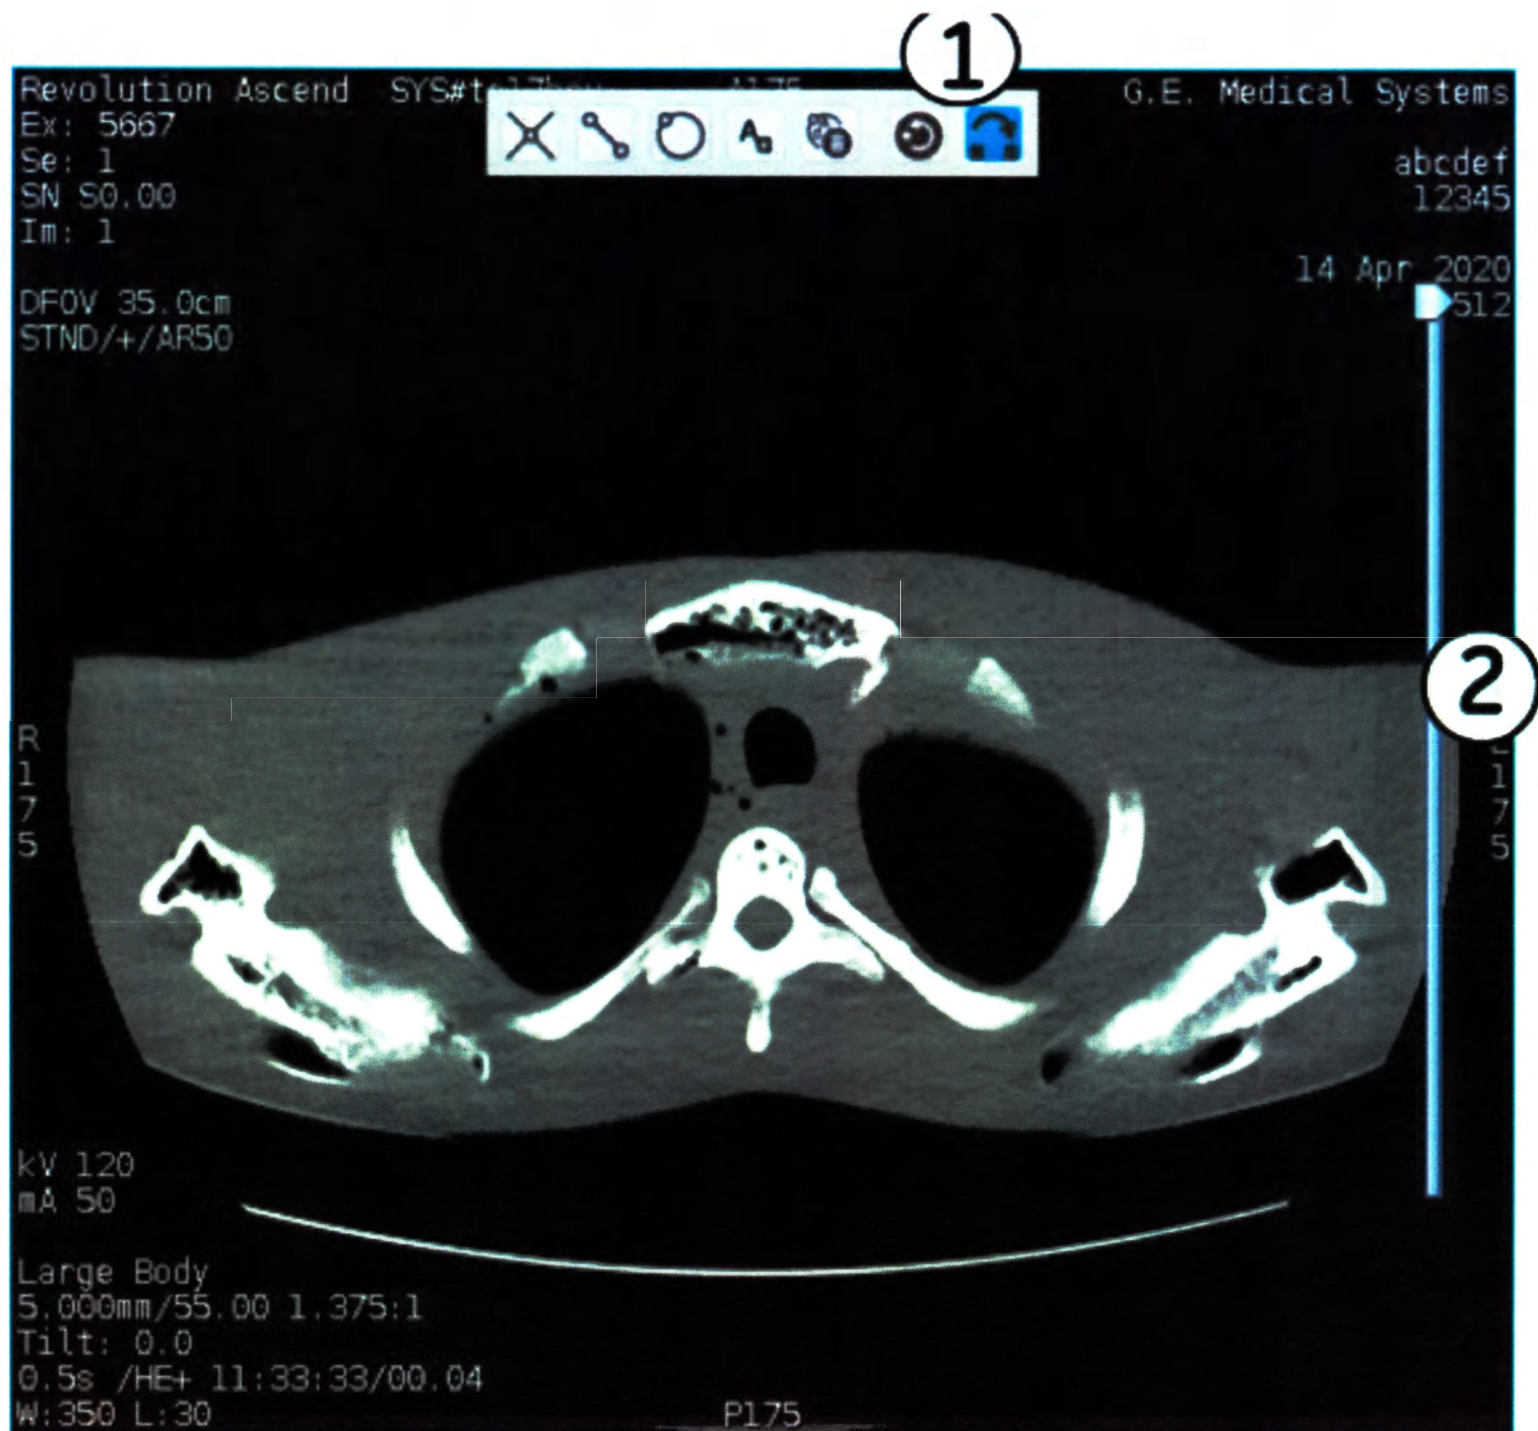


Рис. 53. Программные пакеты двухмерной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или серийных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

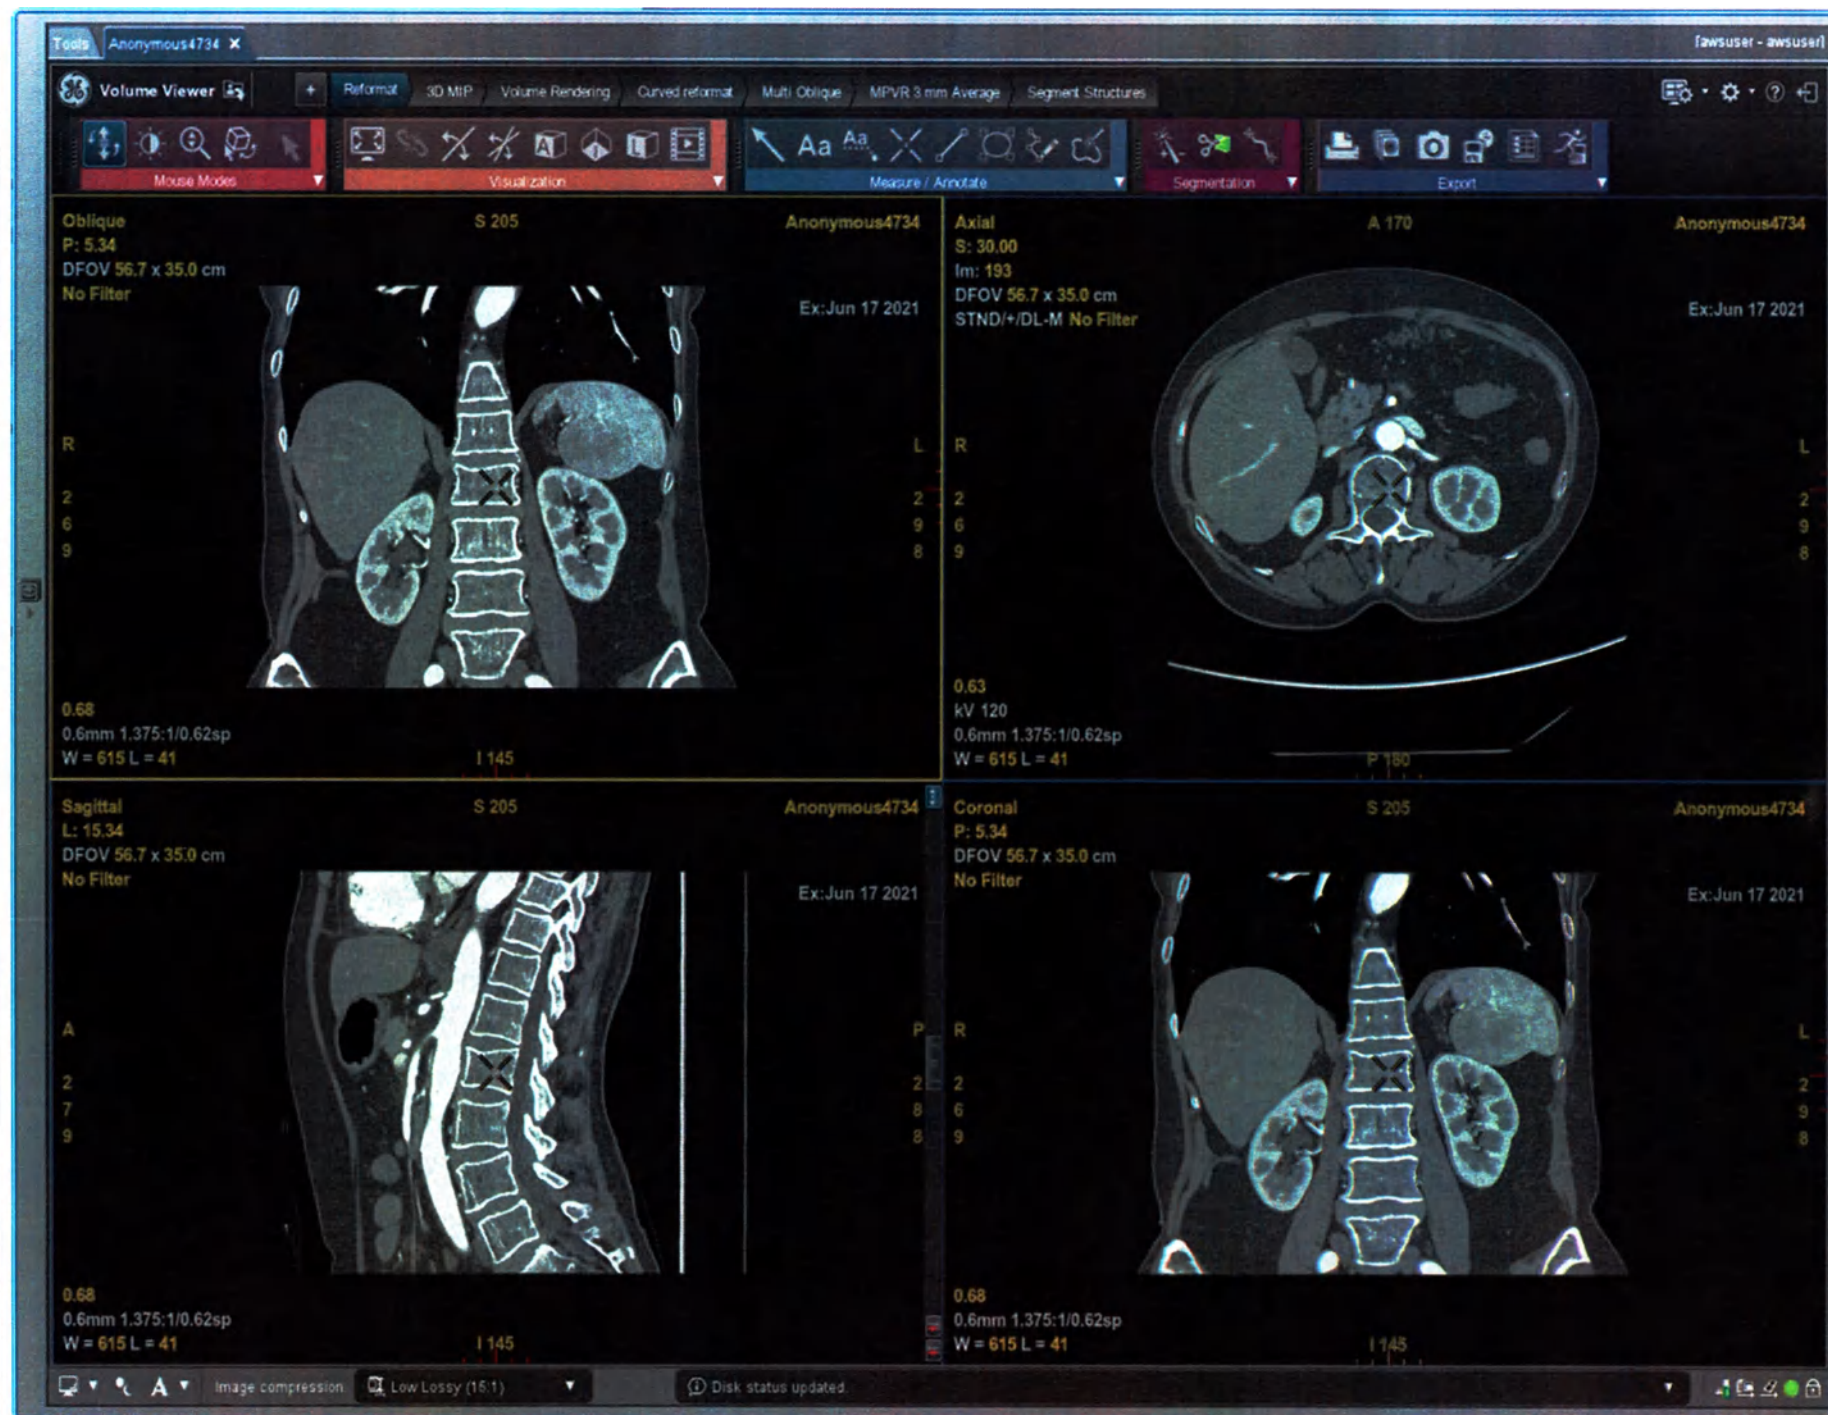


Рис. 54. Программные пакеты трехмерной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 55. Программные пакеты для объемной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

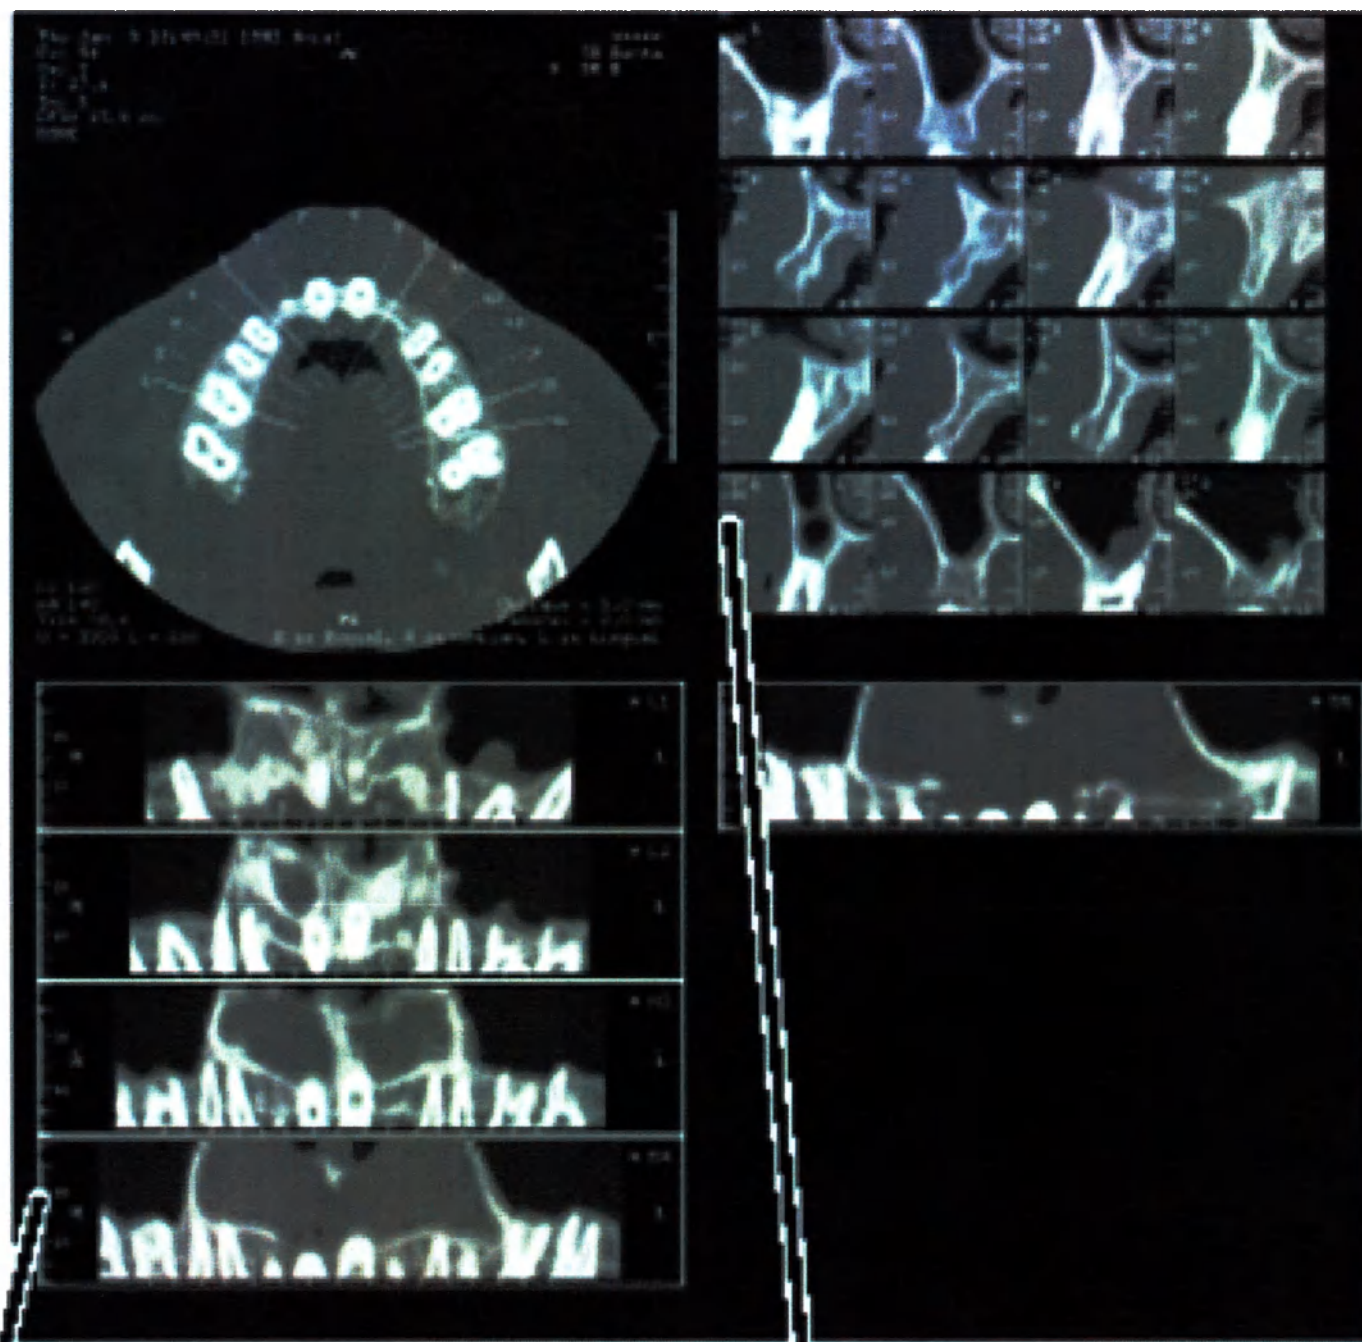


Рис. 56. Программные пакеты для челюстно-лицевой визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 57. Программные пакеты для сосудистой визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификата) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).

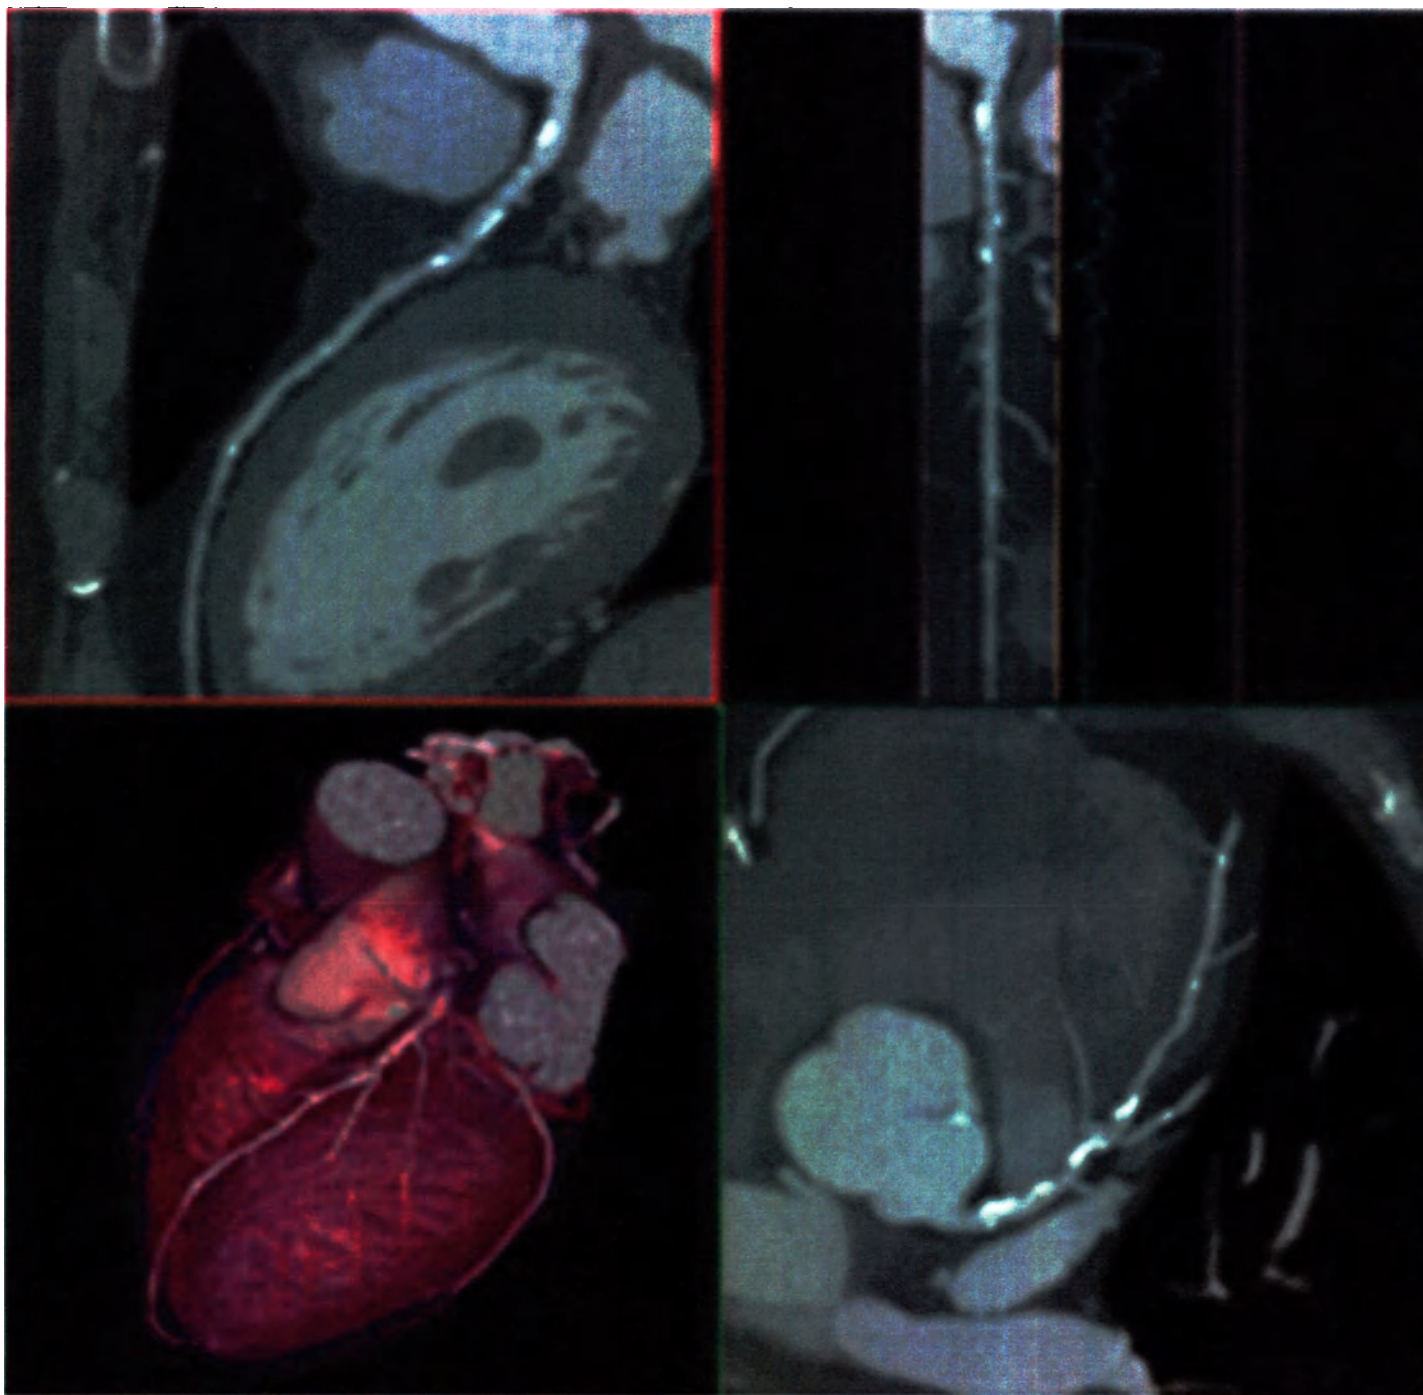


Рис. 58. Программные пакеты для работы с кардиоизображениями на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключевых) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 59. Программные пакеты для перфузионного расчета на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 60. Программные пакеты для кардиологического и сосудистого расчета на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителе – не более 5 шт. (при необходимости).



Рис. 61. Программные пакеты для легочной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).

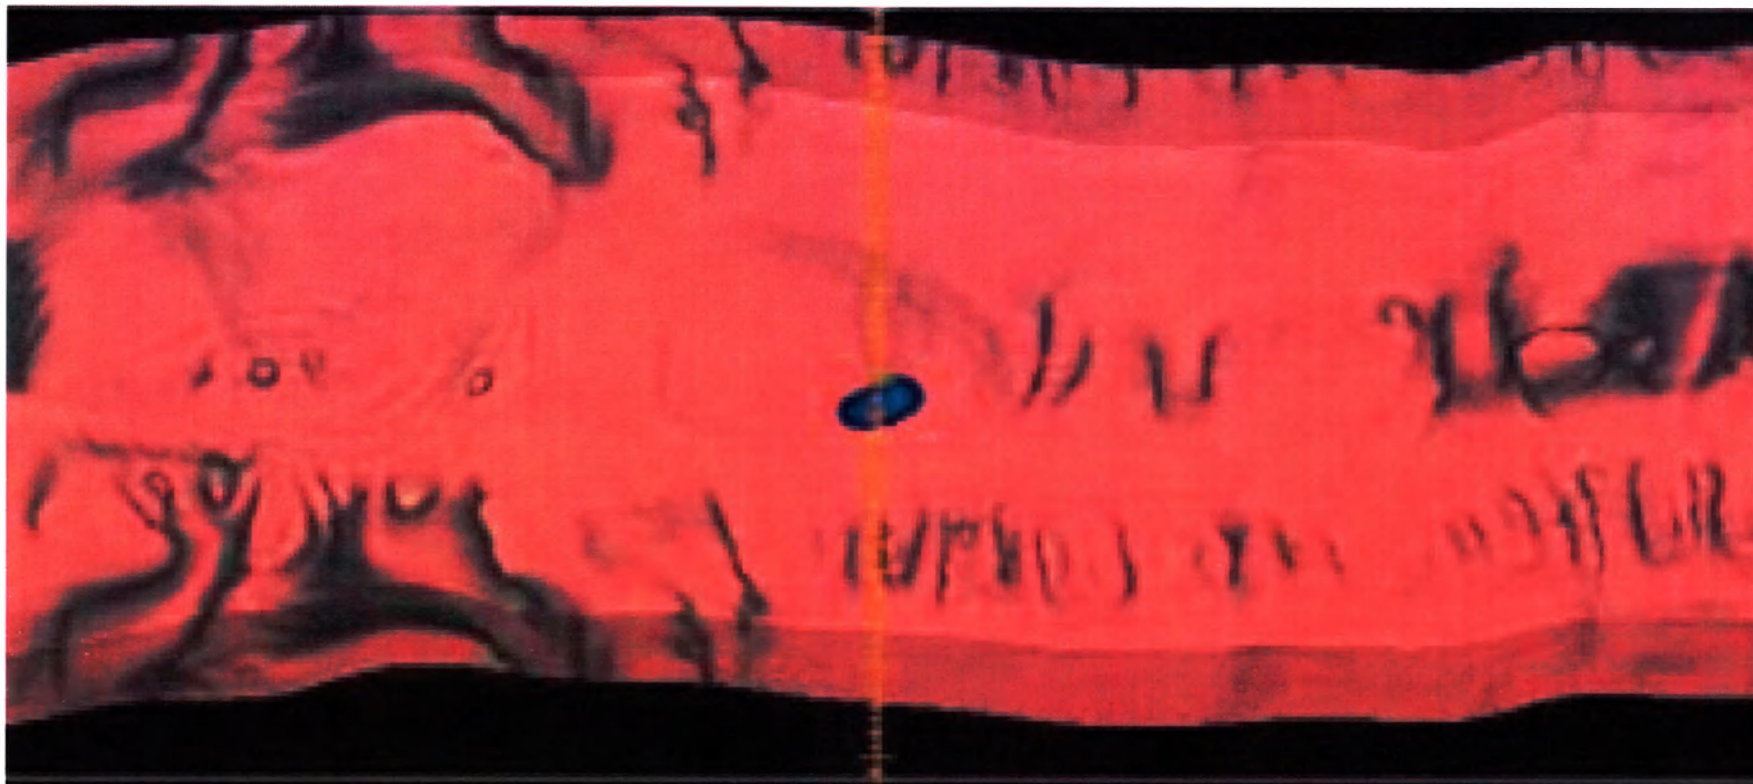


Рис. 62. Программные пакеты для кишечной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

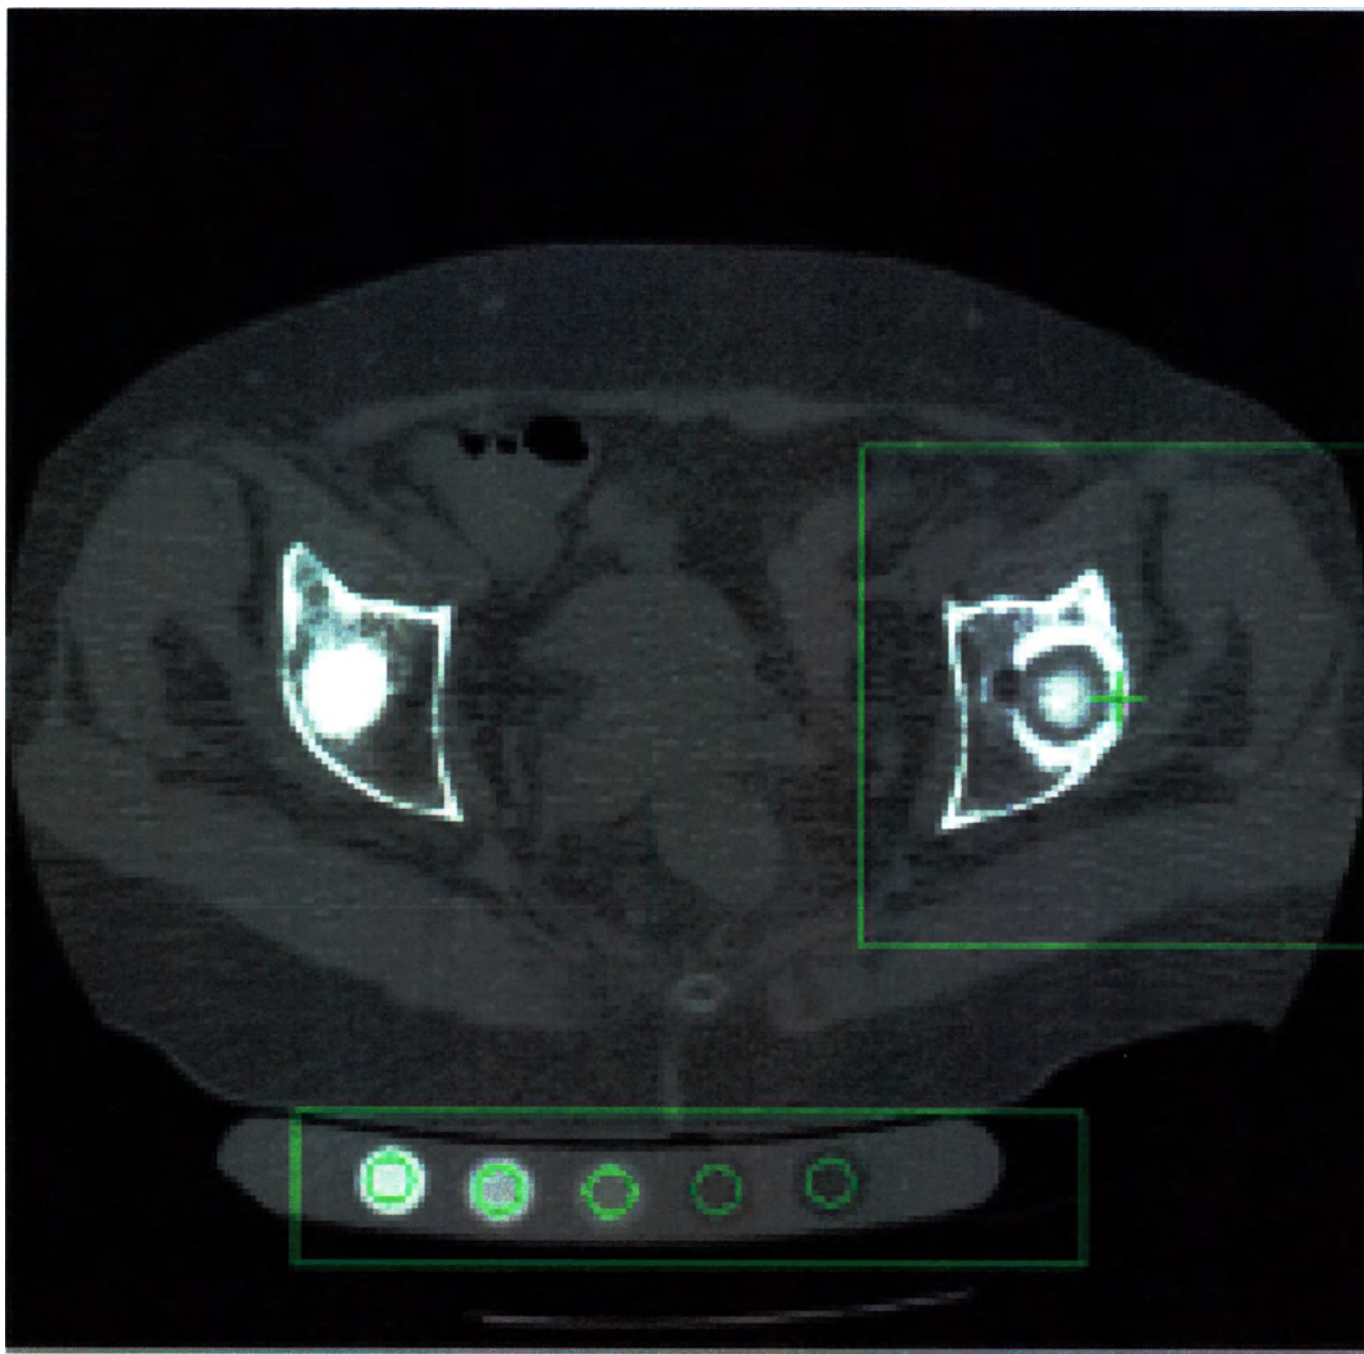


Рис. 63. Программные пакеты расчета костной плотности на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 5 шт. (при необходимости).

Scanning

123
4642



↑ Patient

OM Head First / Supine / Off /

English (Male)

21.11 CT HEAD PERFUS ...

Scout

Scout

Pre Contrast Brain

Perfusion

Group 1

Scan

Post Contrast Brain

Done Scanning

Total Accumulated Dose

DLP (mGy*cm)

5.96

Group 1

Total Scan Time: 57.0s

7.0s 50.0s

All Settings

↑ Anatomy Selection

S30.000 mm / S105.000 mm / 1-272 / 272 / S0.0 * /

Head / 25.0 cm / A0.0 mm / R0.0 mm / Auto Scan /

Stroke, Perfusion

⌚ kV and mA Control

Manual / 80 kV / SmartmA 100-400 / 8.0 / S

∞ Contrast

Off / --- / Off / --- / Off / ---

⌚ Timing

7.0 s / 1.0 s / Off / Off, Off, Off

📄 Scan Type

Scan Type

Rotator Time

▢ Axial

0.50 s

⌚ Coverage Speed

Table Positions

Detector Coverage

Number of Passes

Minimum Time Between P...

Scan Interval

Rotation Time

Total Exposure Time

Two

48 mm

17

3.00 s

48.000 mm

0.50 s

17.00 s

📄 Primary Recon

5.0 mm / 512 / Std / Off / None / 50% / 100 / 30 /

None

♥ Gating And Trace

Quick Settings

Projected Dose	CTDIvol	DLP	Dose	Phantom
DLP (mGy*cm)	(mGy)	(mGy*cm)	Efficiency	(cm)
777.11	97.14	777.11	91.51%	Head 16

Confirm Settings

Рис. 64. Программные пакеты челночного сканирования на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 66. Основные программные модули станции рабочей AW VolumeShare на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителе – не более 10 шт. (при необходимости).

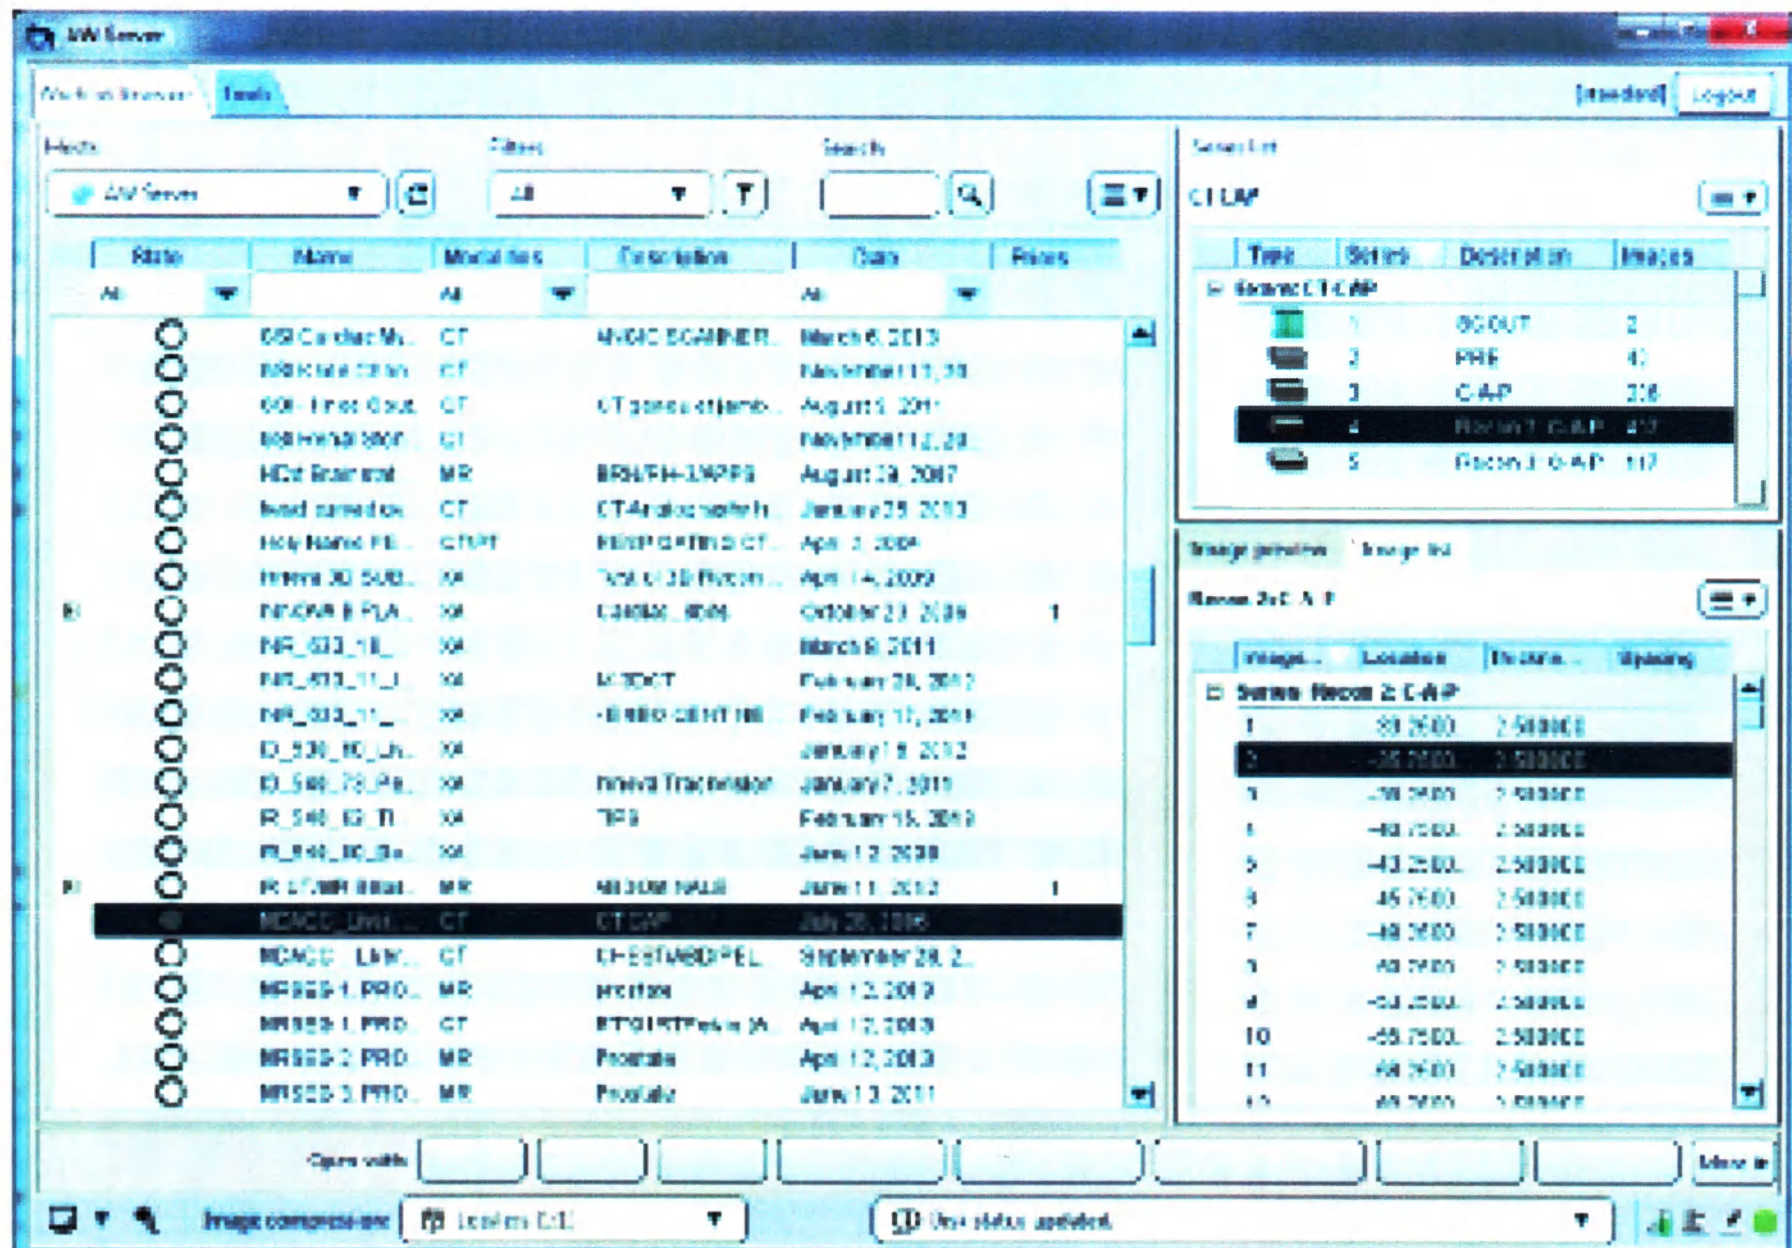


Рис. 67. Основные программные модули сервера станции рабочей AW VolumeShare на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

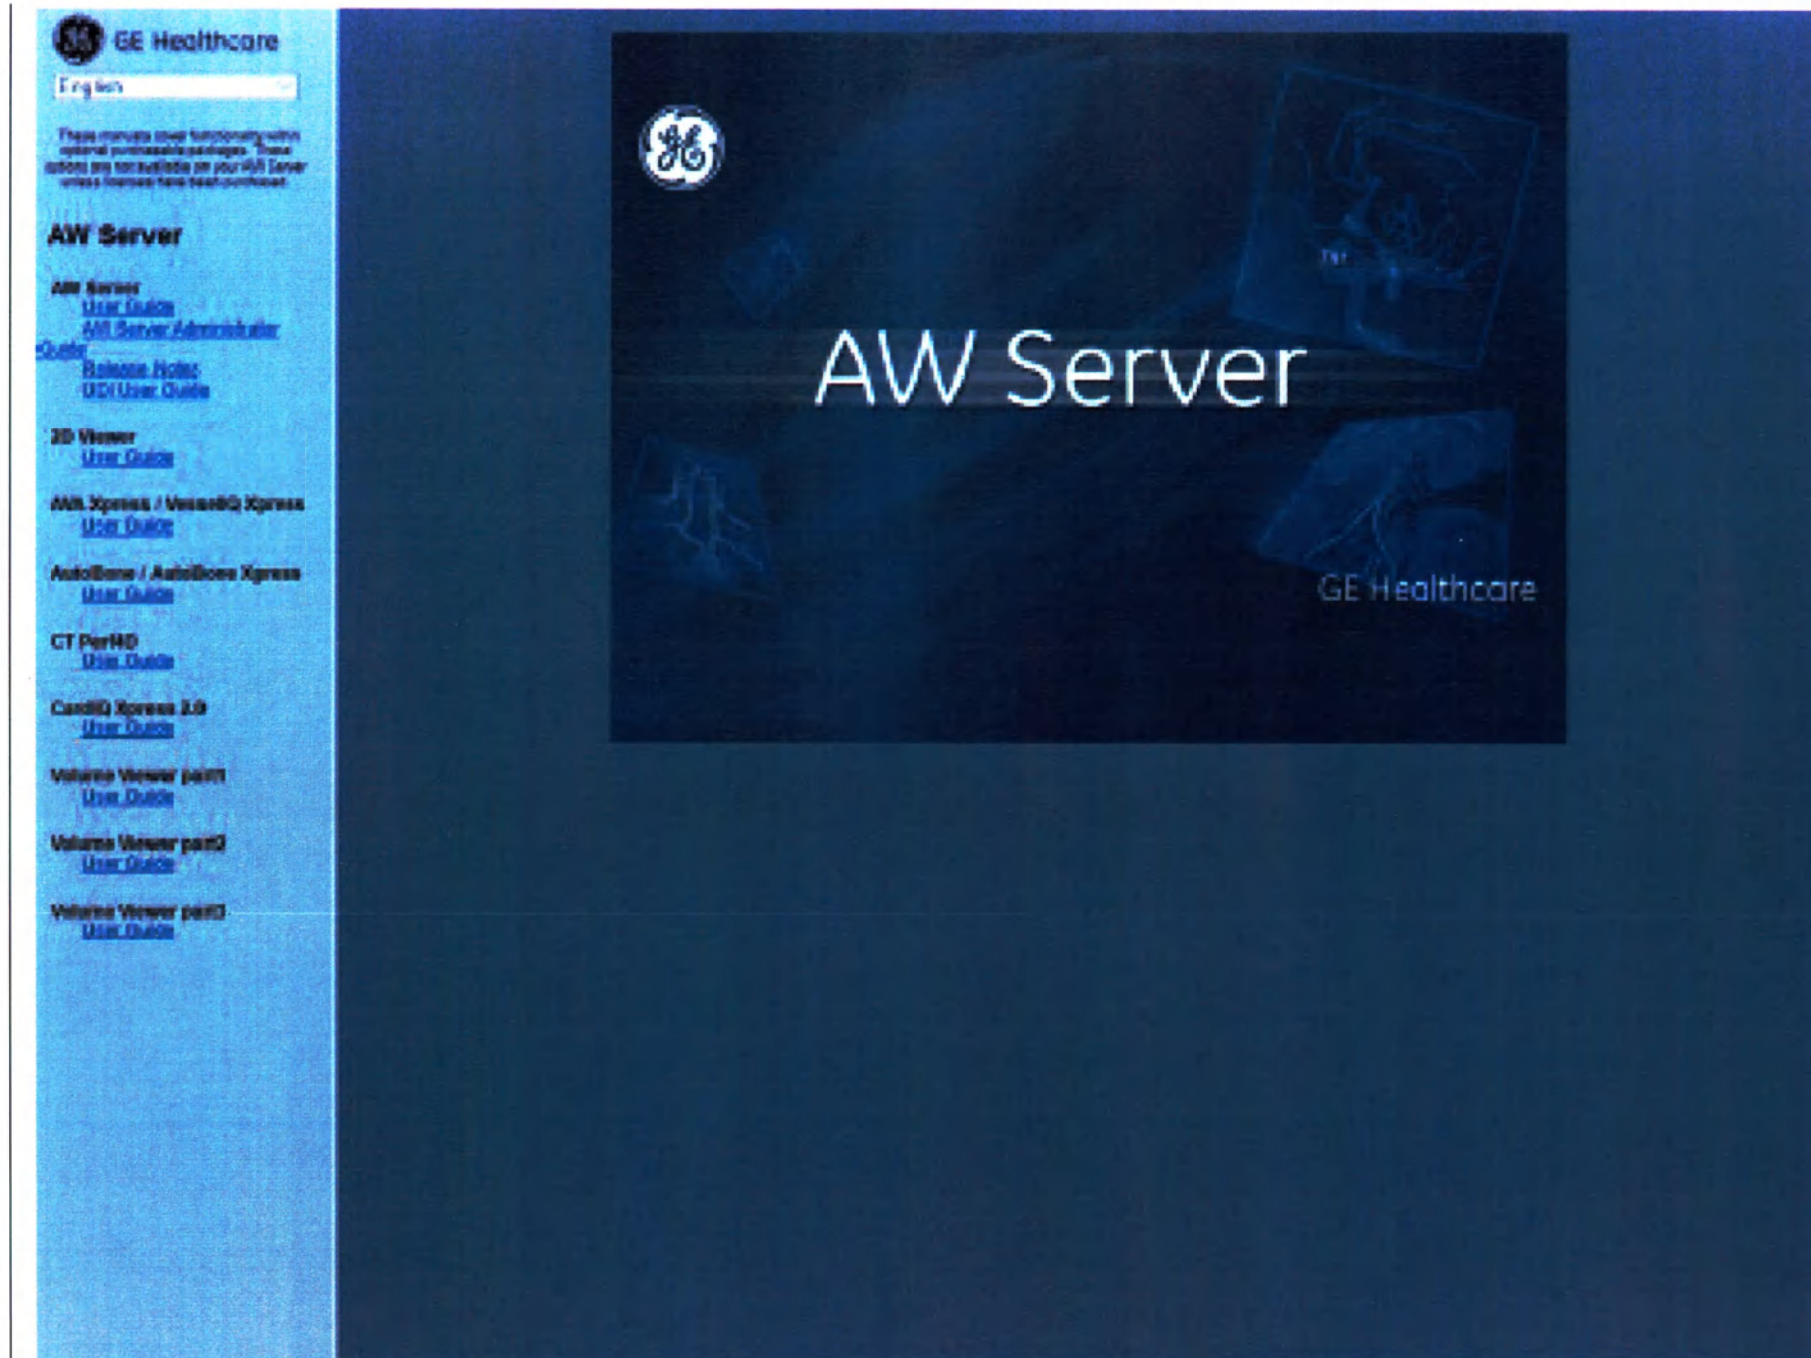


Рис. 68. Программные пакеты клиентского доступа на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 69. Программные пакеты обновления программного обеспечения рабочей станции на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

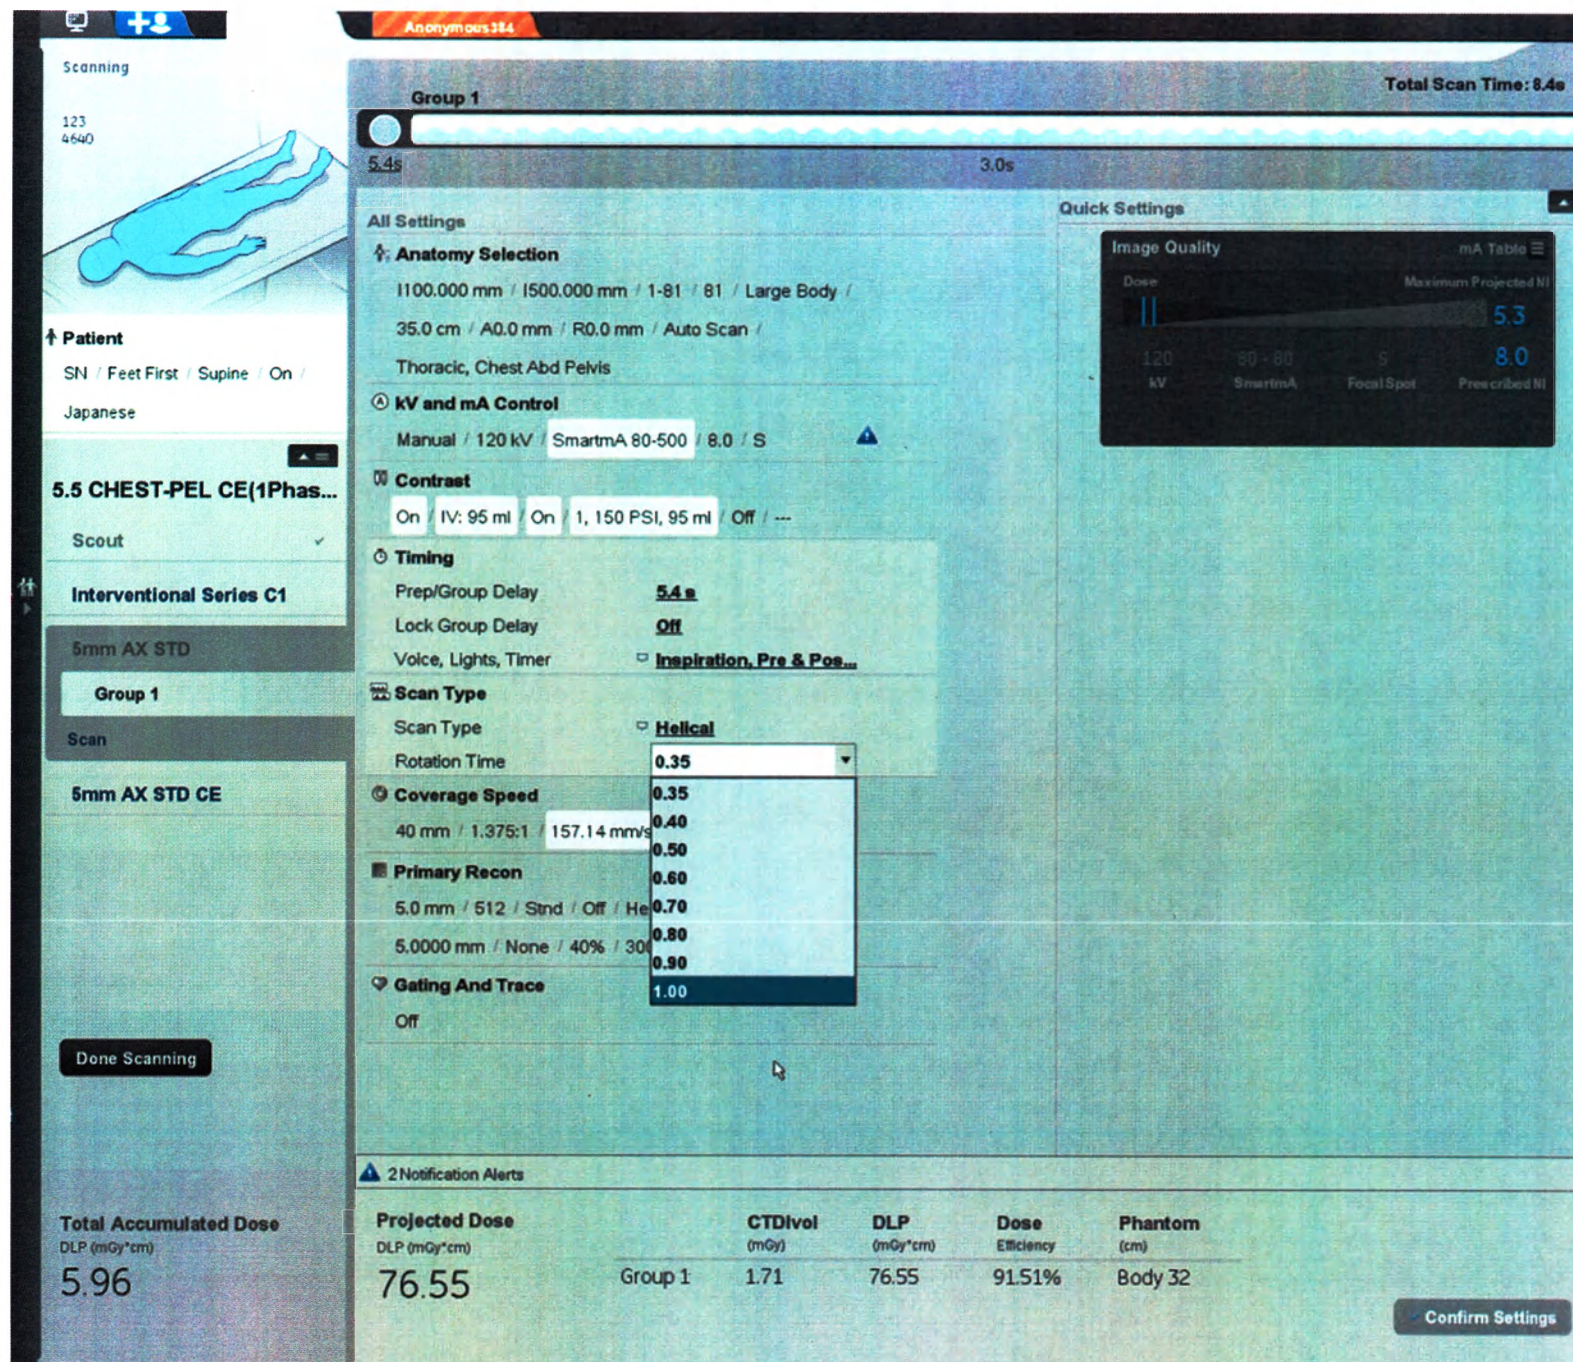


Рис. 70. Программные пакеты для сканирования на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

Patient Name	Exam Description	Patient ID
REV KNEE	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	AW5454
REV TAVI	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	AW1997
REV TAVI	ANONYMIZED	AW9989
REV CARD	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	AW1622
REV CARE	ANONYMIZED	AW1229
rep img 2		rep img 2
rep img		rep img

Open exam

Send Exam To ▶

Anonymize Patient

Edit Patient

Exam Split

Add / Sub

Reformat

Vol Viewer

Send PPS ▶

Delete Exam

Exam Split

Рис. 71. Программные пакеты для разделения данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 20 шт. (при необходимости).



Рис. 72. Программные пакеты для сегментации костных структур на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

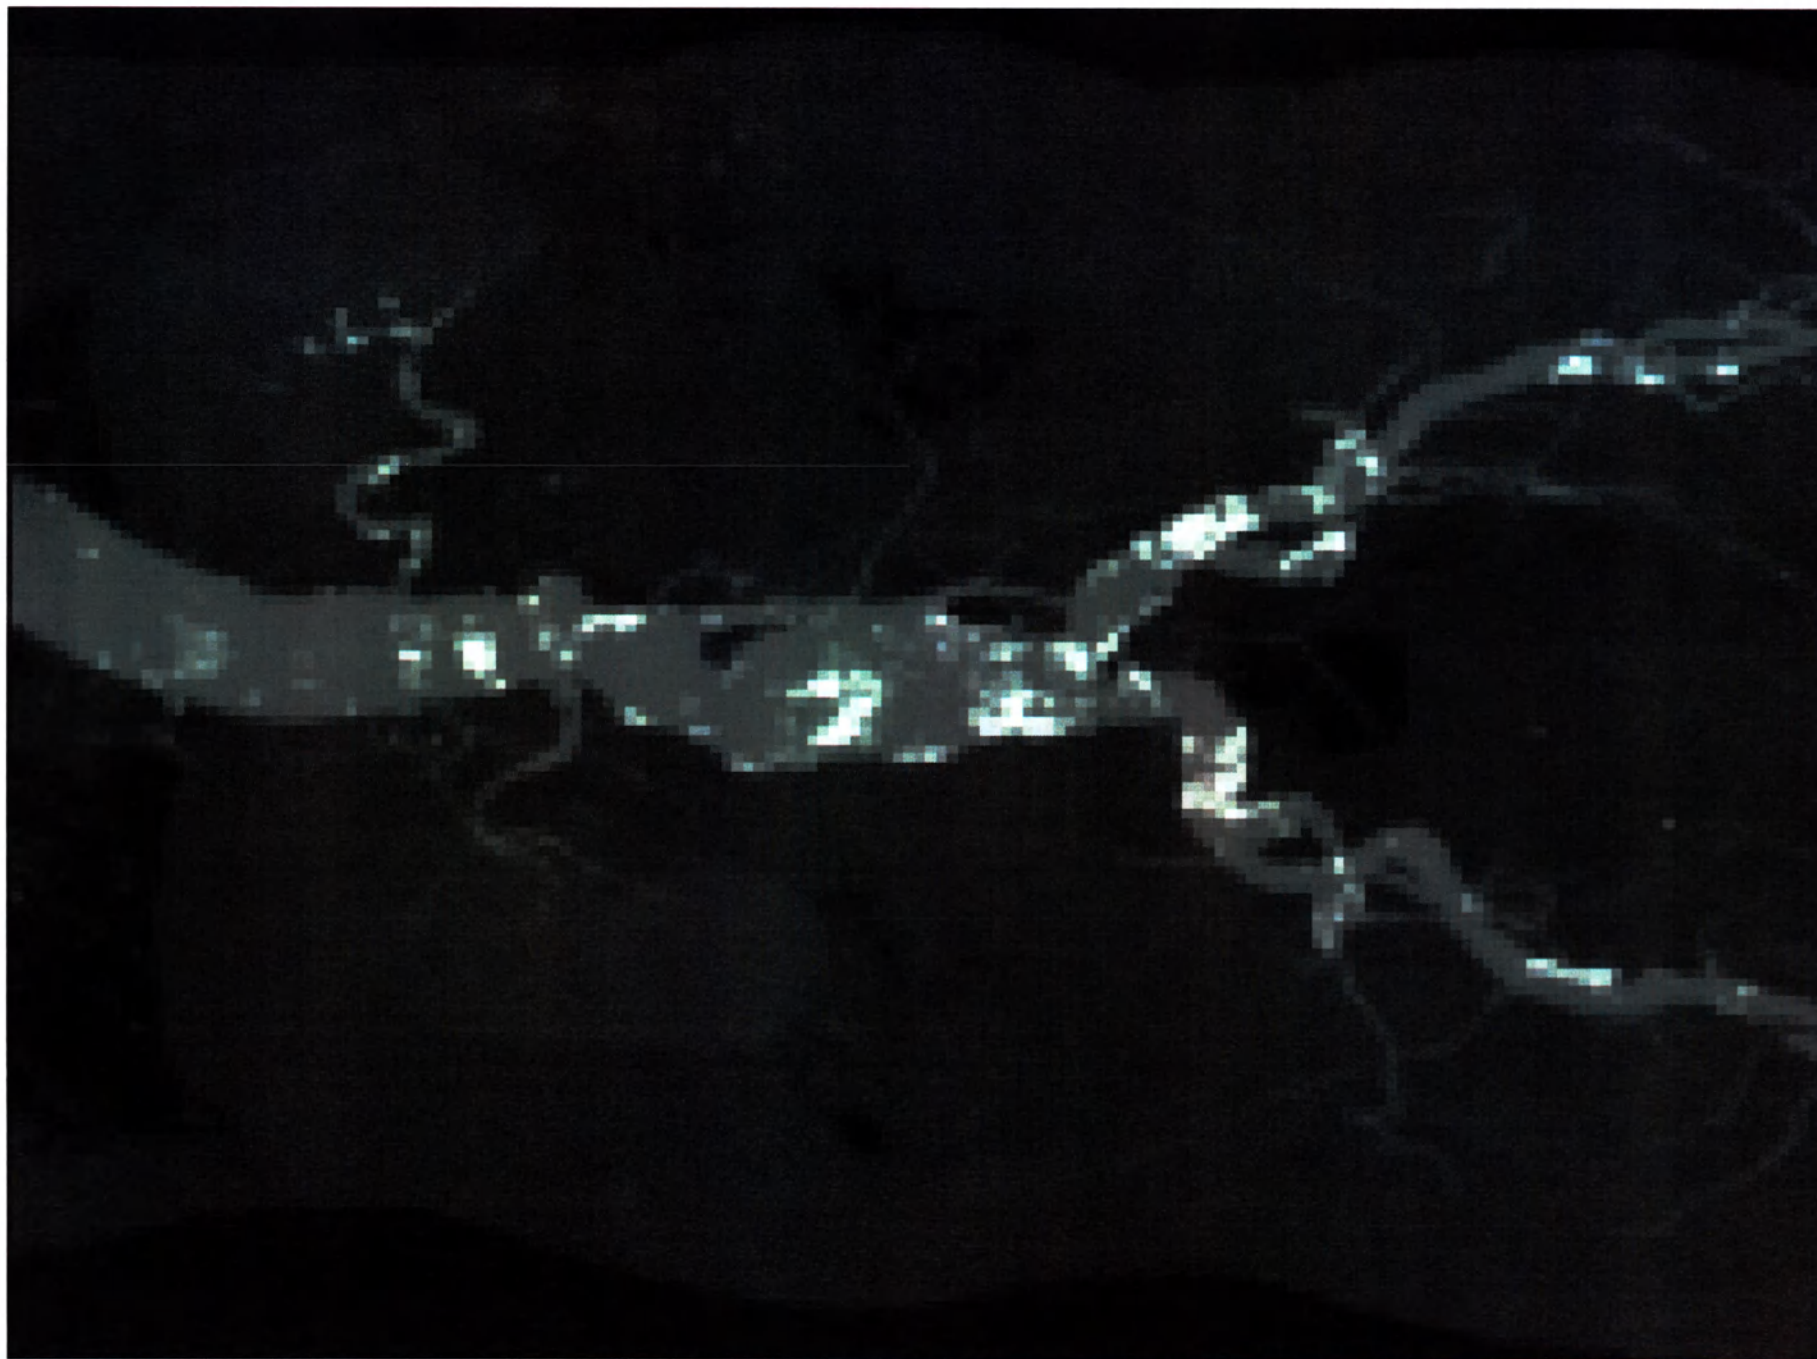


Рис. 73. Программные пакеты для исследования сосудистого русла на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

■ Recon Settings

Thickness	<u>2.5 mm</u>
Matrix Size	<u>512</u>
Recon Type	<u>Stnd</u>
Enhanced Contrast	Off
Image Enhance Filter	<u>None</u>
ASIR-V	<u>50%</u>
MAR	<u>Off</u>
Window Width	<u>350</u>
Window Level	<u>30</u>
Flip / Rotate	None

Рис. 74. Программные пакеты для выполнения двух и трехмерных реконструкций изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).

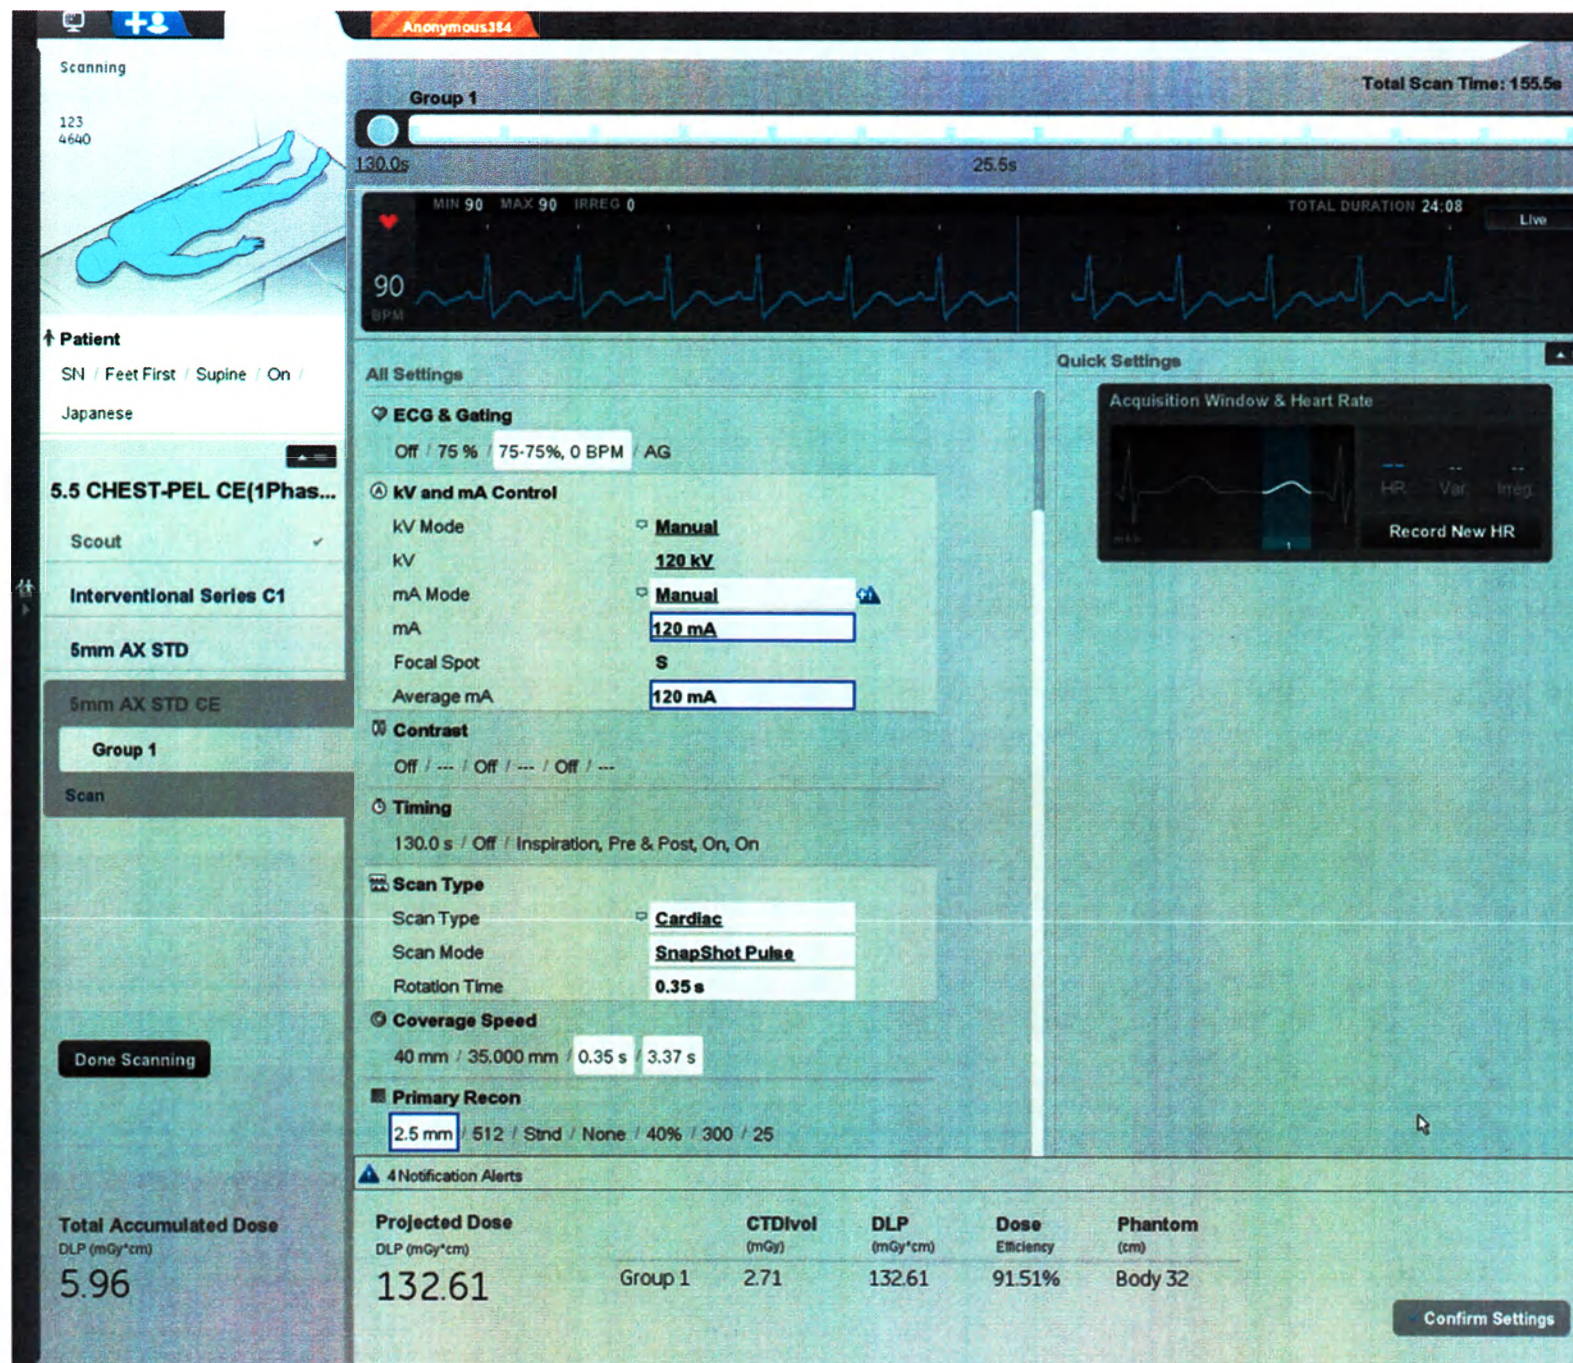


Рис. 75. Программные пакеты для кардиологии на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).

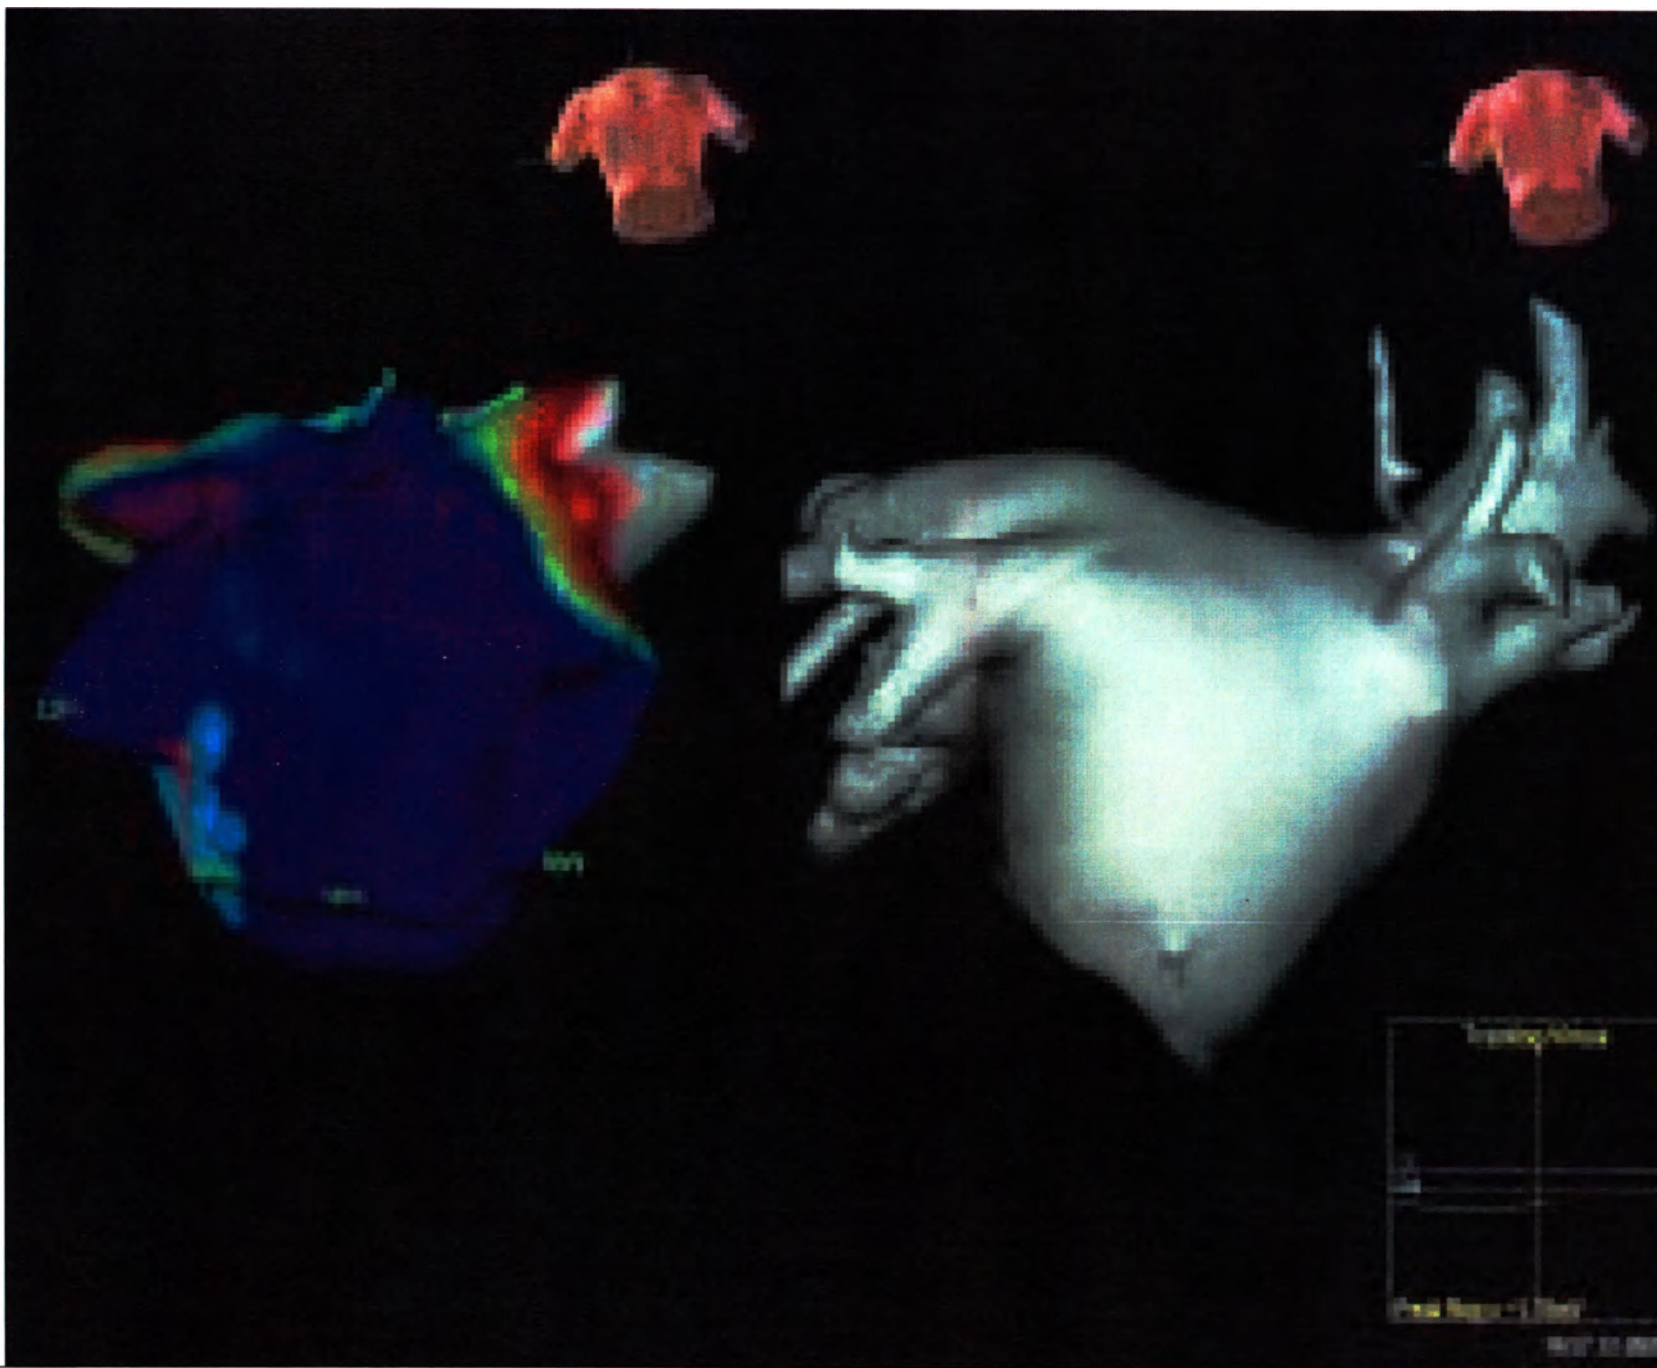


Рис. 76. Программные пакеты для анализа кардиологических и электрофизиологических изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

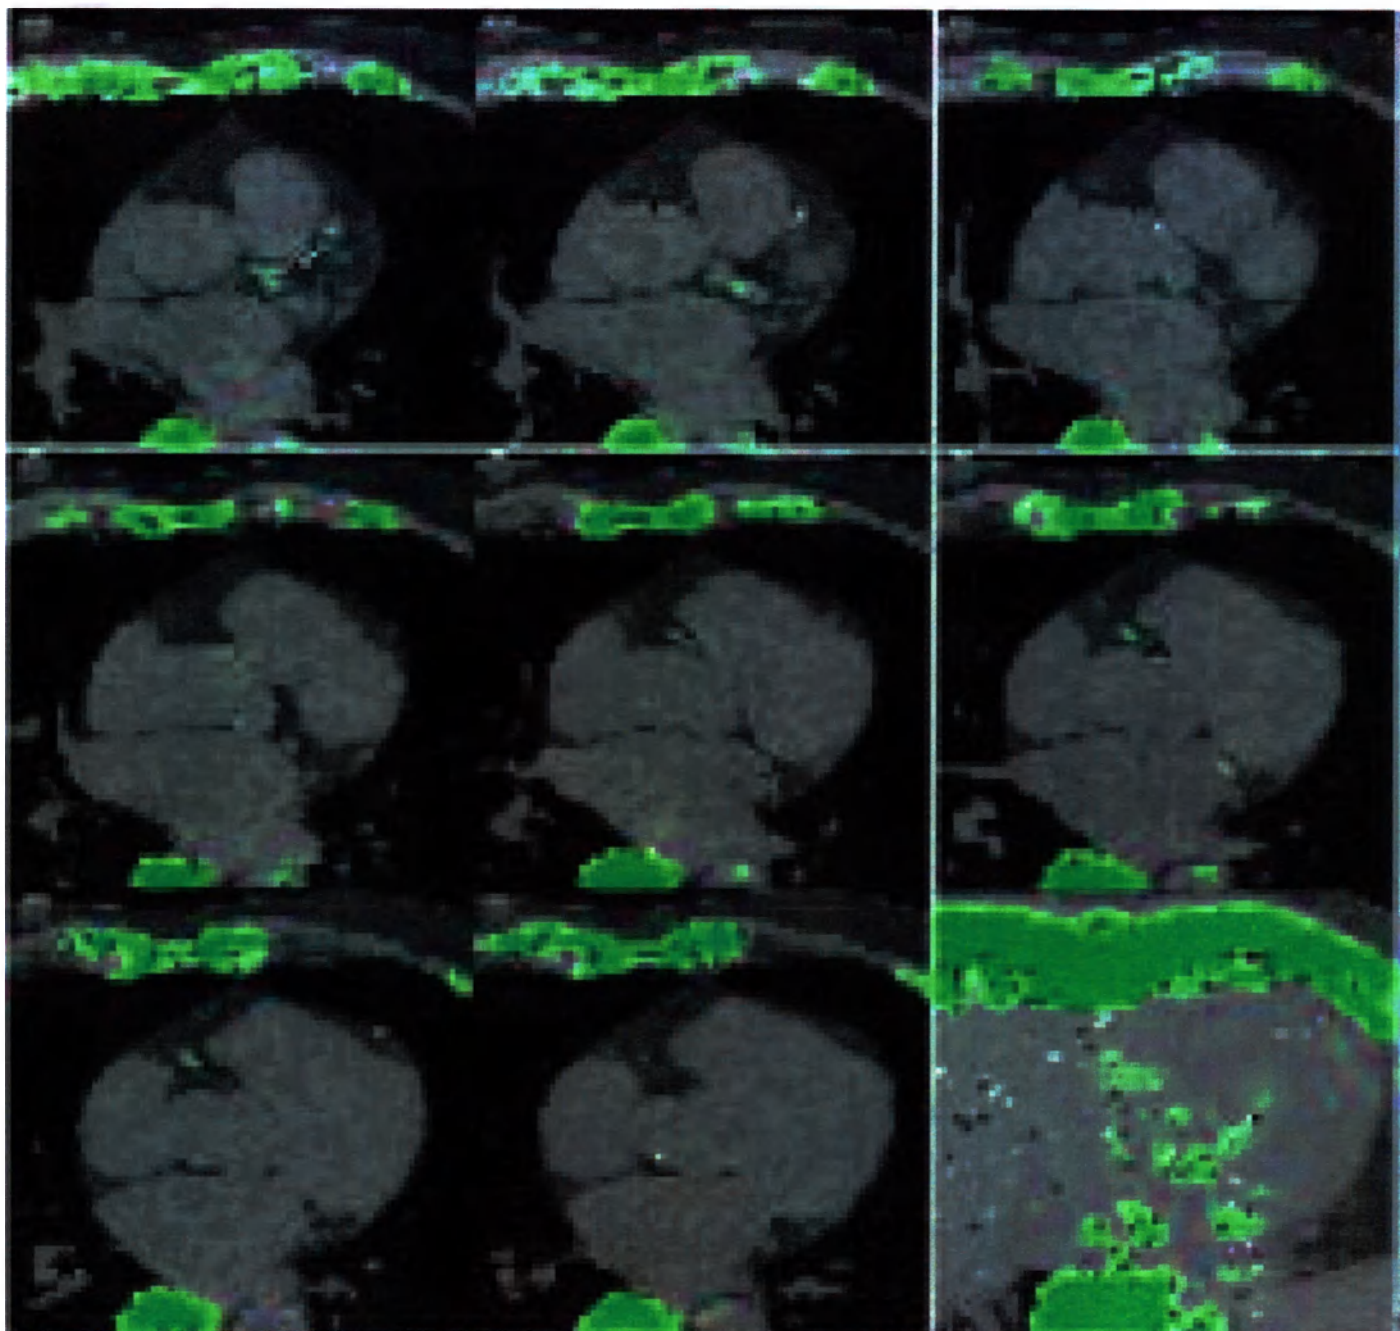


Рис. 77. Программные пакеты для оценки кальцинирования атеросклеротических бляшек на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

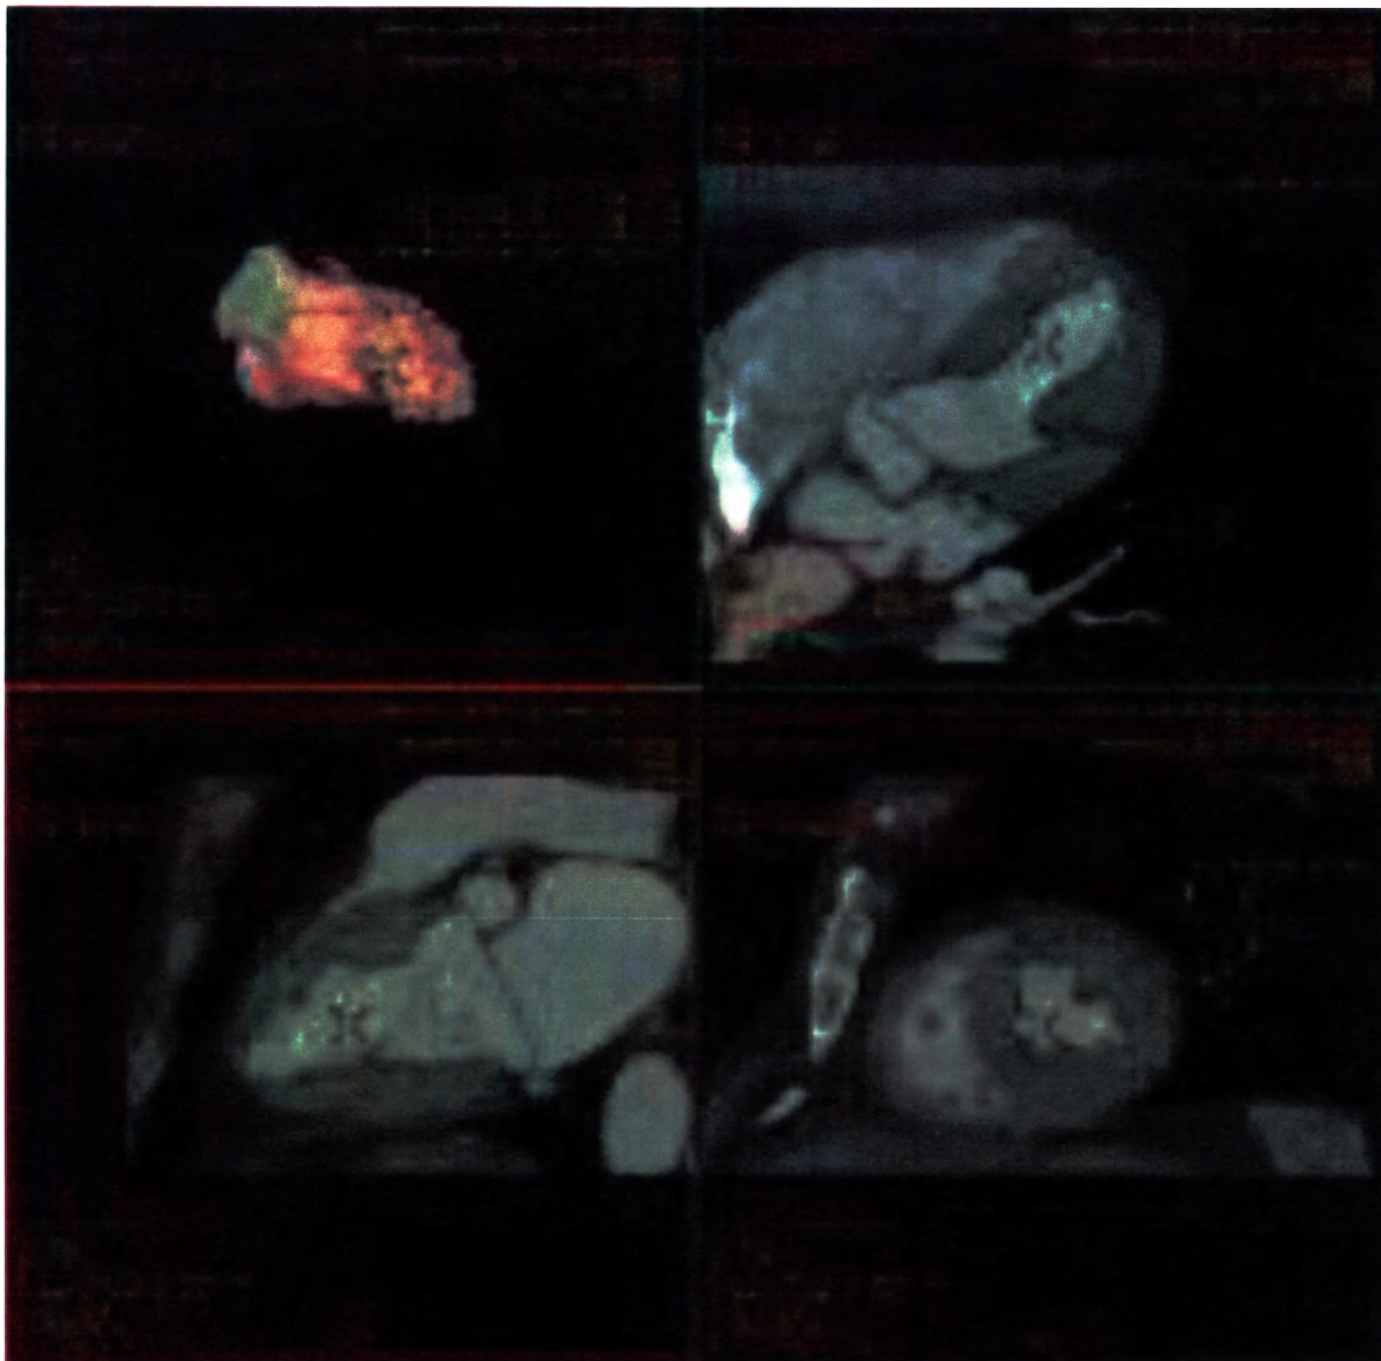


Рис. 78. Программные пакеты для количественной оценки функции желудочков сердца на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

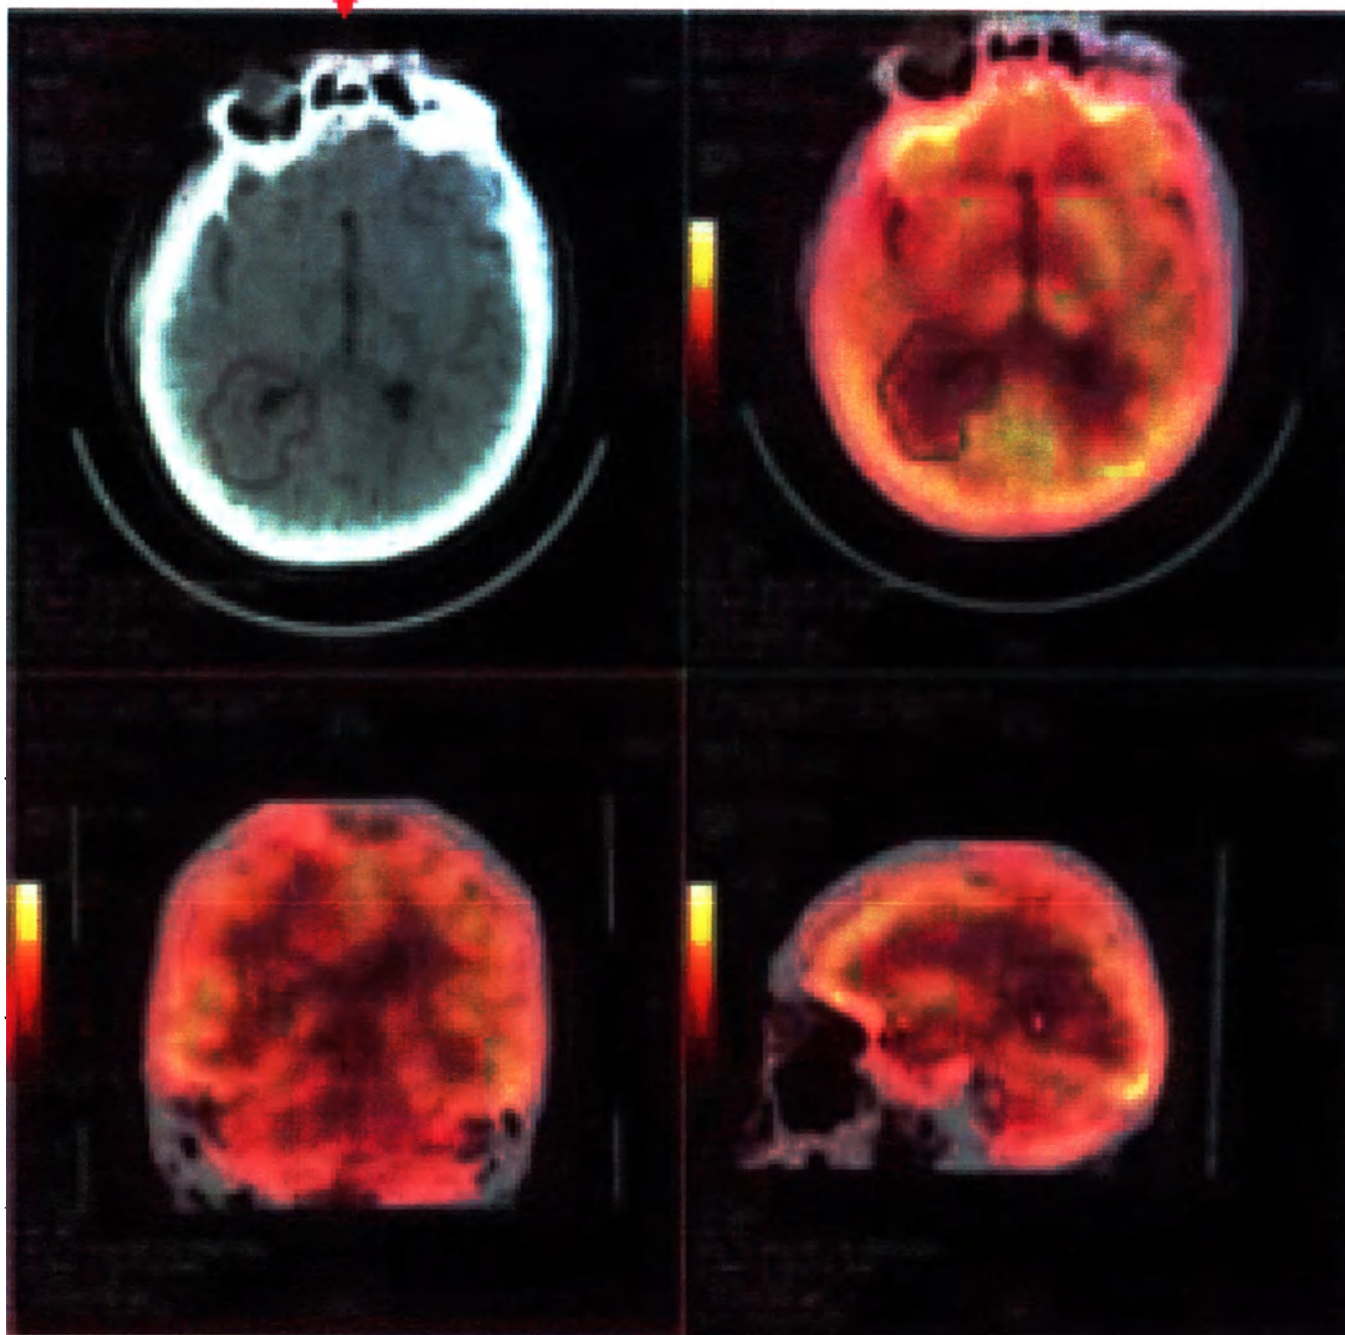


Рис. 79. Программные пакеты для совместного исследования изображений КТ, МРТ и ПЭТ на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

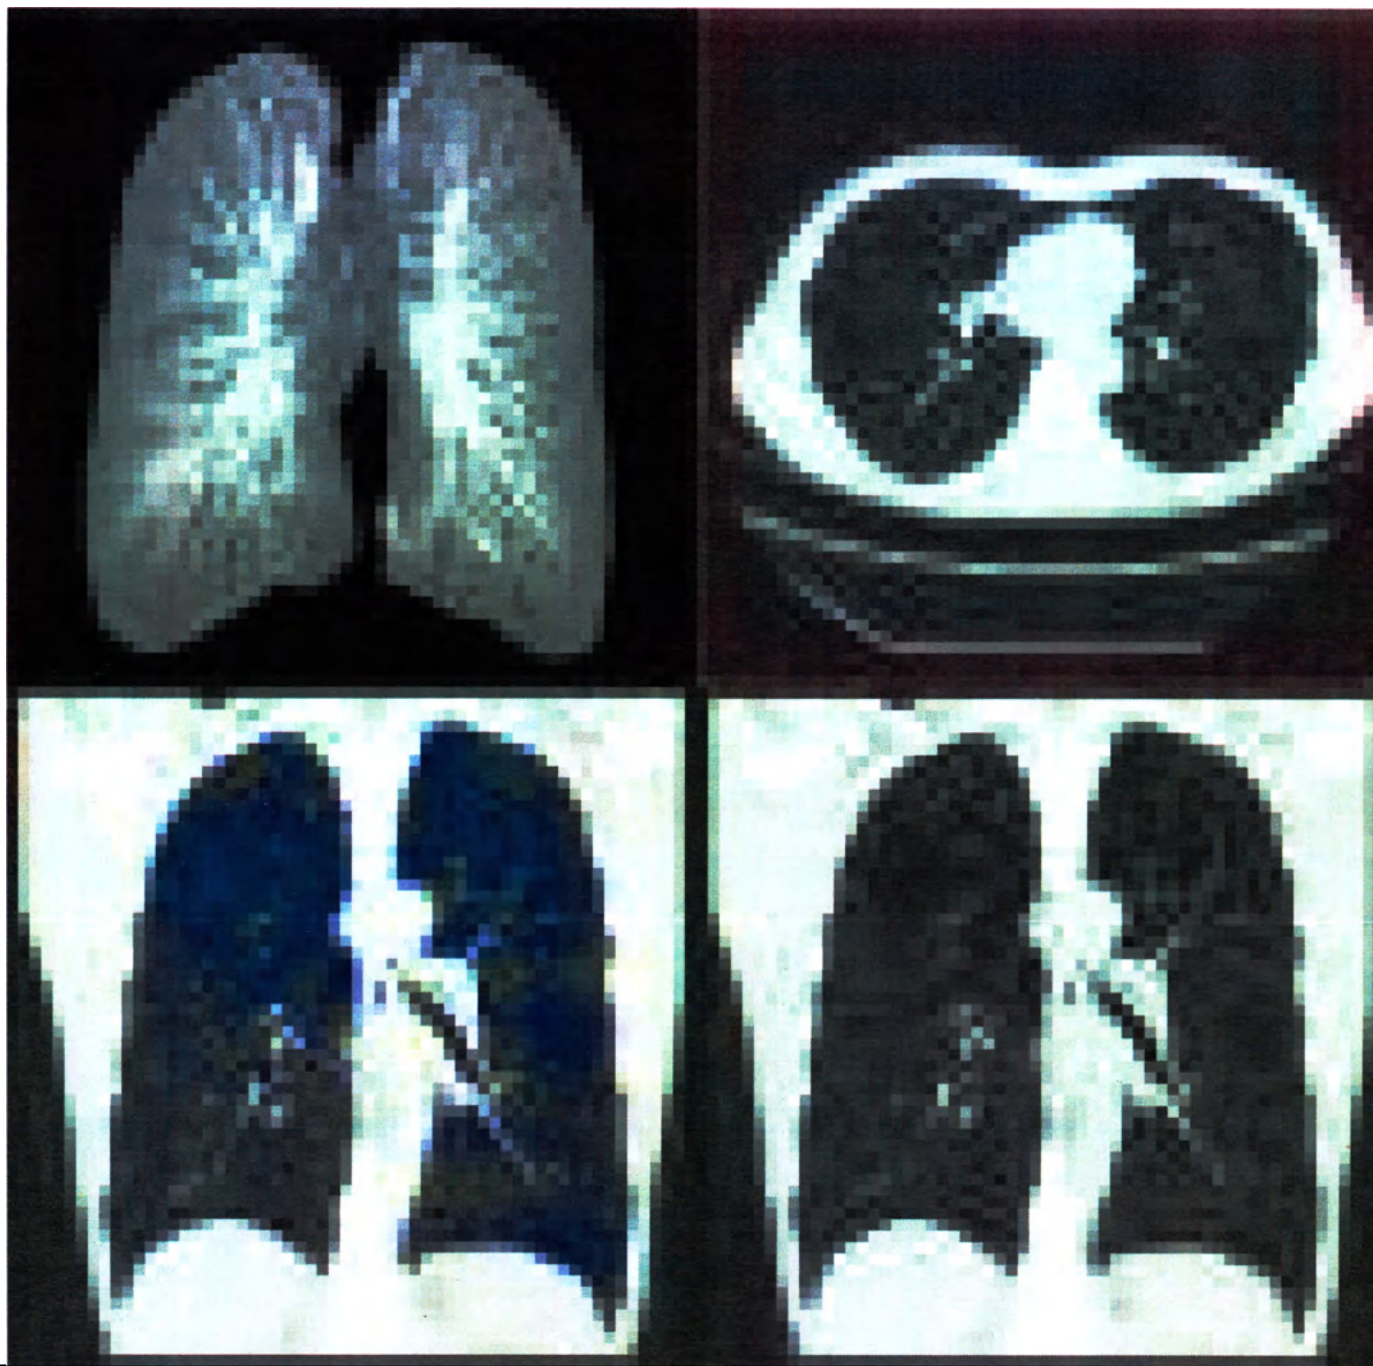


Рис. 80. Программные пакеты для виртуальной бронхоскопии и исследования узелков в легких на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).

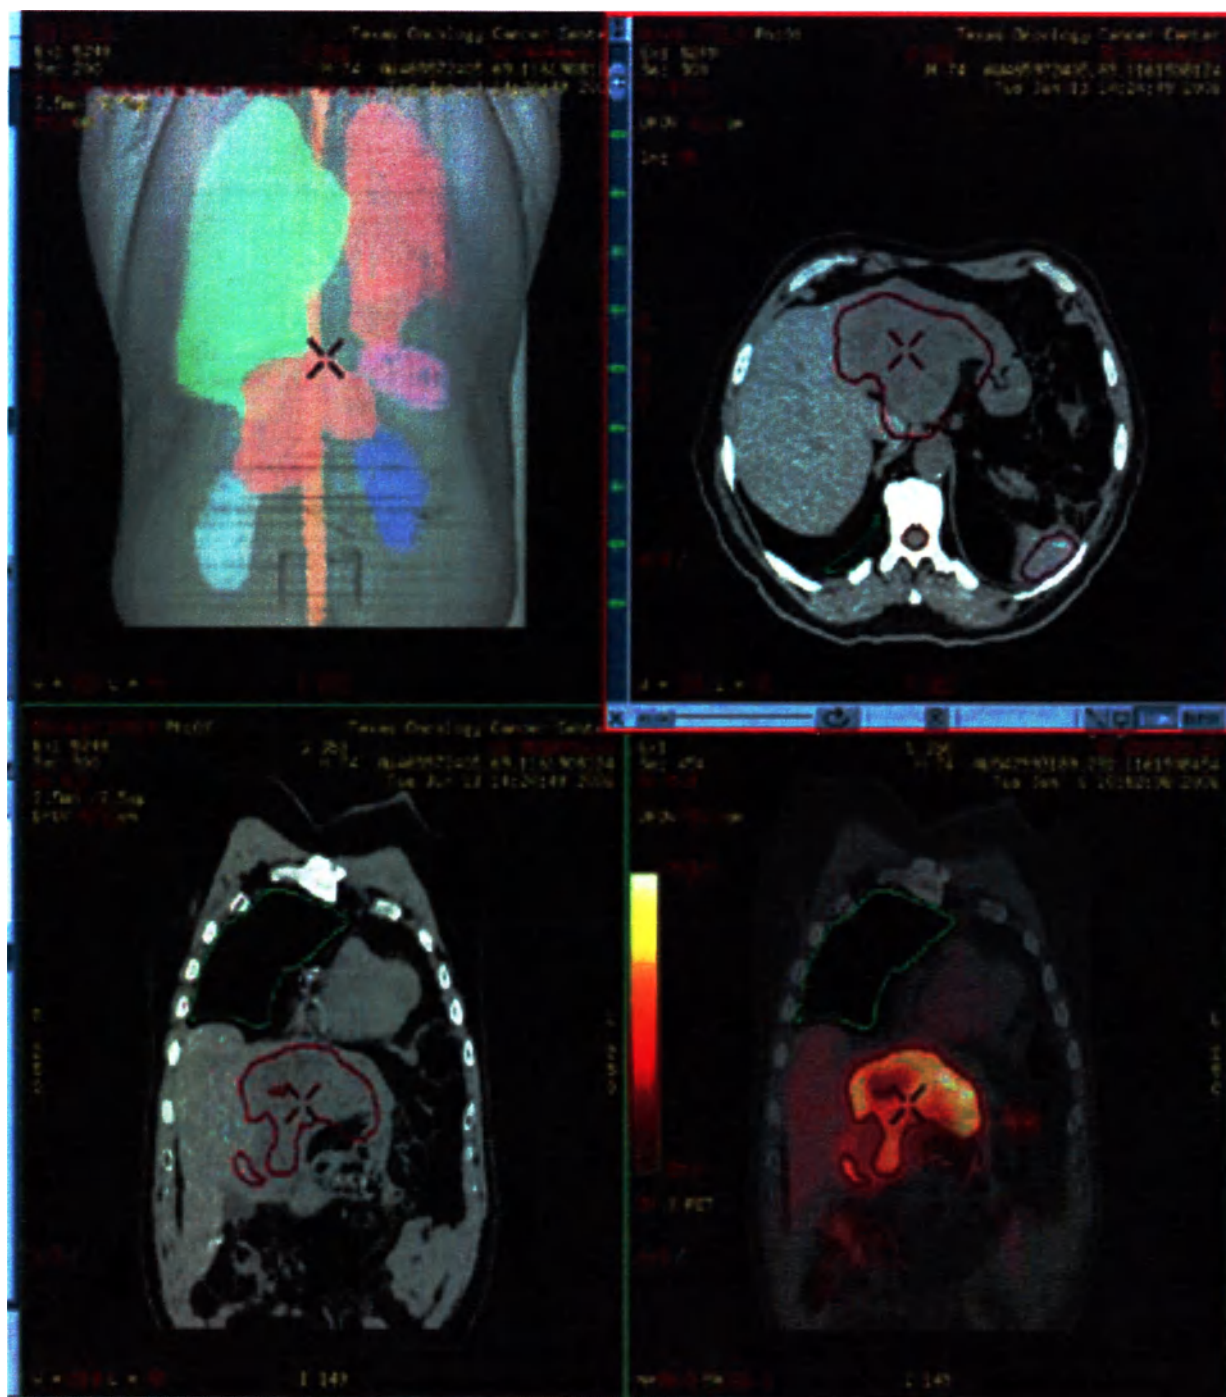


Рис. 81. Программные пакеты для подготовки геометрических и анатомических данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех— не более 10 шт. (при необходимости).

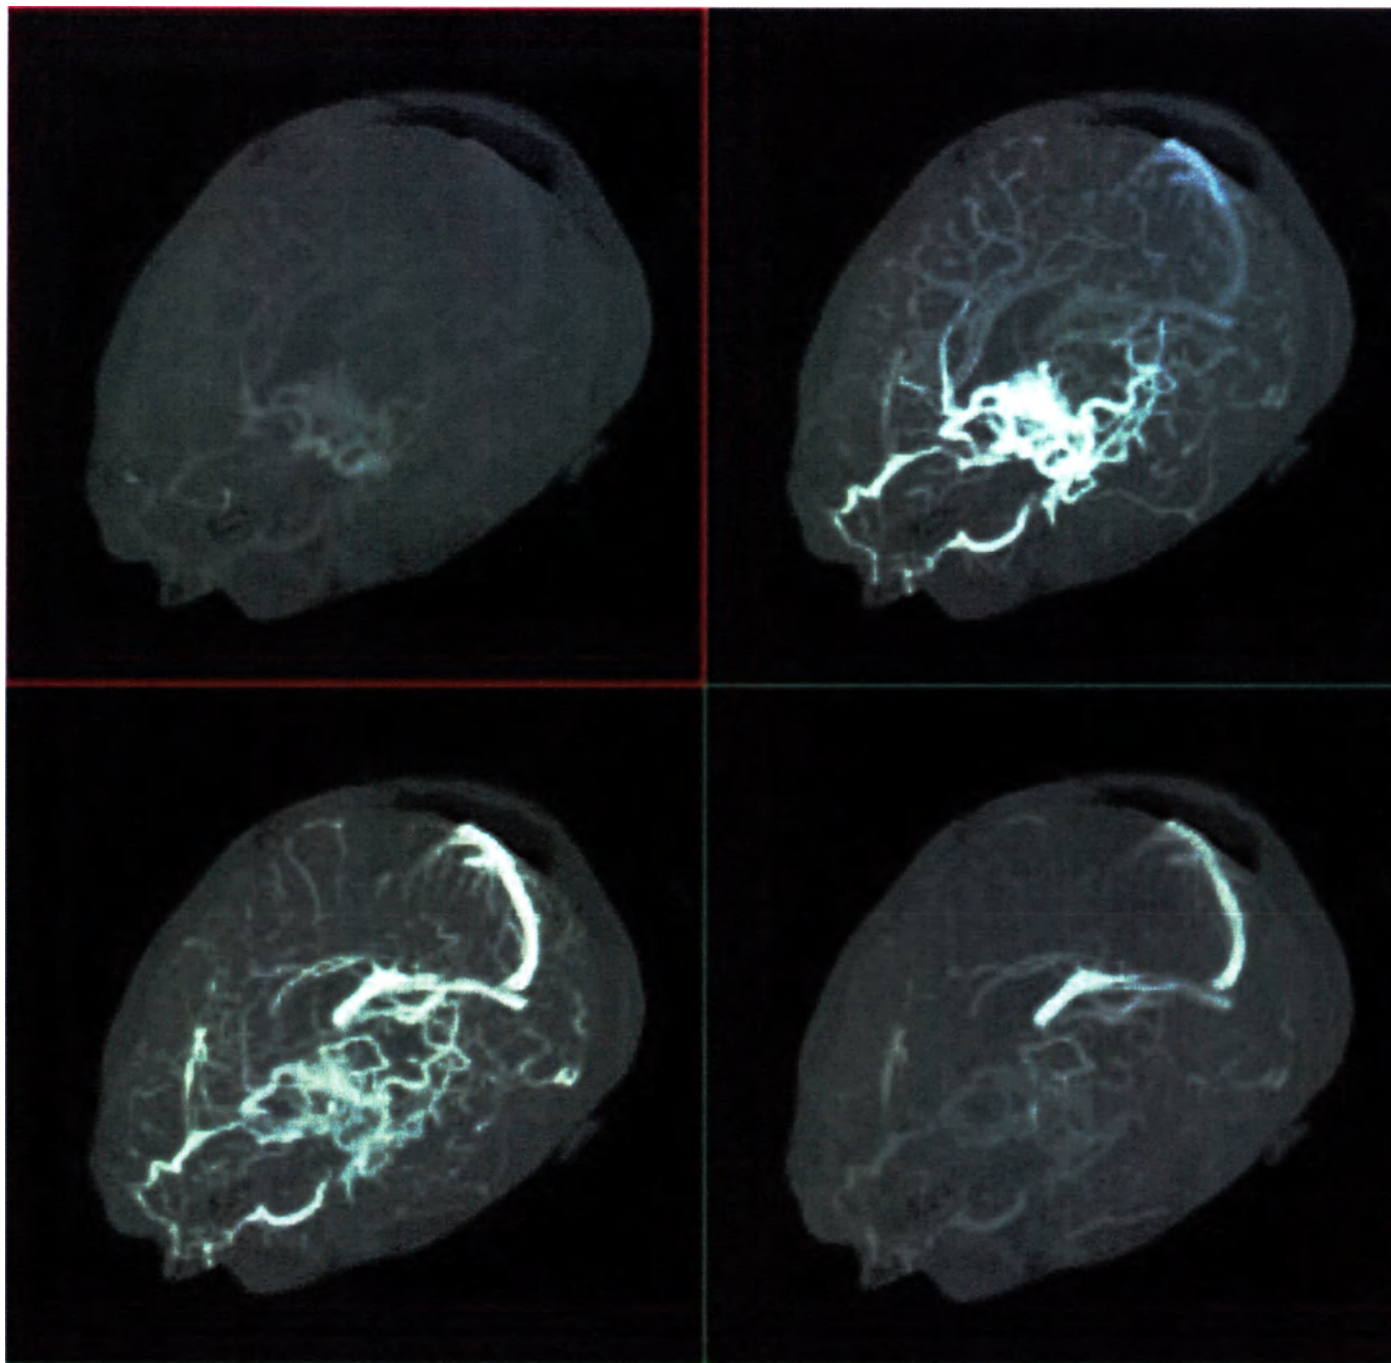


Рис. 82. Программные пакеты для динамического сбора данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

Schedule



Patient Name	Patient ID	Accession #	Exam Description	Date ▲	Time ▲	New ▼	Monographic Patient
	as if				11:31 AM	N	
HAGEN, PAUL ERIC	GEHC-379-06-1961	7139-72974-73617	DOUBLE HELIX	12-01-2013	06:00 AM	N	
GARRIOTT, BARBE...	GEHC-378-06-2648	1008-32000-22290	ABOPEL	12-01-2013	06:30 AM	N	
FLOWERS, ABE JAN...	GEHC-802-11-7277	4233-19541-85988	NECK	12-01-2013	06:00 AM	N	
PETERS, RAE SAM	GEHC-771-88-4233	1347-35788-74821	ROUTINE HEAD	12-01-2013	06:30 AM	N	
CASILLAS, IRELAN...	GEHC-085-14-2296	8570-74545-00882	SELLA SUPINE	12-01-2013	07:00 AM	N	
FORD, MYER HOPE	GEHC-524-10-9086	1910-67012-12602	CHEST/ABD/PELVIS	12-01-2013	07:30 AM	N	
HICA, YOSHIE CAR...	GEHC-731-04-4951	0214-18067-40097	SHOULDER	12-01-2013	08:00 AM	N	
ELLIS, FORD ALICE	GEHC-772-77-3021	8905-34865-35252	ACRYLIC DISSECTION	12-01-2013	08:30 AM	N	
HEILEMANN, MINE...	GEHC-229-49-4463	5156-82063-23279	ROUTINE HEAD	12-01-2013	09:00 AM	N	
DALEY, HASH MIT...	GEHC-873-02-5987	6005-07096-10639	C-SPINE	12-01-2013	09:30 AM	N	
SANDERS, HASHIL...	GEHC-861-40-4159	2812-95075-48639	ROUTINE HEAD	12-01-2013	10:00 AM	N	
SULLIVAN, ROBER...	111-222-333	485	PELVIS	12-01-2013	10:00 AM	N	
SULLIVAN, ROBER...	111-222-333	483	CHEST	12-01-2013	10:00 AM	N	
SULLIVAN, ROBER...	111-222-333	484	ABDOMEN	12-01-2013	10:00 AM	N	
HAYDEN, PARK ED...	383-444-595	902	ROUTINE CHEST W/ CO.	12-01-2013	10:00 AM	N	
BROWNELL, METZ ...	985-866-777	508	CT HEAD W/CONTRAST J.	12-01-2013	10:00 AM	N	
MANNING, CESZY...	777-888-999	510	TEMPORAL BONES	12-01-2013	10:00 AM	N	
WOODMAN, JORD...	GEHC-806-43-3725	2489-67297-35382	PEDICLE	12-01-2013	10:30 AM	N	
MEREDITH, LEHM...	GEHC-895-75-1387	2614-67211-04141	PREPOST HONEY	12-01-2013	11:00 AM	N	
GLAZER, SCHNEID...	GEHC-233-12-1487	8869-11842-95219	PEDICLE	12-01-2013	11:30 AM	N	
GOODWYN, HUBB...	GEHC-784-73-8888	4759-34009-38228	PELVIC FX	12-01-2013	12:00 PM	N	
SHIMIZU, DEPALM...	GEHC-318-42-1998	4742-94820-03446	PELVIS	12-01-2013	12:30 PM	N	
SAKURAI, TAKAM...	GEHC-117-80-0955	9989-7751442151	RTN HEAD FEET FIRST	12-01-2013	01:00 PM	N	
CHABER, TO RUPY	CPHF-289/28/2013	1074/0706/17081	CT HEAD W/CO.	12-01-2013	04:15 PM	N	

Select Patient

Рис. 83. Программные пакеты - интерфейс для подключения к системе на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

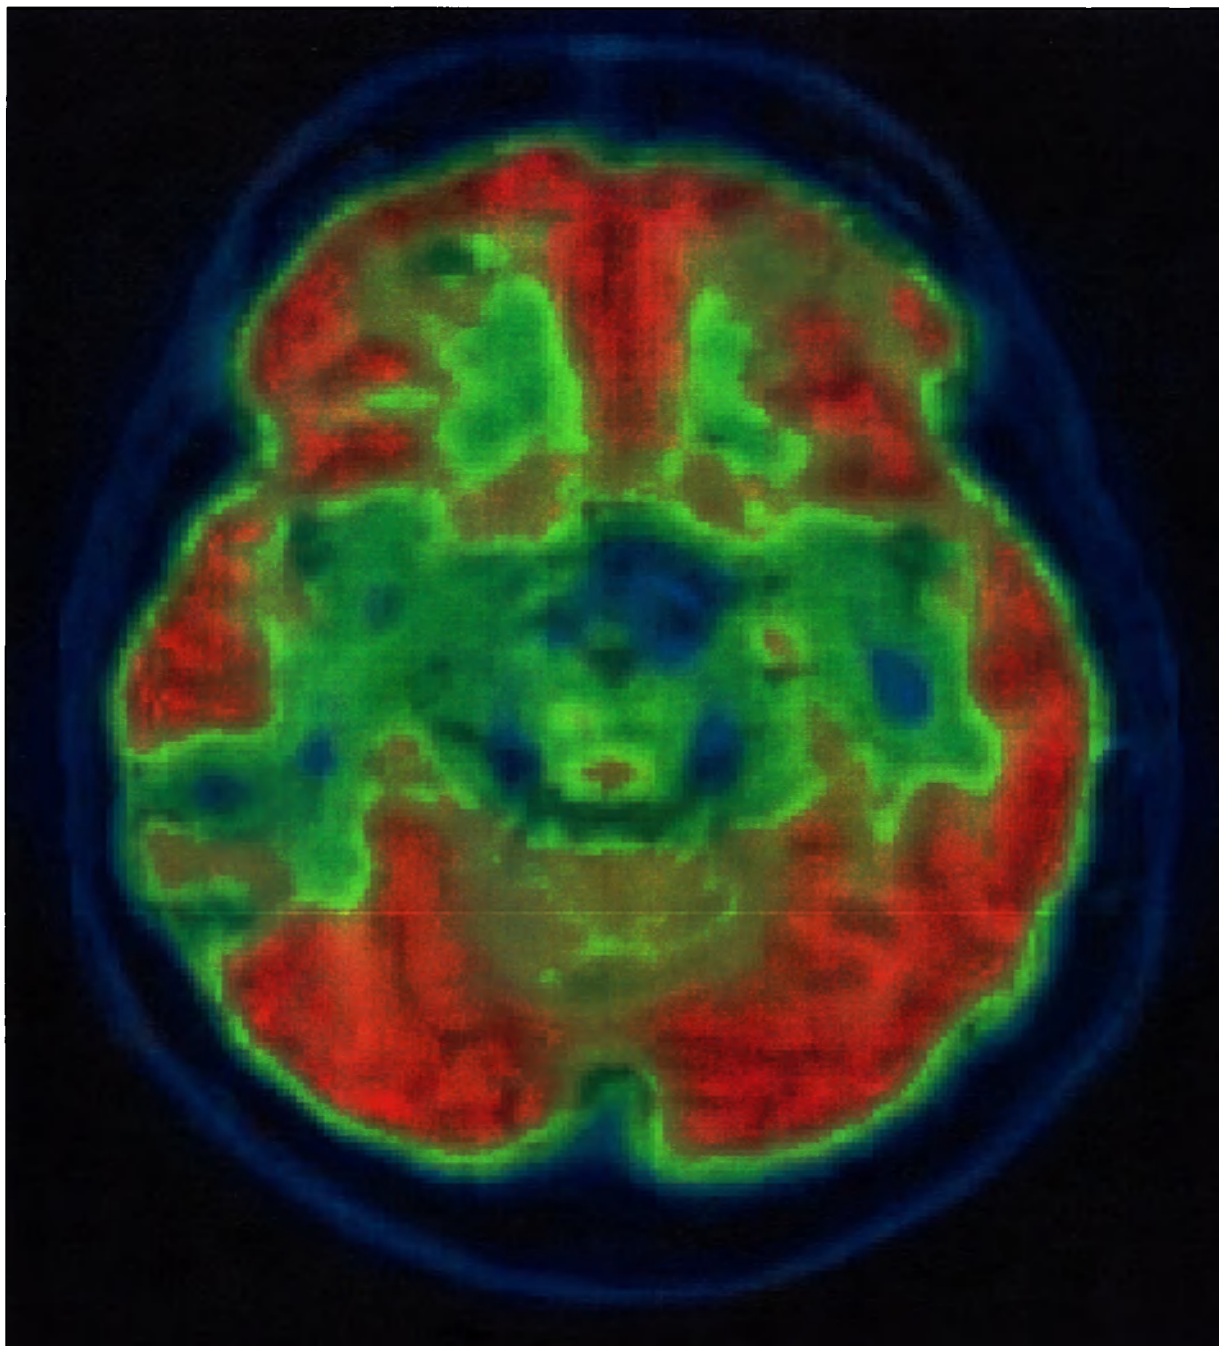


Рис. 84. Программные пакеты для выполнения реконструкции ПЭТ-изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

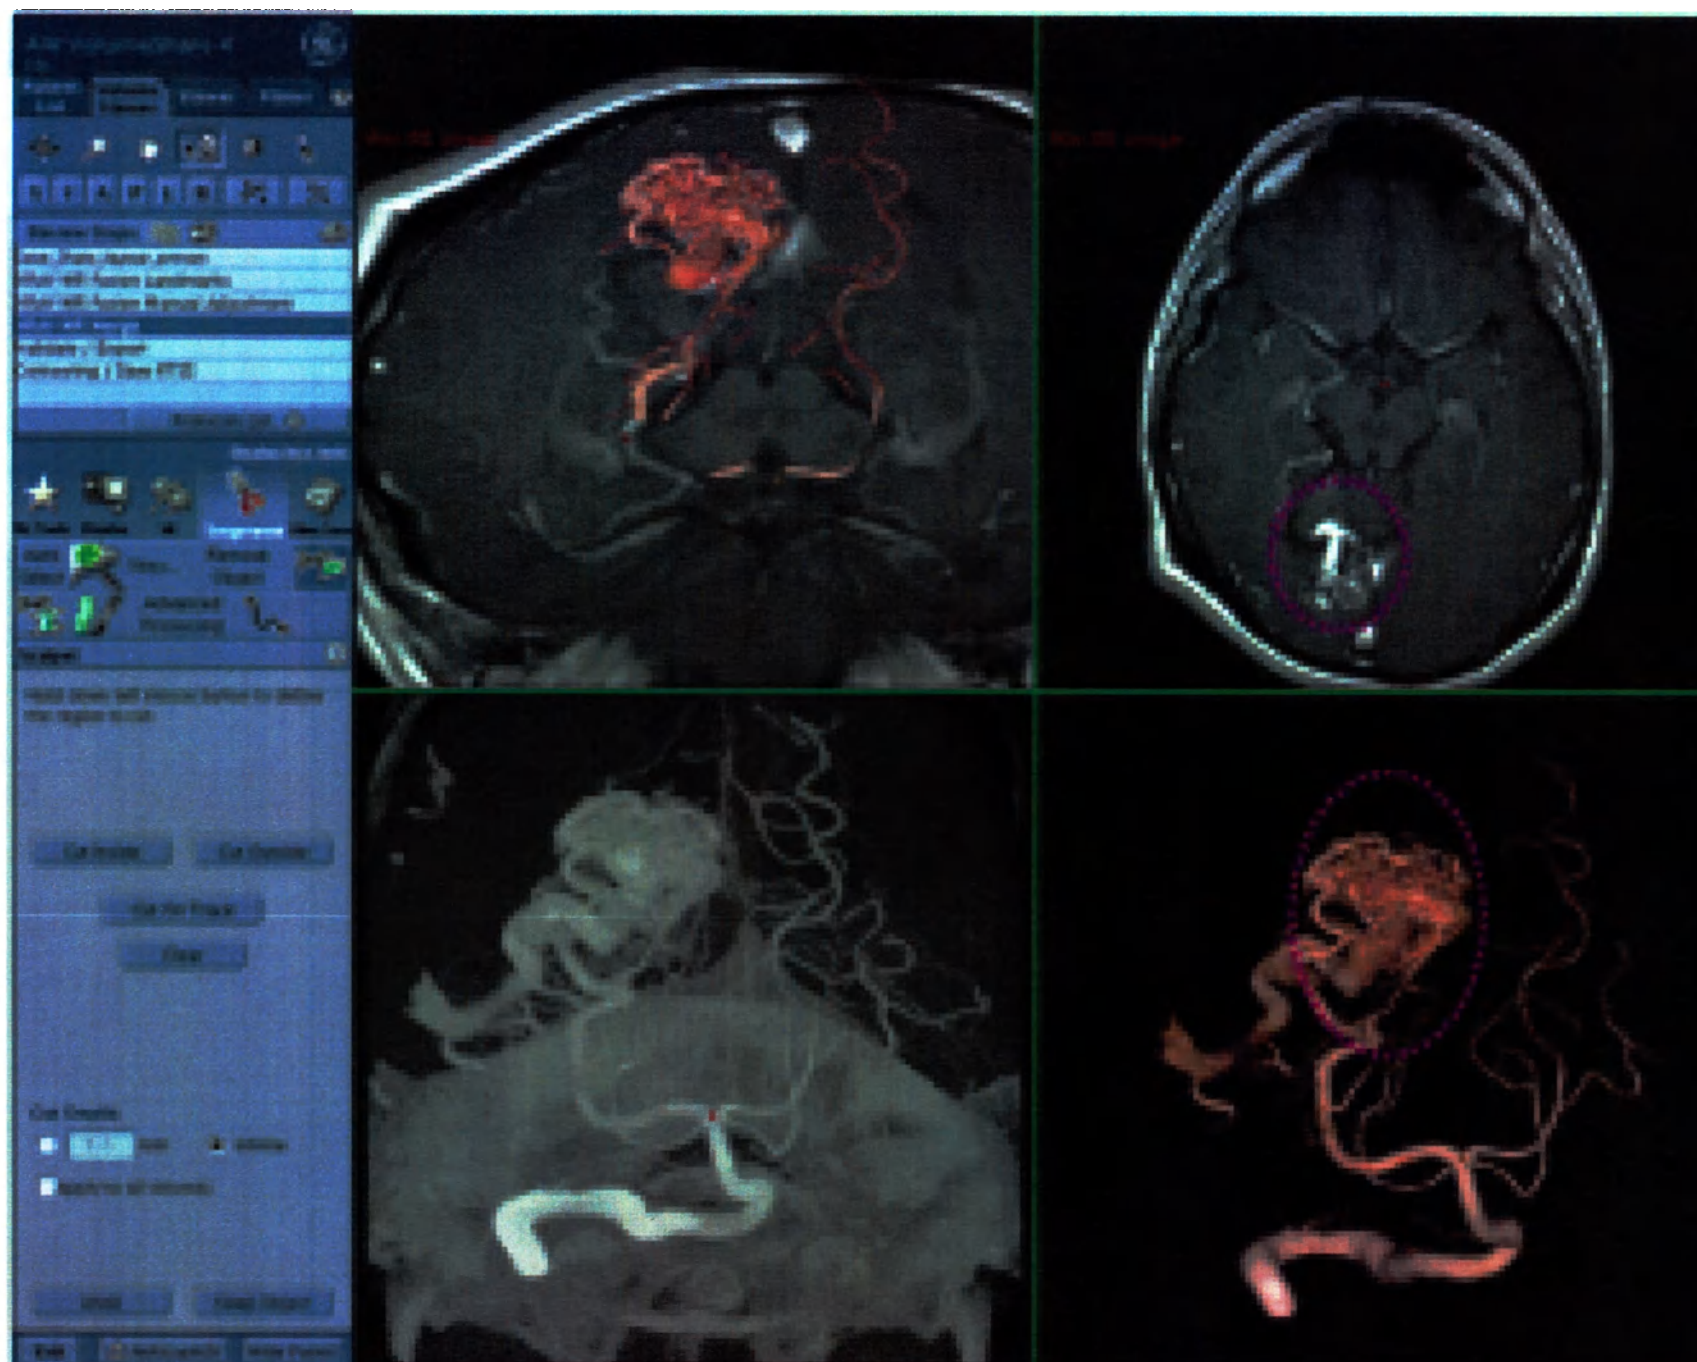


Рис. 85. Программные пакеты для выполнения реконструкции МРТ-изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).

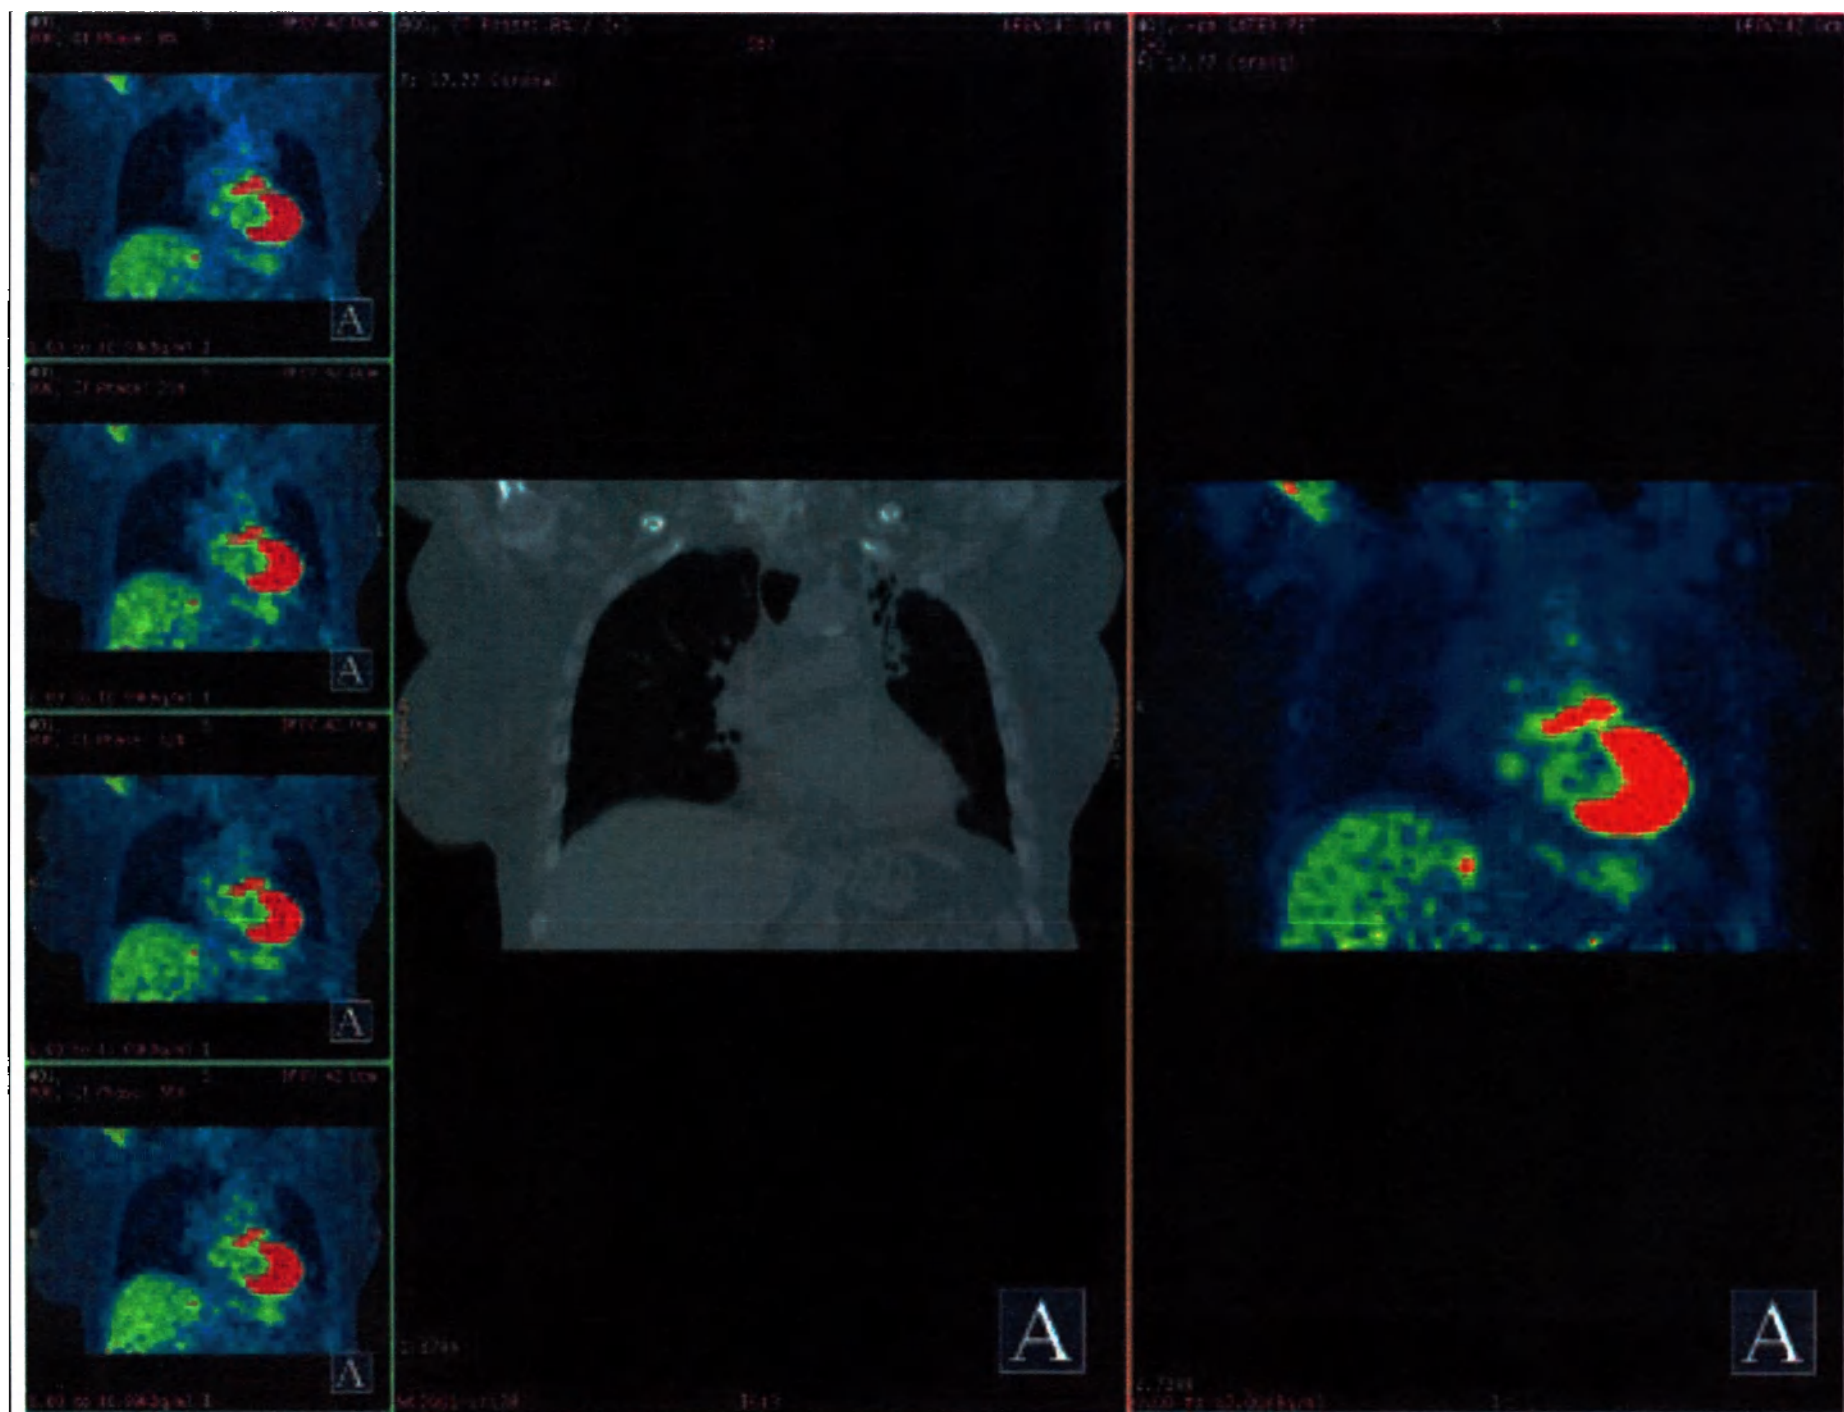


Рис. 86. Программные пакеты для совместного исследования изображений КТ и ПЭТ на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителе – не более 10 шт. (при необходимости).


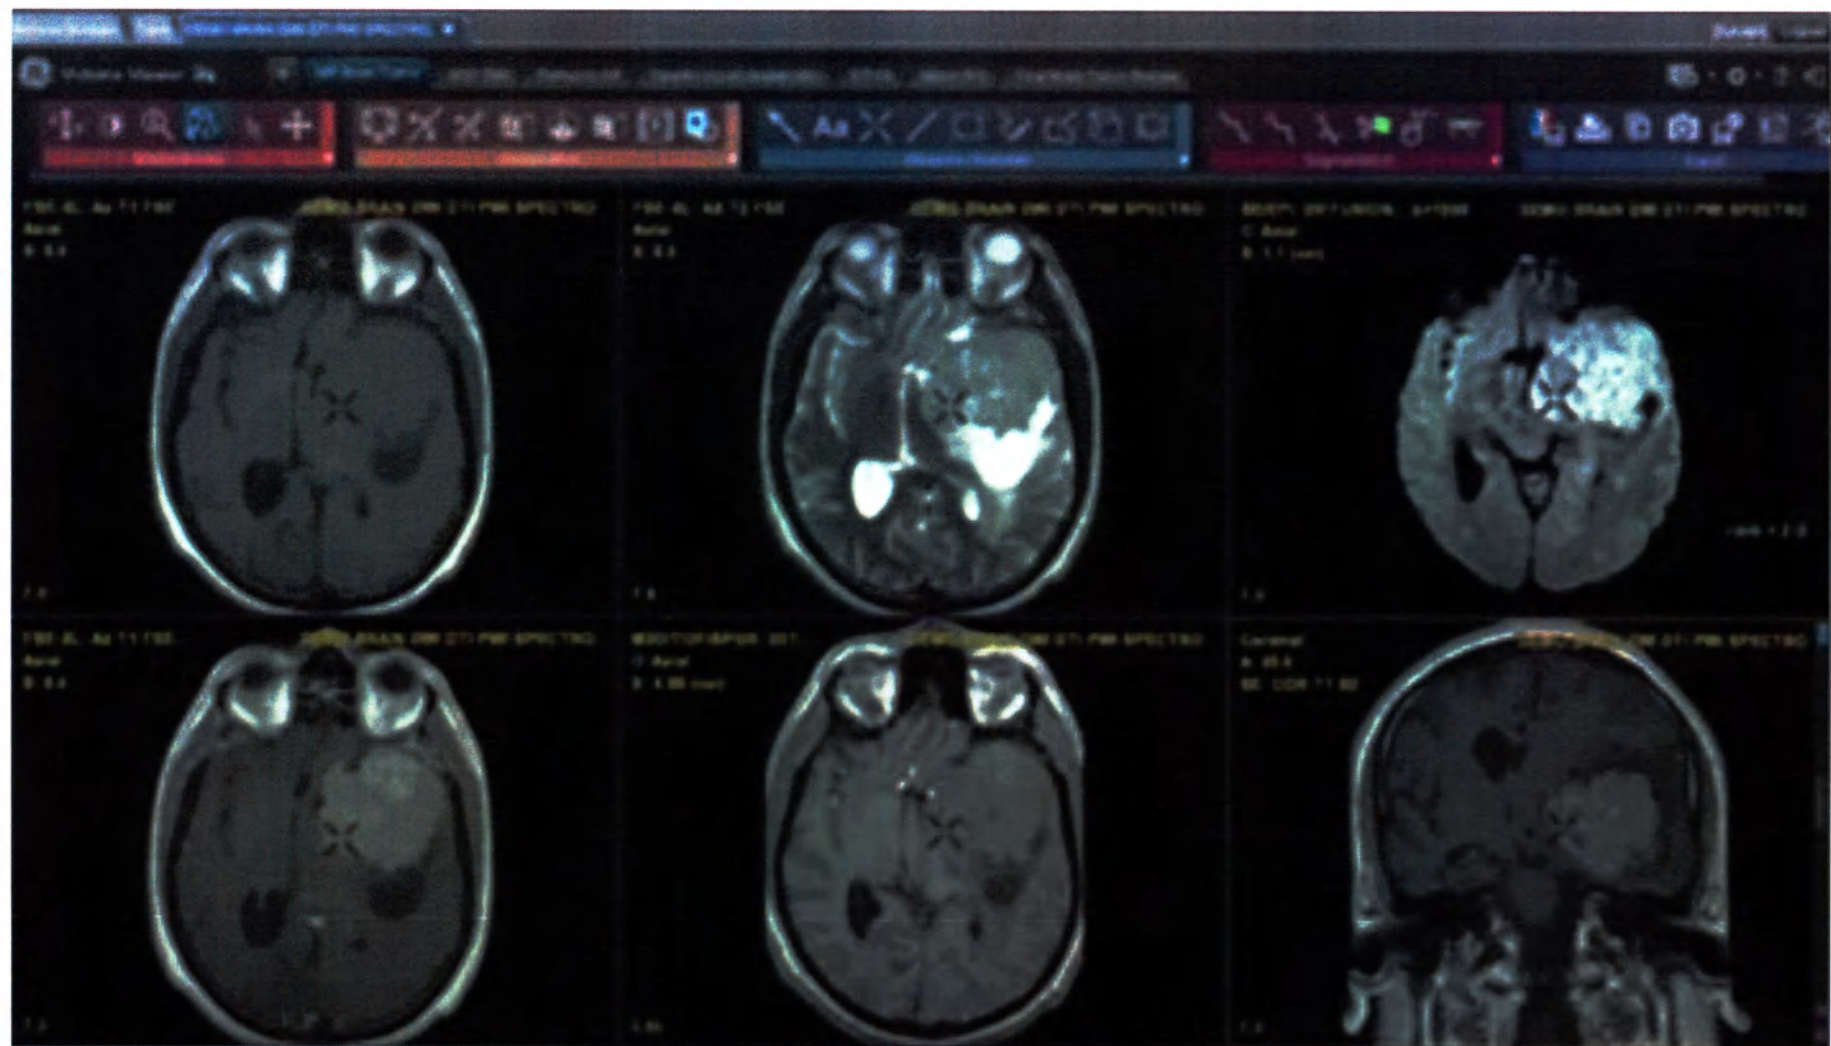


Рис. 87. Программные пакеты для совместного исследования изображений КТ и МРТ на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителе – не более 10 шт. (при необходимости).


Finding 2 (Liver) - TARGET

Sep 11 2007 - CT 3

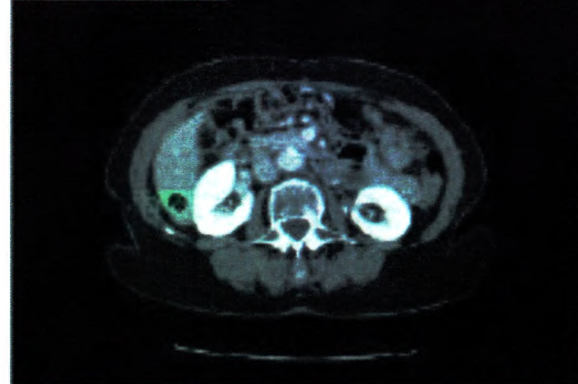


ROI 3
2Dmax: 13 mm

Oct 17 2007 - CT 3

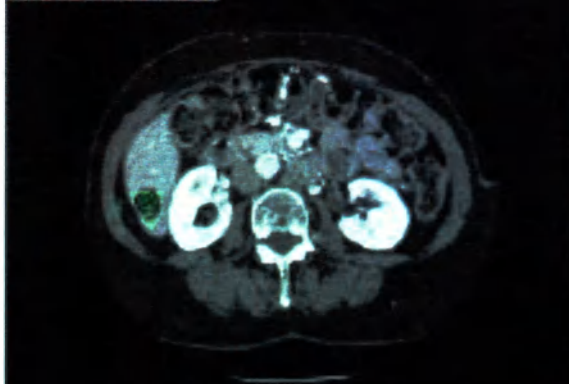

ROI 4
2Dmax: 17 mm (+31%)

Dec 27 2007 - CT 1

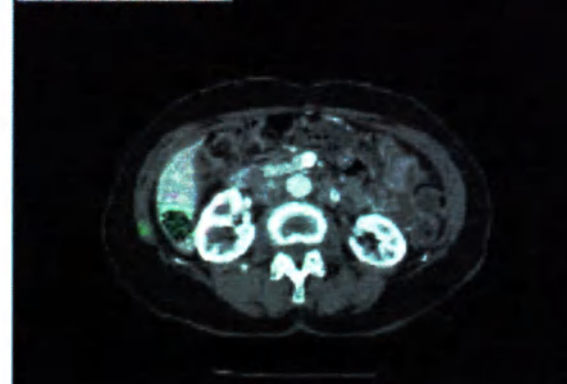

ROI 6
2Dmax: 22 mm (+69%)


Finding 1 (Liver) - TARGET

Sep 11 2007 - CT 3




ROI 1
2Dmax: 10 mm

Oct 17 2007 - CT 3

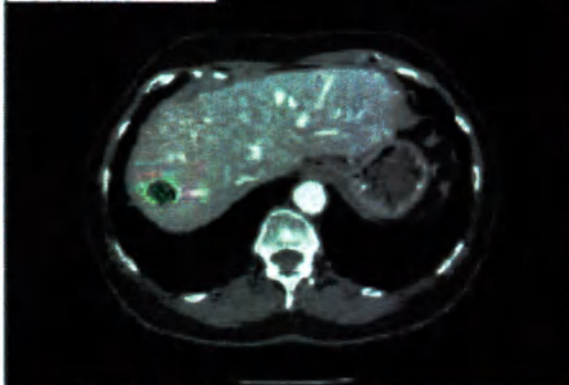

ROI 2
2Dmax: 15 mm (+50%)

Dec 27 2007 - CT 1

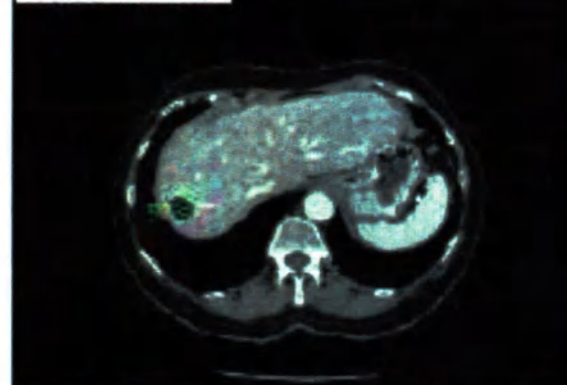

ROI 5
2Dmax: 16 mm (+60%)

SUMMARY - "RECIST 1.1"

	Sep 11 2007 (Ref) Baseline	Oct 17 2007	Dec 27 2007
Sum	23.0 mm	32.0 mm (+39%)	38.0 mm (+65%)
Lesion count	2 target lesion(s)	2 target lesion(s)	2 target lesion(s)

Рис. 88. Программные пакеты онкологической визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

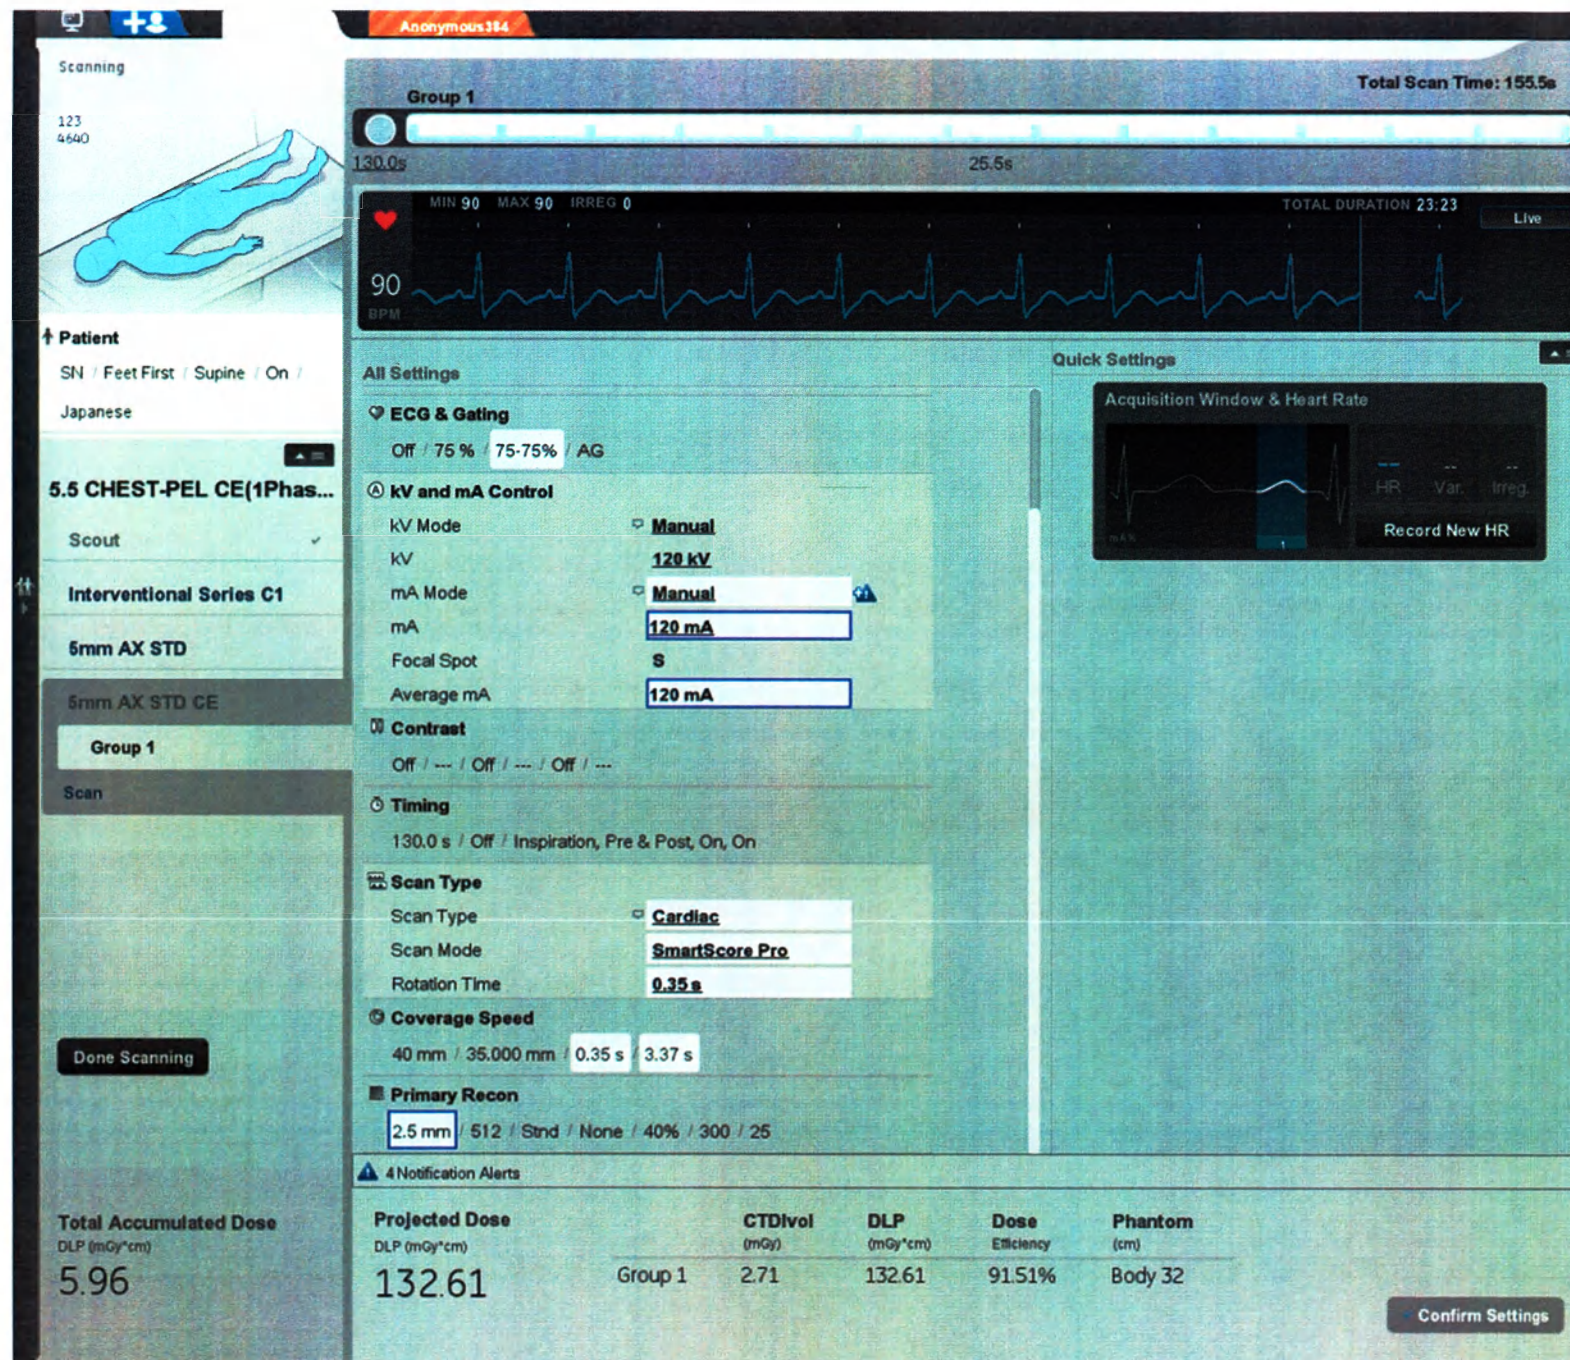


Рис. 89. Программные пакеты для ЭКГ-синхронизации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

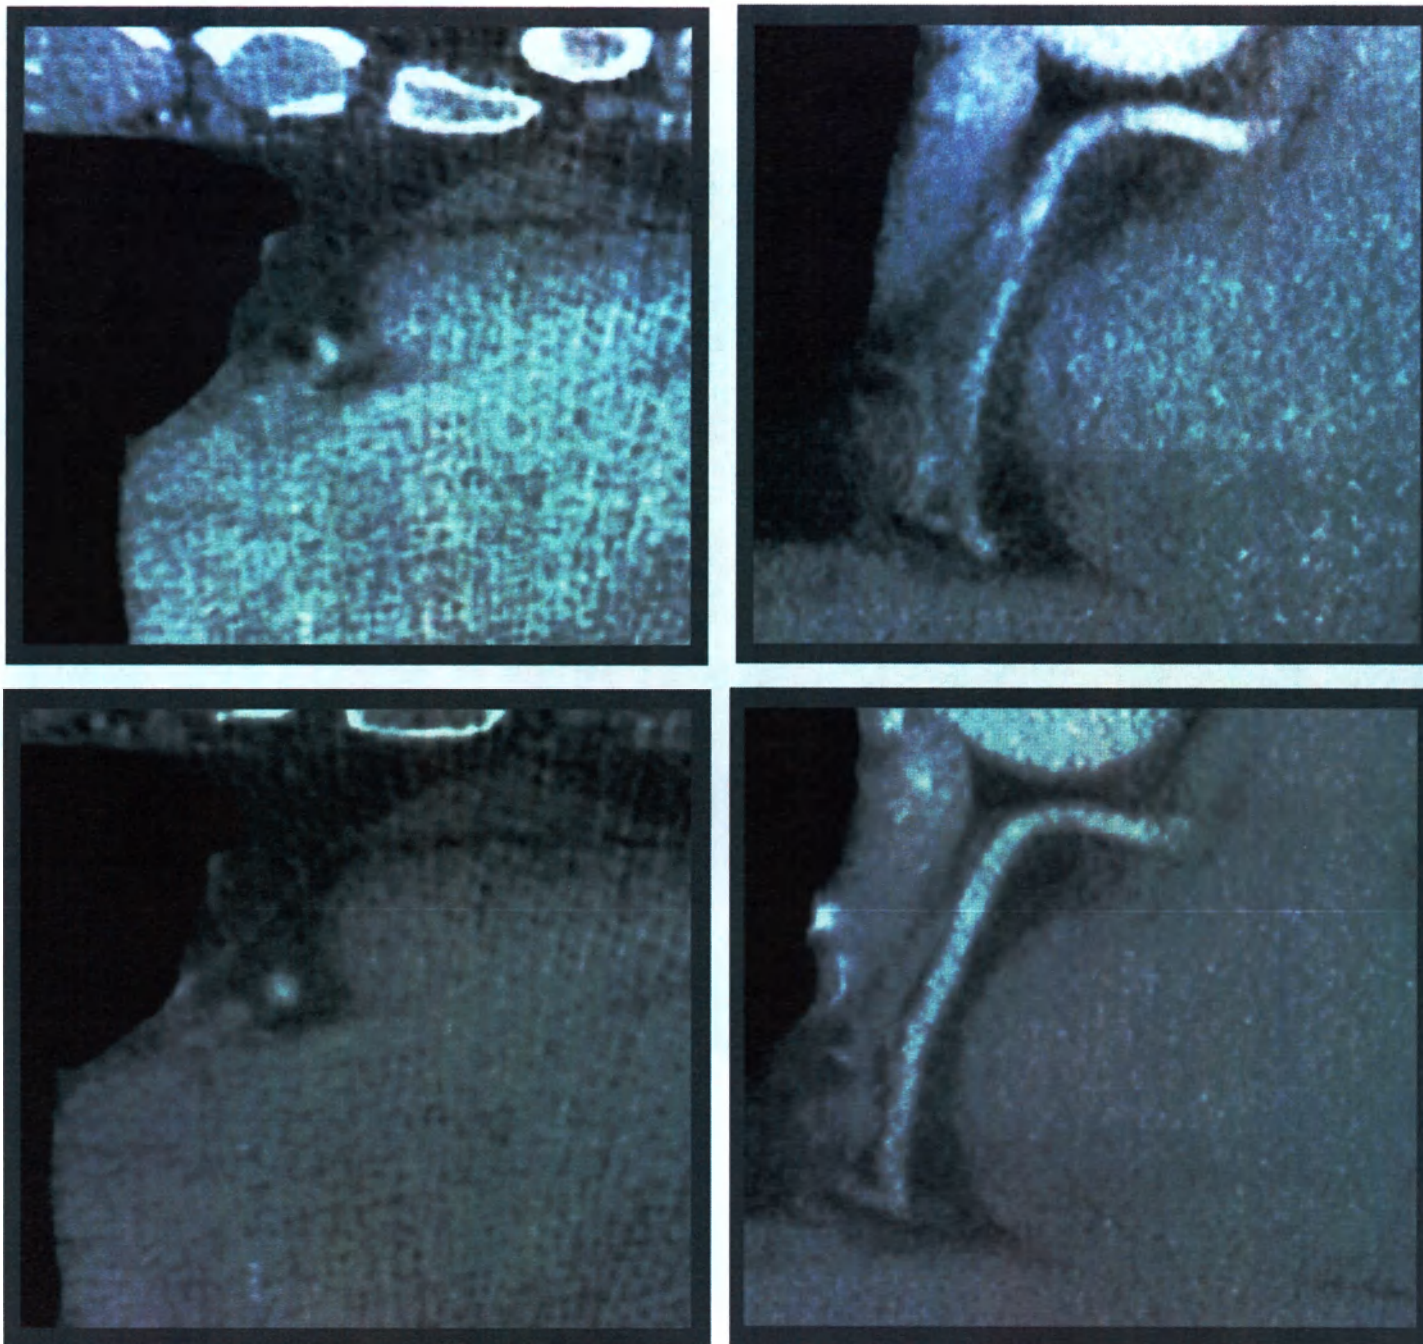


Рис. 90. Программный пакет для подавления артефактов движения коронарных артерий на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

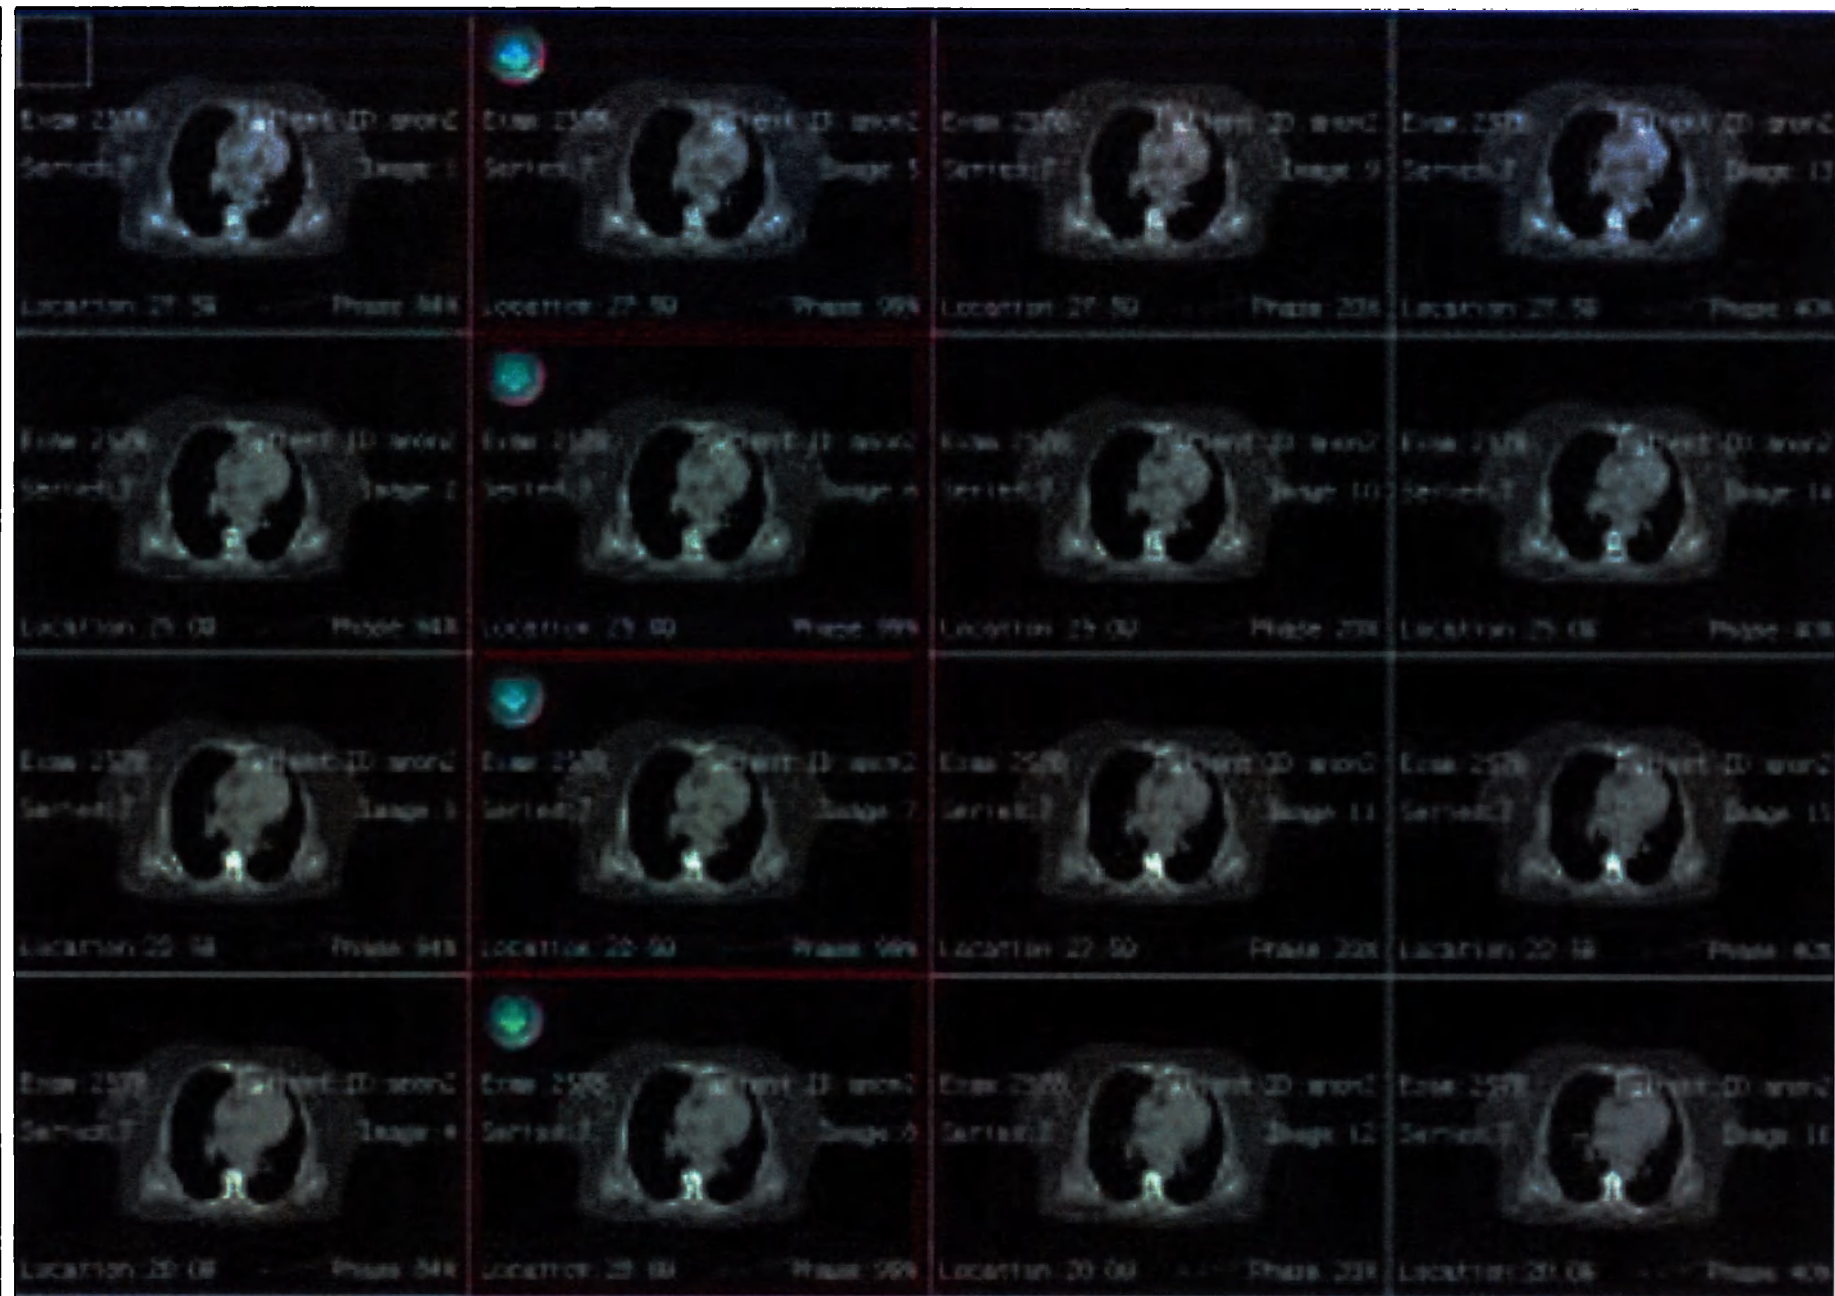


Рис. 91. Программные пакеты для синхронизации с дыханием на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 5 шт. (при необходимости).

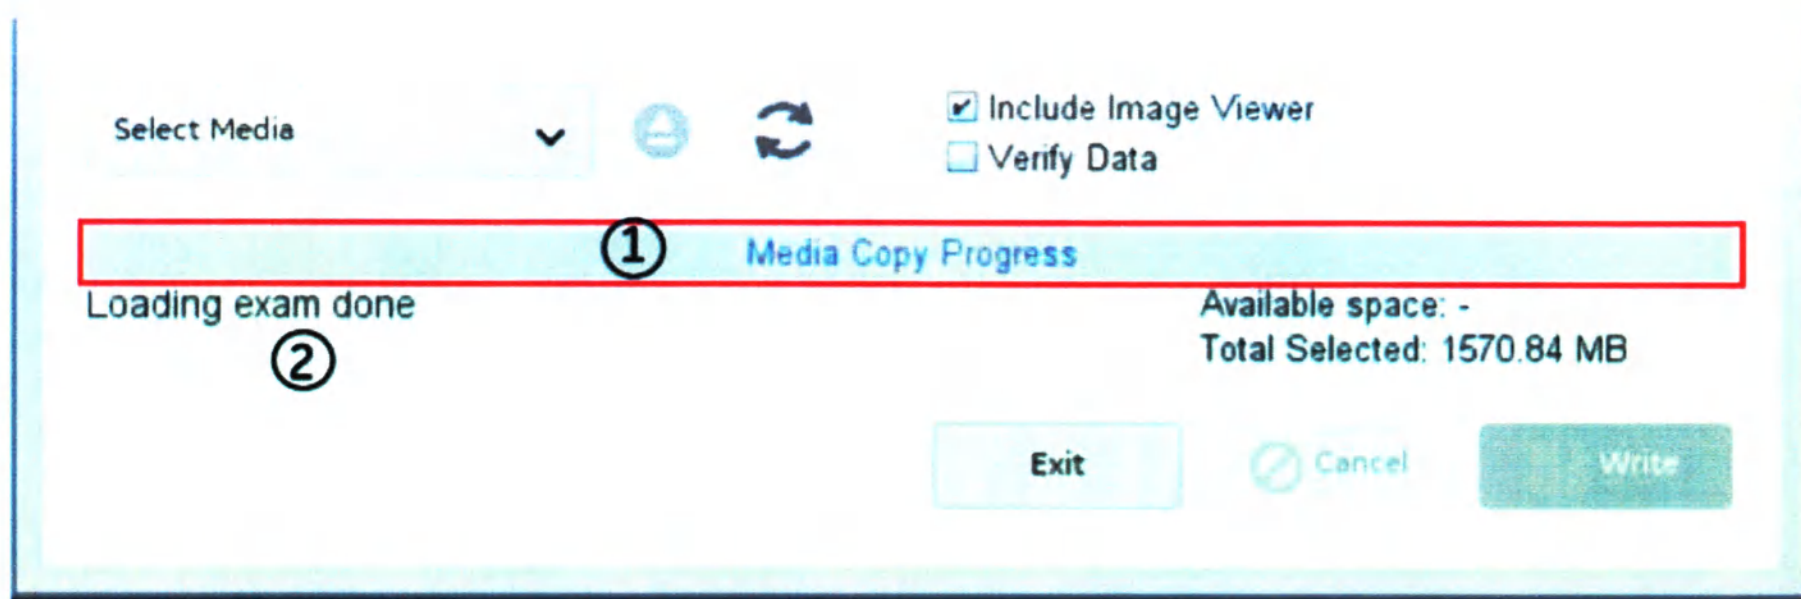


Рис. 92. Программные пакеты для записи исследований пациентов на внешние носители на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

5.5 CHEST-PEL CE(1Phase)

Scout

Scout

Interventional Series C1

Interventional Series C1

5mm AX STD

5mm AX STD

0.625mm AX DLIR

CT Thick Axials 5mm

5mm AX STD CE

5mm AX STD CE

5mm AX LUNG CE

0.625mm AX DLIR CE

CT Thick Axials 5mm

Image Display

0.625mm AX DLIR

Group 1

All Settings

Recon Settings

Thickness	0.625 mm
Matrix Size	512
Recon Type	Std
Enhanced Contrast	Off
Recon Mode	Helical Plus
IQ Enhance	E
Interval	0.6250 mm
Image Enhance Filter	None
ASIR-V	—
DLIR	Low
MAR	Off
Window Width	Off
Window Level	On
Flip / Rotate	None

Anatomy Selection

1100.000 mm / 1500.000 mm / 641 / 35.0 cm / A0.0 mm /

R0.0 mm / ---, ---

Output Options

On / 0.625mm AX DLIR / Off

Transfer Options

Delete Recon

☒ Auto Run



Revolution Ascend

Рис. 93. Программные пакеты для удаления артефактов от металлических объектов на оптических и/или электронных и/или бумажных носителях (цифровые пленки, диски, компакт-диски, DVD-диски, флэш-накопители и т.д.) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 5 шт. (при необходимости).

■ Recon Settings

Thickness	<u>2.5 mm</u>
Matrix Size	<u>512</u>
Recon Type	<u>Std</u>
Enhanced Contrast	<u>Off</u>
Image Enhance Filter	<u>None</u>
ASIR-V	<u>50%</u>
MAR	<u>Off</u>
Window Width	<u>350</u>
Window Level	<u>30</u>
Flip / Rotate	<u>None</u>

Рис. 94. Программные пакеты итеративной реконструкции на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 5 шт. (при необходимости).

McAfee Endpoint Security for Linux Threat Prevention [ENSLTP]

Antivirus scan

Antivirus ePO setup

ePO server status:

Antivirus details

Antivirus version

: 10.6.10.107

Engine version

: 6010.8670

DAT file version

: 999.0

Antivirus scan

Start scan

Status information

Antivirus scan is not started

Antivirus scan result details

Last On-Demand scan result

Scan completed time

Files scanned

Files excluded

Errors

Timeouts

Infected

On-Demand scan Log

Recent On-Access scan results

On-Access scan log:

Antivirus scan information

List of files being scanned:

OS libraries

Application software

Servers

Configuration files

List of files excluded from scan:

System log files

Application log files

Image data

Рис. 95. Программные пакеты защиты программного обеспечения на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 5 шт. (при необходимости).



Рис. 96. Программные пакеты модернизации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

O Axial HEAD STND
I: 89.8 (coi)
Im: 17
DFOV 27.4 x 23.0 cm
STND/SS60 No Filter

AS

Ex:Mar 13 2015

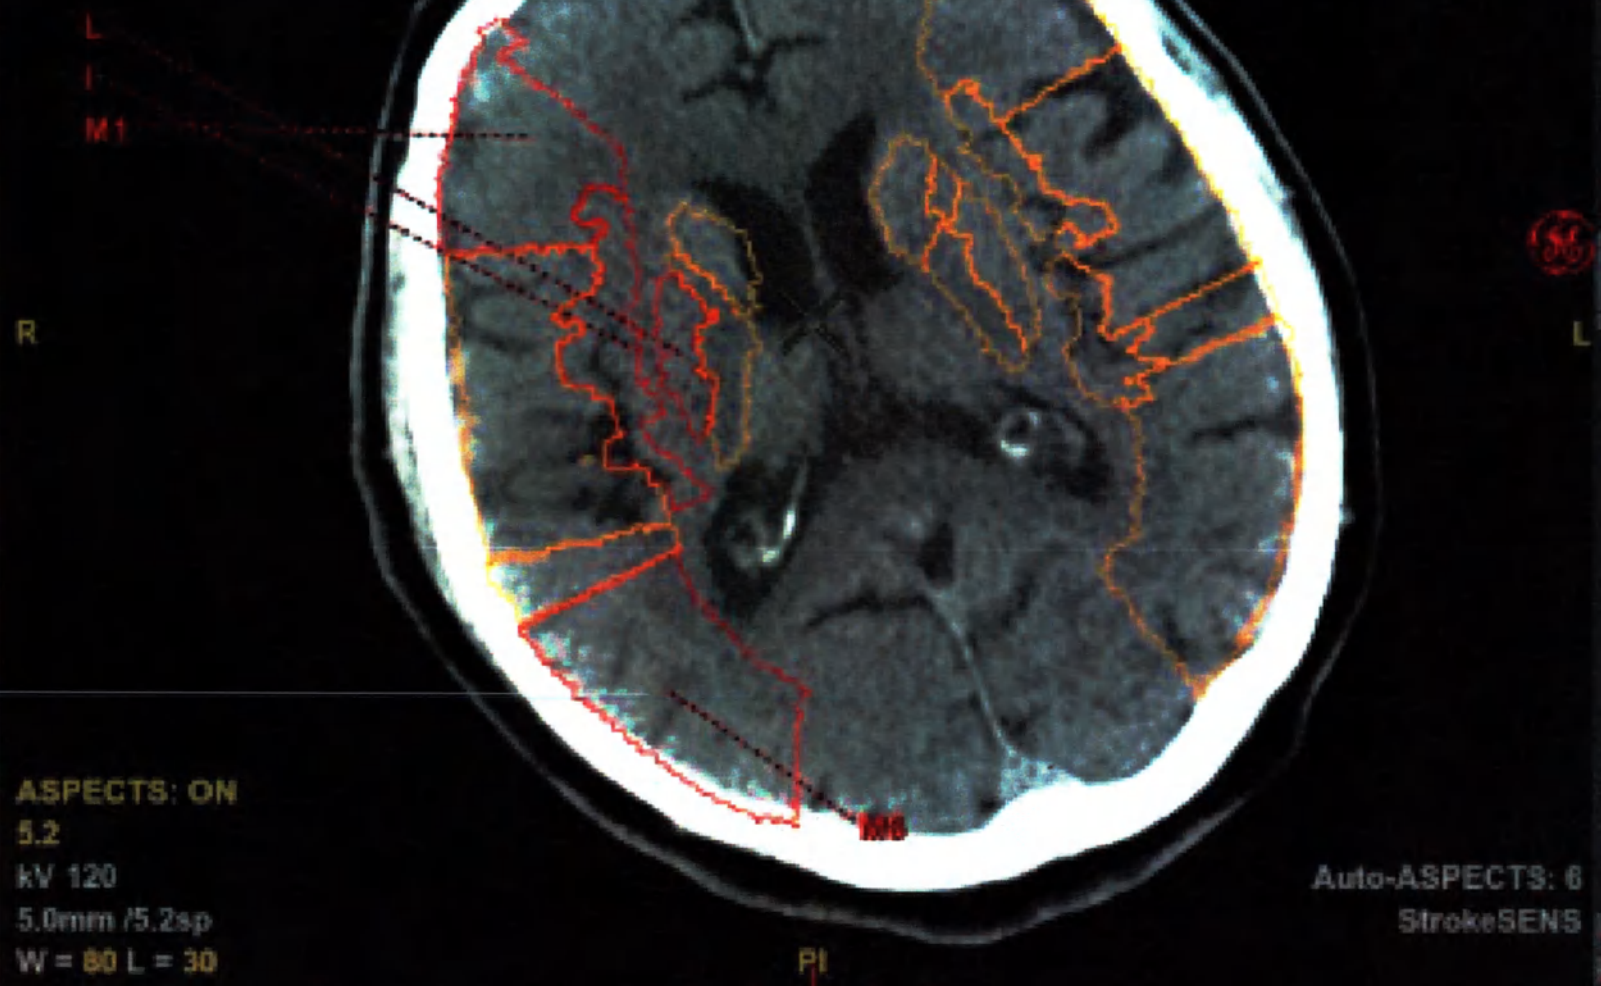


Рис. 97. Программные пакеты для оценки инсультов на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

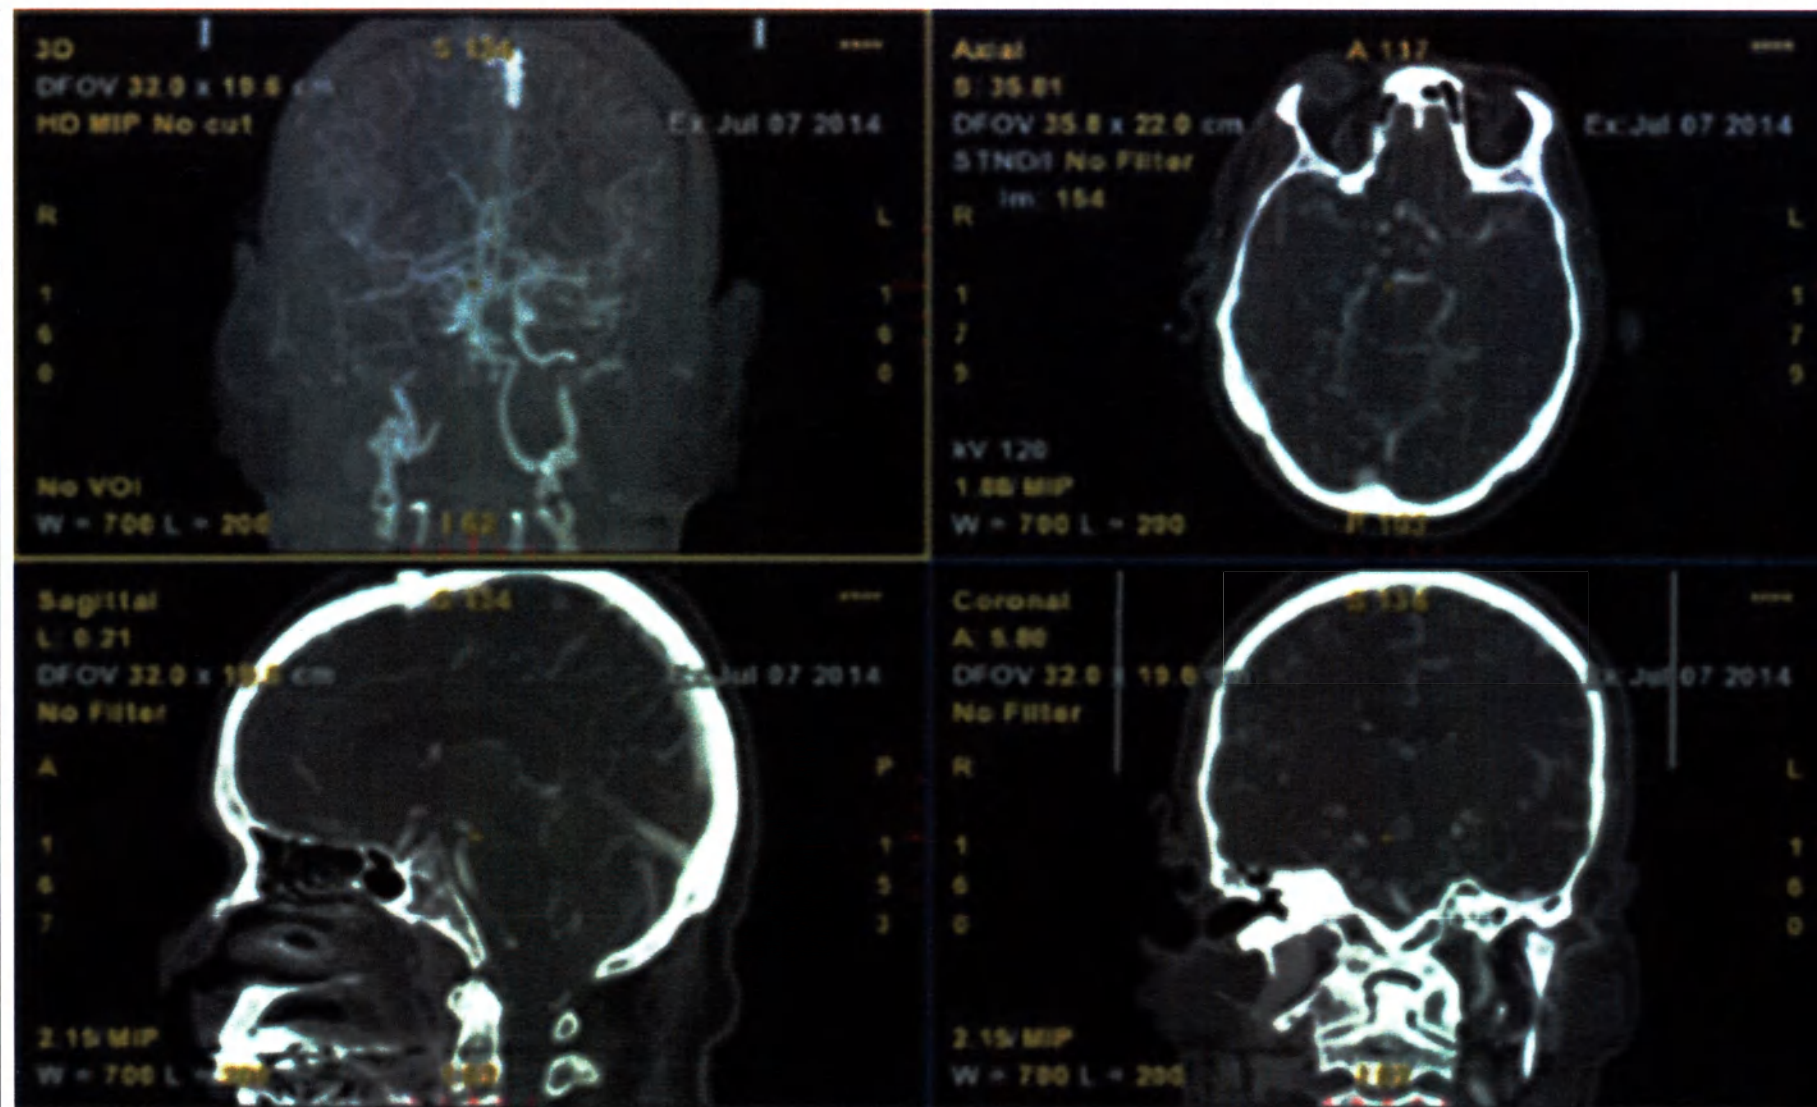


Рис. 98. Программные пакеты для анализа аневризмы сосудов Виллизиева круга и оценки гематомы на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

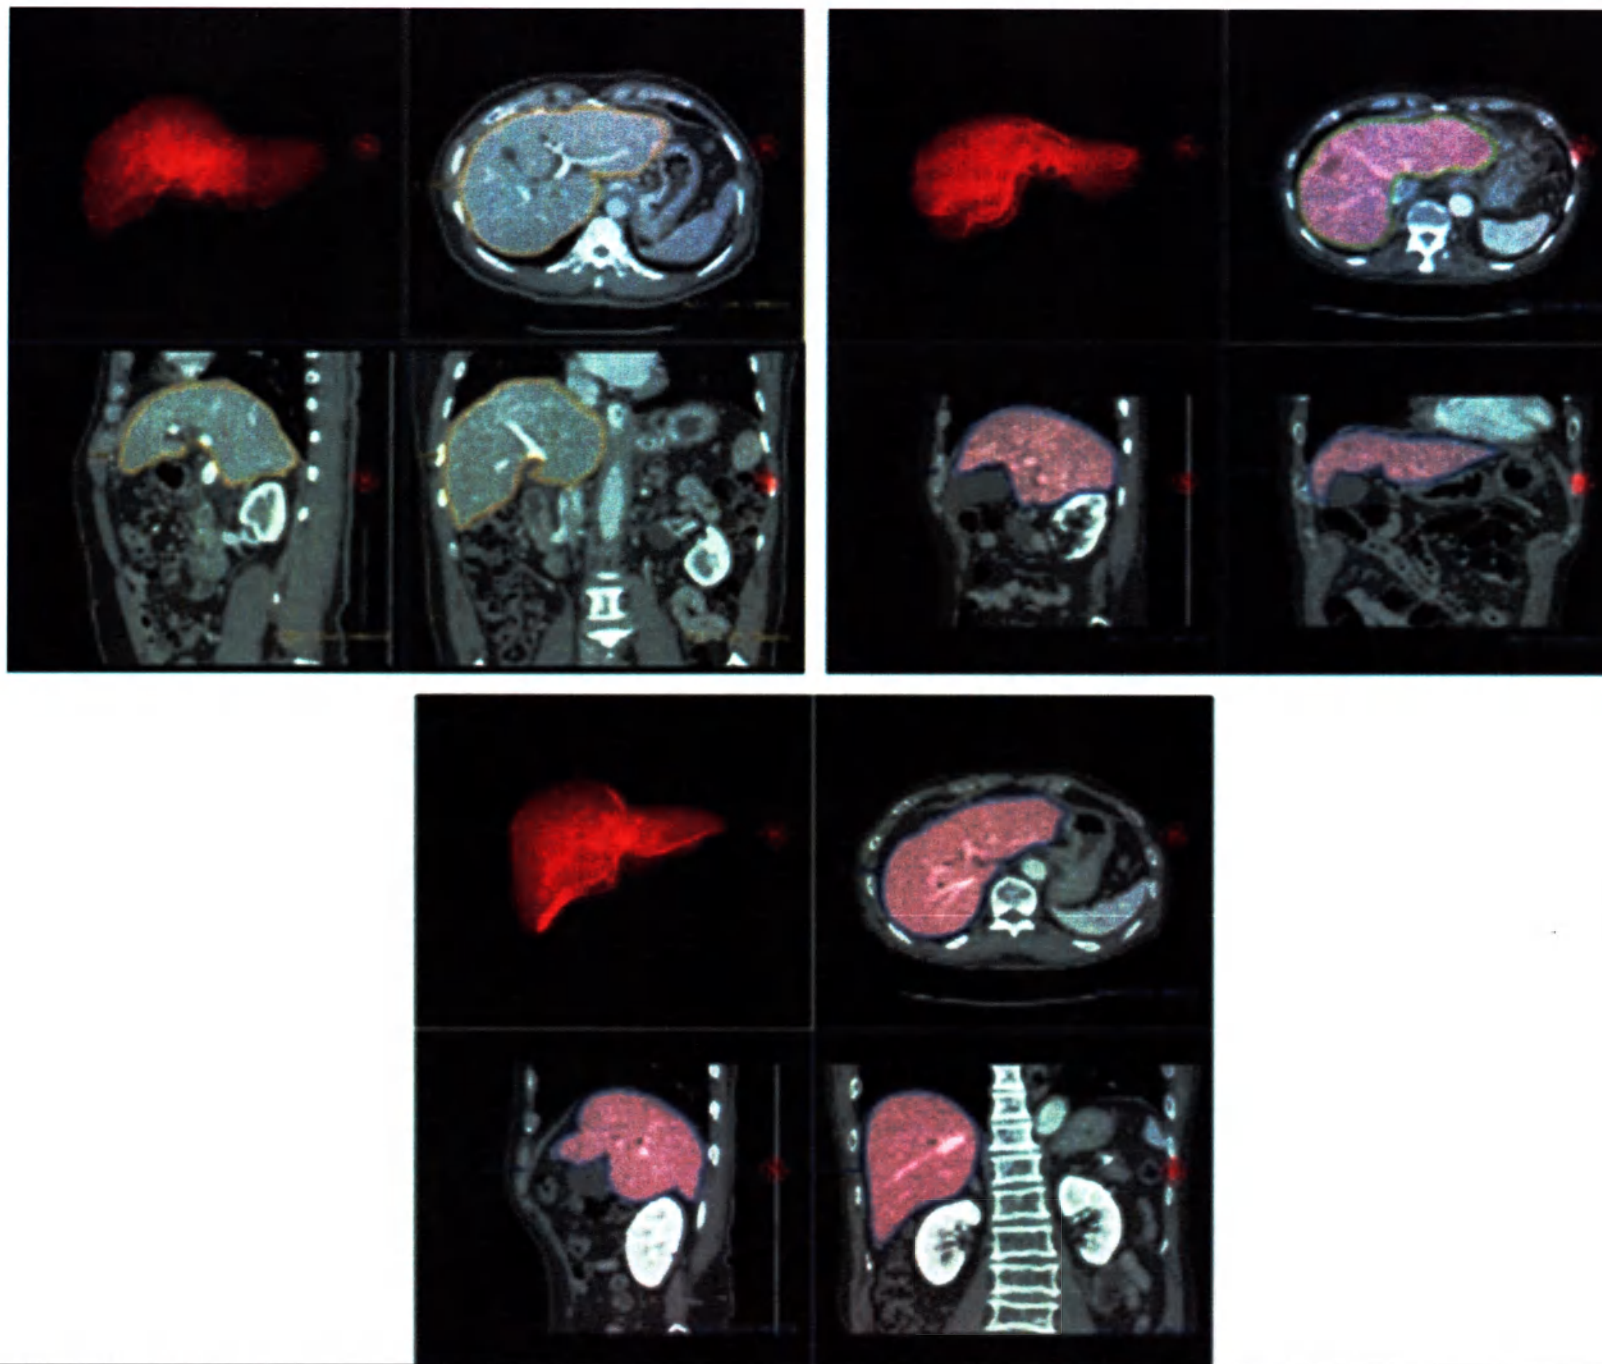


Рис. 99. Программные пакеты для оценки анатомии печени на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

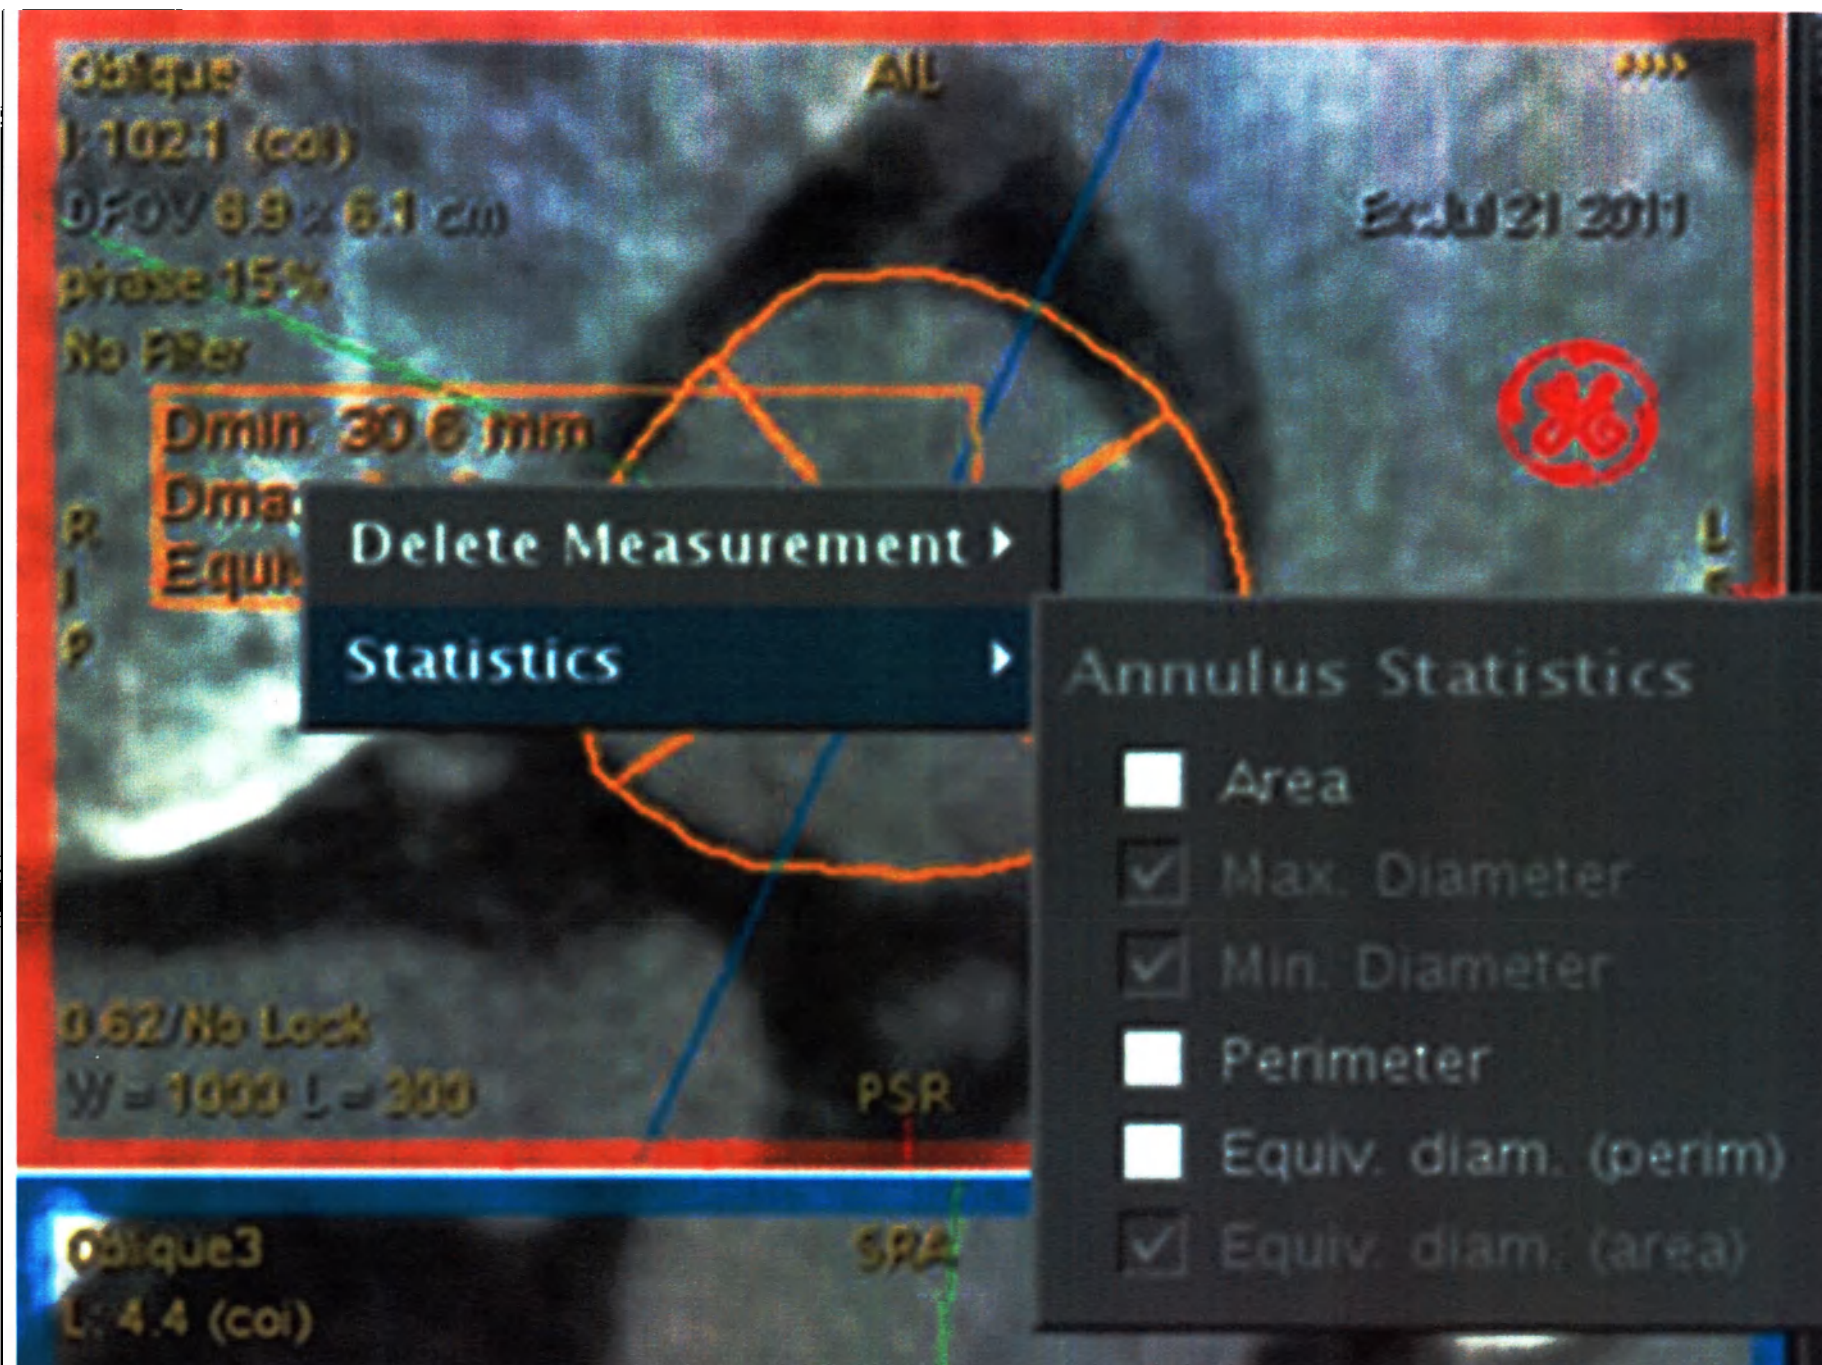


Рис. 100. Программные пакеты для планирования транскатетерной имплантации аортального клапана на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

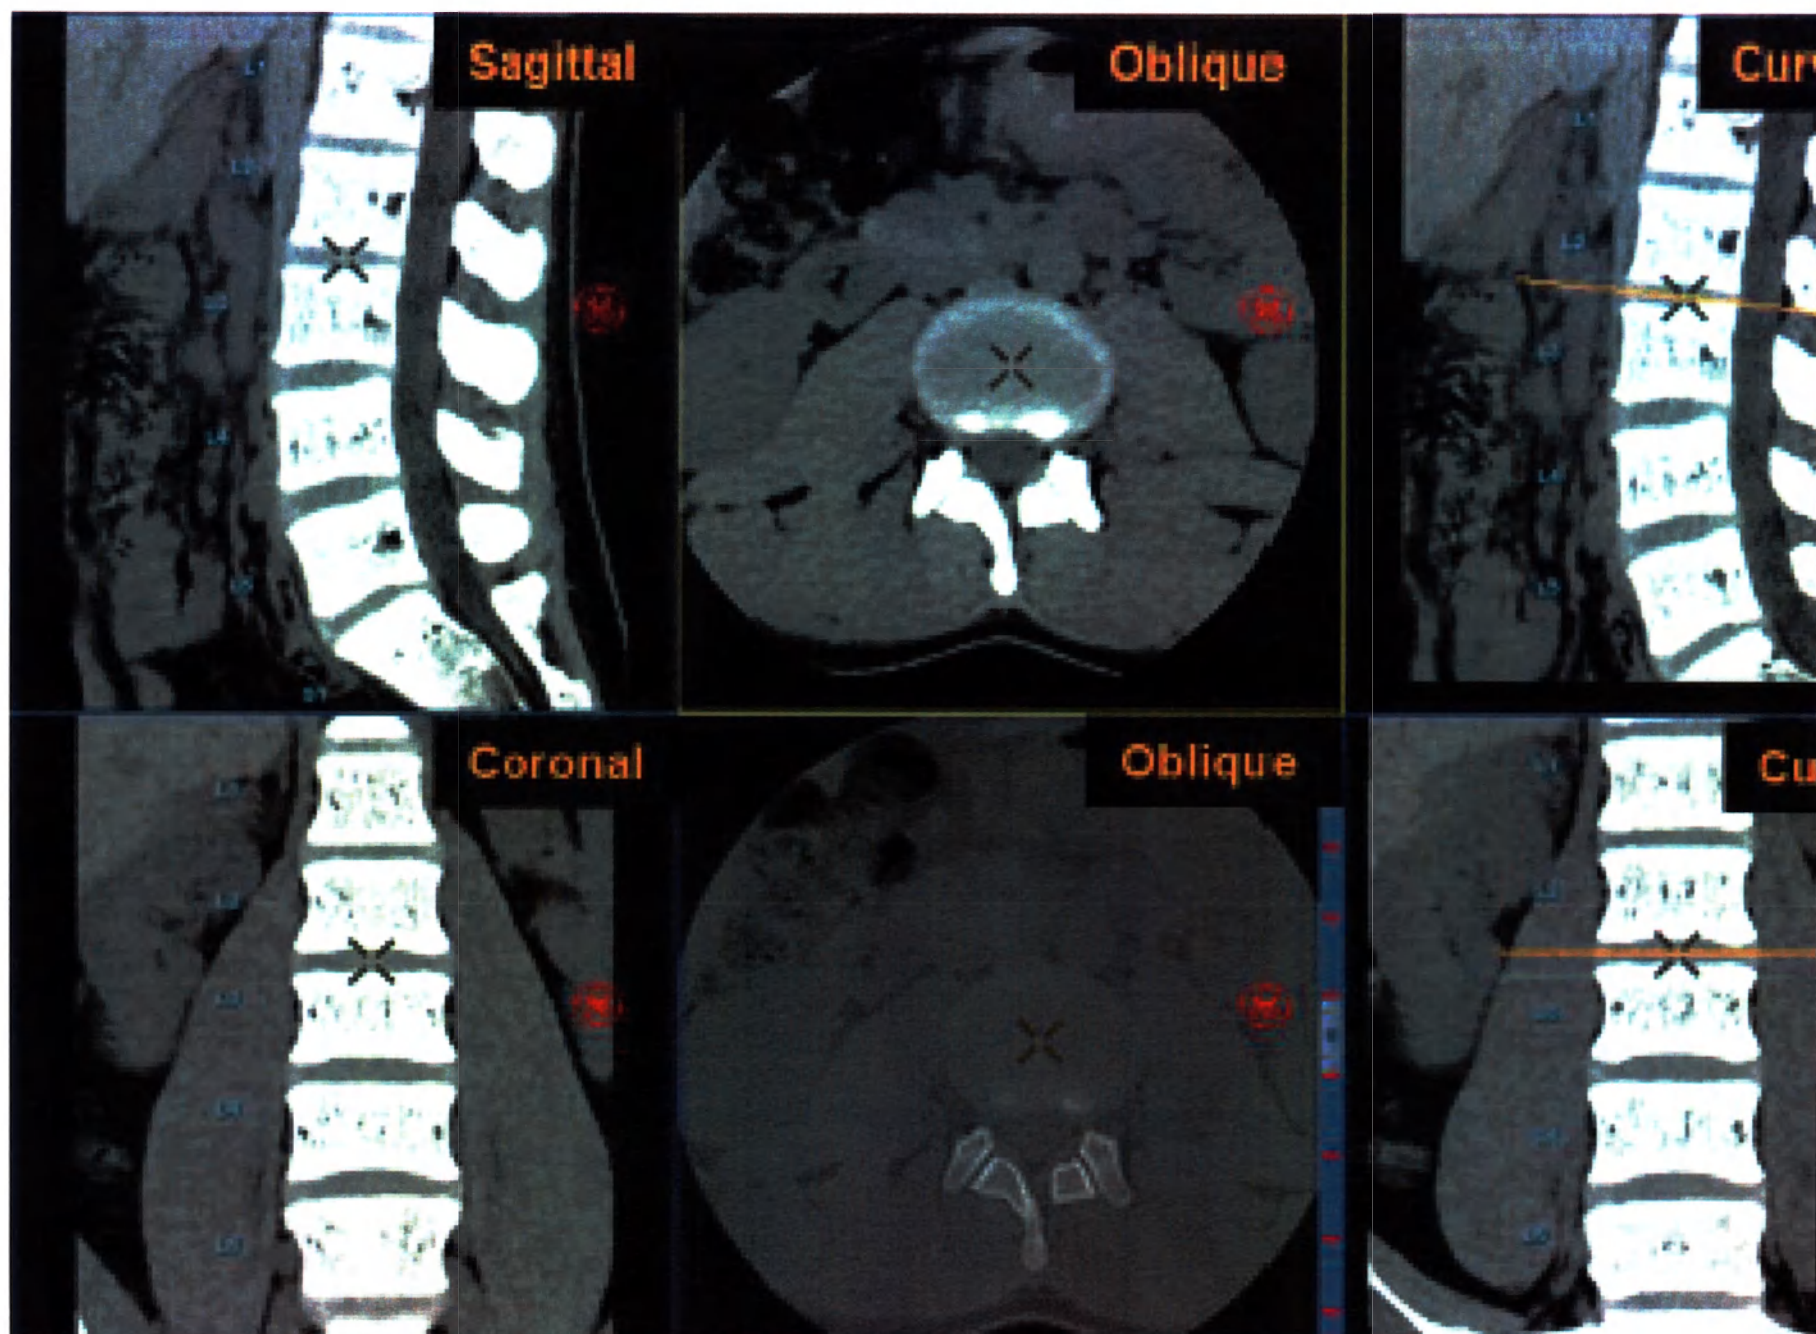


Рис. 101. Программный пакет для визуализации позвоночника на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).

5.5 CHEST-PEL CE(1Phase)

Scout

Scout

Interventional Series C1

Interventional Series C1

5mm AX STD

5mm AX STD

0.625mm AX DLIR

CT Thick Axials 5mm

5mm AX STD CE

5mm AX STD CE

5mm AX LUNG CE

0.625mm AX DLIR CE

CT Thick Axials 5mm

Image Display

0.625mm AX DLIR

Group 1

All Settings

Recon Settings

Thickness	0.625 mm
Matrix Size	512
Recon Type	512
Enhanced Contrast	1024
Recon Mode	Helical Plus
IQ Enhance	E
Interval	0.6250 mm
Image Enhance Filter	None
ASIR-V	---
DLIR	Low
MAR	Off
Window Width	300
Window Level	25
Flip / Rotate	None

Anatomy Selection

1100.000 mm / 1500.000 mm / 641 / 35.0 cm / A0.0 mm / R0.0 mm / ---, ---

Output Options

On / 0.625mm AX DLIR / Off

Transfer Options

Delete Recon


☒ Auto Run



Revolution Ascend

Рис. 102. Программный пакет для матрицы реконструкции 1024 на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости)).



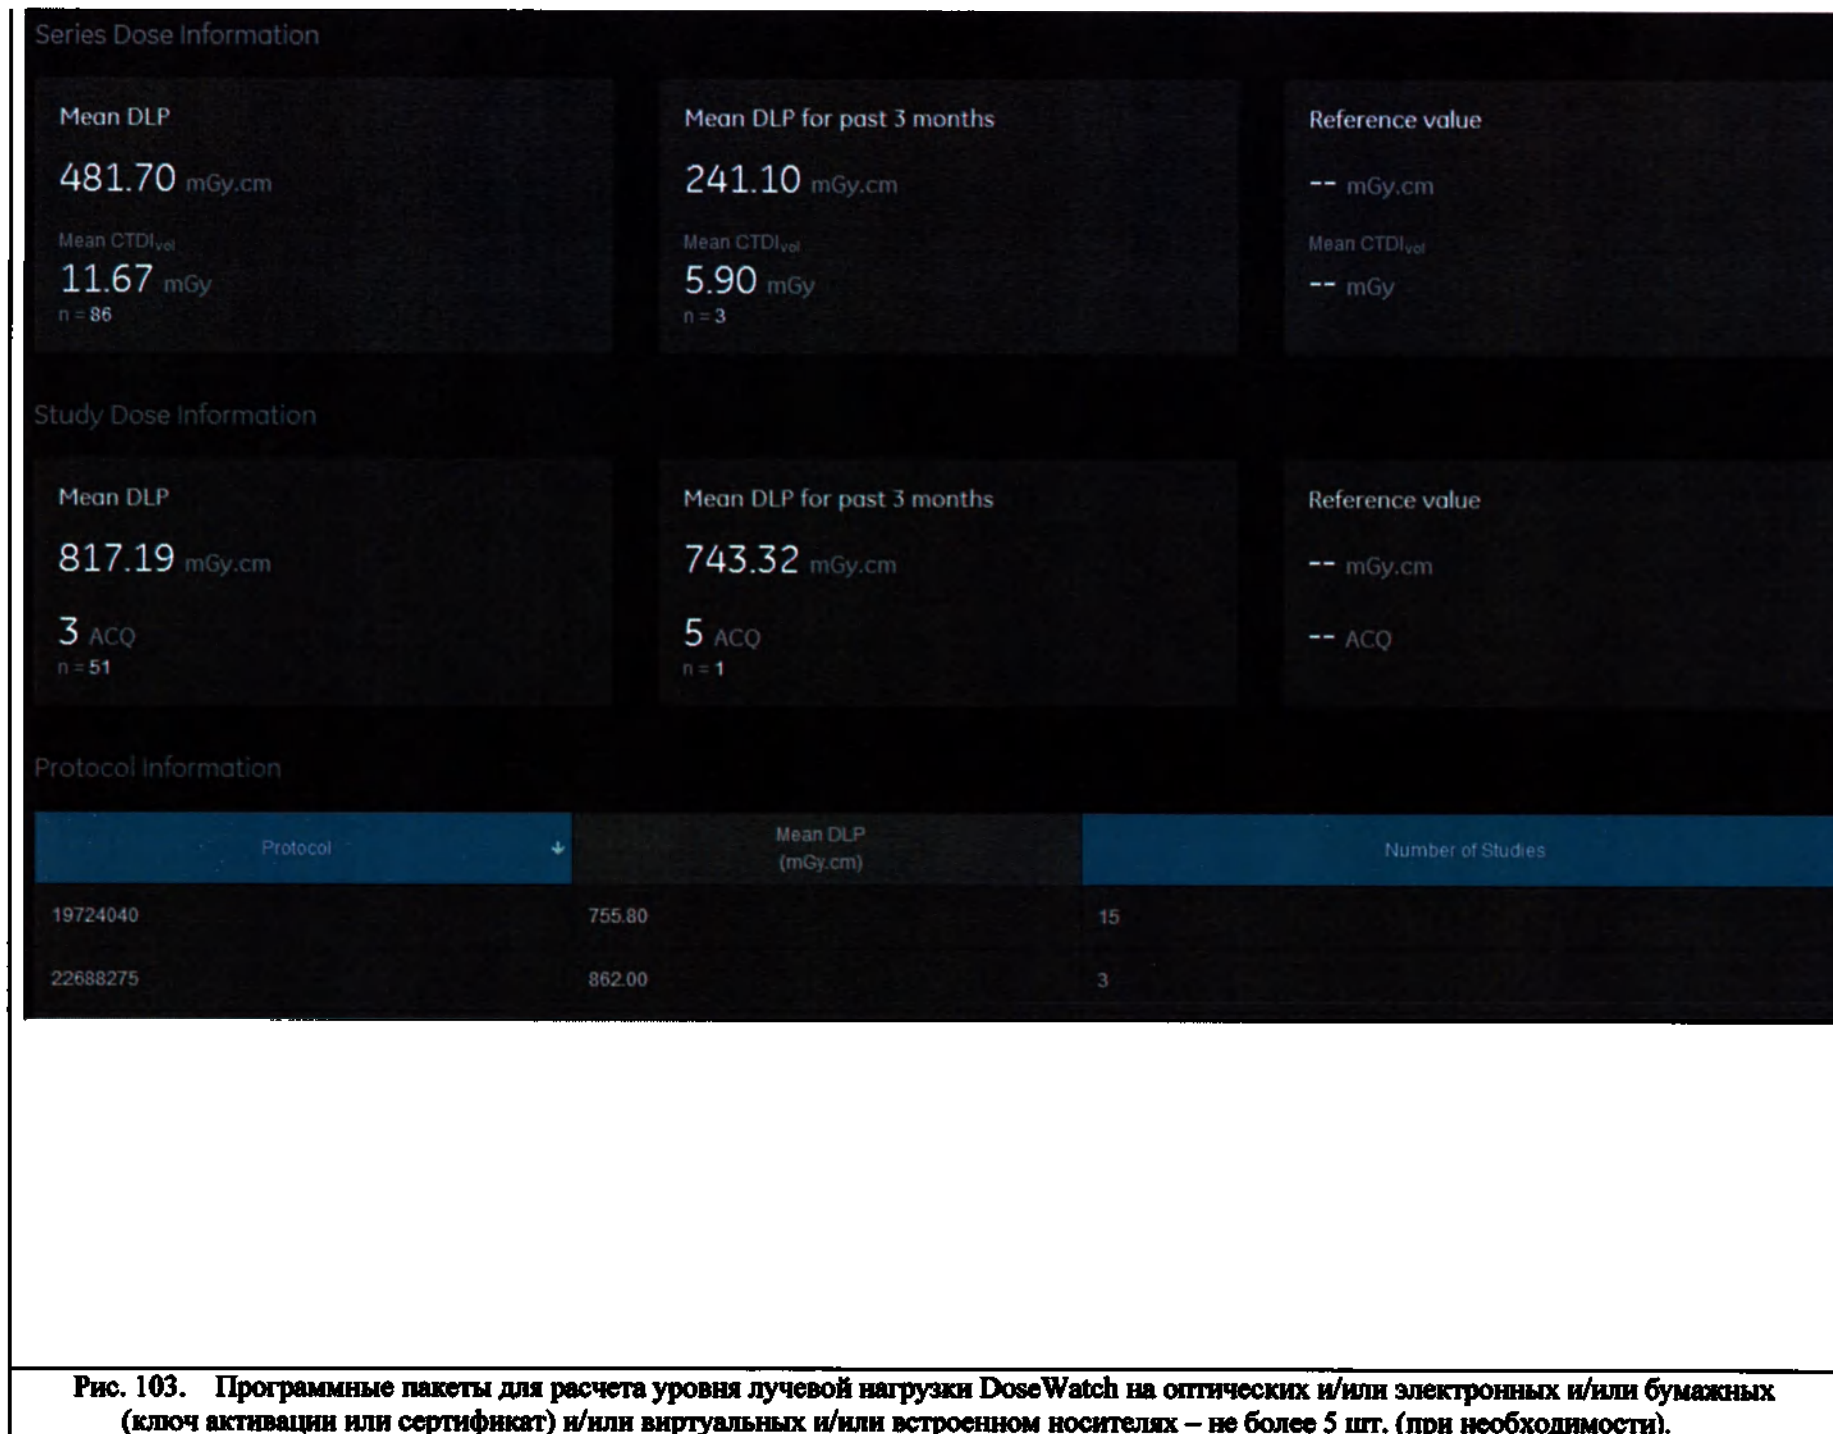

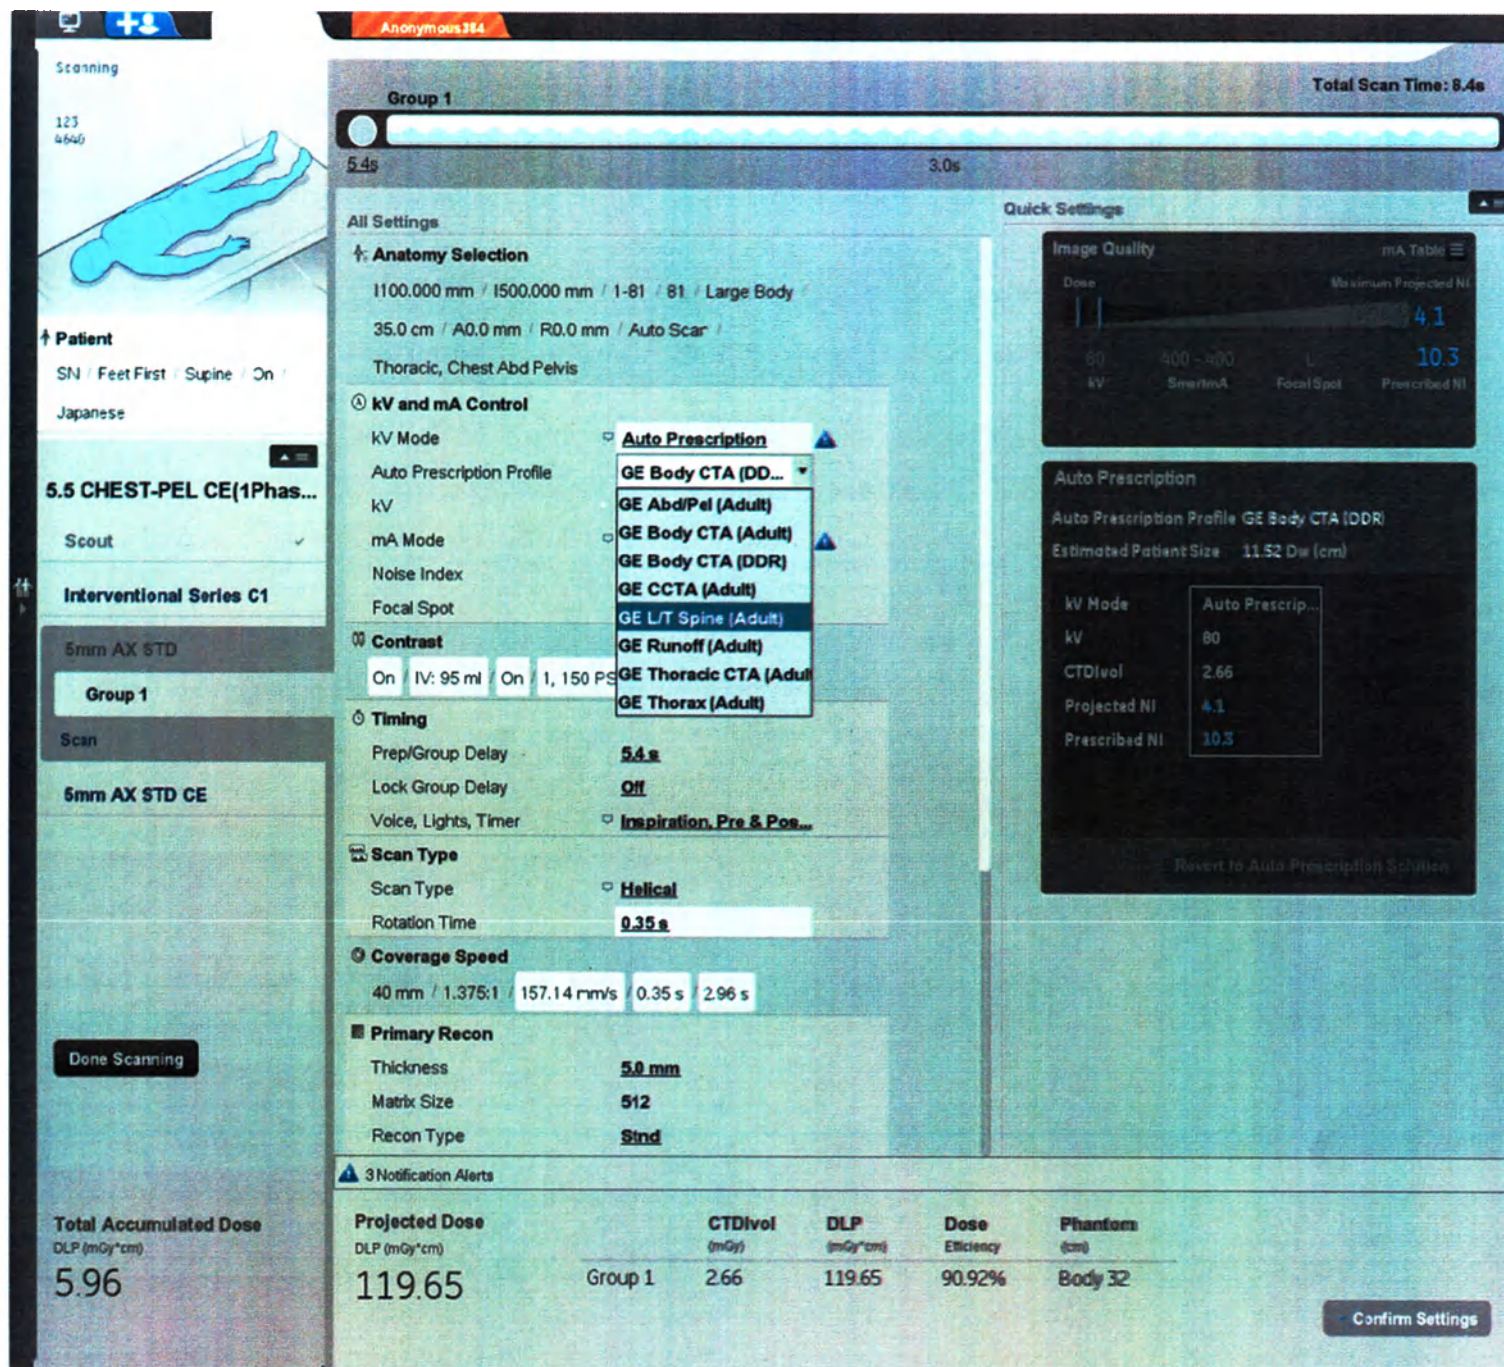


Рис. 104. Программные пакеты для автоматического подбора параметров сканирования на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).


Select Protocol


Tools


DPP

Johnathan Moore

400-89-067 1971/7/4 48 Years M¹

Chest Routine

Operator

Protocol: 3.4 Chest w/o IV Contrast

SCOUT	GROUP1	GROUP2
Start Loc.	S 60.0 mm	S 60.0 mm
End Loc.	I 300.0 mm	I 300.0 mm
kV	80	80
mA	10	10
Scout Plane	0	90

Head First
Supine
XY

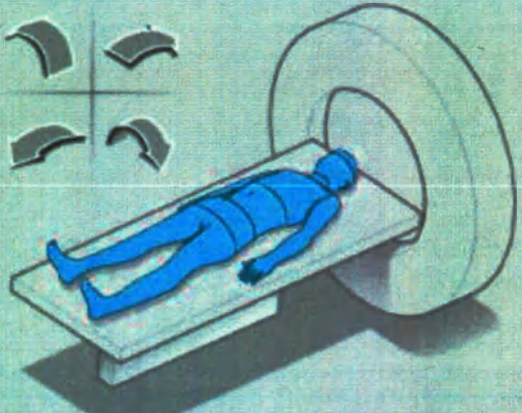




Table motion will begin when pressed.
Please monitor patient during movement.



Рис. 105. Программные пакеты автоматического позиционирования пациента на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).

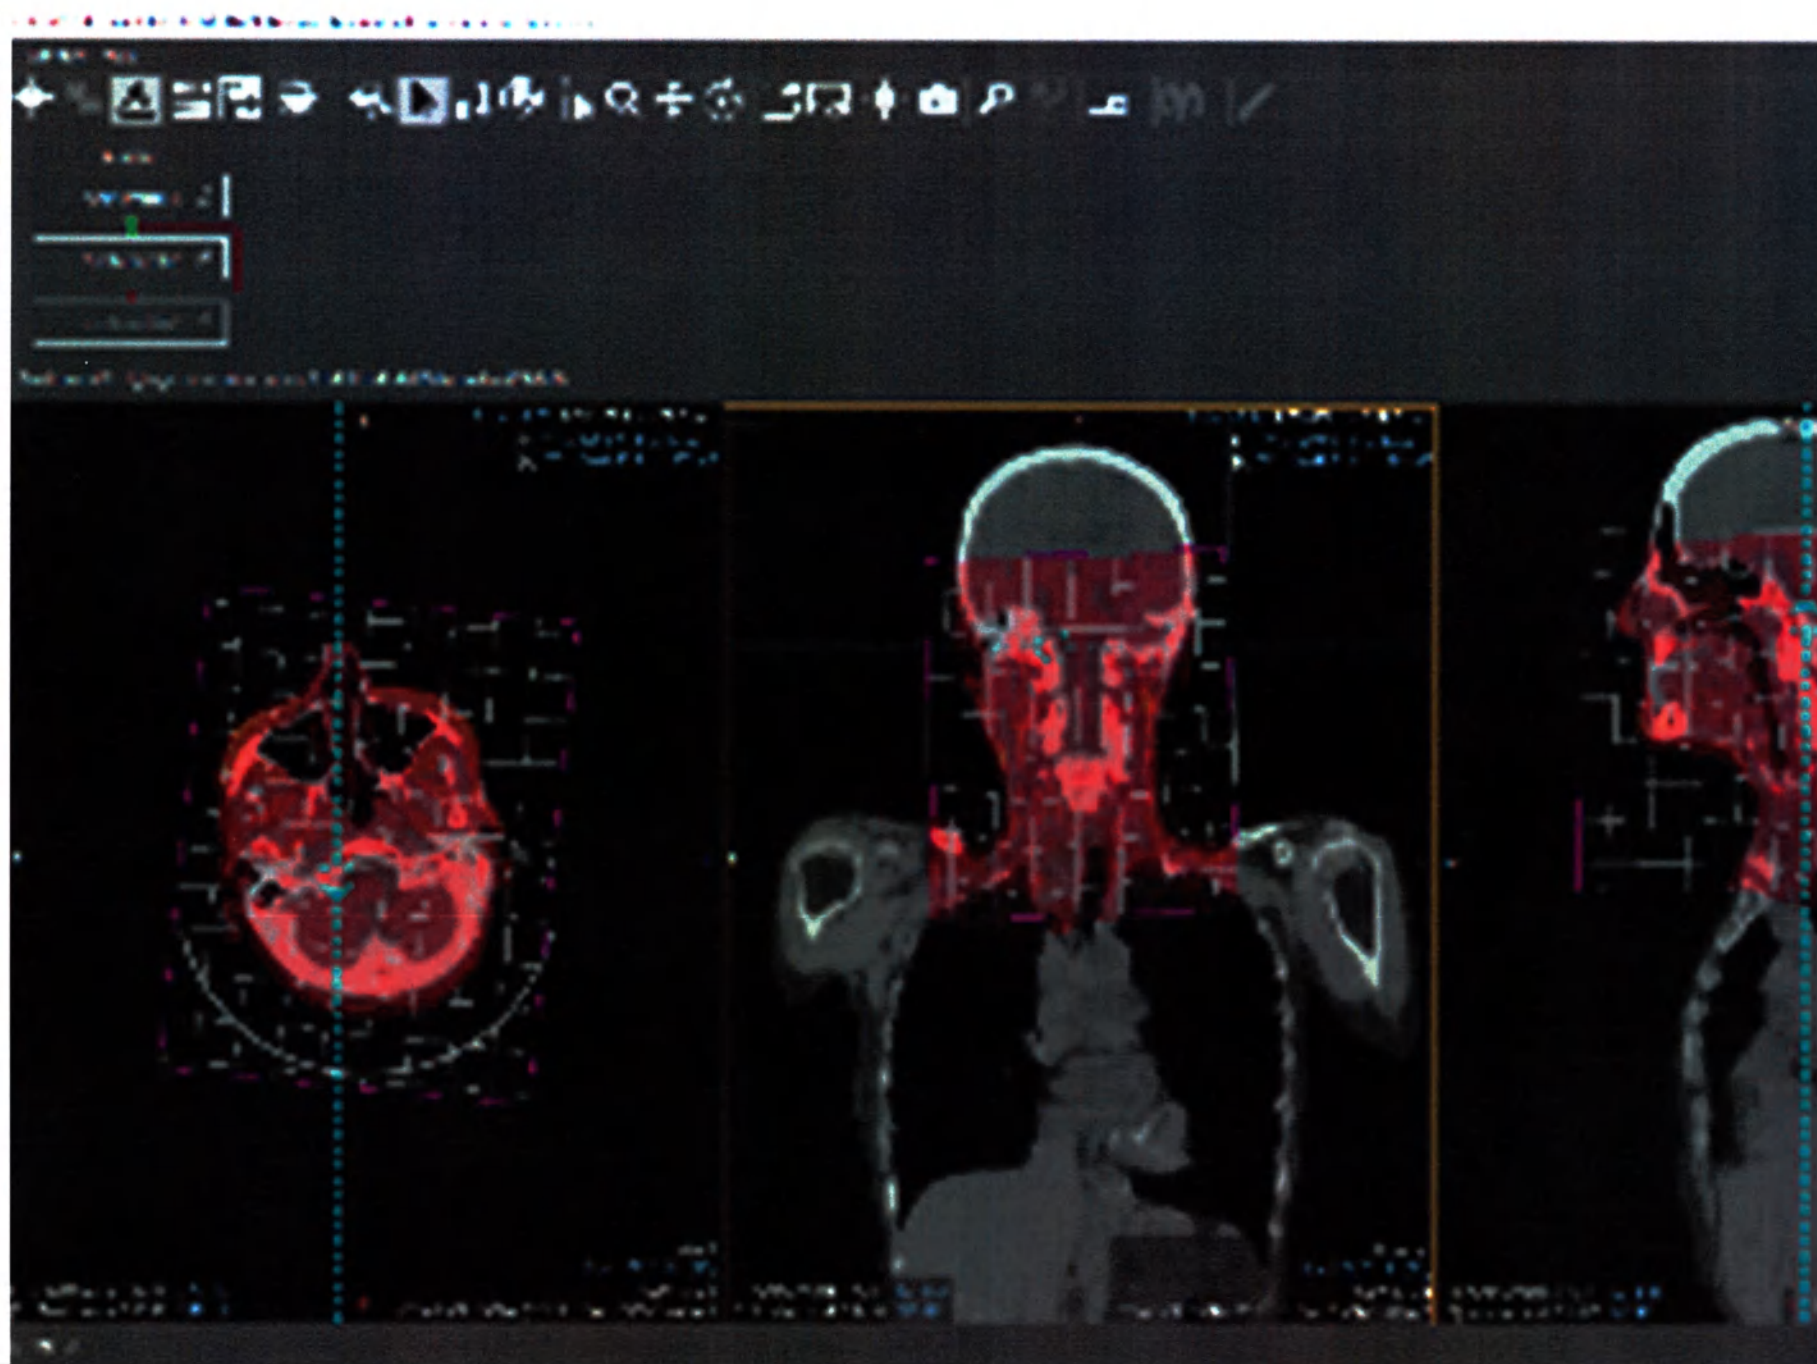


Рис. 106. Программные пакеты для подготовки данных для радиотерапии на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

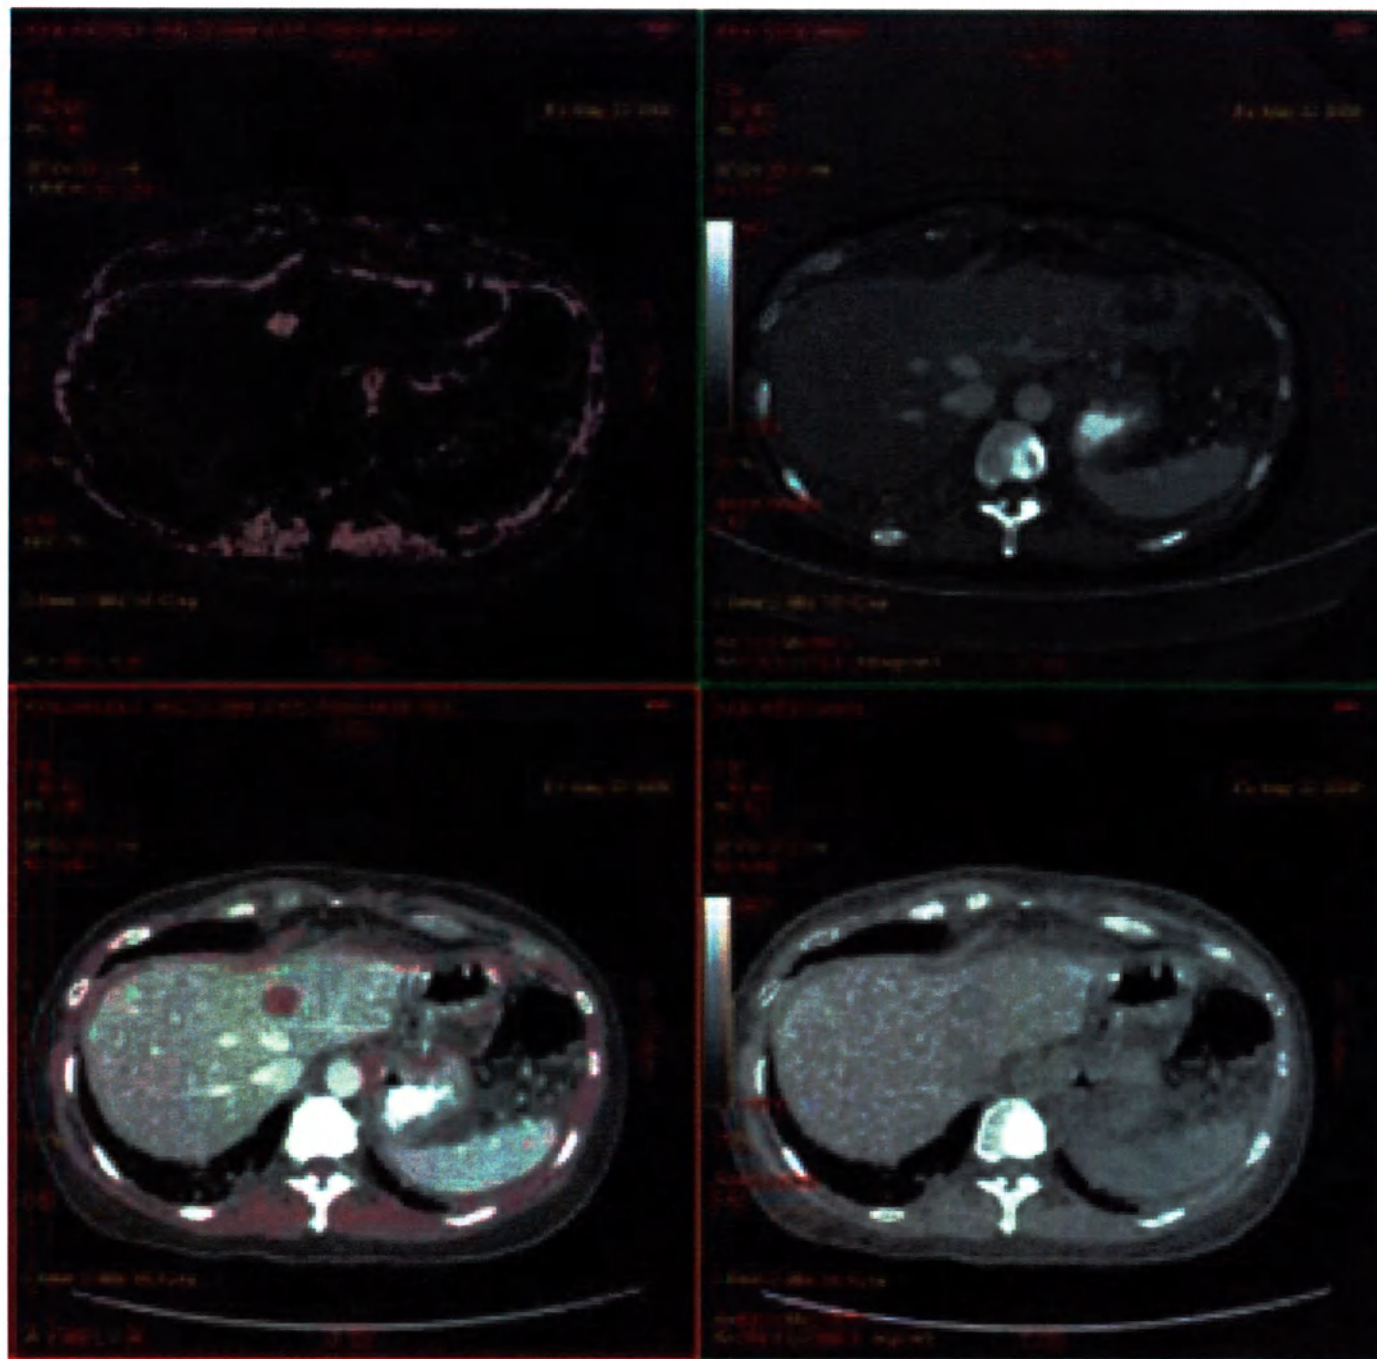


Рис. 107. Программный пакет для двухэнергетической визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

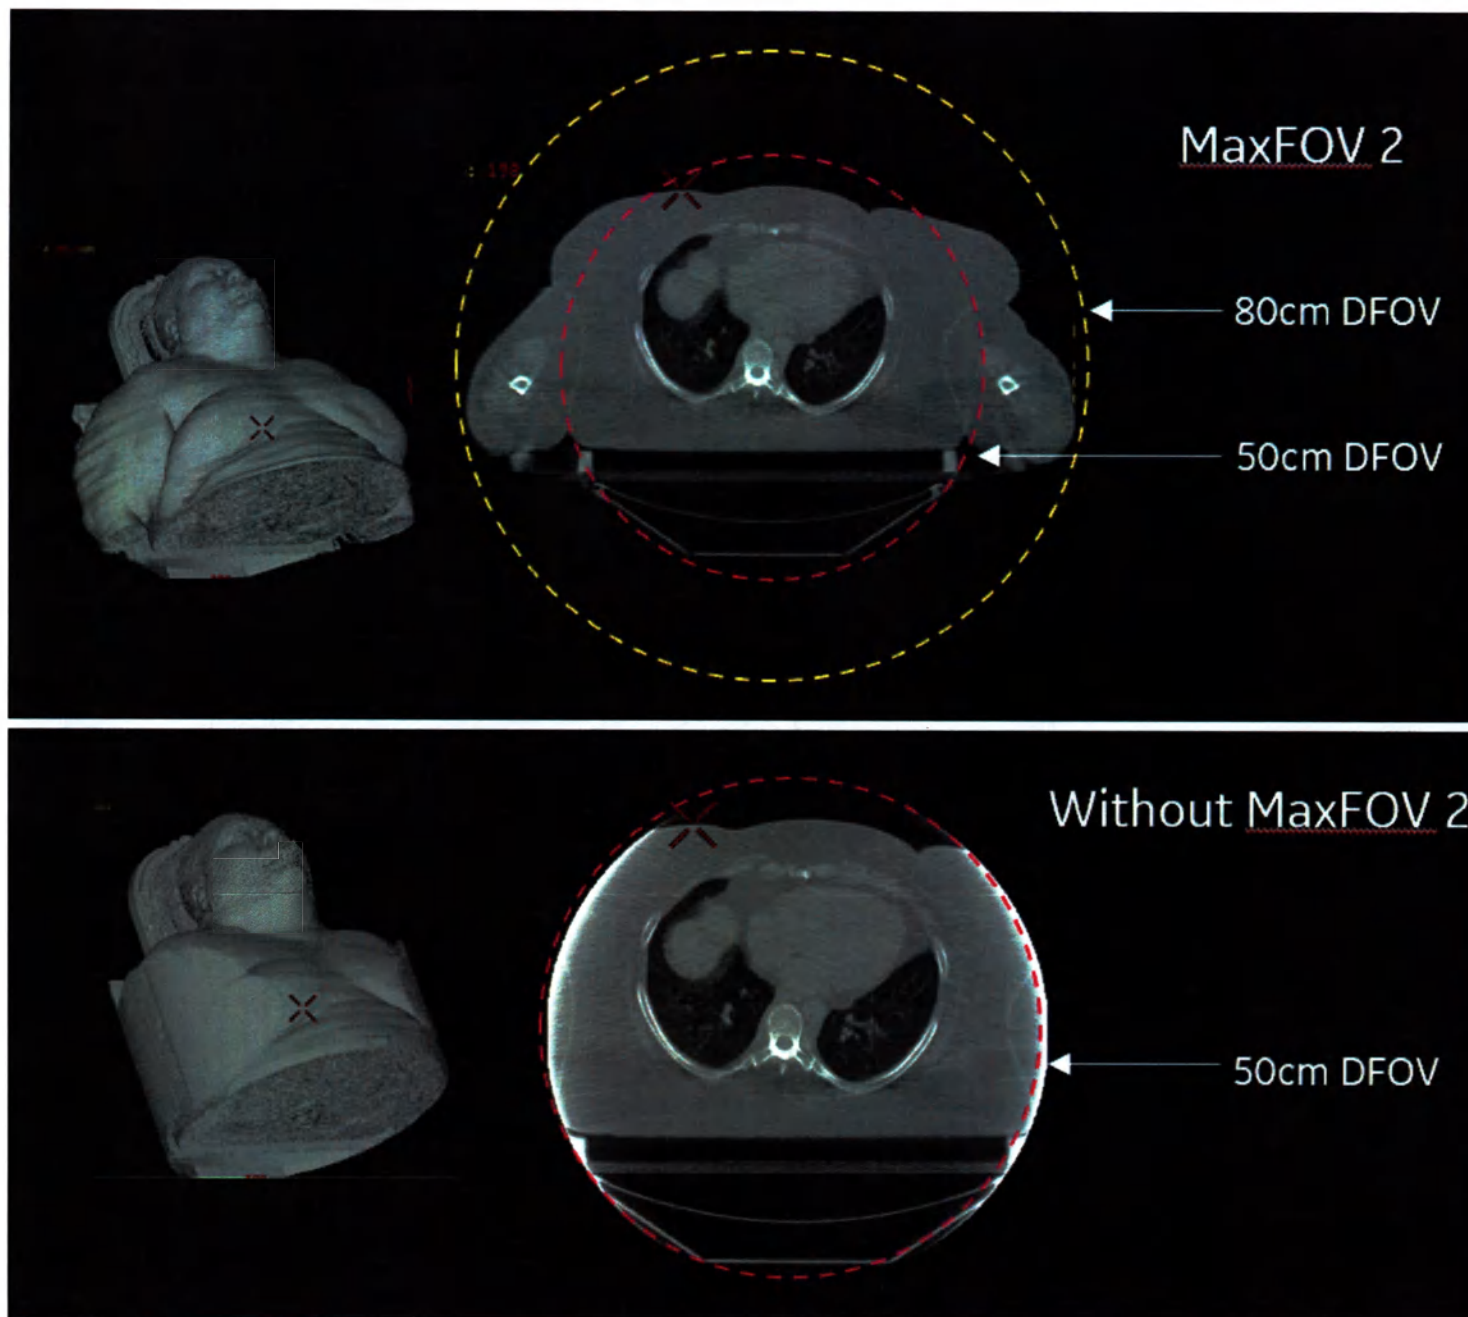


Рис. 108. Программные пакеты для увеличения поля обзора отображения на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 109. Программный пакет для выполнения реконструкции изображений с применением технологий глубинного обучения на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

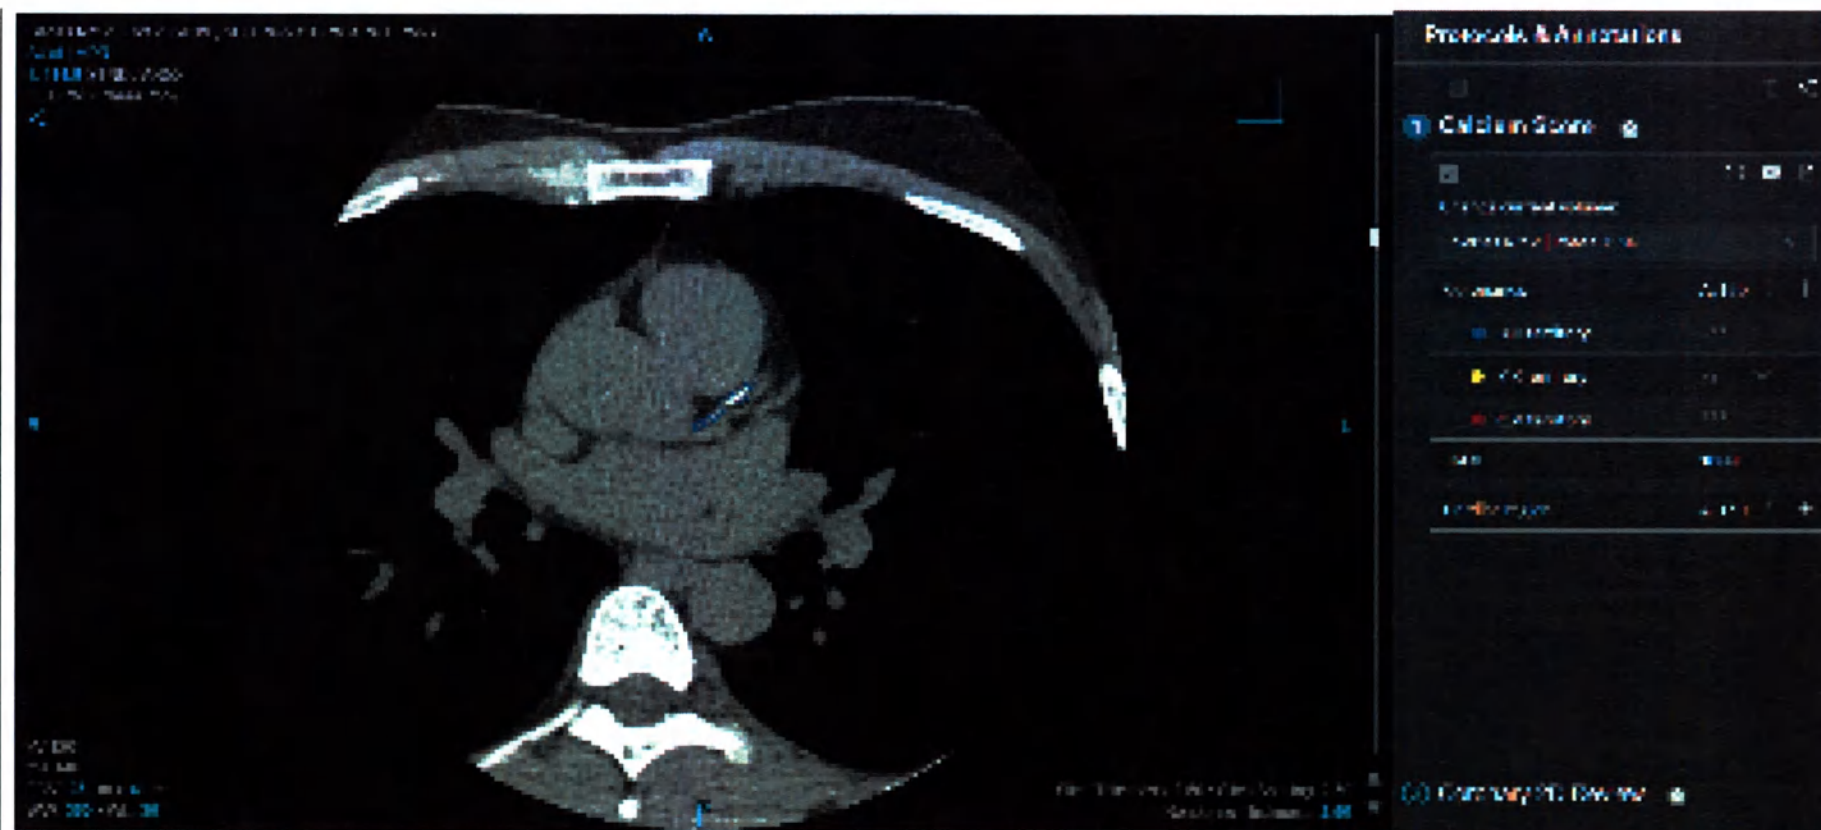


Рис. 110. Программный пакет для постобработки кардиологических КТ-исследований на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

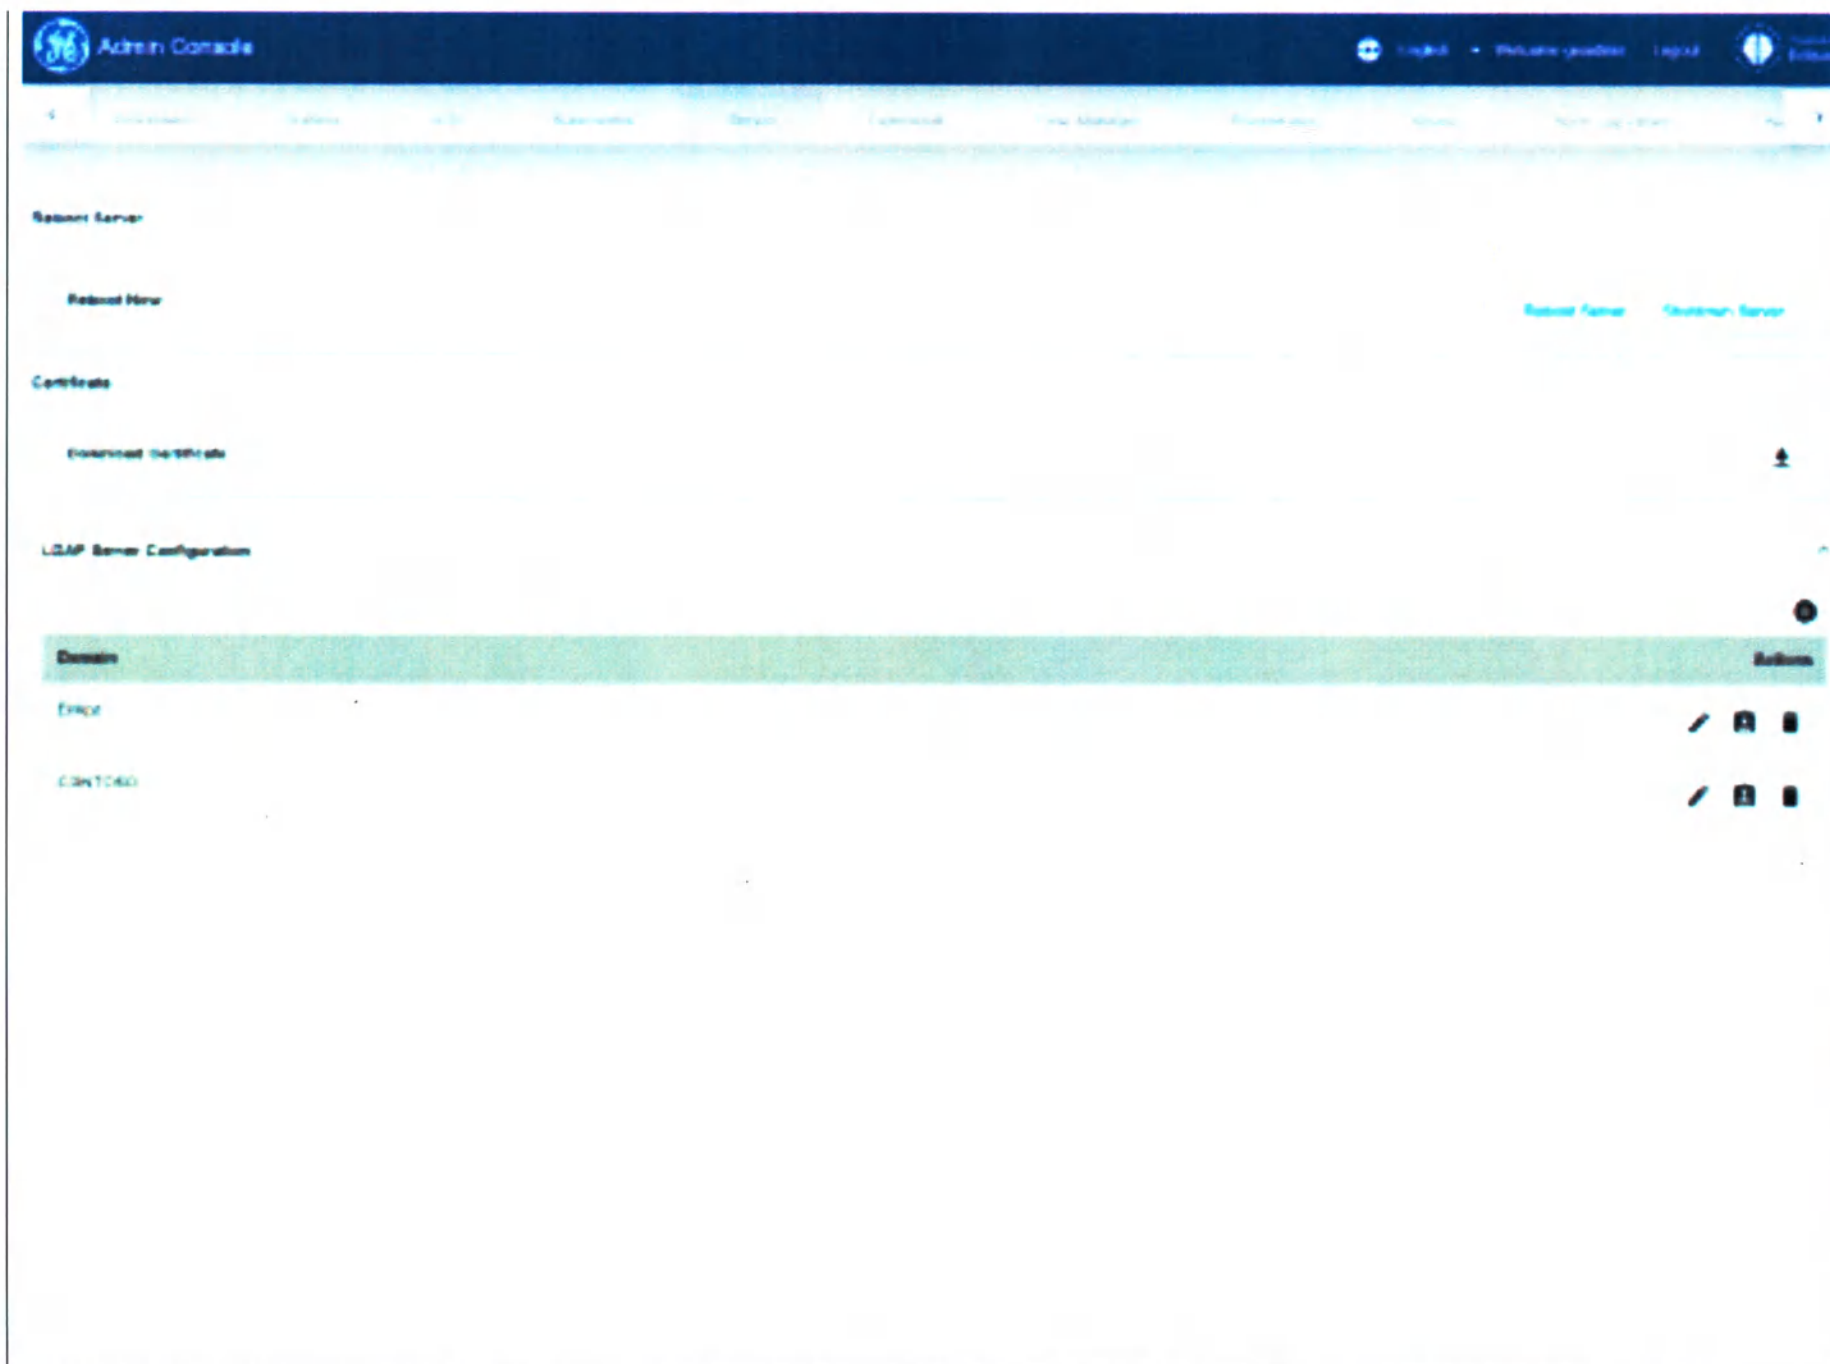


Рис. 111. Программный пакет для связи с сервером обработки диагностических данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

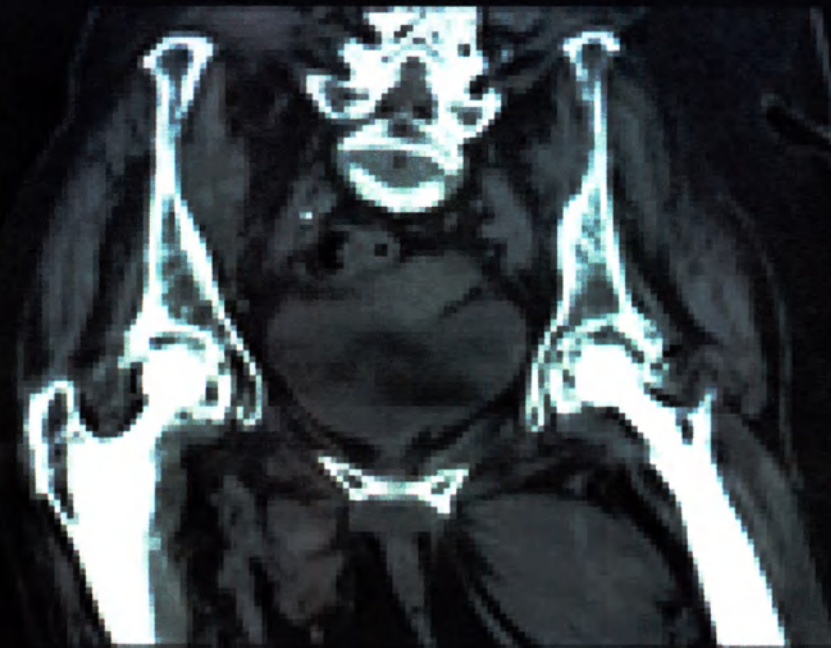
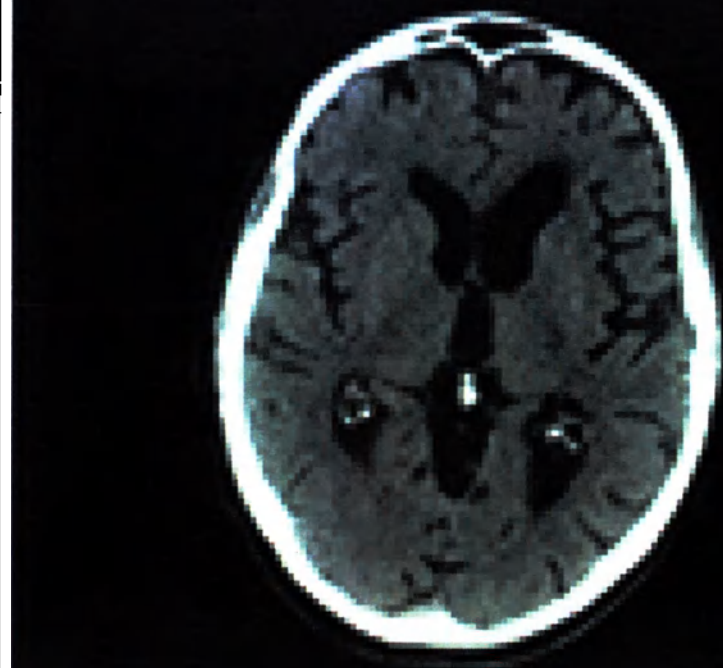


Рис. 112. Программный пакет для обработки изображений на сервере обработки диагностических данных на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

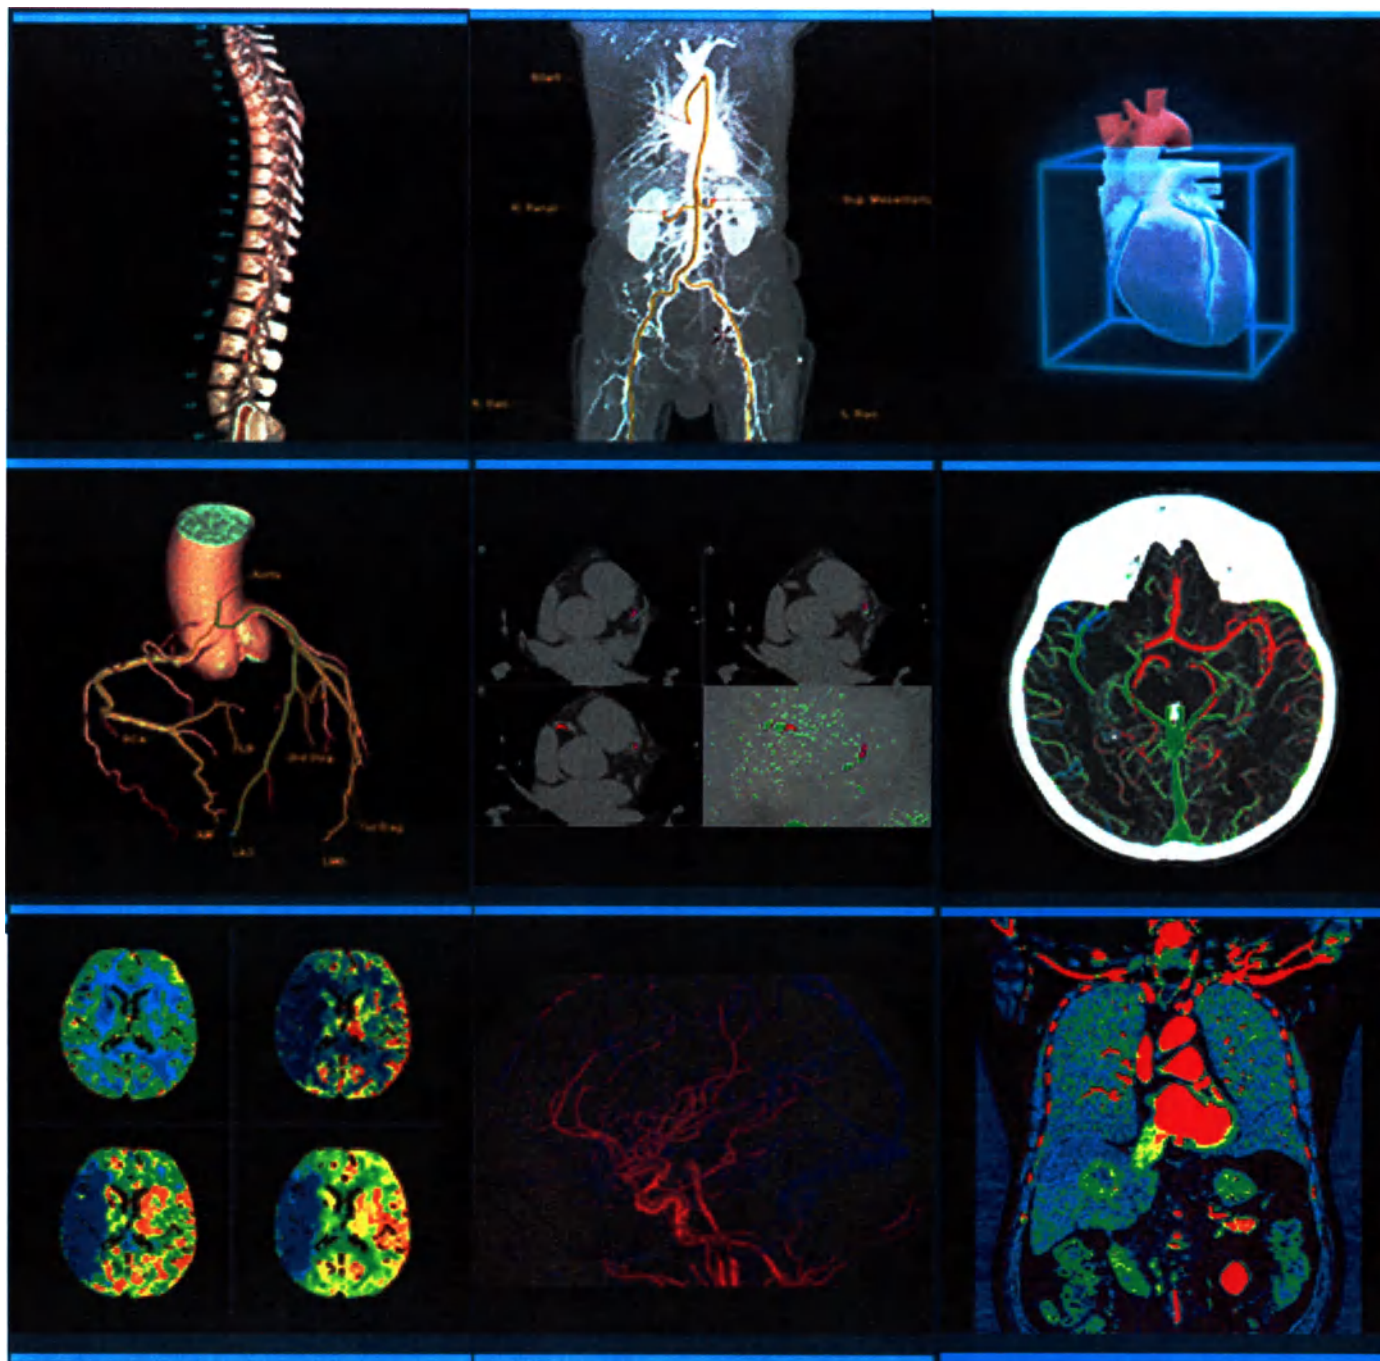


Рис. 113. Программный пакет для расширенной трехмерной визуализации на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).

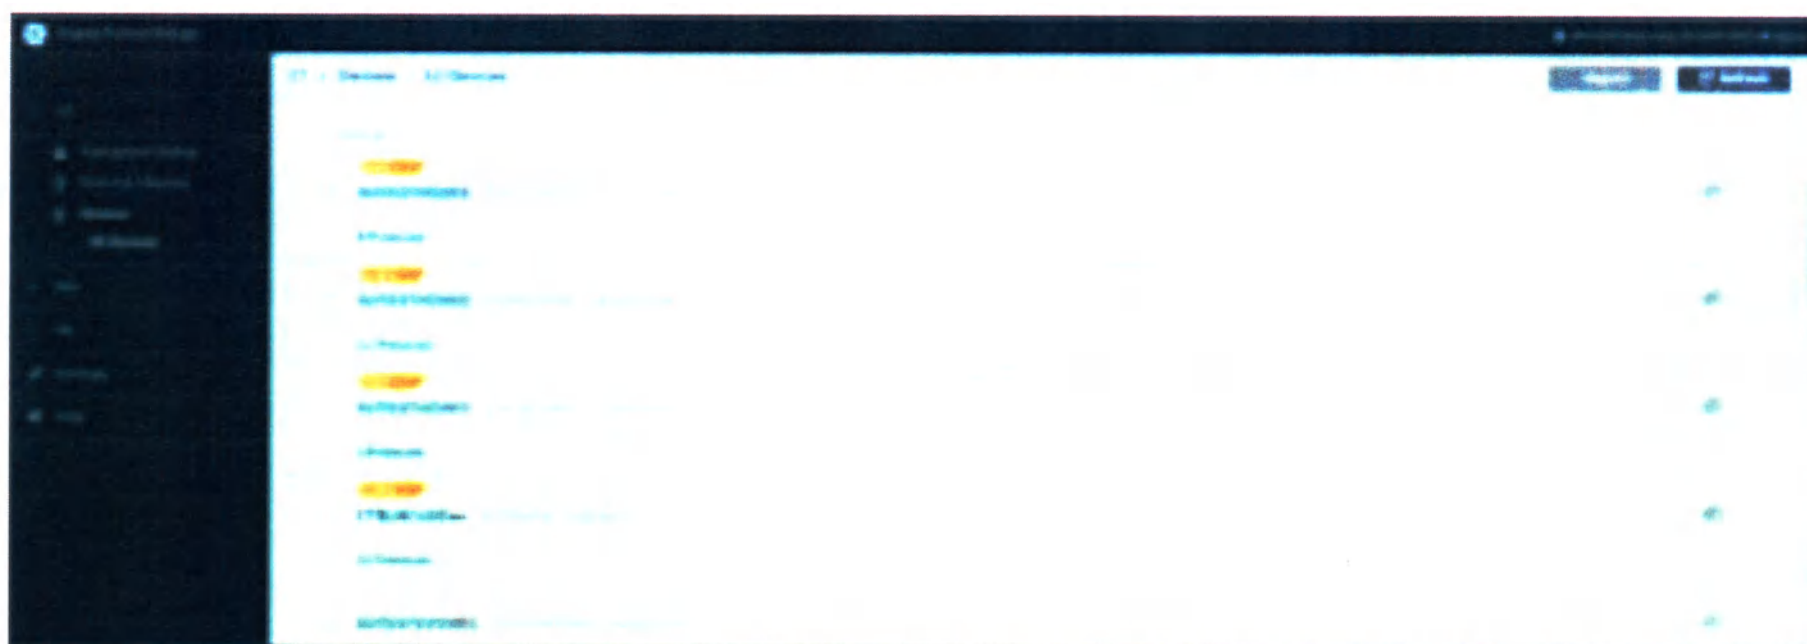


Рис. 114. Программные пакеты для управления протоколами сканирования на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 115. Программные пакеты для автоматической отправки результатов исследования на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 116. Программный пакет для автоматической постобработки КТ-исследований головы на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителех – не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 117. – Программный пакет для совмещения спектрального и монохроматического изображений на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях - не более 10 шт. (при необходимости).



Рис. 118. Программный пакет для анализа костного мозга на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) и/или виртуальных и/или встроенном носителях – не более 10 шт. (при необходимости).





Рис. 120. Устройства для наблюдения за пациентом AVIMOS, в составе (не более 10 шт.): Компьютер для обработки видеосигналов – 1 шт.;



Рис. 121. Устройства для наблюдения за пациентом AVIMOS, в составе (не более 10 шт.): Монитор – не более 5 шт.;



Рис. 122. Устройства для наблюдения за пациентом AVIMOS, в составе (не более 10 шт.): Мышь – 1 шт.;



Рис. 123. Панель дистанционного управления – не более 10 шт.

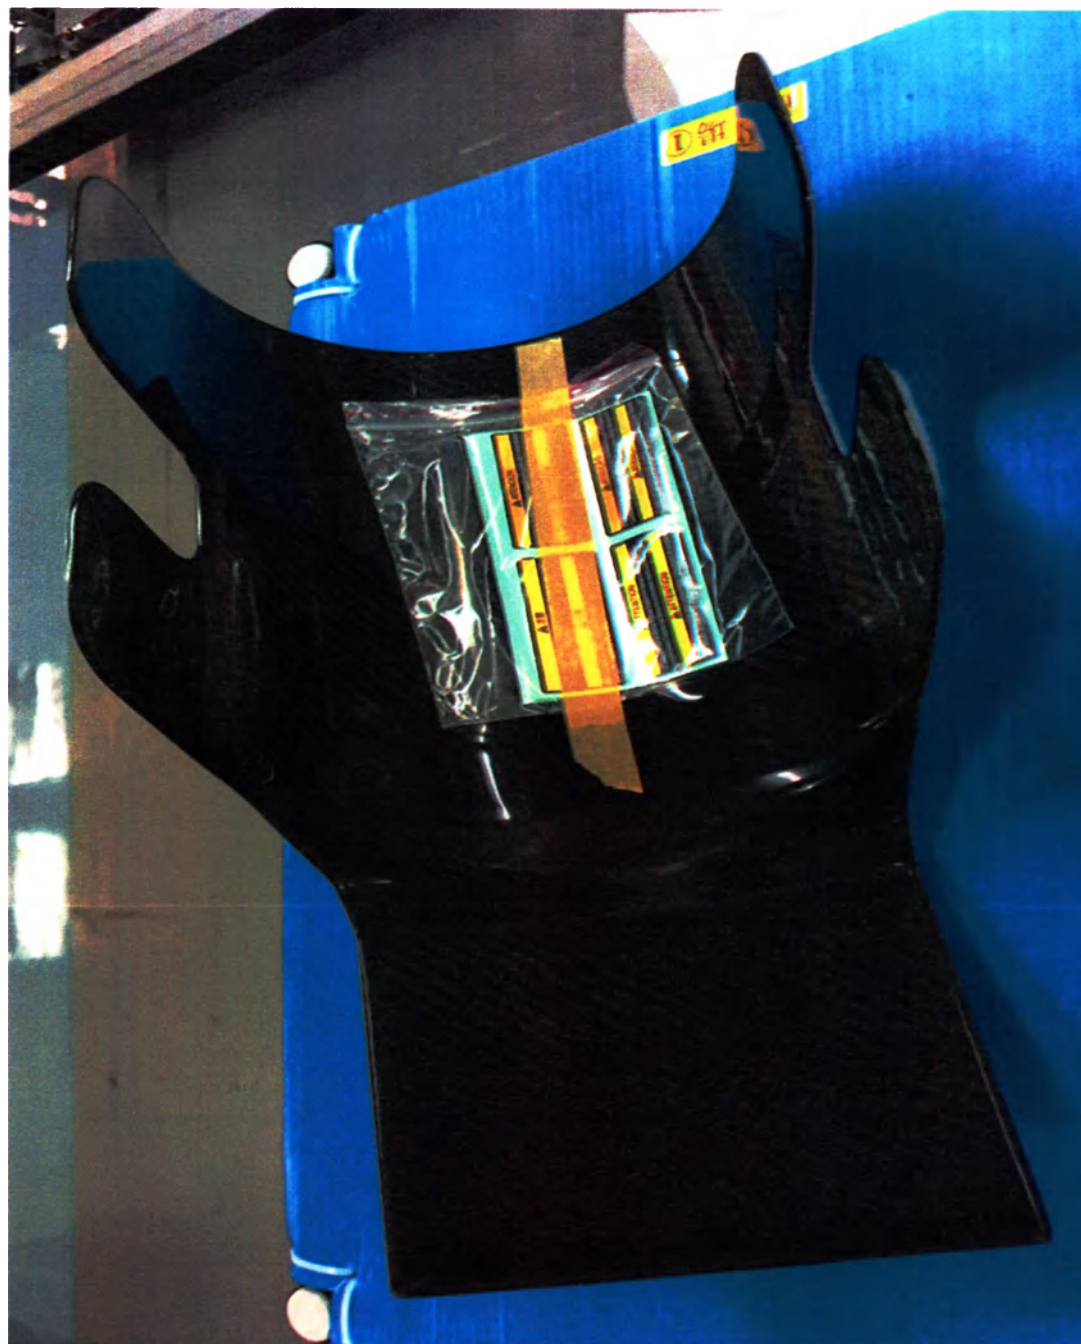


Рис. 124. Подголовник корональный и/или аксиальный и/или низкопрофильный – не более 5 шт.

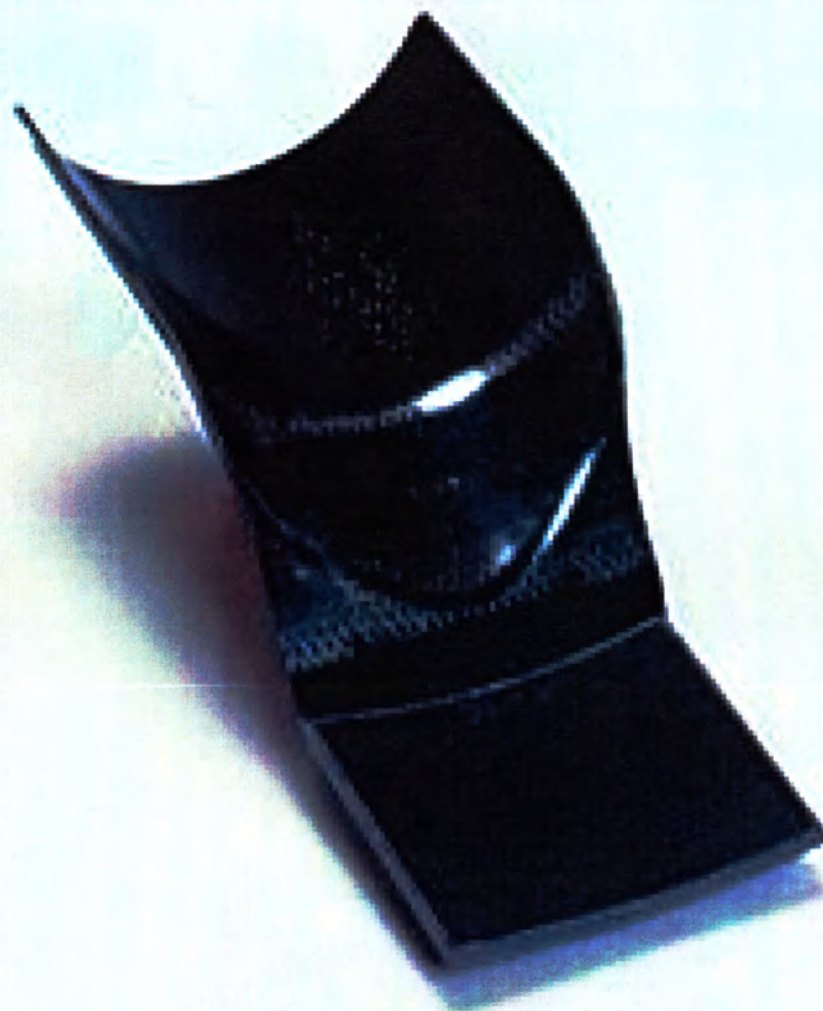


Рис. 125. Подголовник корональный и/или аксиальный и/или низкопрофильный – не более 5 шт.



Рис. 126. Подголовник коронарный и/или аксиальный и/или низкопрофильный – не более 5 шт.



Рис. 127. Вкладыши мягкие для подголовников – не более 20 шт.



Рис. 128. Вкладыши мягкие для подголовников – не более 20 шт.

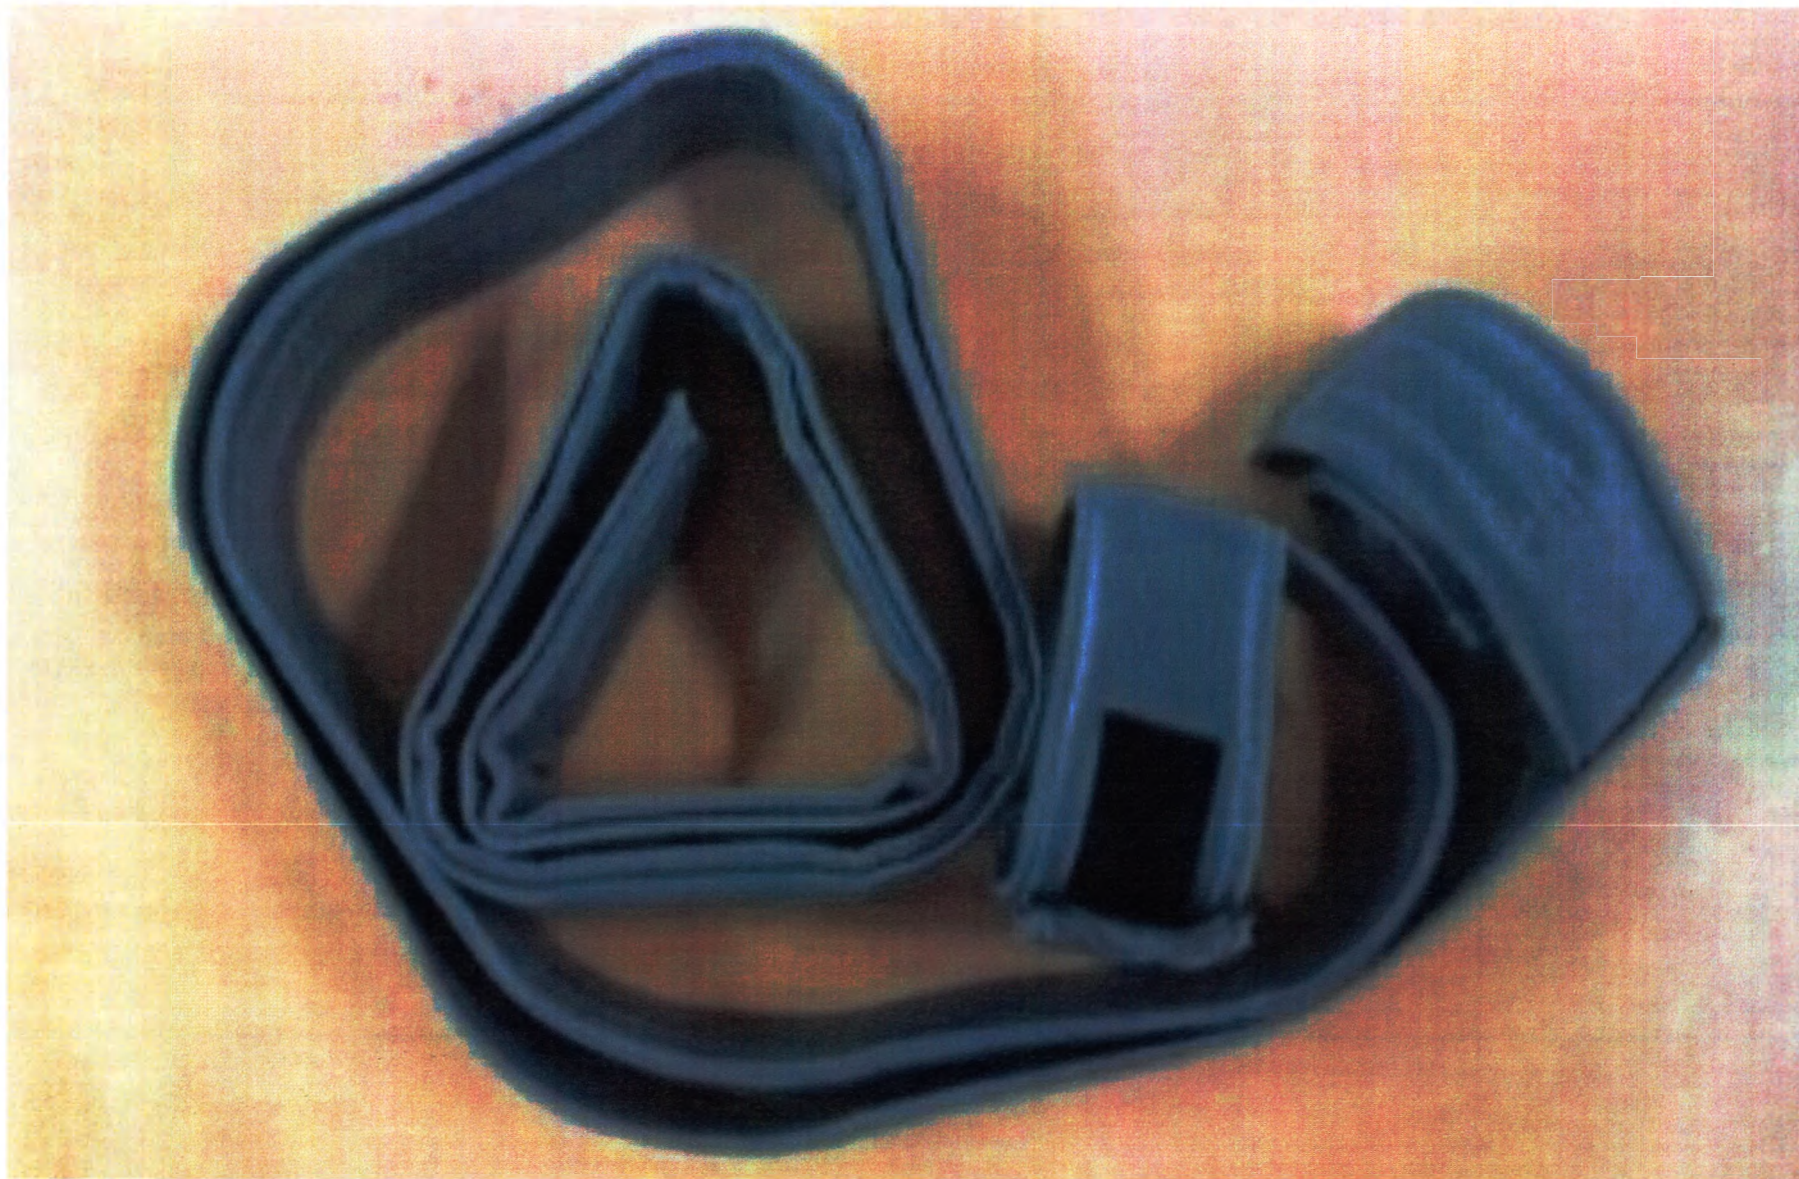


Рис. 129. Ремни для фиксации пациента: Короткие ремни пациента и/или Длинные ремни пациента и/или Ремни с петлями и/или Фиксирующие ремни – не более 10 шт.

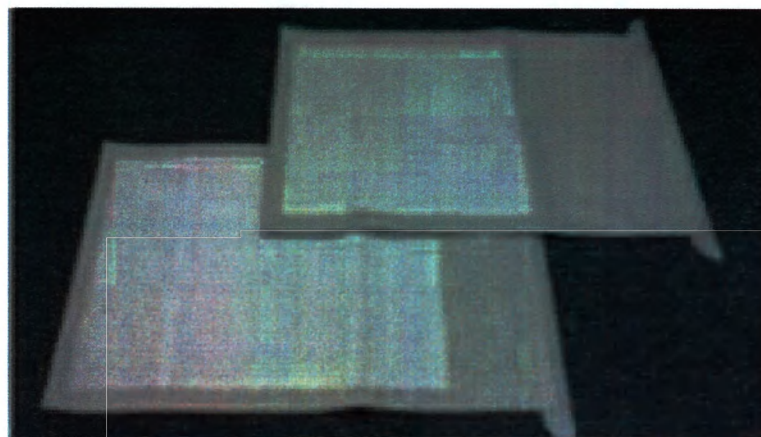
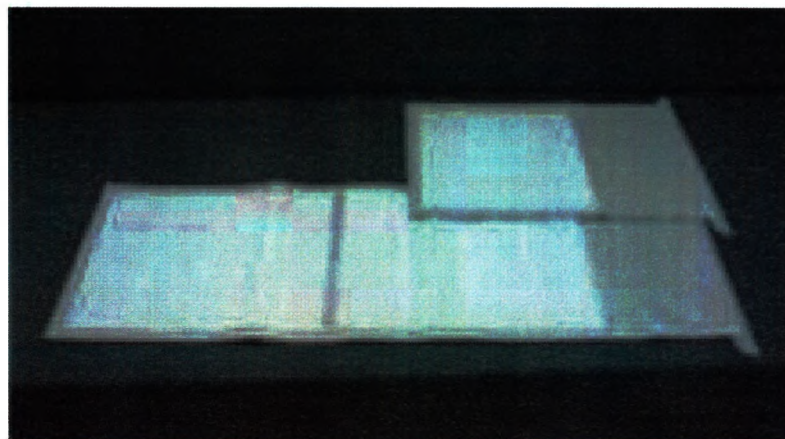
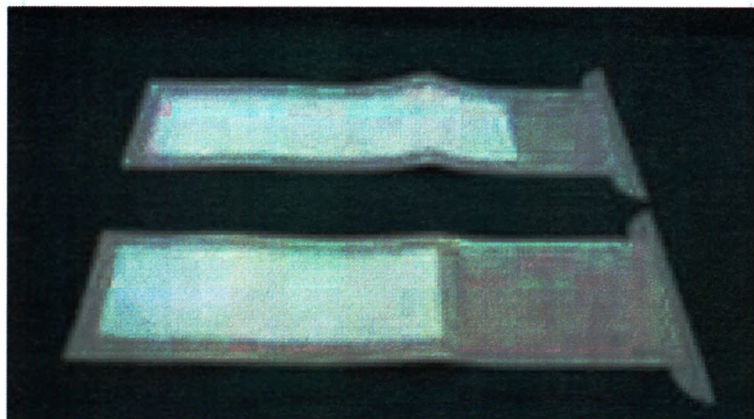
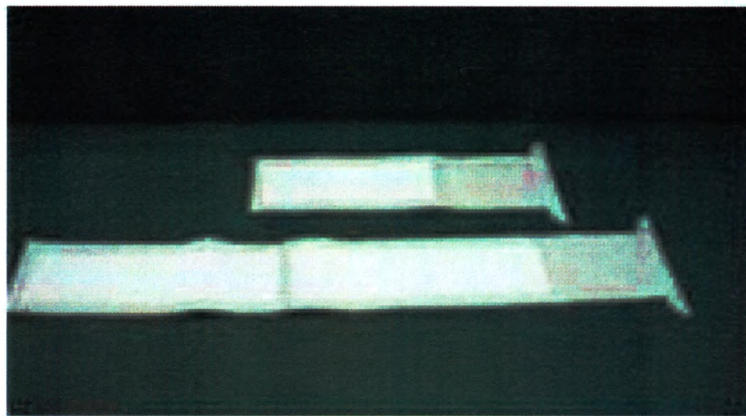
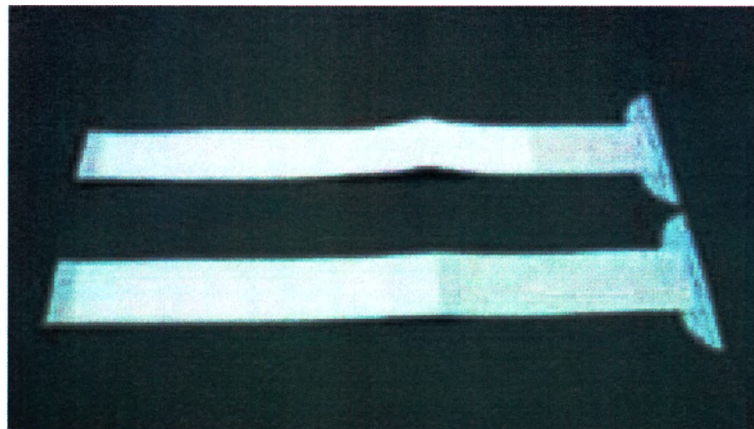
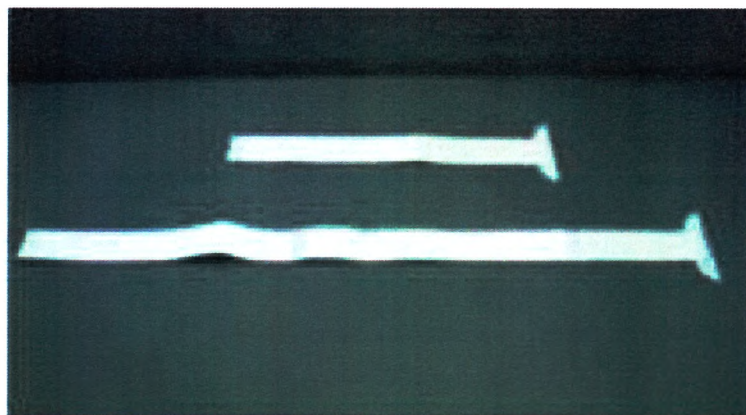


Рис. 130. Ремни для фиксации пациента: Короткие ремни пациента и/или Длинные ремни пациента и/или Ремни с петлями и/или Фиксирующие ремни – не более 10 шт.



Рис. 131. Ремни для фиксации пациента: Короткие ремни пациента и/или Длинные ремни пациента и/или Ремни с петлями и/или Фиксирующие ремни – не более 10 шт.

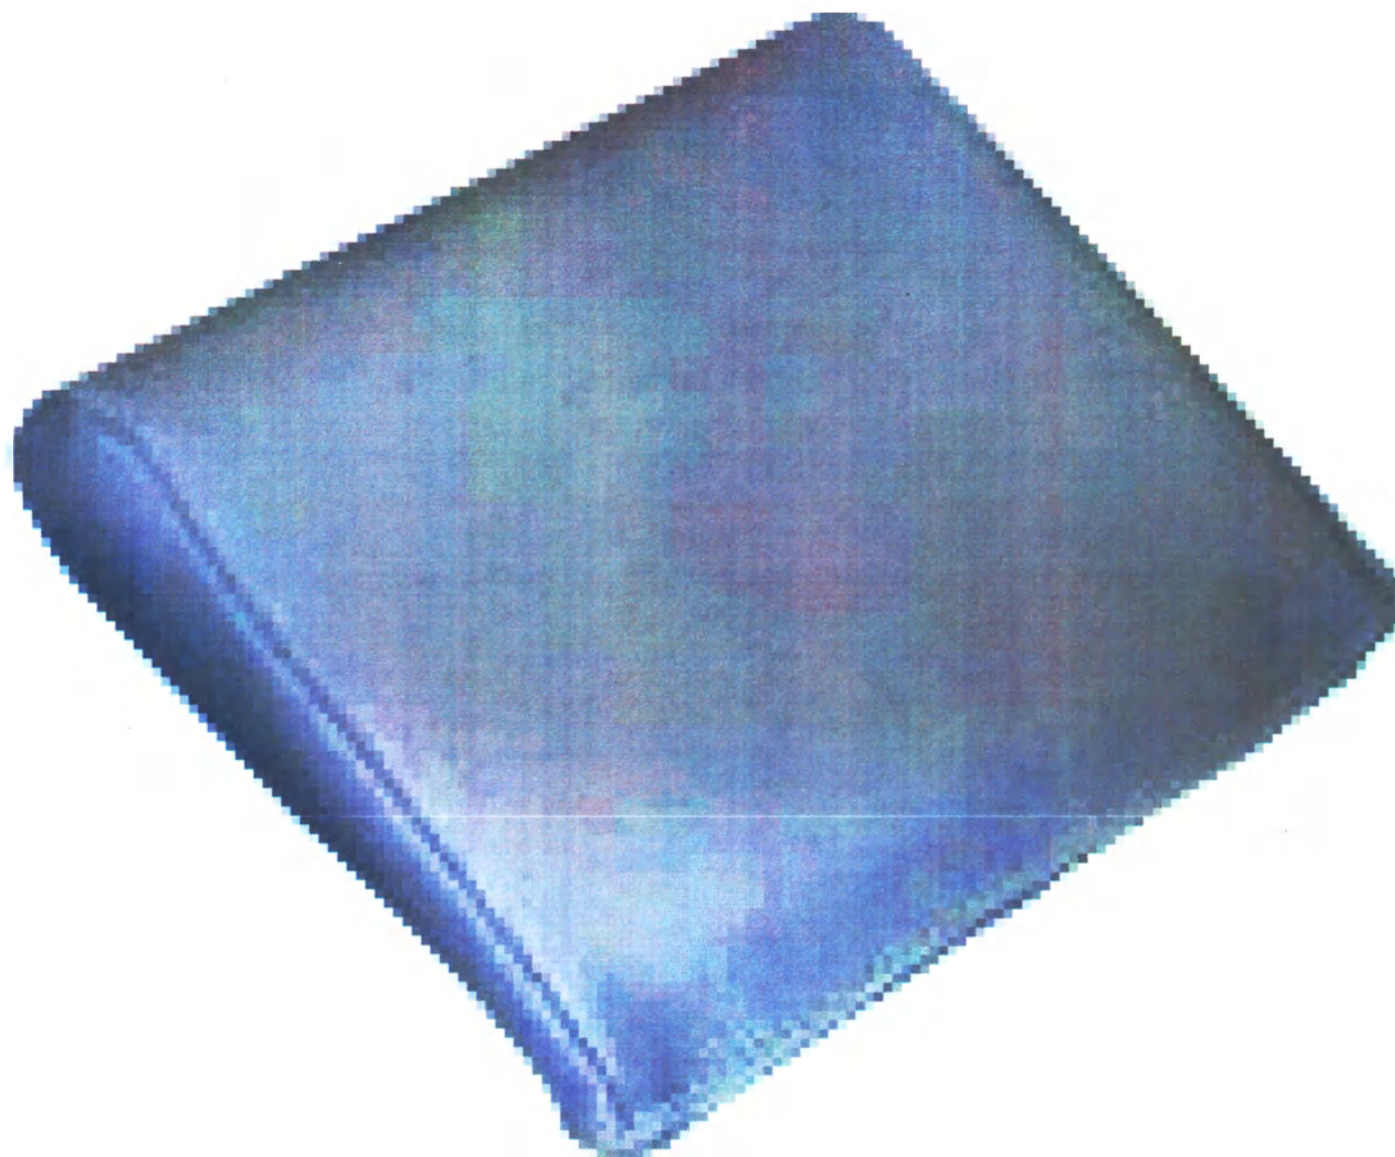



Рис. 132. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов: Приспособление для фиксации плеча/лодыжки и/или
Приспособление для фиксации головы/коленей и/или Цилиндрический вкладыш и/или Приспособление для позиционирования
головы и/или Клинья и/или Вкладыши прямоугольные и/или Подставка для ног – не более 50 шт.



Рис. 133. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов: Приспособление для фиксации плеча/лодыжки и/или Приспособление для фиксации головы/коленей и/или Цилиндрический вкладыш и/или Приспособление для позиционирования головы и/или Клинья и/или Вкладыши прямоугольные и/или Подставка для ног – не более 50 шт.



Рис. 134. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов: Приспособление для фиксации плеча/лодыжки и/или Приспособление для фиксации головы/коленей и/или Цилиндрический вкладыш и/или Приспособление для позиционирования головы и/или Клинья и/или Вкладыши прямоугольные и/или Подставка для ног – не более 50 шт.

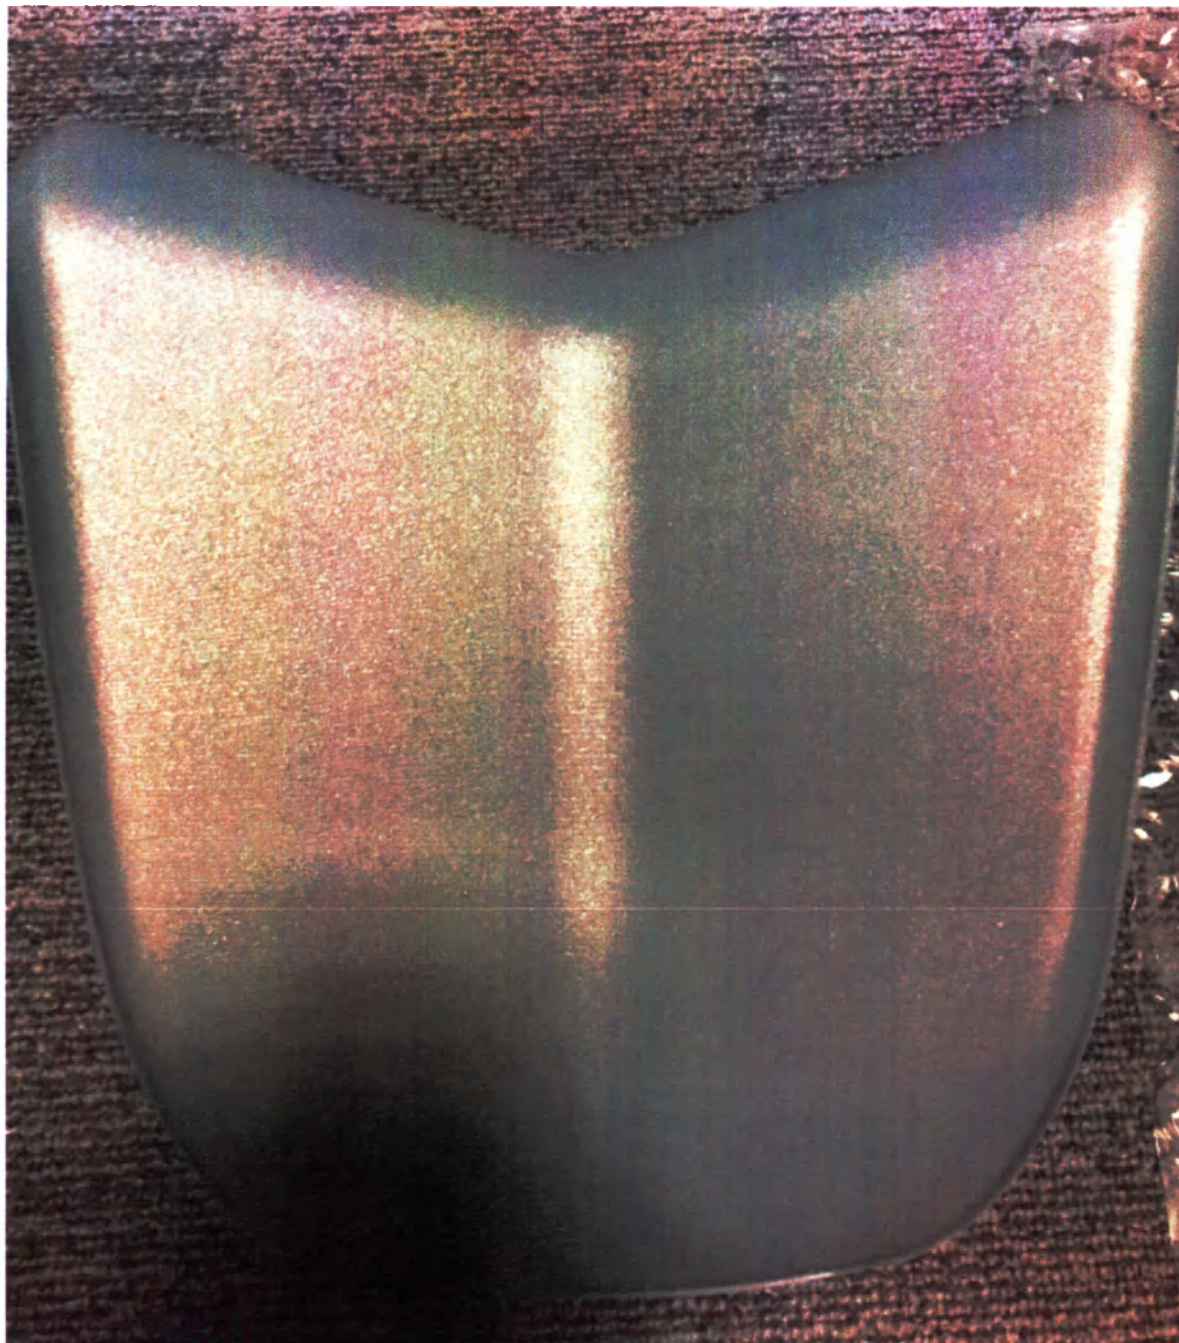

**Рис. 135. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов: Приспособление для фиксации плеча/лодыжки и/или
Приспособление для фиксации головы/коленей и/или Цилиндрический вкладыш и/или Приспособление для позиционирования
головы и/или Клинья и/или Вкладыши прямоугольные и/или Подставка для ног – не более 50 шт.**


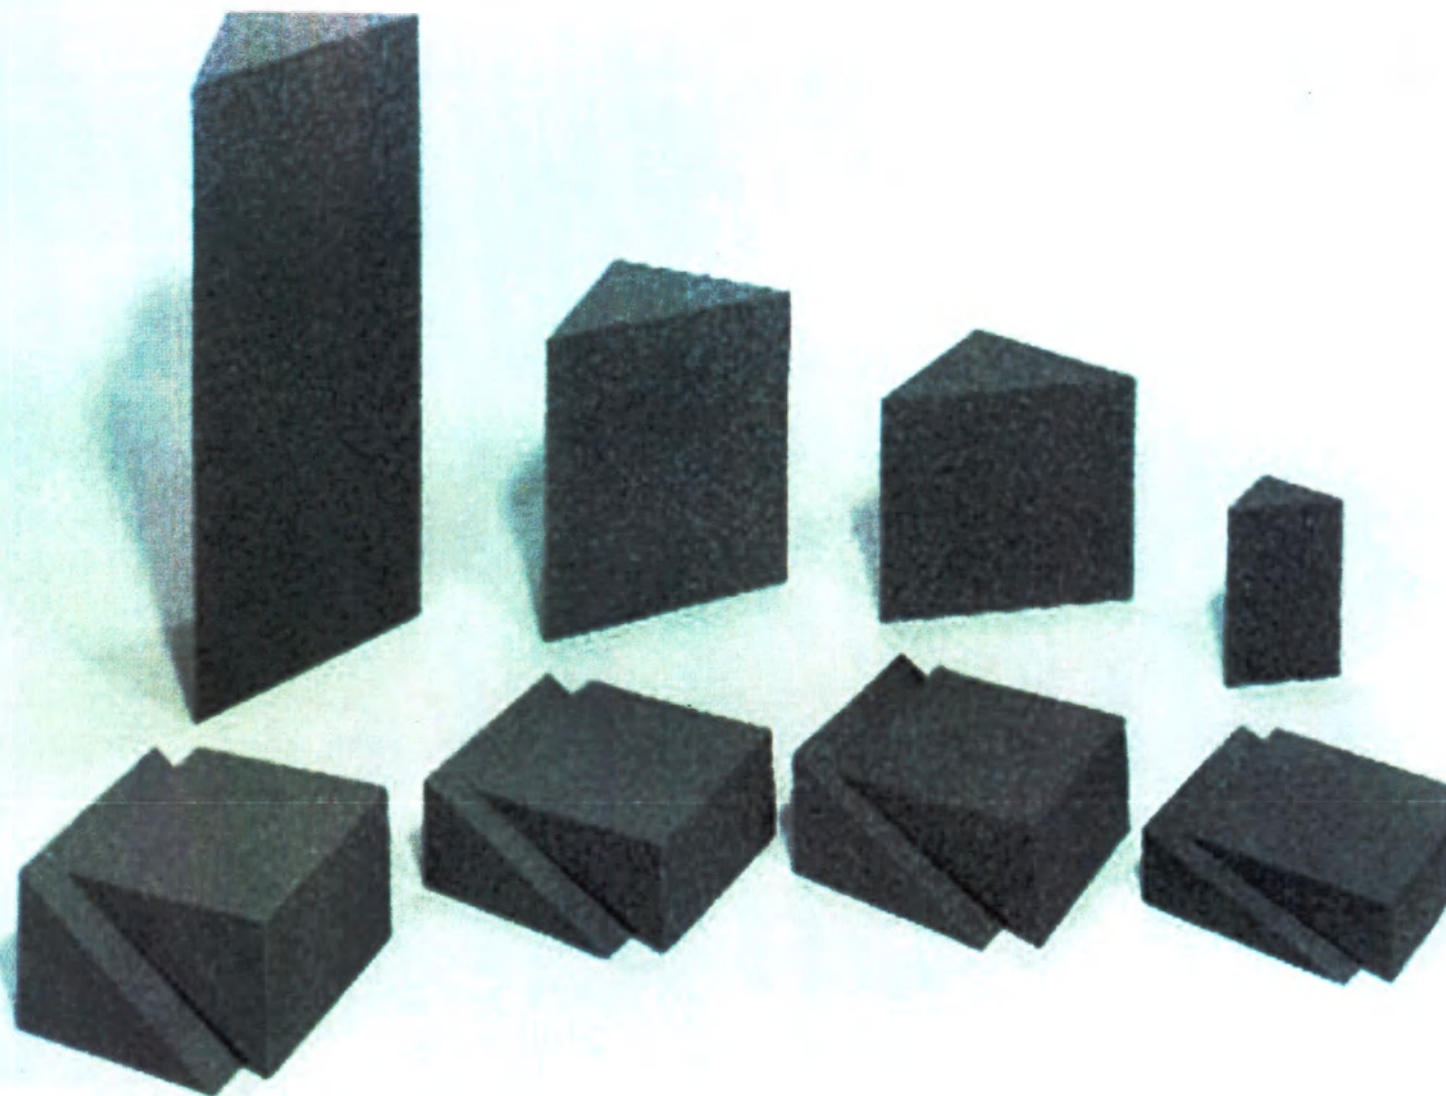


Рис. 136. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов: Приспособление для фиксации плеча/лодыжки и/или Приспособление для фиксации головы/коленей и/или Цилиндрический вкладыш и/или Приспособление для позиционирования головы и/или Клинья и/или Вкладыши прямоугольные и/или Подставка для ног – не более 50 шт.

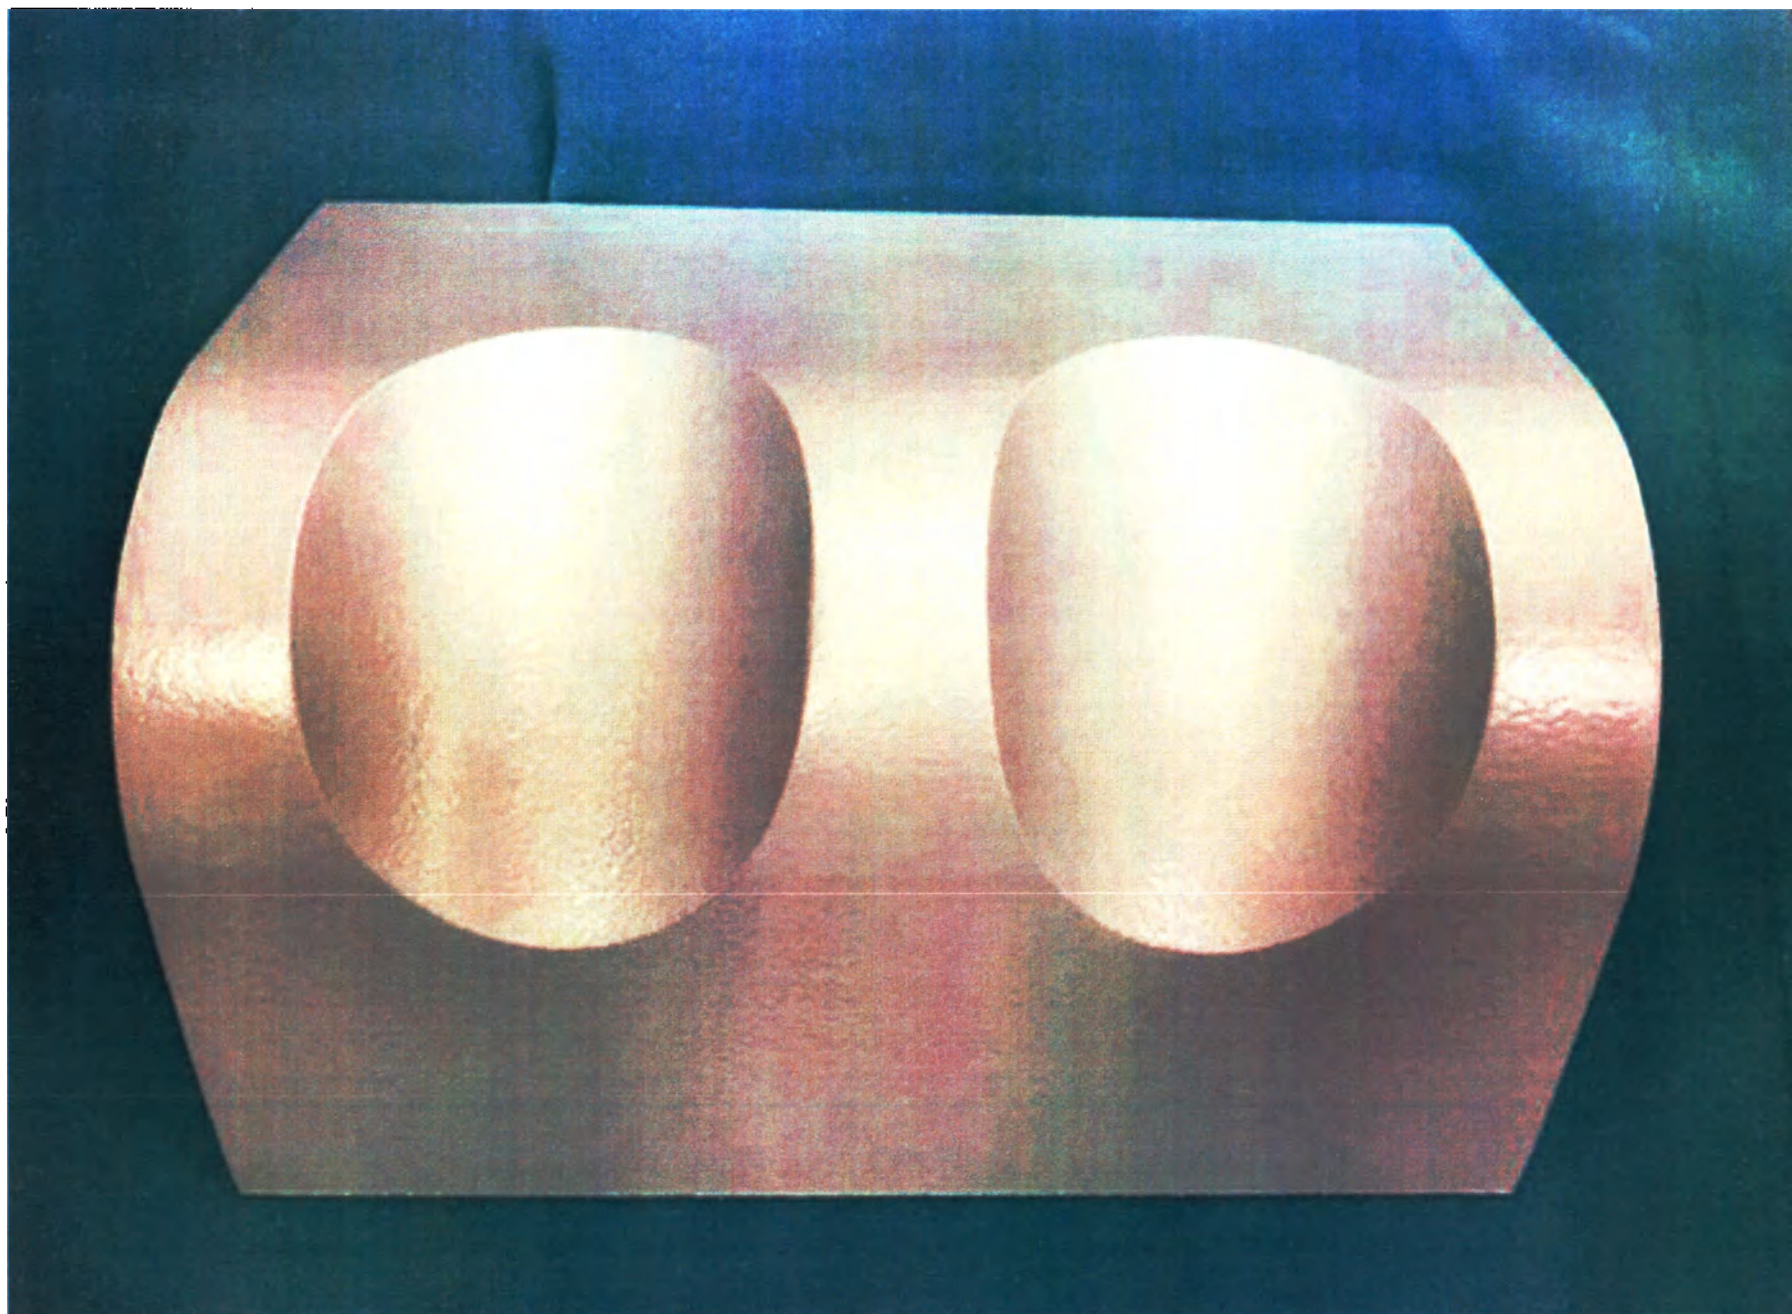

**Рис. 137. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов: Приспособление для фиксации плеча/лодыжки и/или
Приспособление для фиксации головы/коленей и/или Цилиндрический вкладыш и/или Приспособление для позиционирования
головы и/или Клинья и/или Вкладыши прямоугольные и/или Подставка для ног – не более 50 шт.**



Рис. 138. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов: Приспособление для фиксации плеча/лодыжки и/или Приспособление для фиксации головы/коленей и/или Цилиндрический вкладыш и/или Приспособление для позиционирования головы и/или Клинья и/или Вкладыши прямоугольные и/или Подставка для ног – не более 50 шт.

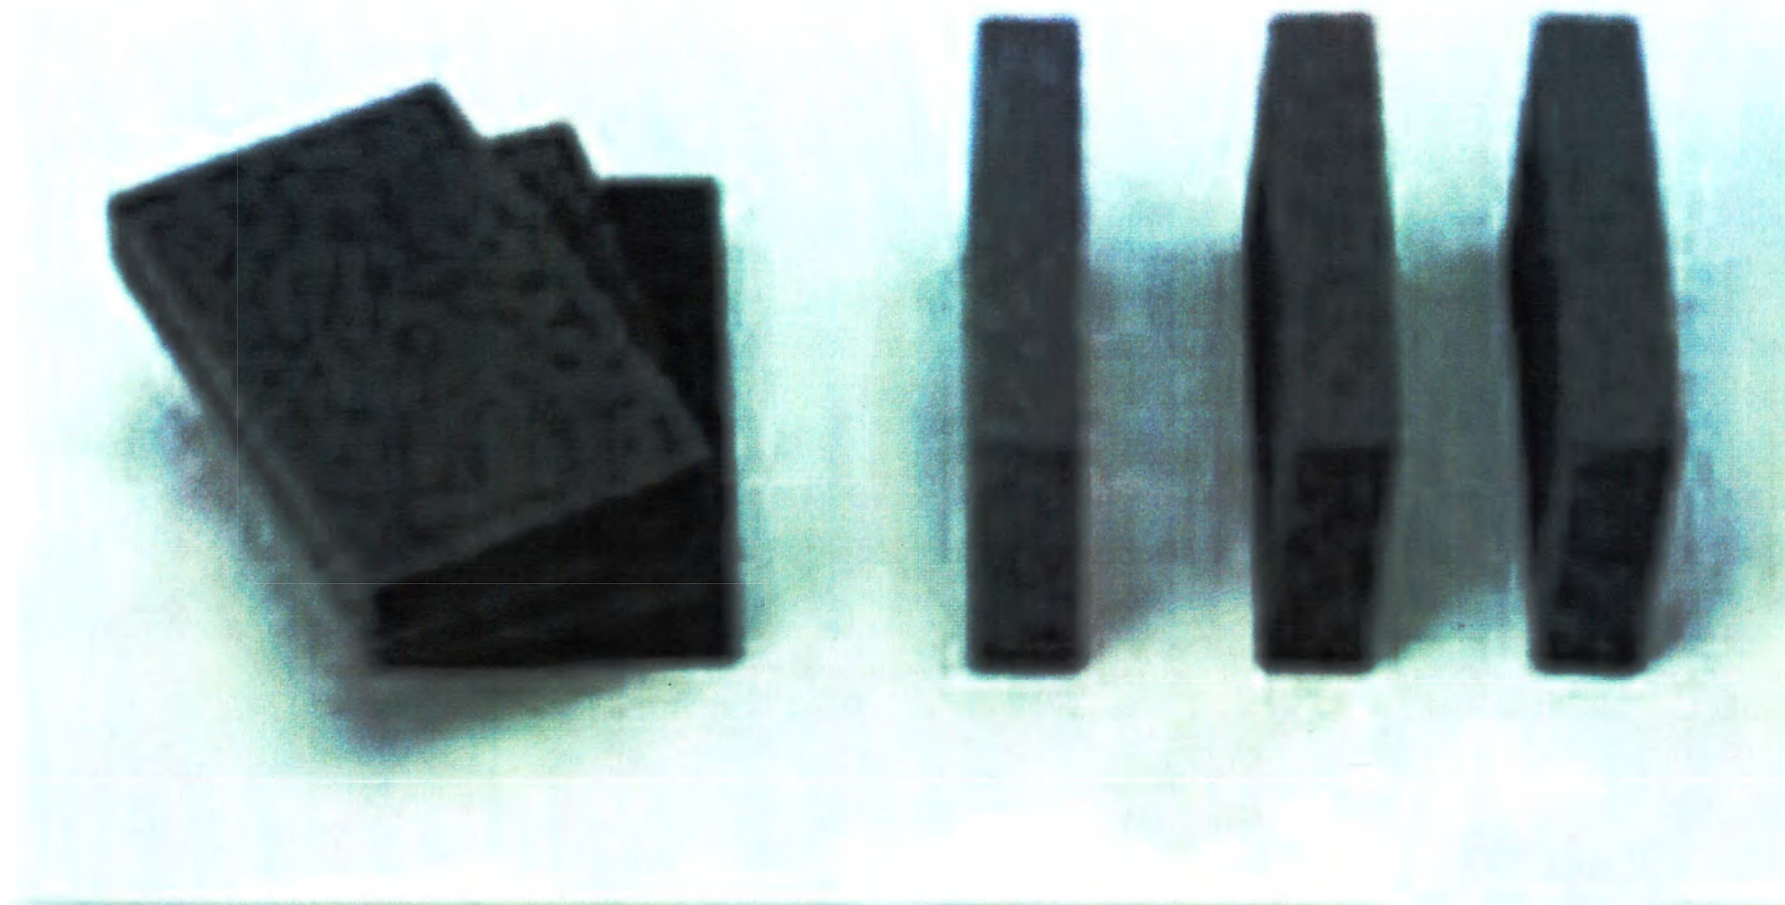


Рис. 139. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов: Приспособление для фиксации плеча/лодыжки и/или Приспособление для фиксации головы/коленей и/или Цилиндрический вкладыш и/или Приспособление для позиционирования головы и/или Клинья и/или Вкладыши прямоугольные и/или Подставка для ног – не более 50 шт.

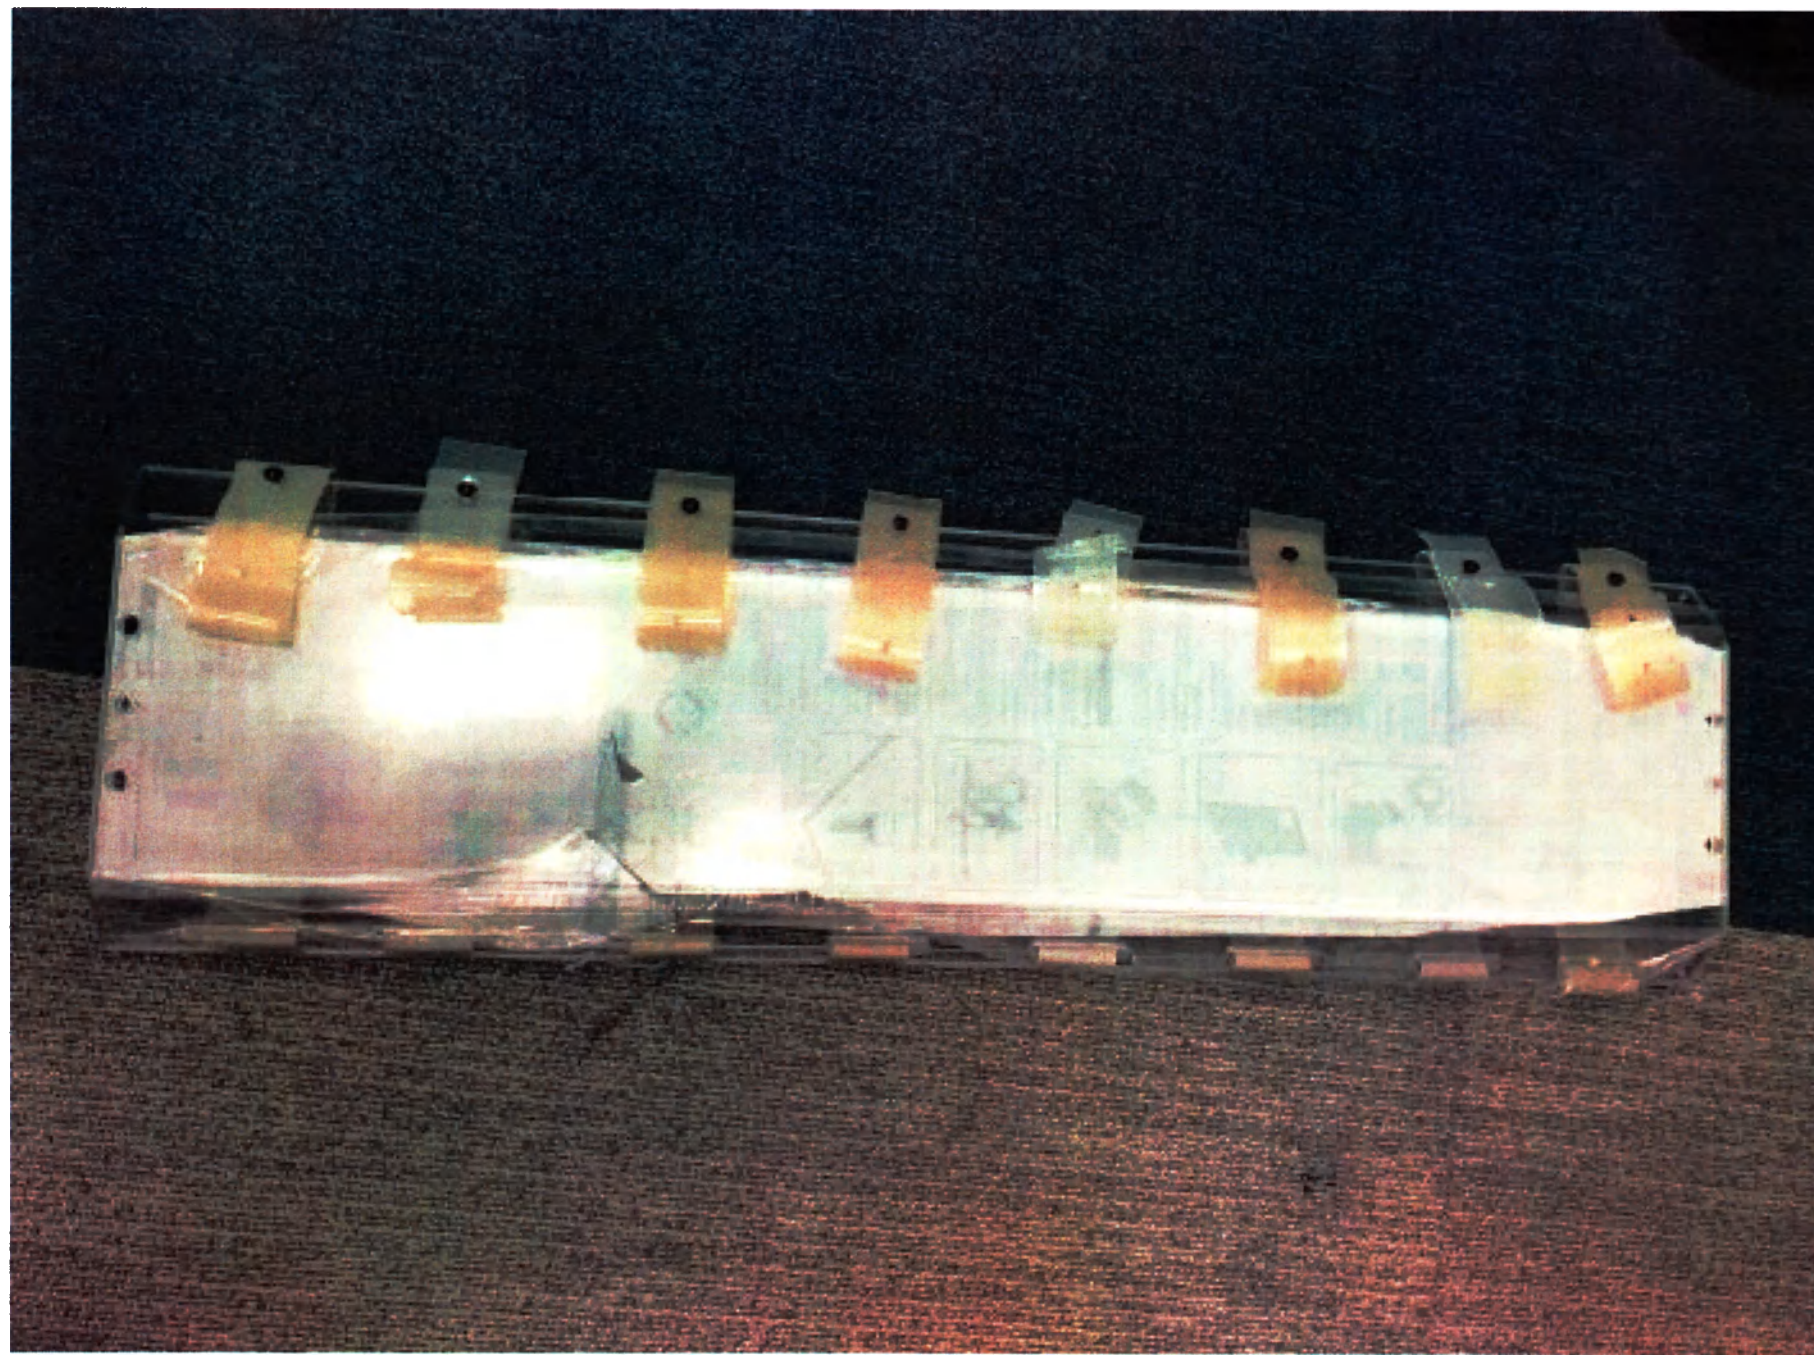


Рис. 140. Устройство для позиционирования младенцев и детей – не более 5 шт.



Рис. 141. Фиксаторы налобные – не более 5 шт.



Рис. 142. Фиксаторы подбородочные – не более 5 шт.



Рис. 143. Подкладки мягкие на стол для пациента VT1700V (GT1700V) или VT2000 (GT2000) или VT2000х (GT2000х) – не более 5 шт.



Рис. 144. Подкладки мягкие на стол для пациента VT1700V (GT1700V) или VT2000 (GT2000) или VT2000x (GT2000x) – не более 5 шт.

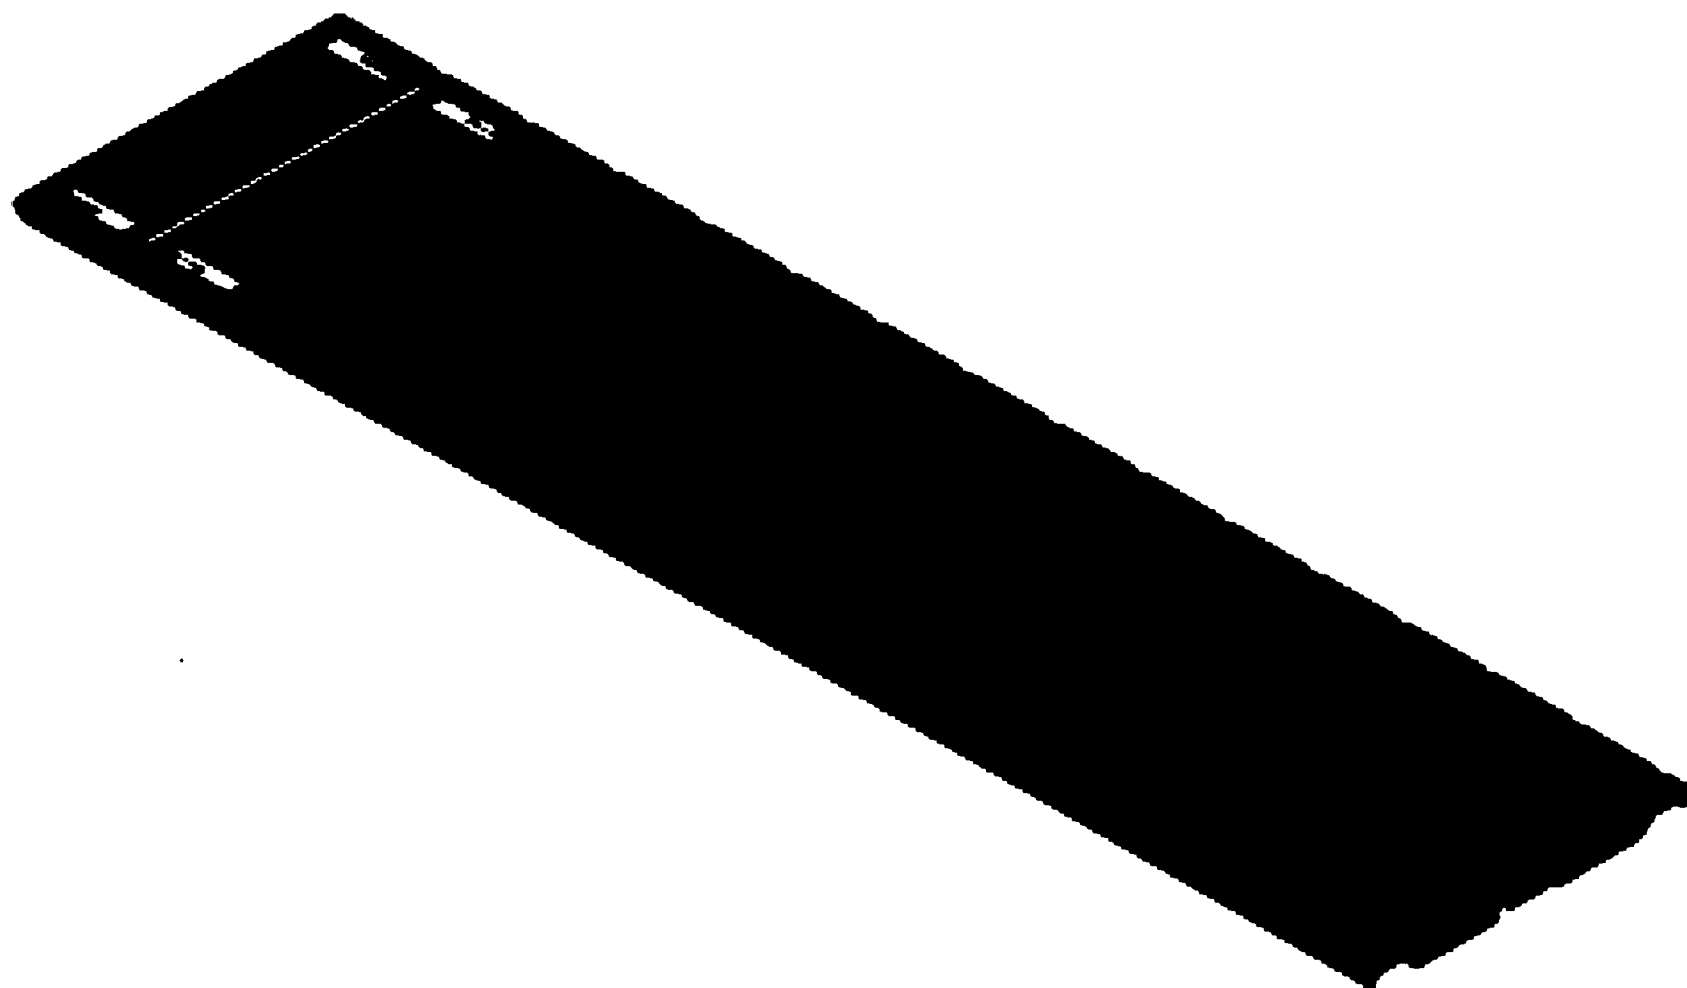


Рис. 145. Дека стола плоская DIACOR или CIVCO – не более 2 шт.



Рис. 146. Дека стола плоская DIACOR или CIVCO – не более 2 шт.

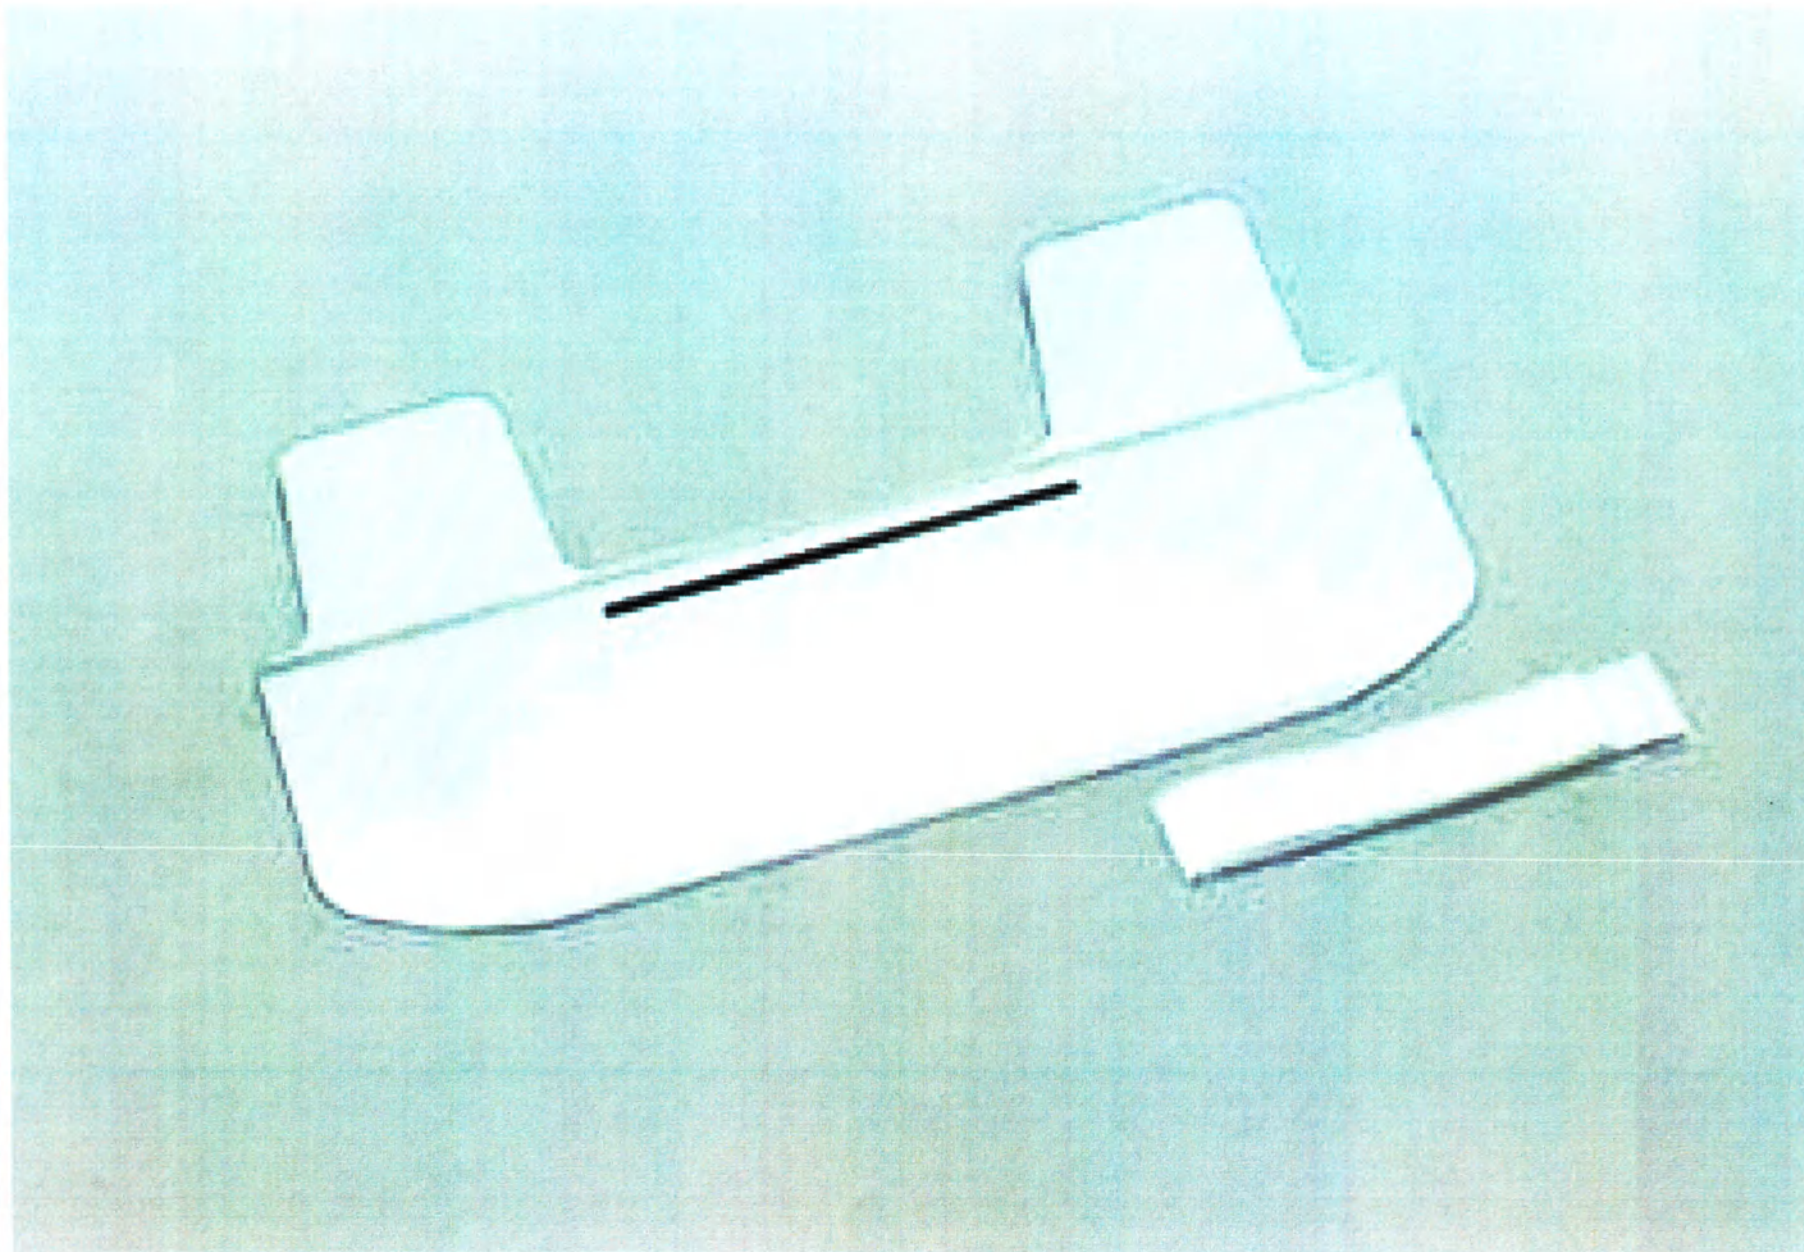


Рис. 147. Подлокотники для инъекций – не более 5 шт.



Рис. 148. Чехлы защитные для педалей стола для пациента VT1700V (GT1700V) / VT2000 (GT2000) / VT2000x (GT2000x) – не более 100 шт.

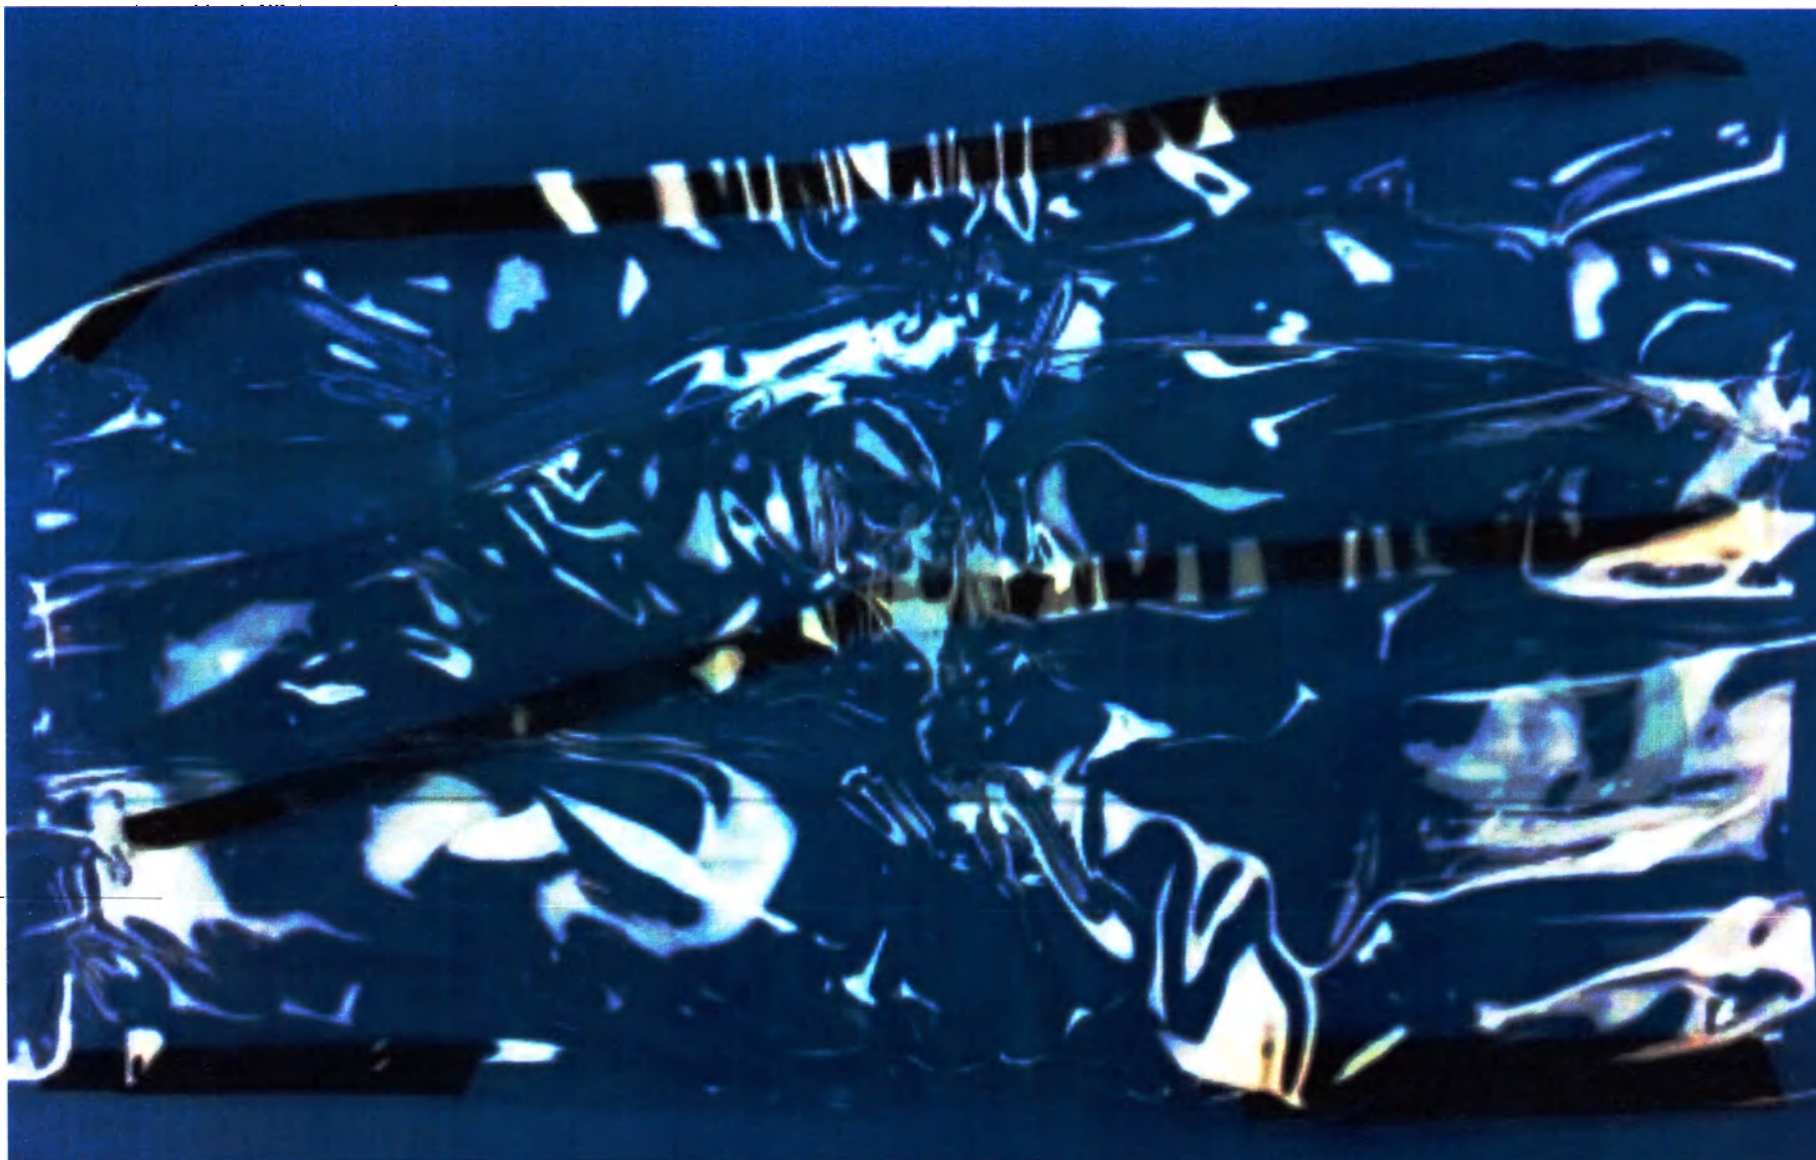


Рис. 149. Чехлы защитные для педалей стола для пациента VT1700V (GT1700V) / VT2000 (GT2000) / VT2000х (GT2000х) – не более 100 шт.

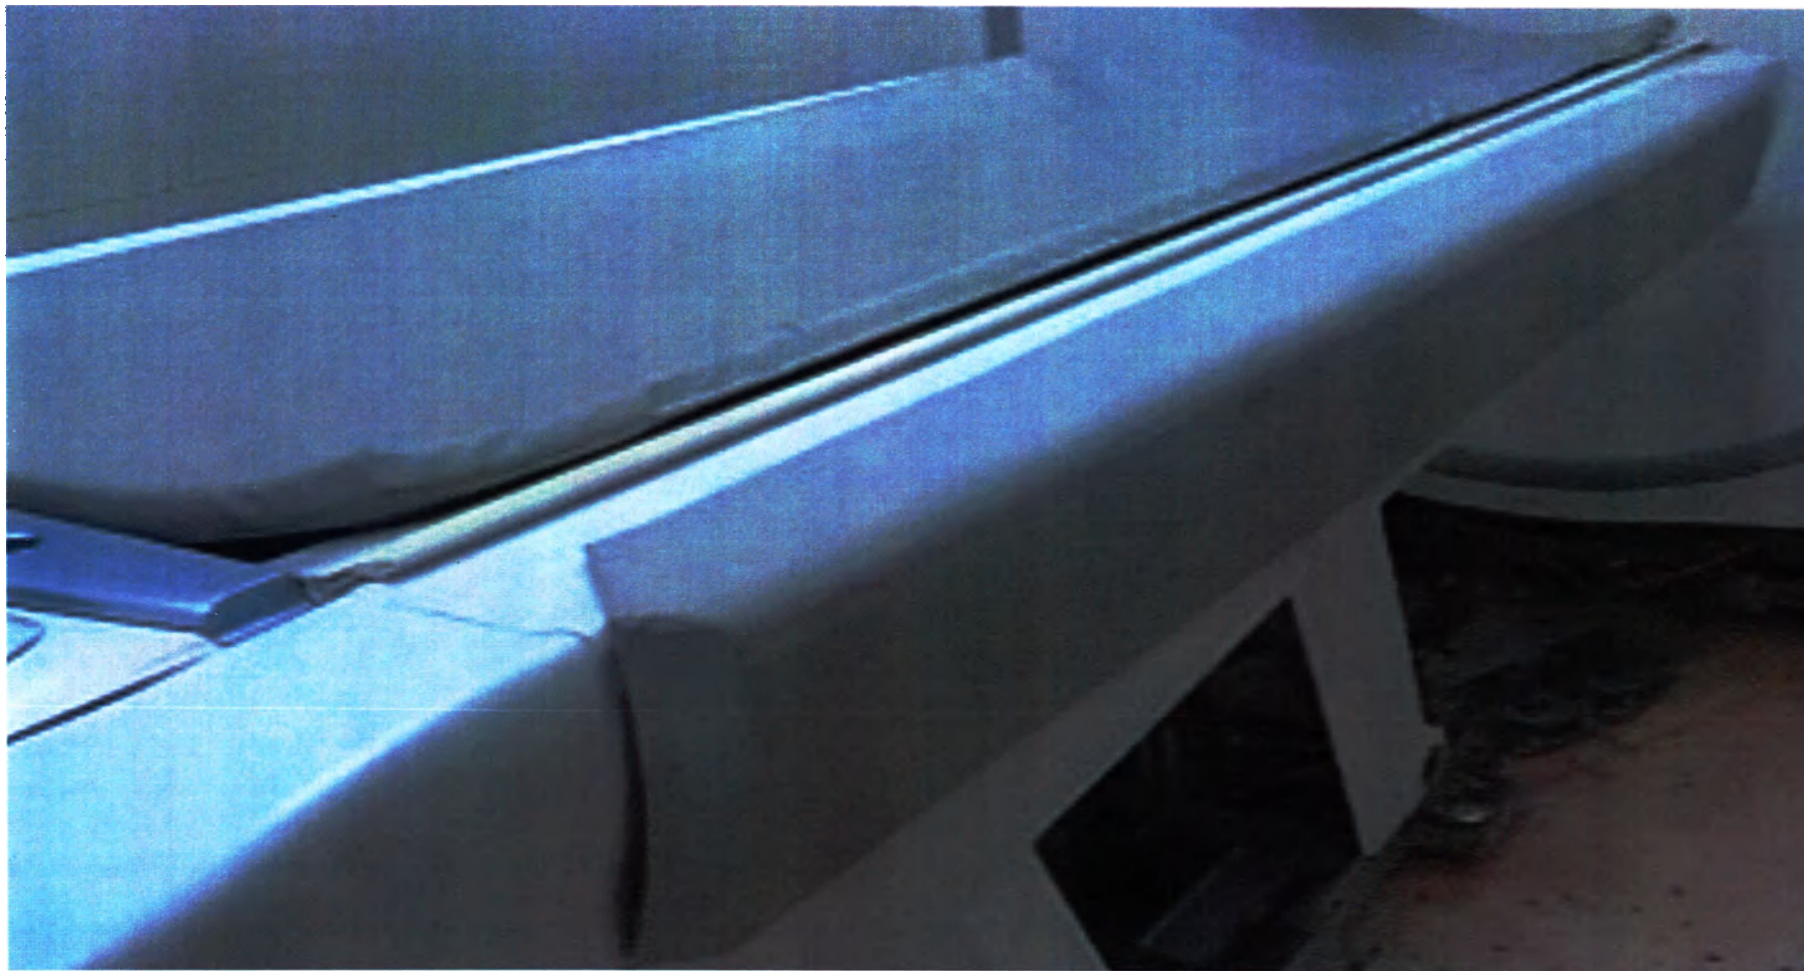


Рис. 150. Накладки защитные на стол для пациента VT1700V (GT1700V) / VT2000 (GT2000) / VT2000х (GT2000х) – не более 10 шт.



Рис. 151. Стерильные защитные накладки для интервенционных процедур – не более 50 шт.



Рис. 152. Стерильные защитные накладки для интервенционных процедур – не более 50 шт.



Рис. 153. Лоток для инструментов – не более 10 шт.

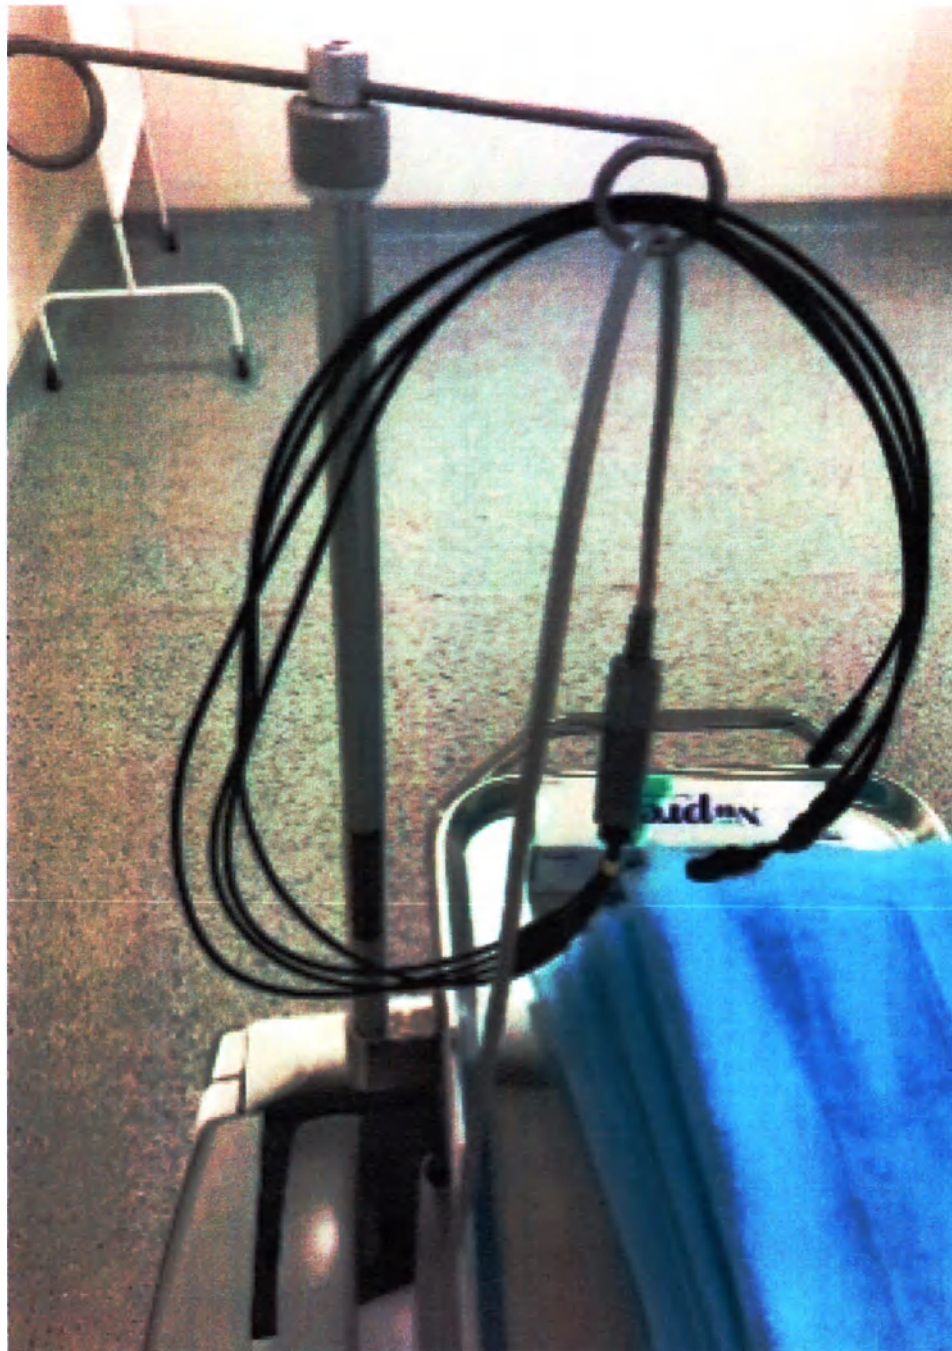


Рис. 154. Стойки инфузионные для стола для пациента VT1700V (GT1700V) / VT2000 (GT2000) / VT2000x (GT2000x) – не более 4 шт.

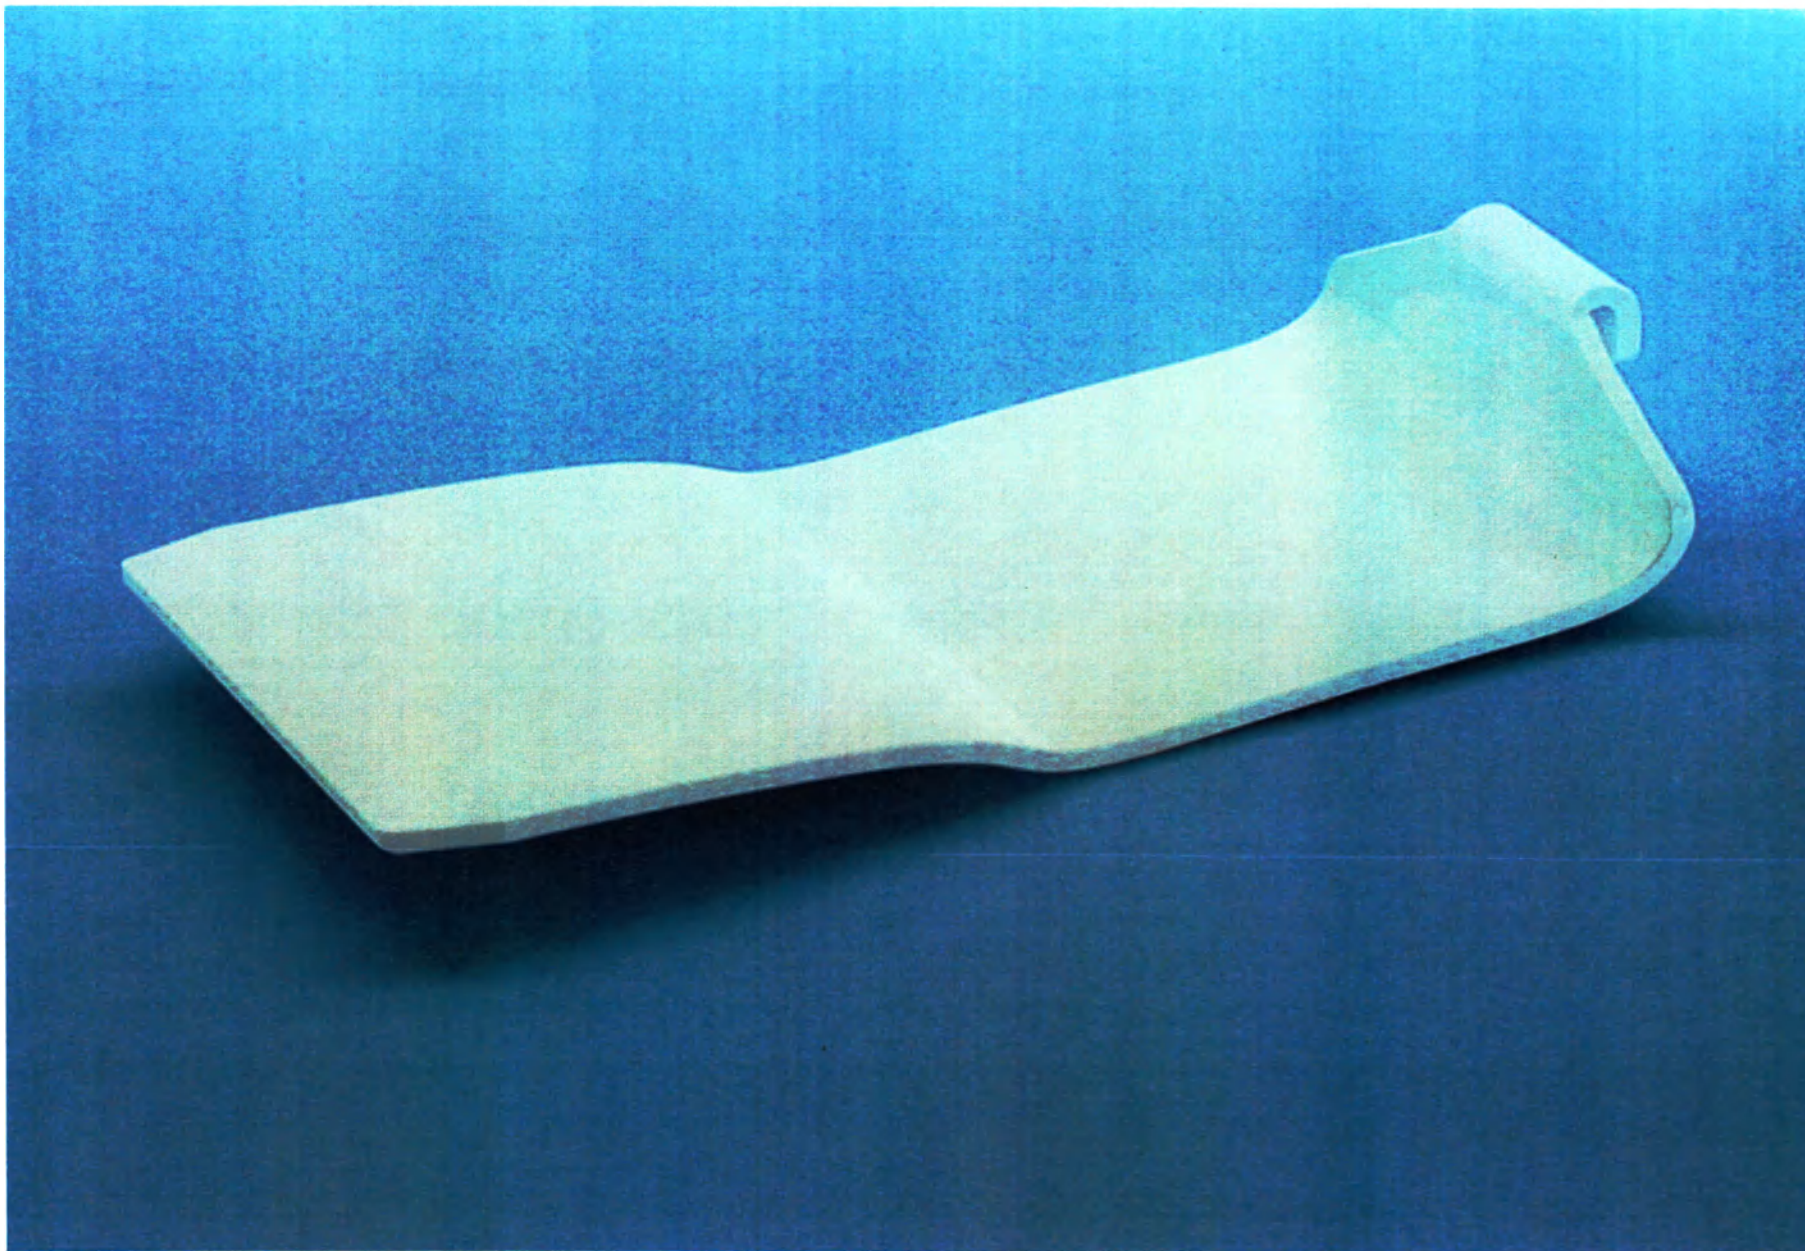


Рис. 155. Держатели для катетеров – не более 10 шт.



Рис. 156. Станции рабочие AW VolumeShare для работы с функциональными изображениями – не более 5 шт.



Рис. 157. Сервер для получения просмотра, обработки, архивирования и передачи медицинских изображений и данных AW Server – не более 4 шт.



Рис. 158. Сервер для получения просмотра, обработки, архивирования и передачи медицинских изображений и данных AW Server – не более 4 шт.

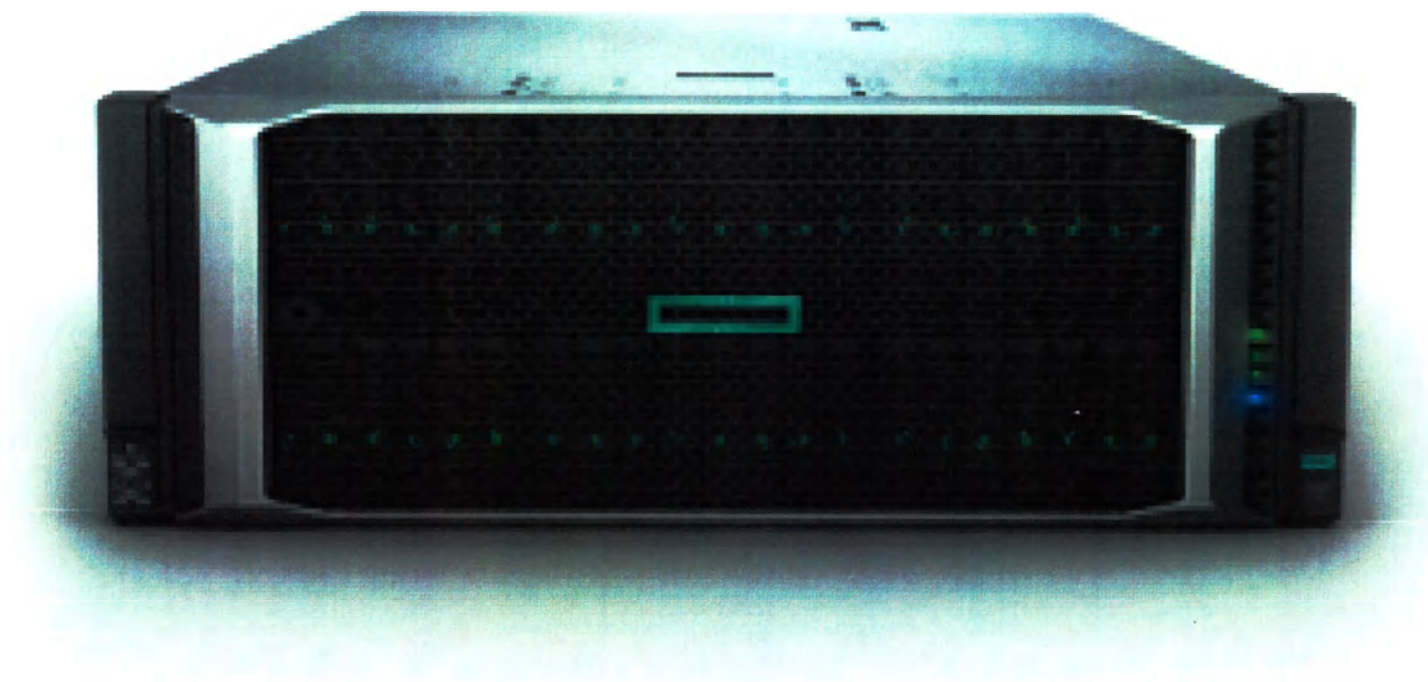


Рис. 159. Сервер для получения просмотра, обработки, архивирования и передачи медицинских изображений и данных AW Server – не более 4 шт.



Рис. 160. Сервер для получения просмотра, обработки, архивирования и передачи медицинских изображений и данных AW Server – не более 4 шт.

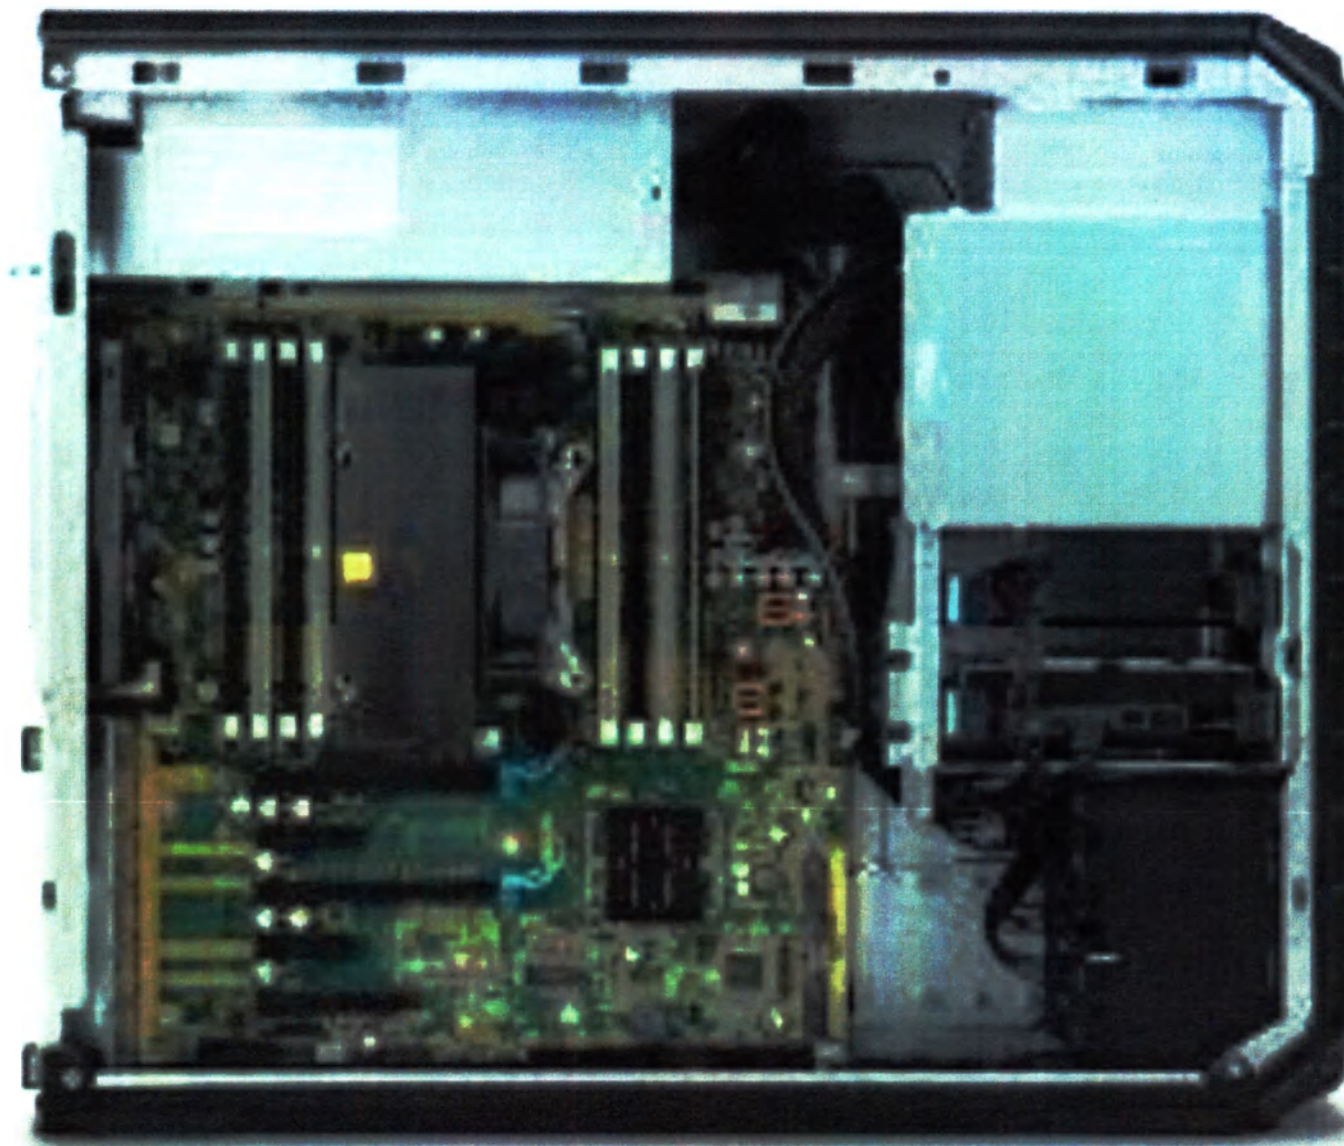


Рис. 161. Модули аппаратные основные станции рабочей AW VolumeShare для работы с функциональными изображениями – не более 10 шт.

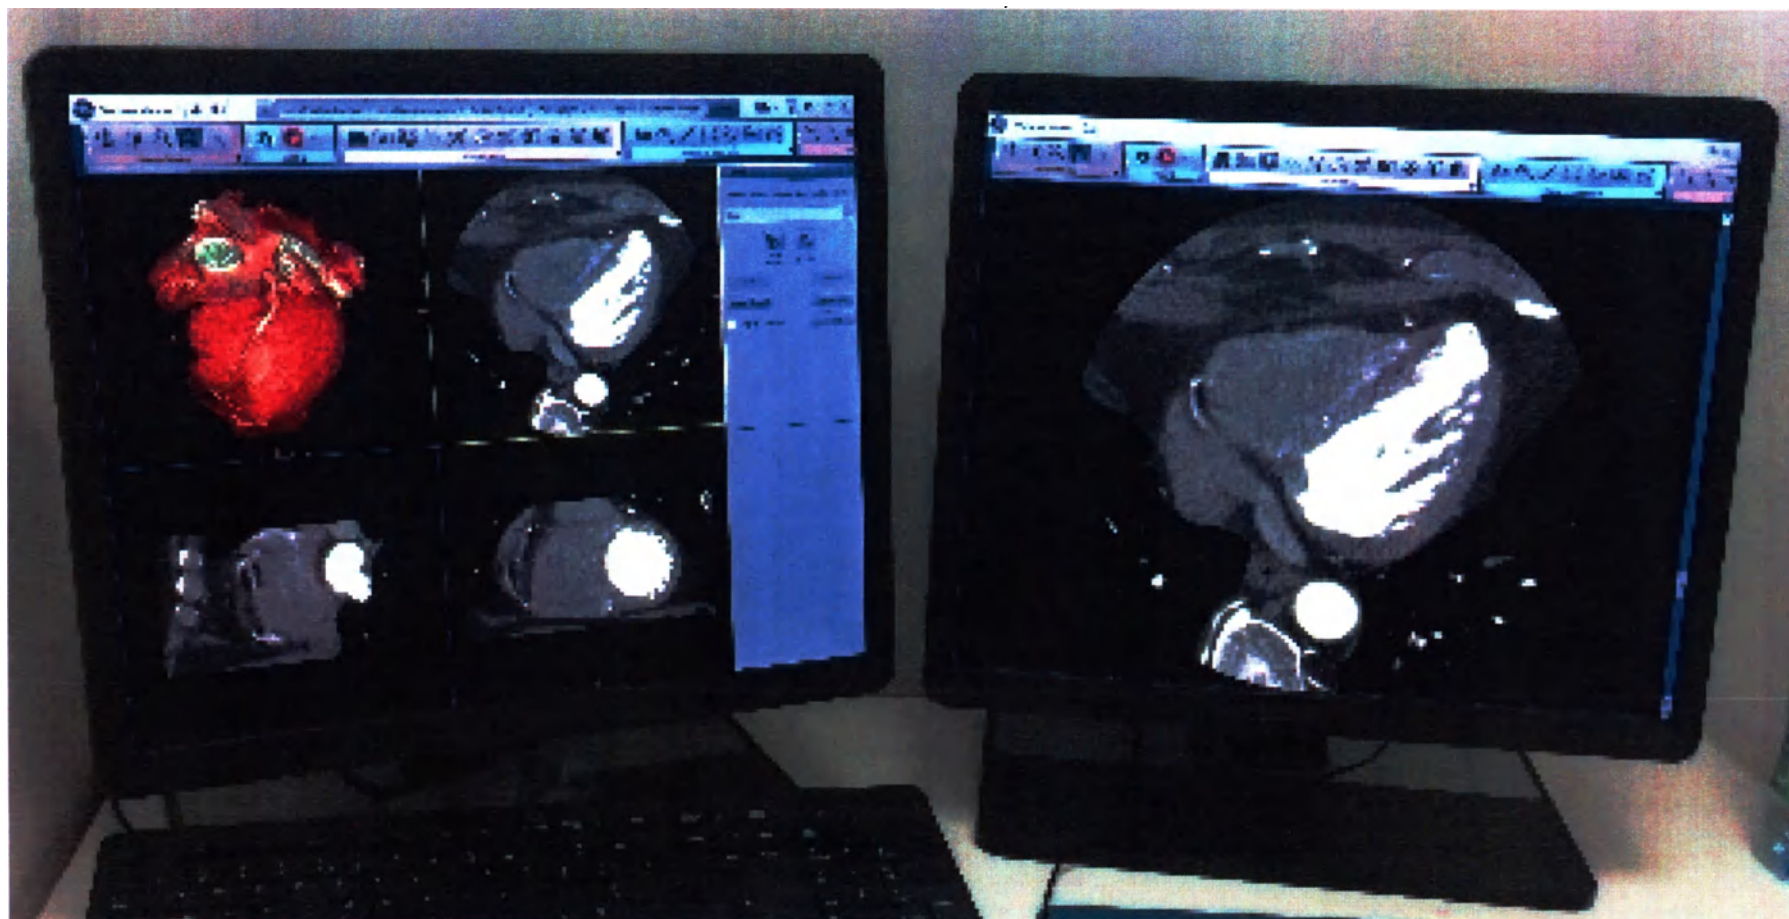


Рис. 162. Мониторы для станции рабочей AW VolumeShare для работы с функциональными изображениями – не более 10 шт.



Рис. 163. Кабели для станции рабочей AW VolumeShare для работы с функциональными изображениями или сервера для получения просмотра, обработки, архивирования и передачи медицинских изображений и данных AW Server – не более 10 шт.



Рис. 164. Приспособления для установки сервера для получения просмотра, обработки, архивирования и передачи медицинских изображений и данных AW Server – не более 10 шт.



Рис. 165. Приспособления для установки сервера для получения просмотра, обработки, архивирования и передачи медицинских изображений и данных AW Server – не более 10 шт.



Рис. 166. Серверные стойки – не более 10 шт.



Рис. 167. Функциональные КТ клавиатуры – не более 5 шт.

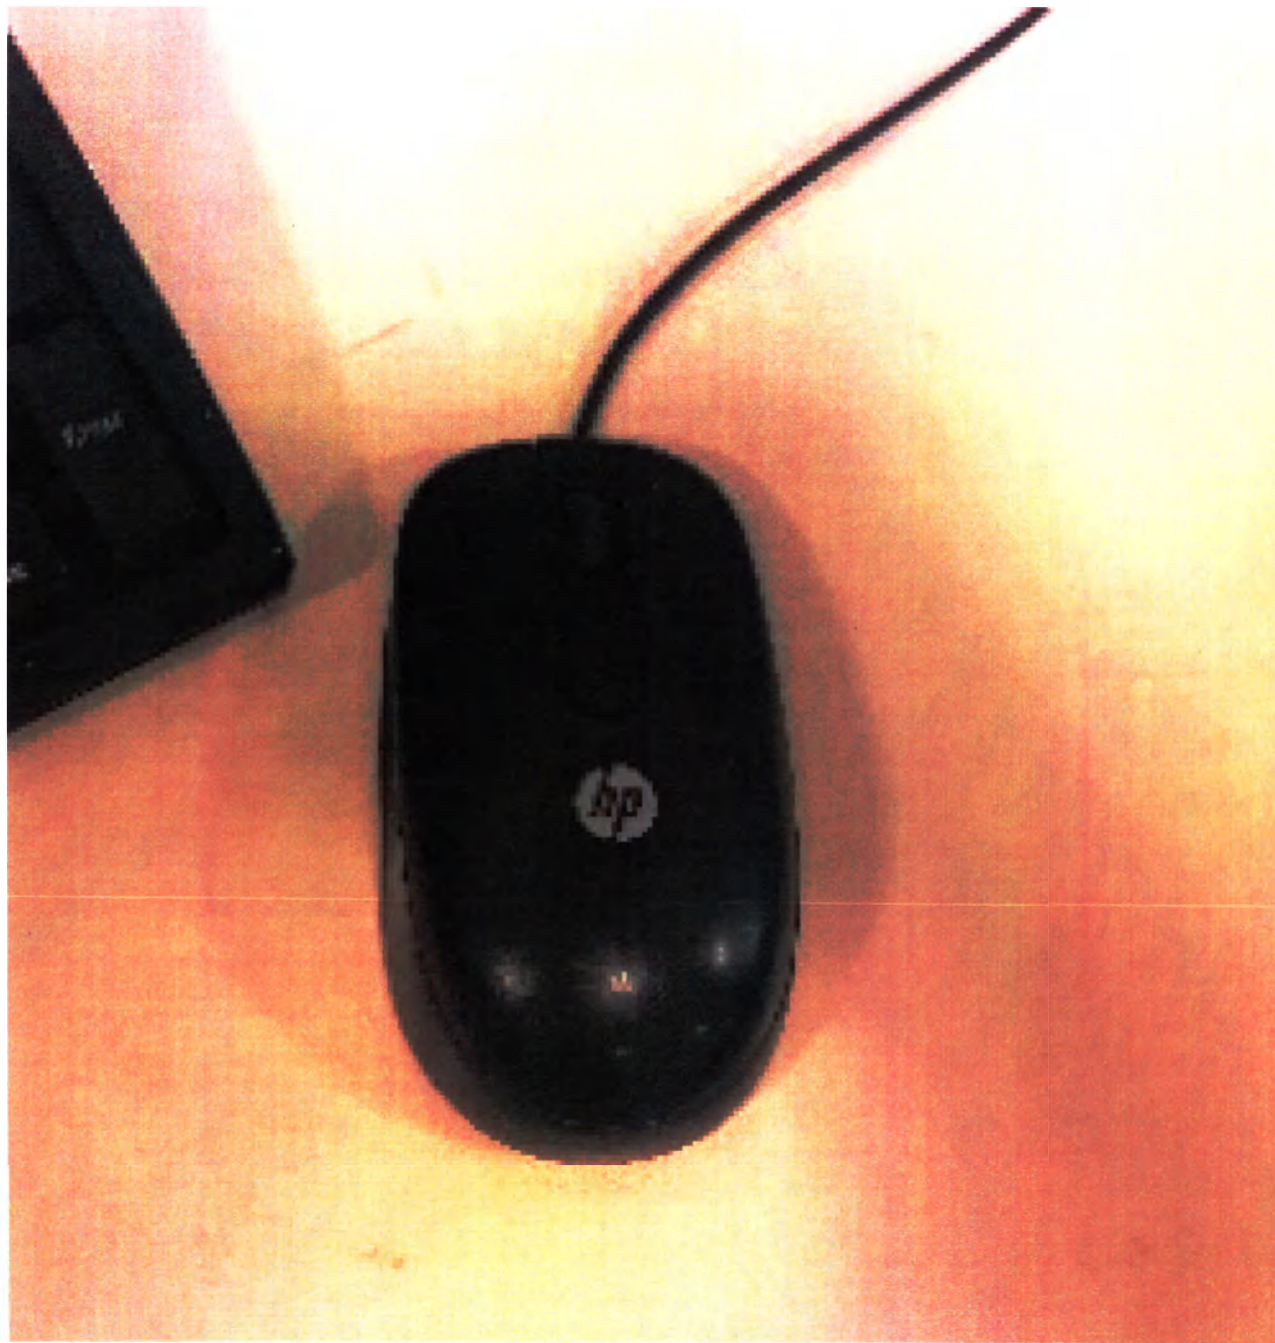


Рис. 168. Манипуляторы типа «мышь» – не более 3 шт.

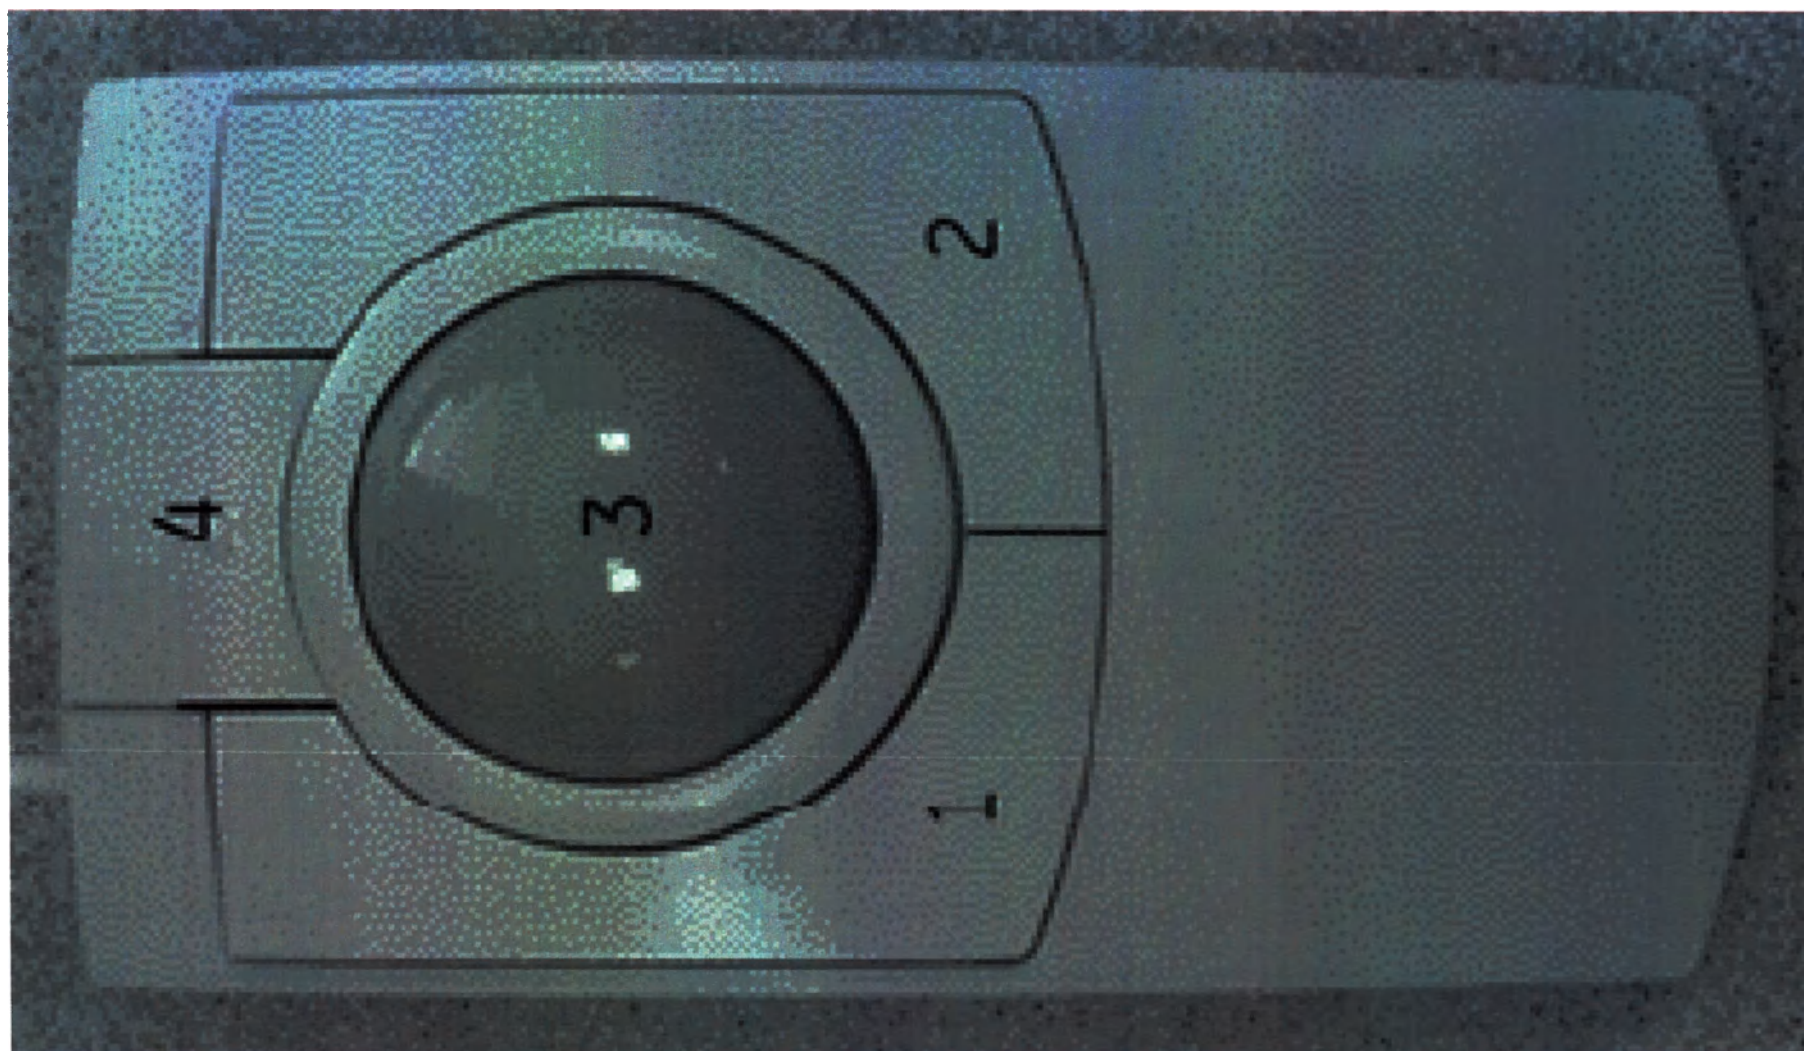


Рис. 169. Манипуляторы шаровые – не более 5 шт.



Рис. 170. Рабочий стол оператора – не более 2 шт.



Рис. 171. Кресла оператора – не более 2 шт.



Рис. 172. Внешний DVD привод для записи результатов исследования – не более 5 шт.



Рис. 173. Сетевой коммутатор – не более 20 шт.

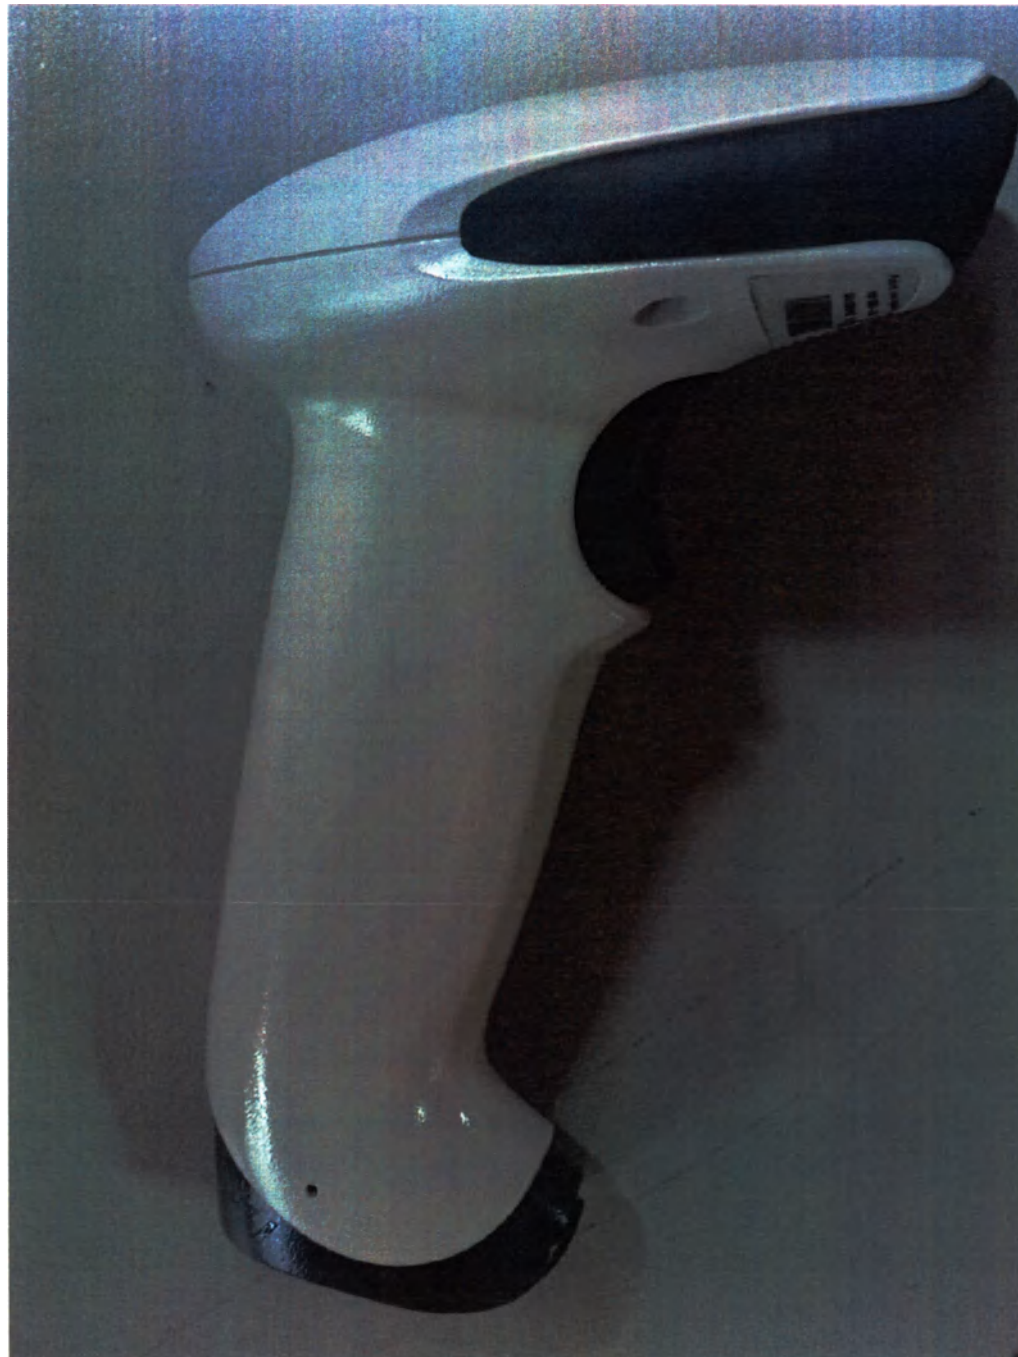


Рис. 174. Штрих-код сканеры Honeywell – не более 5 шт.



Рис. 175. Устройства запоминающие: внешний жесткий диск объемом не менее 2 ТБ и/или USB-флеш-накопитель объемом не менее 64 ГБ – не более 10 шт.



Рис. 176. Устройства запоминающие: внешний жесткий диск объемом не менее 2 ТБ и/или USB-флеш-накопитель объемом не менее 64 ГБ – не более 10 шт.



Рис. 177. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ – не более 100 шт.

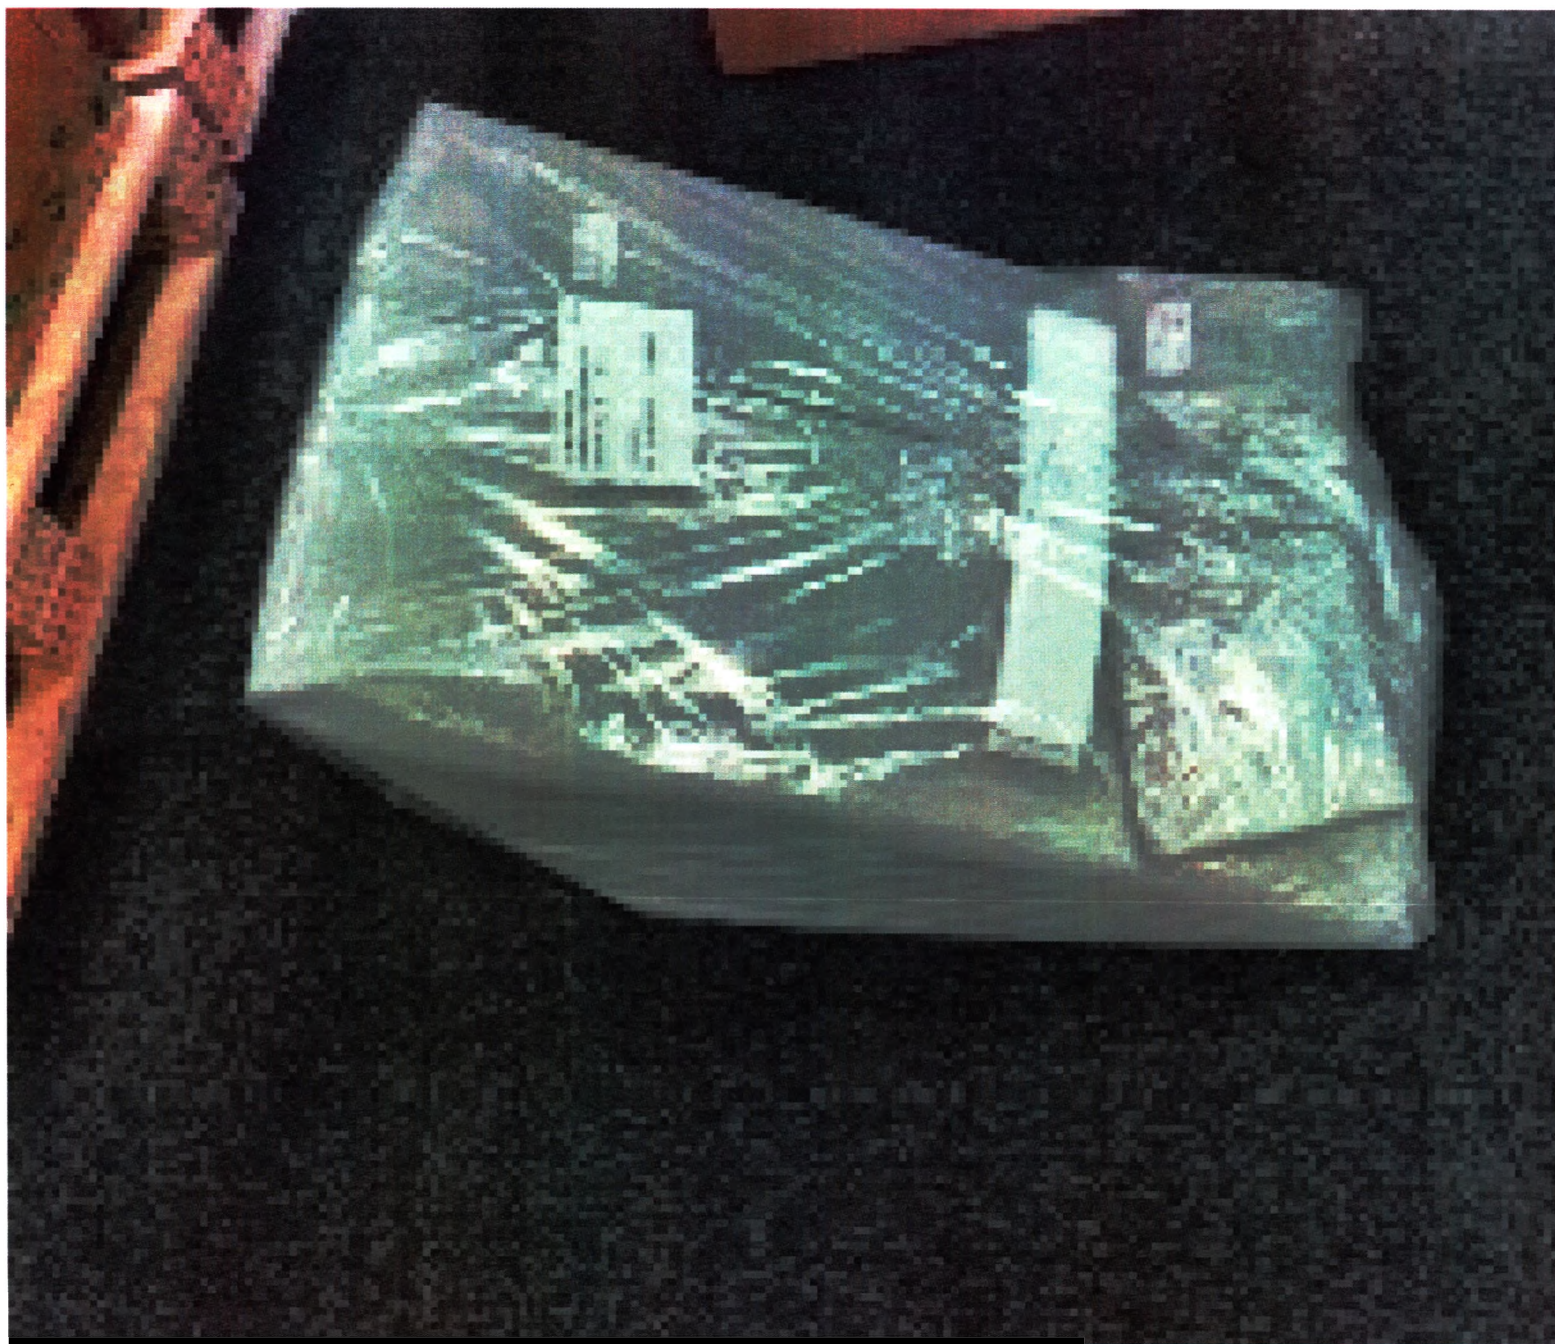


Рис. 178. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ – не более 100 шт.



Рис. 179. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ – не более 100 шт.



Рис. 180. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ – не более 100 шт.



Рис. 181. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки КТ – не более 100 шт.

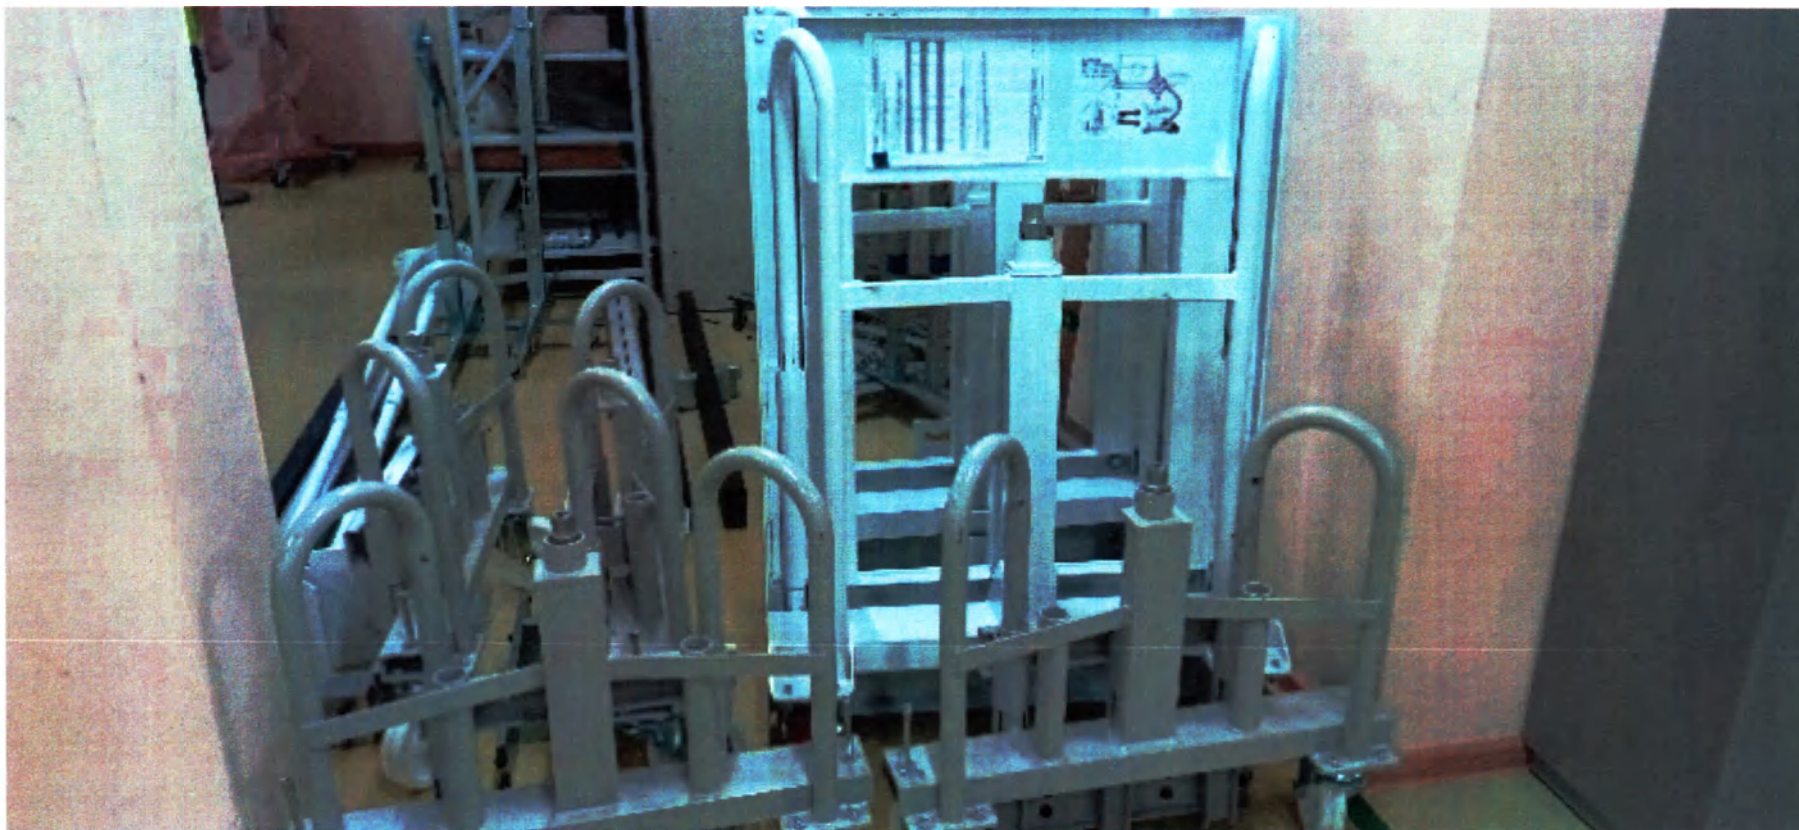


Рис. 182. Устройства транспортировочные для стола пациента – не более 5 шт.

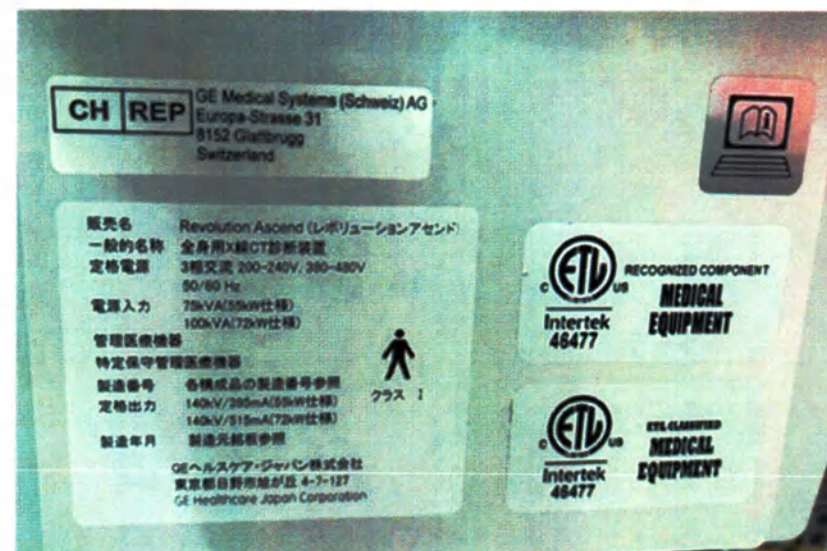


Рис. 183. Наклейки томографа предупреждающие и/или идентифицирующие – не более 200 шт.



Рис. 184. Наклейки томографа предупреждающие и/или идентифицирующие – не более 200 шт.

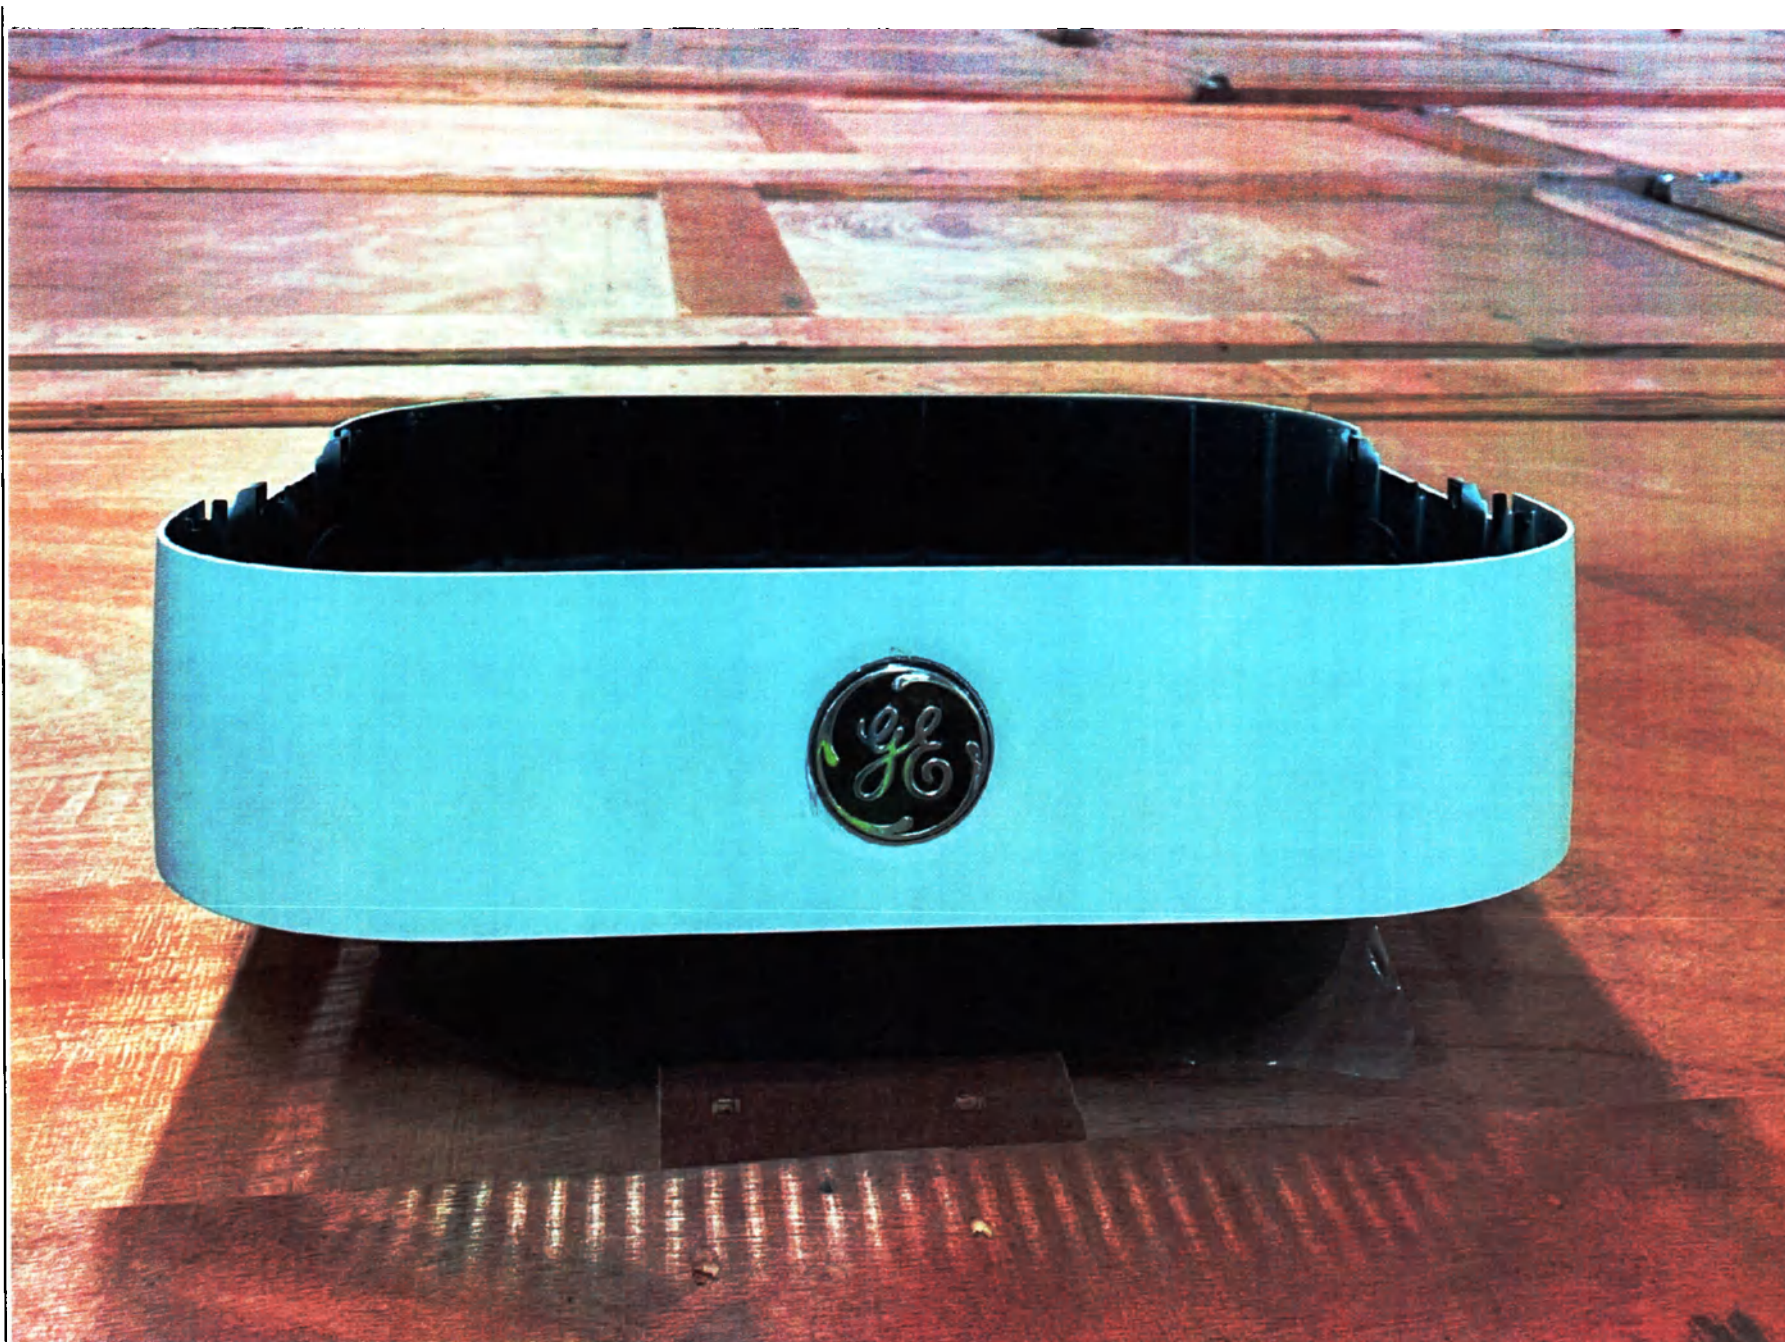


Рис. 185. Камера глубины Xstream для автоматического позиционирования пациента – не более 5 шт.



Рис. 186. Крепление для камеры глубины Xtream для автоматического позиционирования пациента – не более 5 шт.

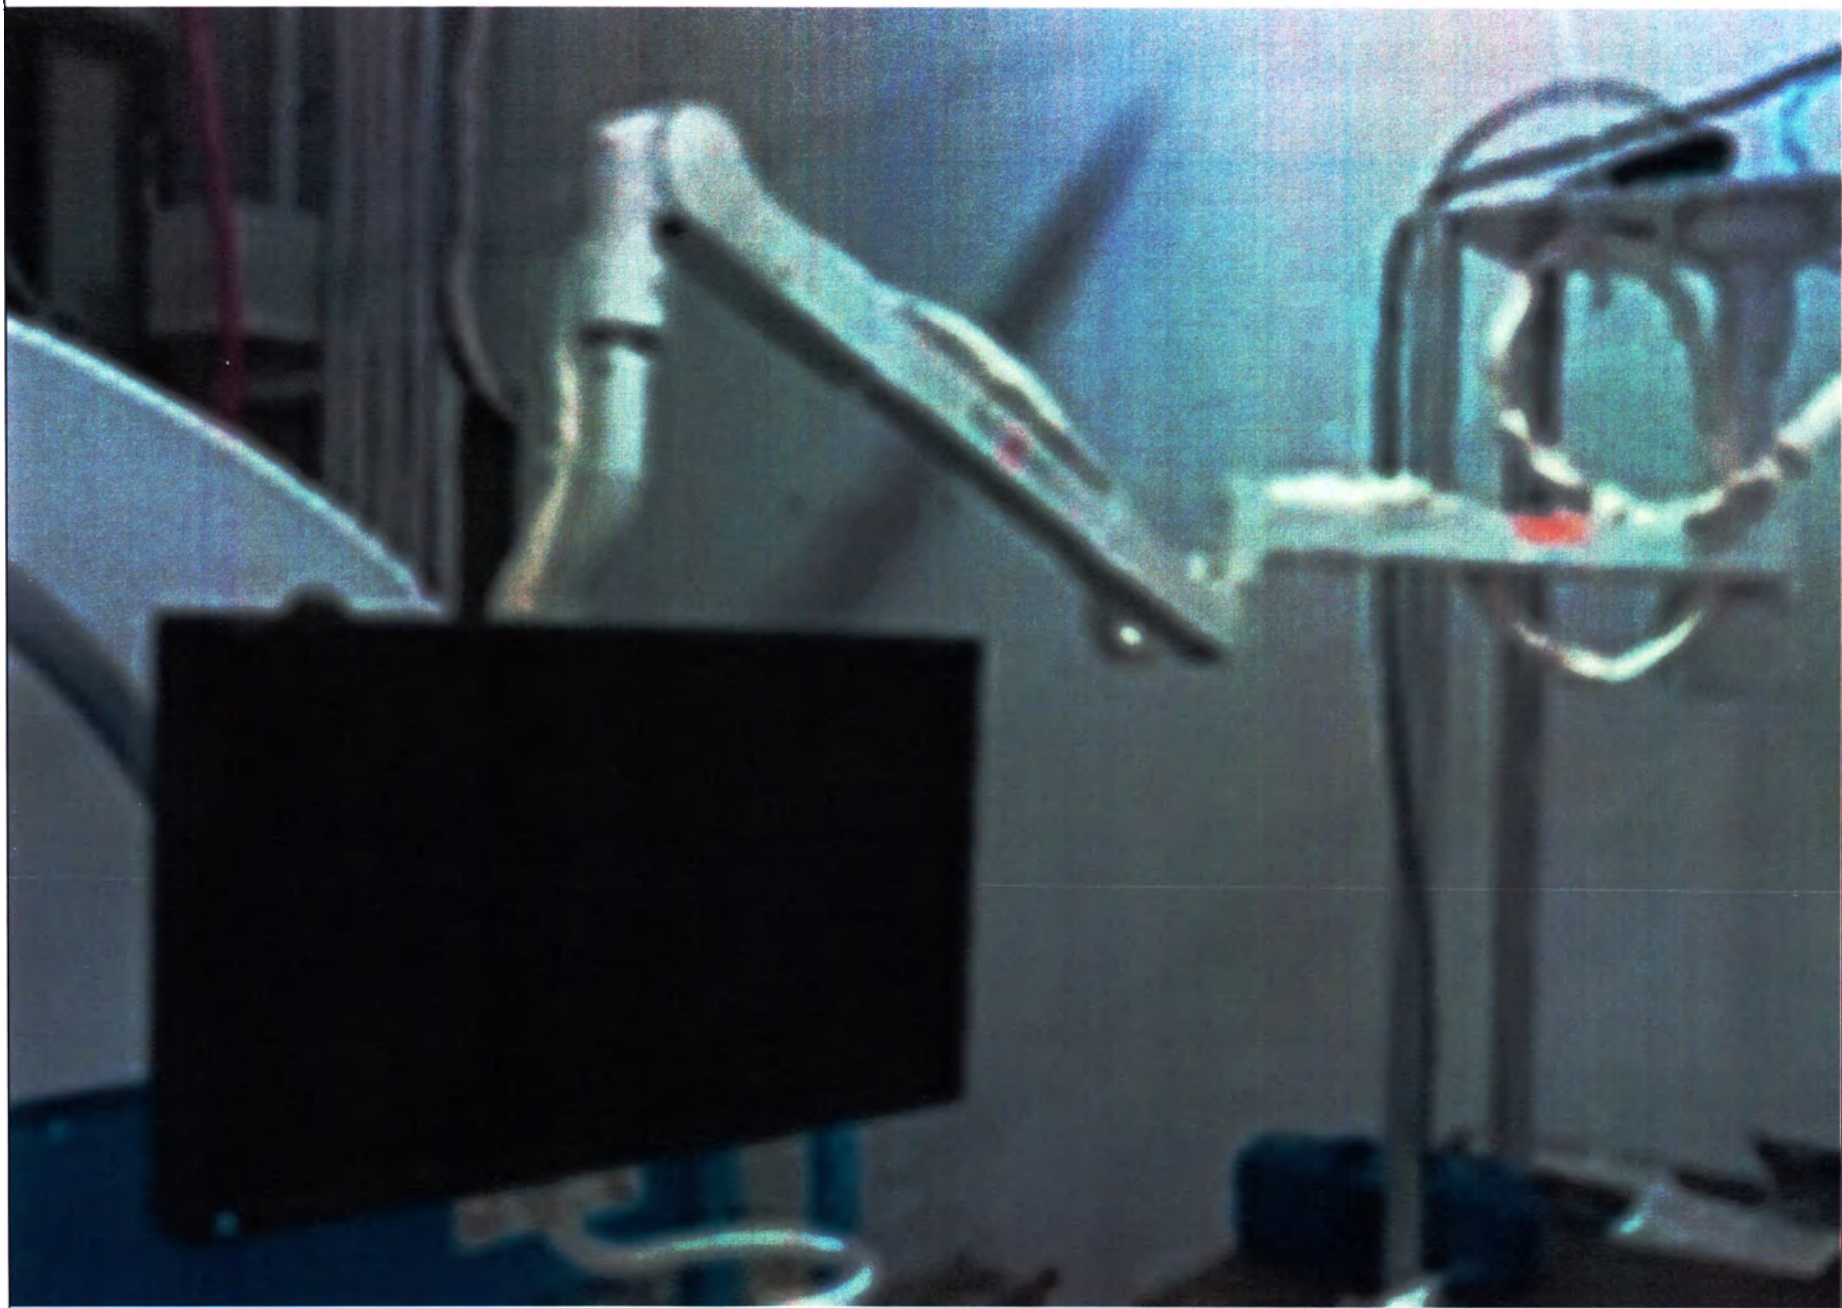


Рис. 187. Устройство SmartStep для интервенционных процедур, в составе: Ручной пульт управления и/или Педаль и/или Устройство крепления монитора (не более 6 шт.) и/или ЖК-монитор – не более 5 шт.



Рис. 188. Устройство SmartStep для интервенционных процедур, в составе: Ручной пульт управления и/или Педаль и/или Устройство крепления монитора (не более 6 шт.) и/или ЖК-монитор – не более 5 шт.



Рис. 189. Устройство SmartStep для интервенционных процедур, в составе: Ручной пульт управления и/или Педаль и/или Устройство крепления монитора (не более 6 шт.) и/или ЖК-монитор – не более 5 шт.

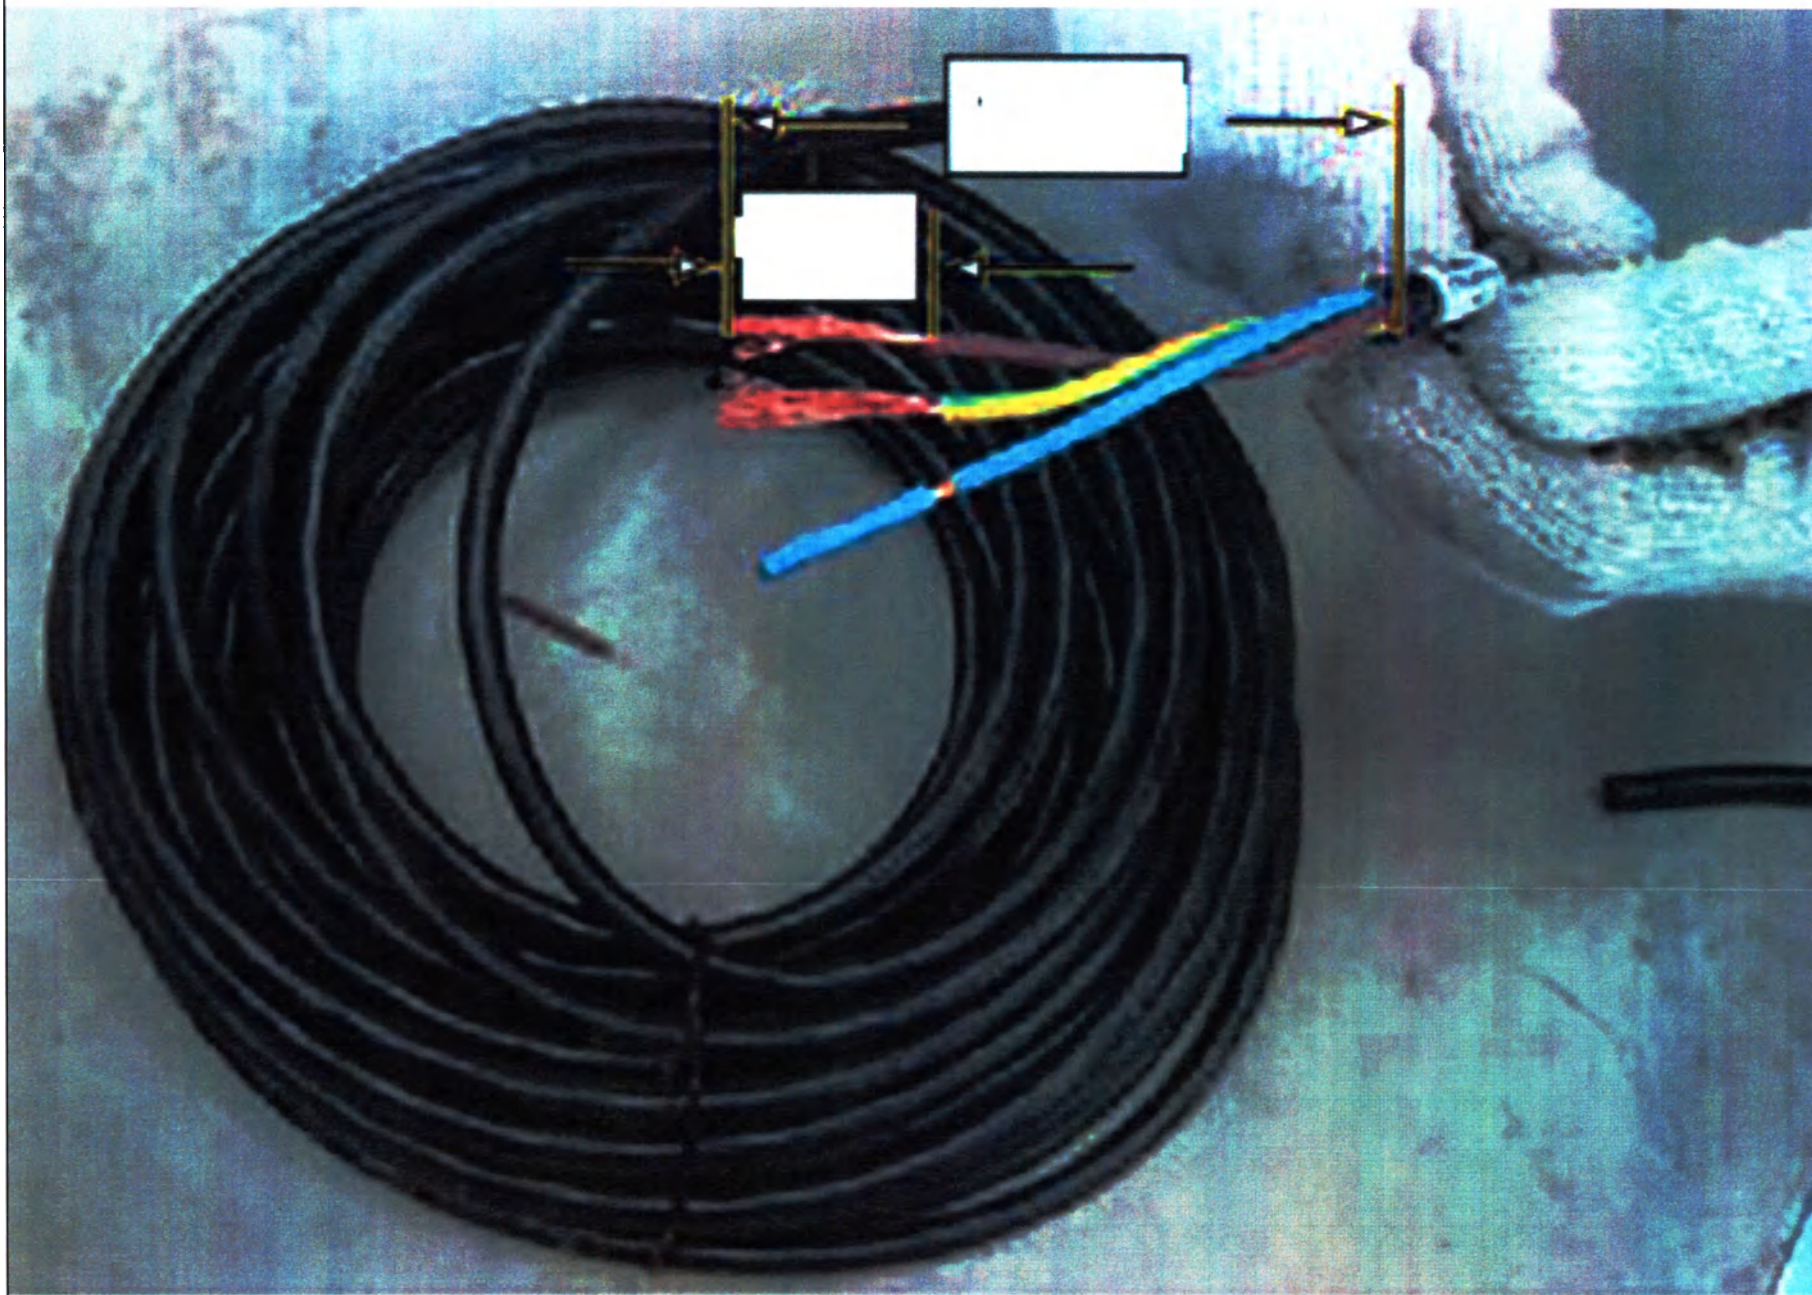


Рис. 190. Кабели для интервенционного модуля – не более 10 шт.

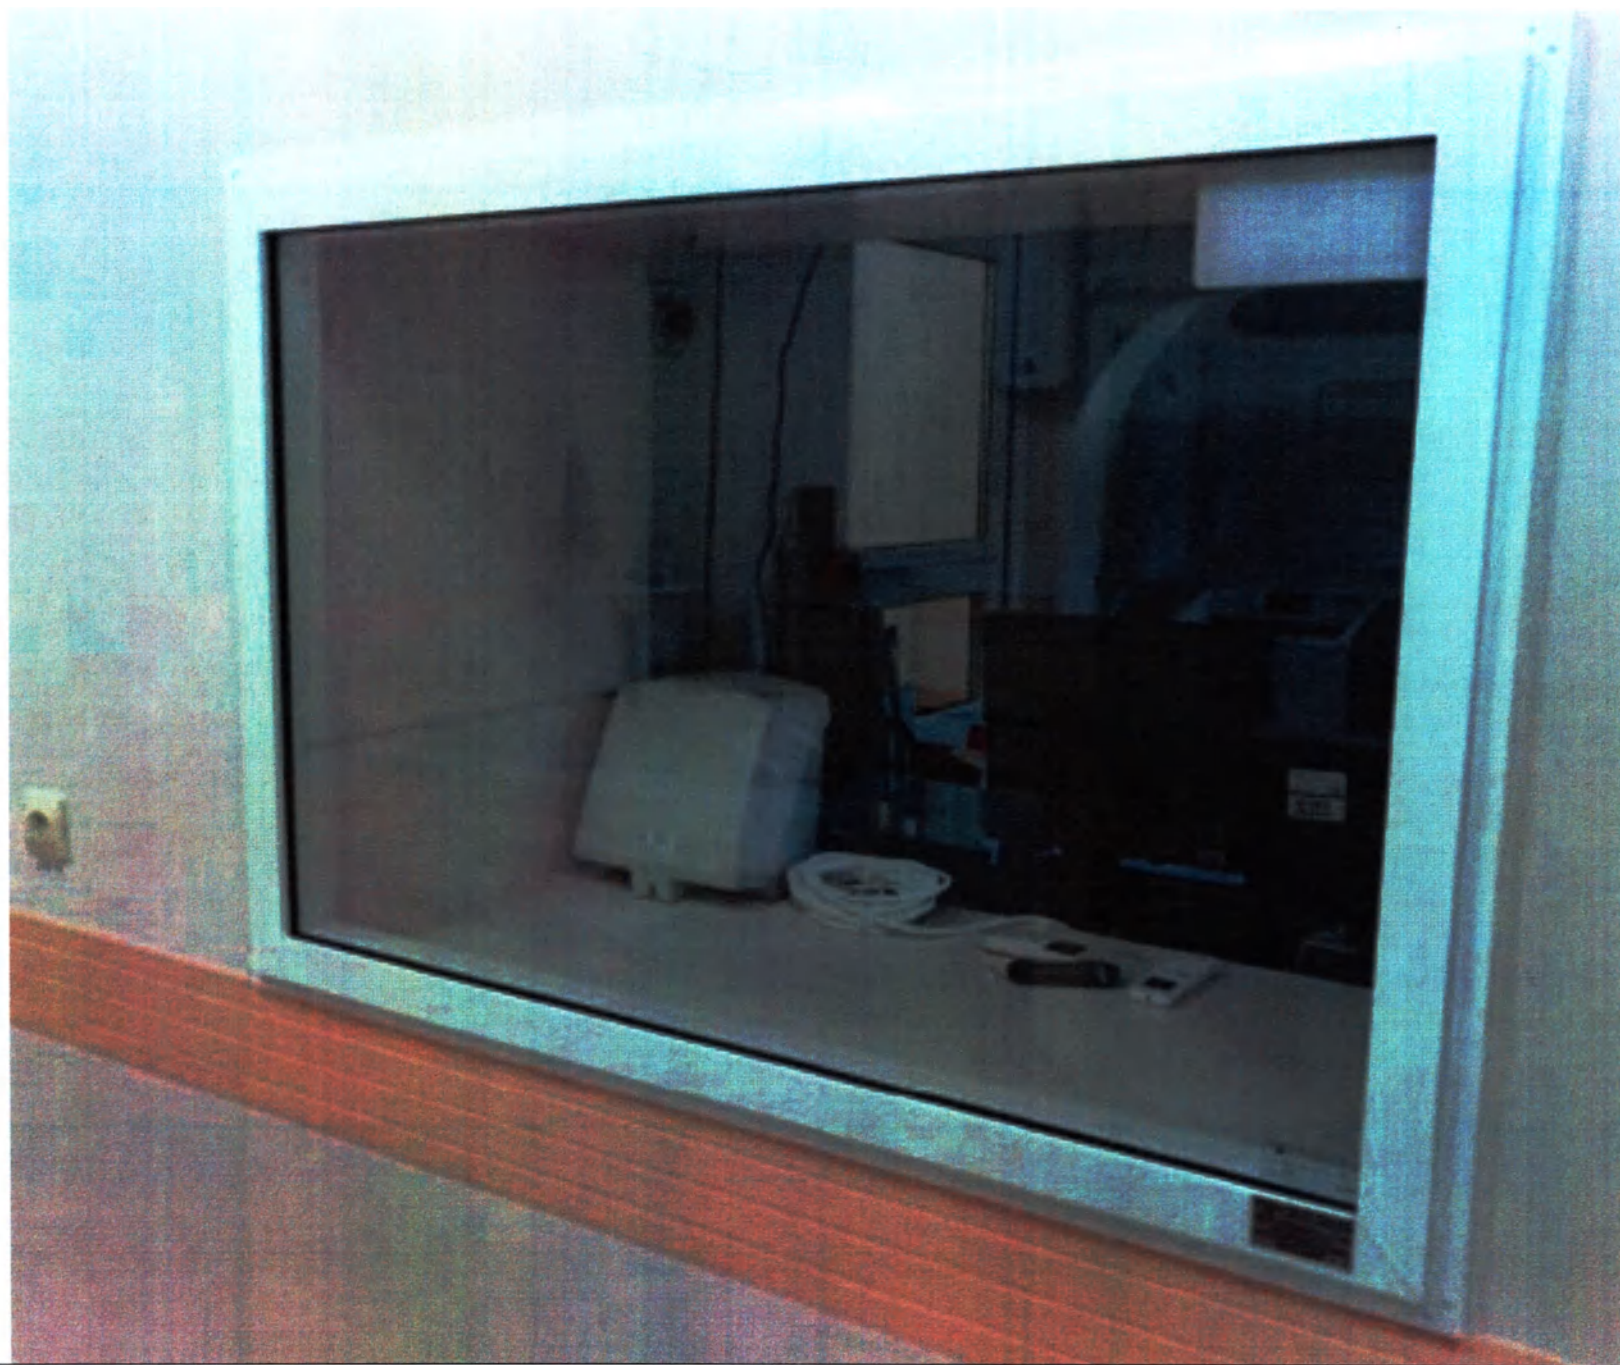
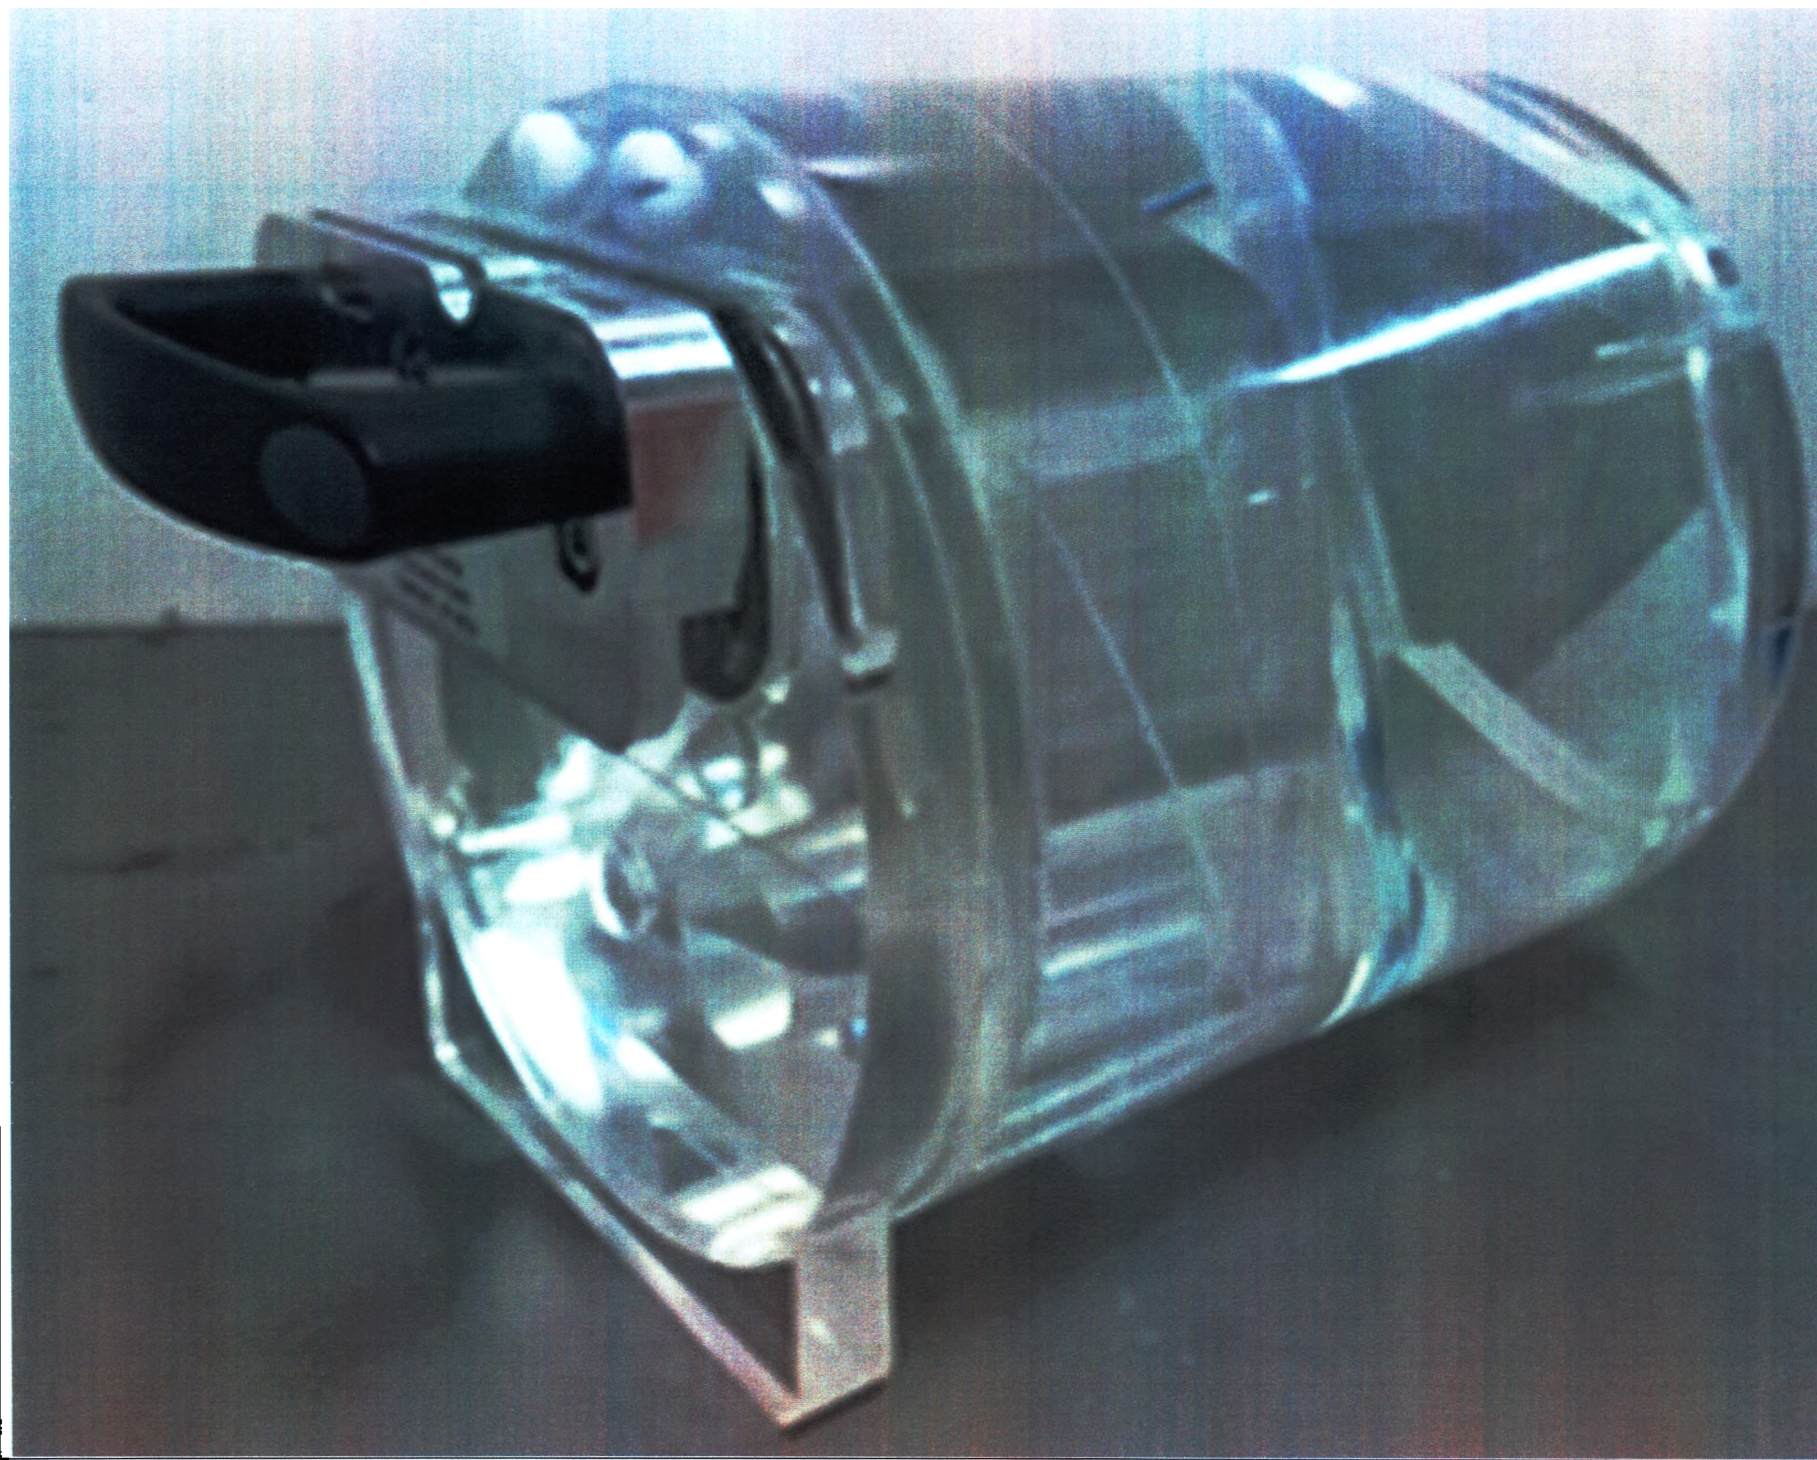


Рис. 191. Стекла защитные просвинцованные – не более 2 шт.



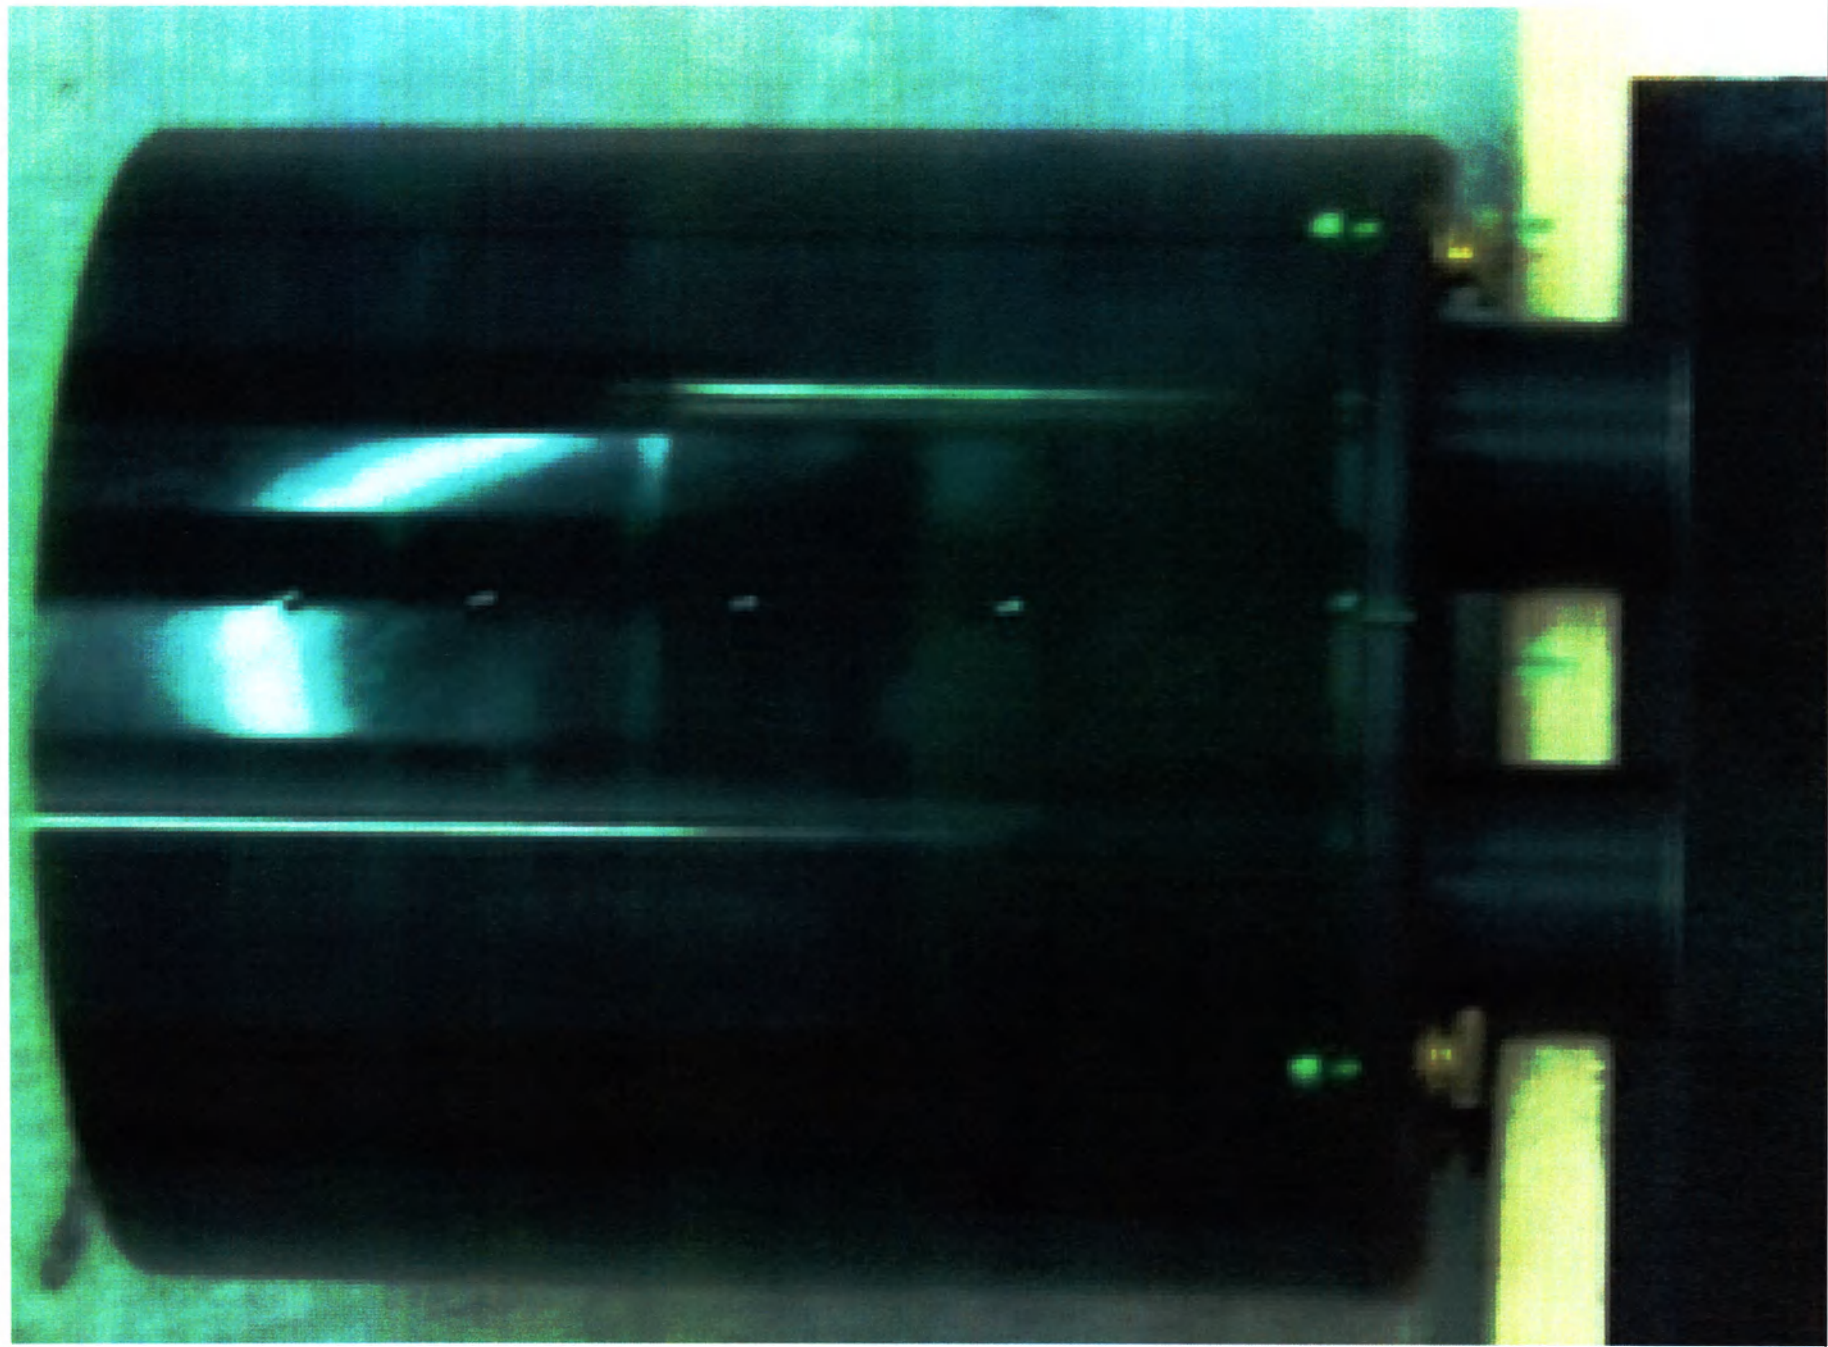


Рис. 193. Фантомы: фантом обеспечения качества и/или GE Performance фантом – не более 16 шт.



Рис. 194. Фантомы: фантом обеспечения качества и/или GE Performance фантом – не более 16 шт.



Рис. 195. Фантомы: фантом обеспечения качества и/или GE Performance фантом – не более 16 шт.



Рис. 196. Фантомы: фантом обеспечения качества и/или GE Performance фантом – не более 16 шт.

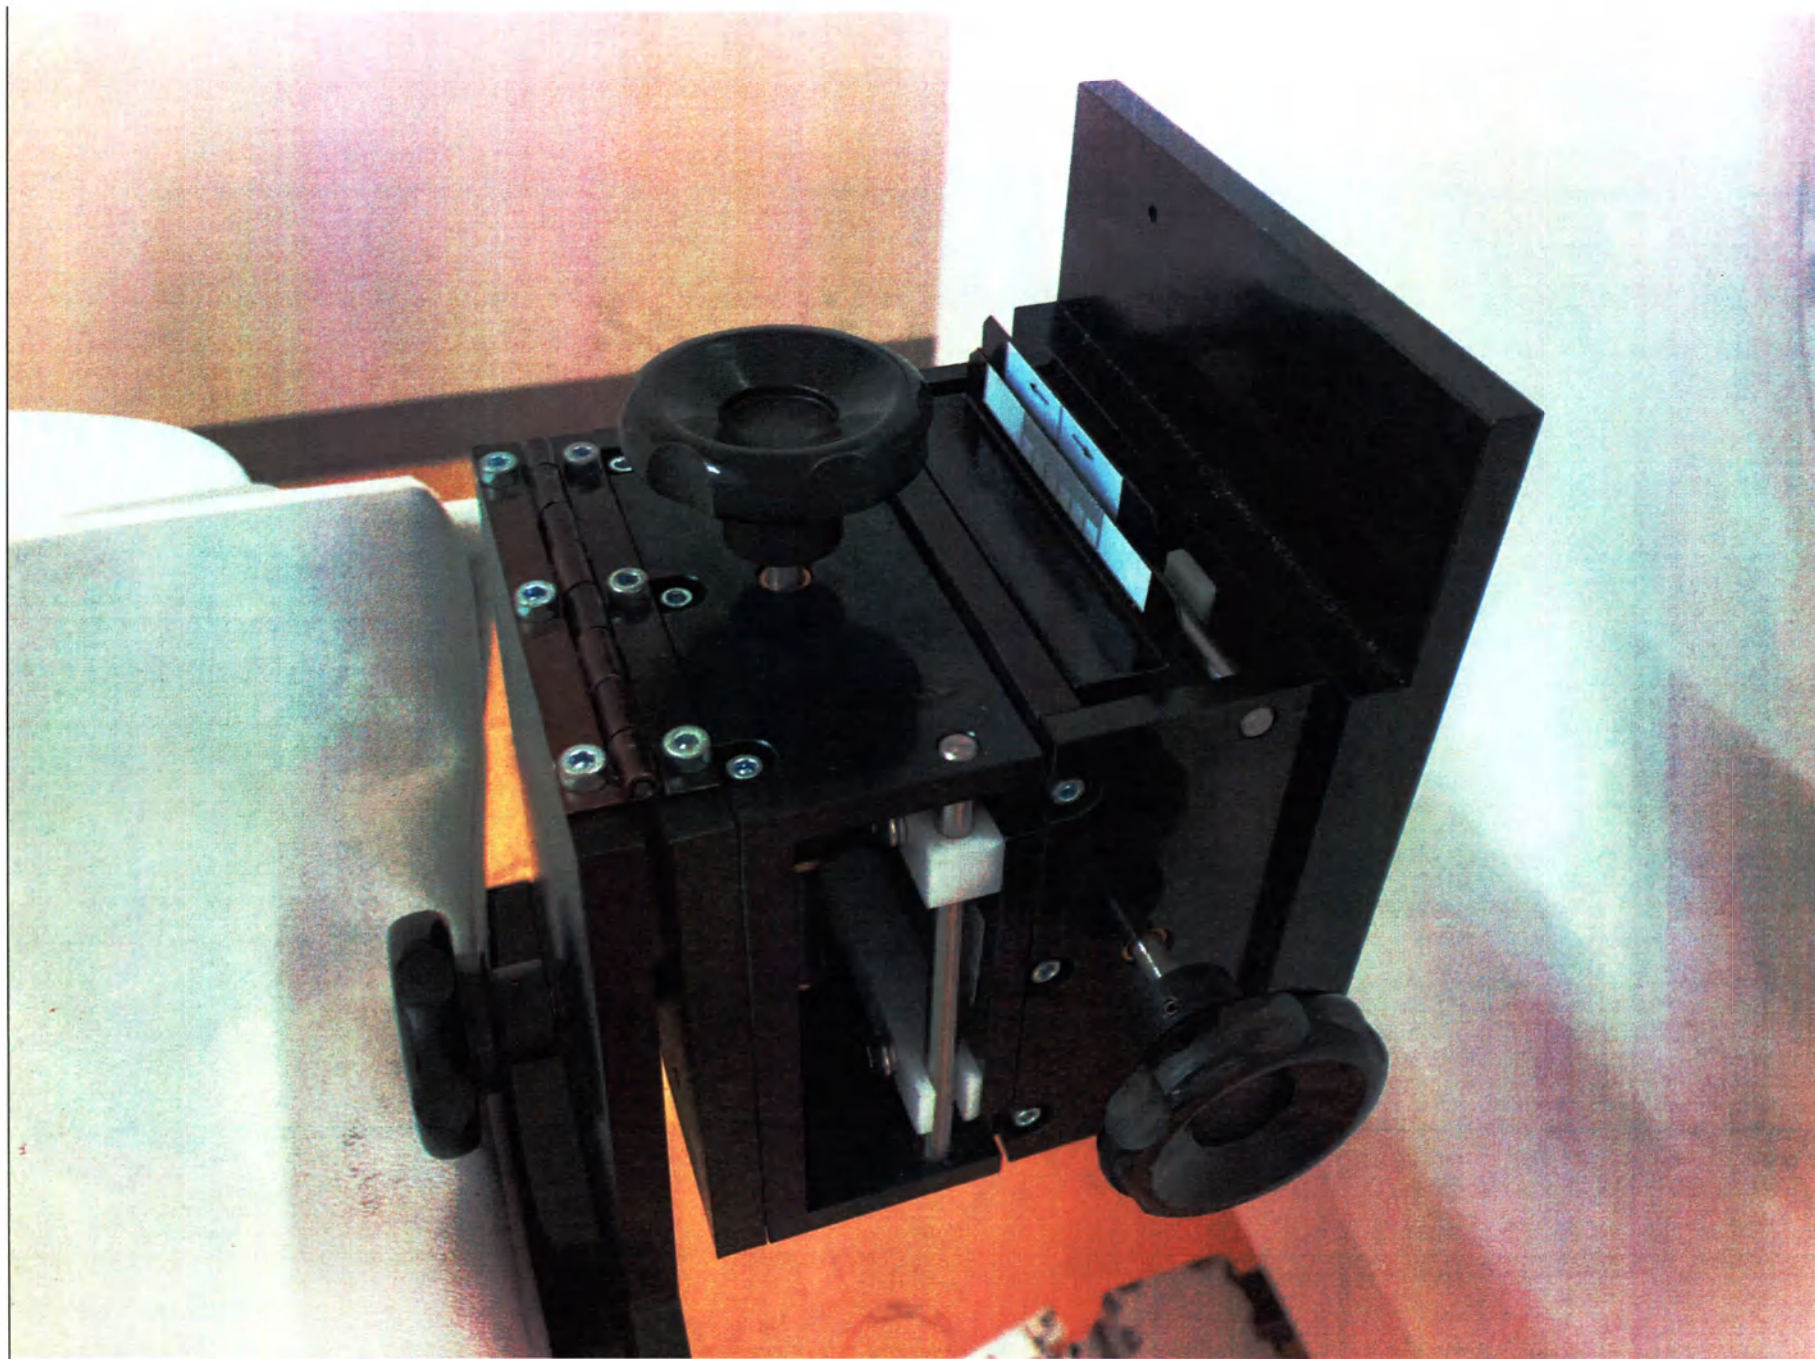


Рис. 197. Держатели фантома – не более 5 шт.

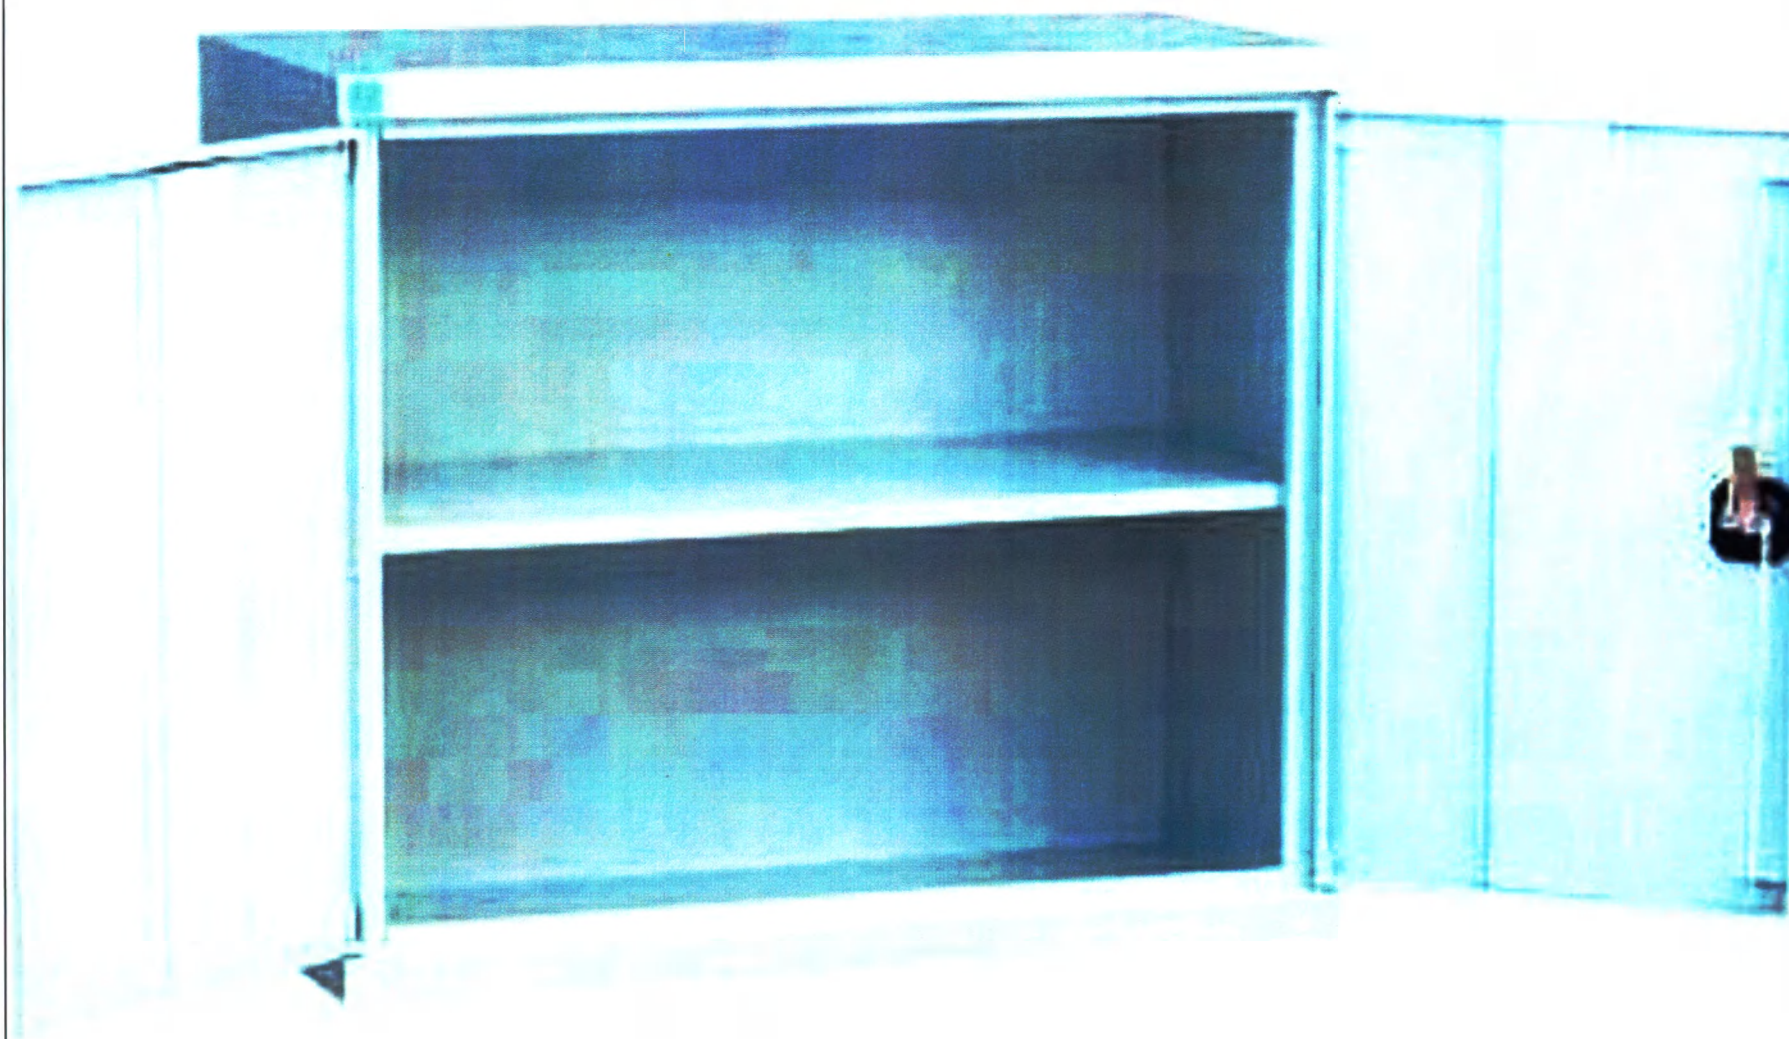


Рис. 198. Шкафы для хранения фантомов и принадлежностей – не более 5 шт.



Рис. 199. Шкафы для хранения фантомов и принадлежностей – не более 5 шт.

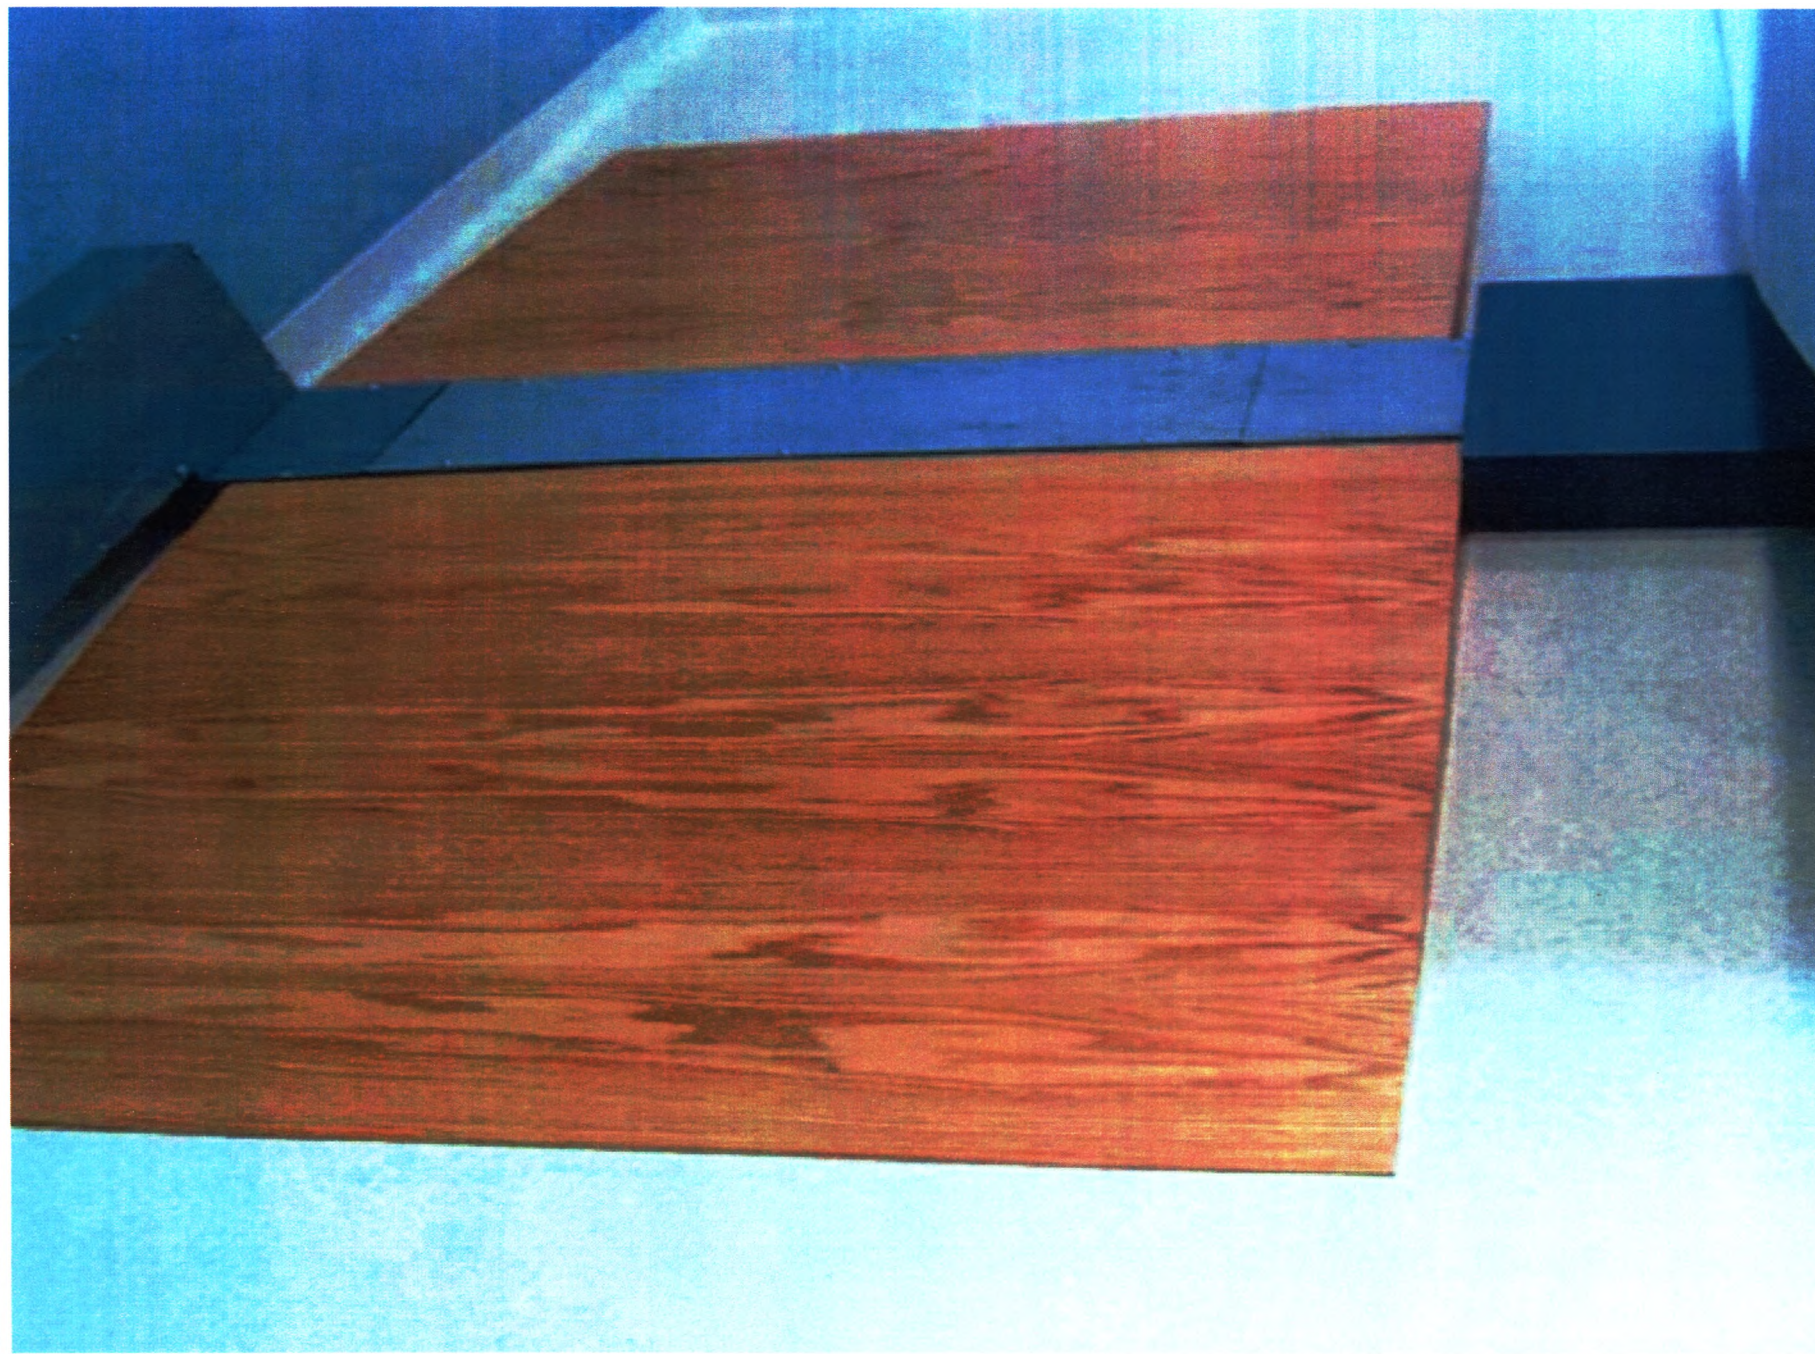


Рис. 200. Кожухи для кабелей защитные – не более 20 шт.



Рис. 201. Источники бесперебойного питания – не более 10 шт.



Рис. 202. Источники бесперебойного питания – не более 10 шт.



Рис. 203. Источники бесперебойного питания – не более 10 шт.



Рис. 204. Источники бесперебойного питания – не более 10 шт.



Рис. 205. Источники бесперебойного питания – не более 10 шт.



Рис. 206. Источники бесперебойного питания – не более 10 шт.

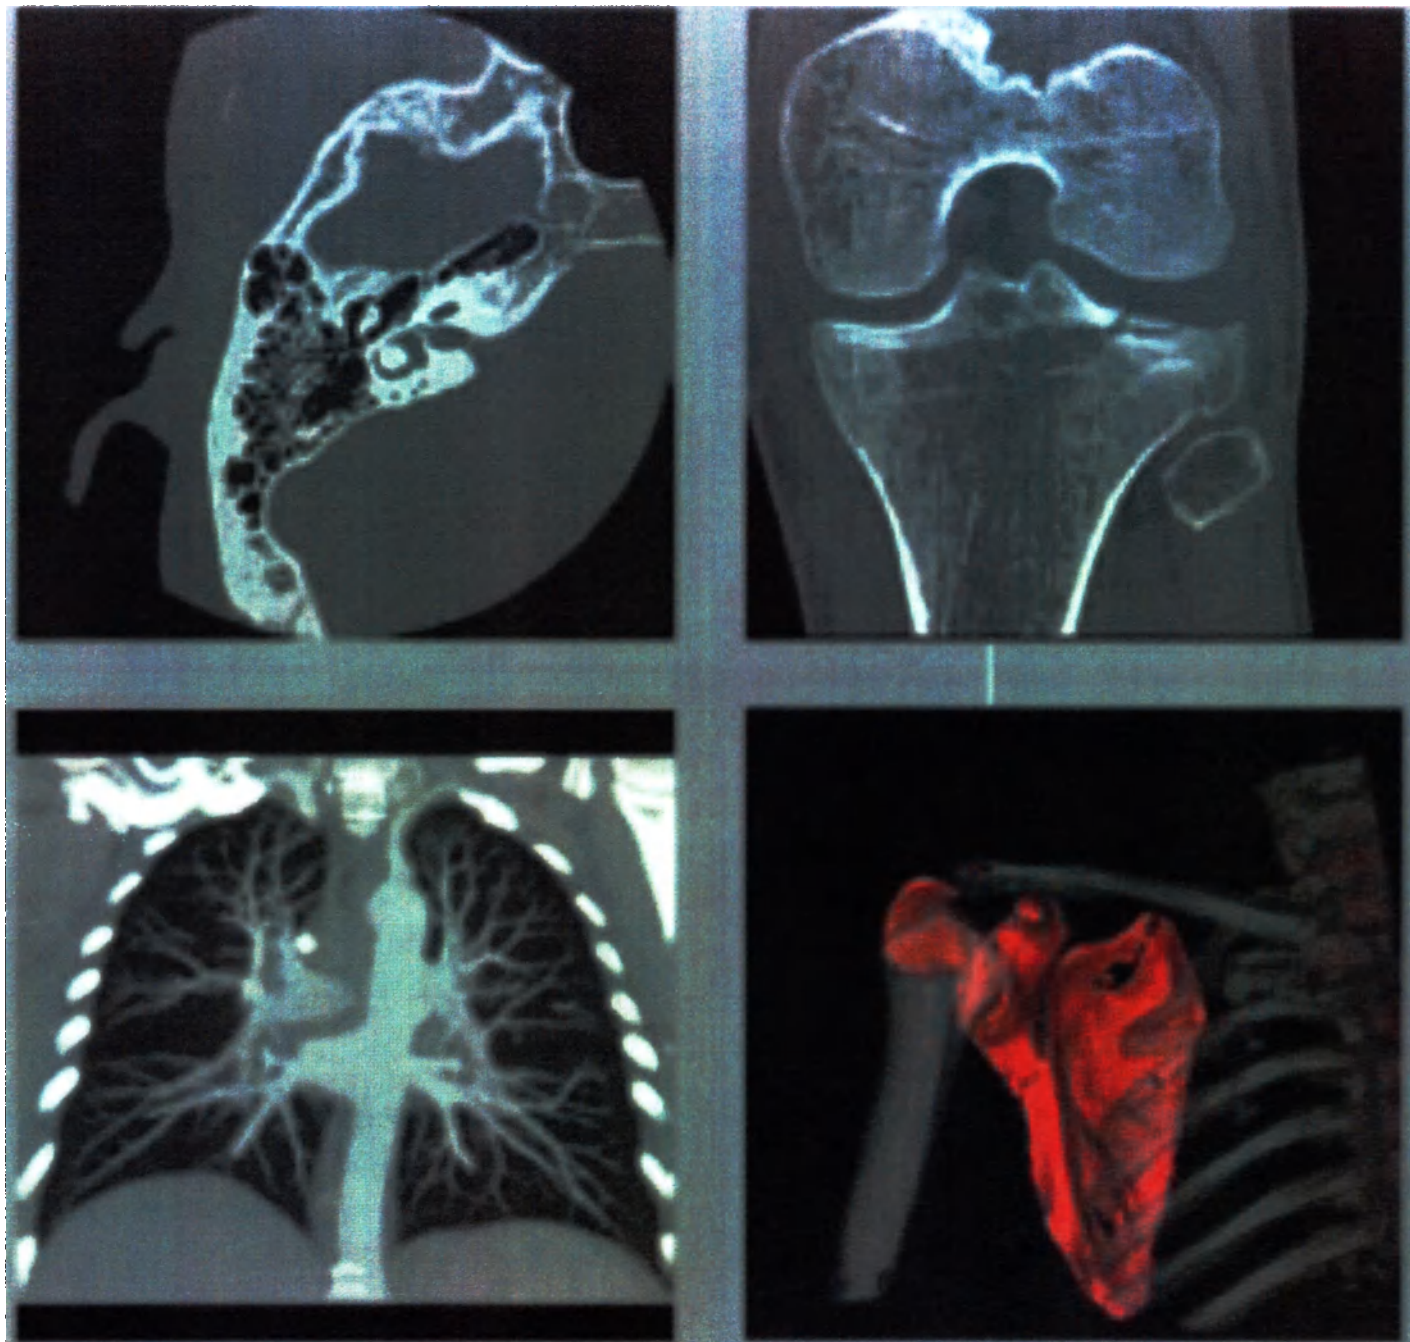


Рис. 207. Изображения демонстрационные КТ – не более 20 шт.



Рис. 208. Сервер обработки диагностических данных – не более 5 шт.

2095/рм

