

Фотографические изображения
набора реагентов

**Набор реагентов in vitro для качественного определения
антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа
(MAGLUMI® HSV-1/2 IgM (CLIA)), методом иммунохеми-
люминесцентного анализа на автоматических анализато-
рах MAGLUMI®, в вариантах исполнения**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛС»


 Смирнов Э.А.

« 14 » октября 2023 г.

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (MAGLUMI® HSV-1/2 IgM (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 1


Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (MAGLUMI® HSV-1/2 IgM (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 30 тестов, в составе:

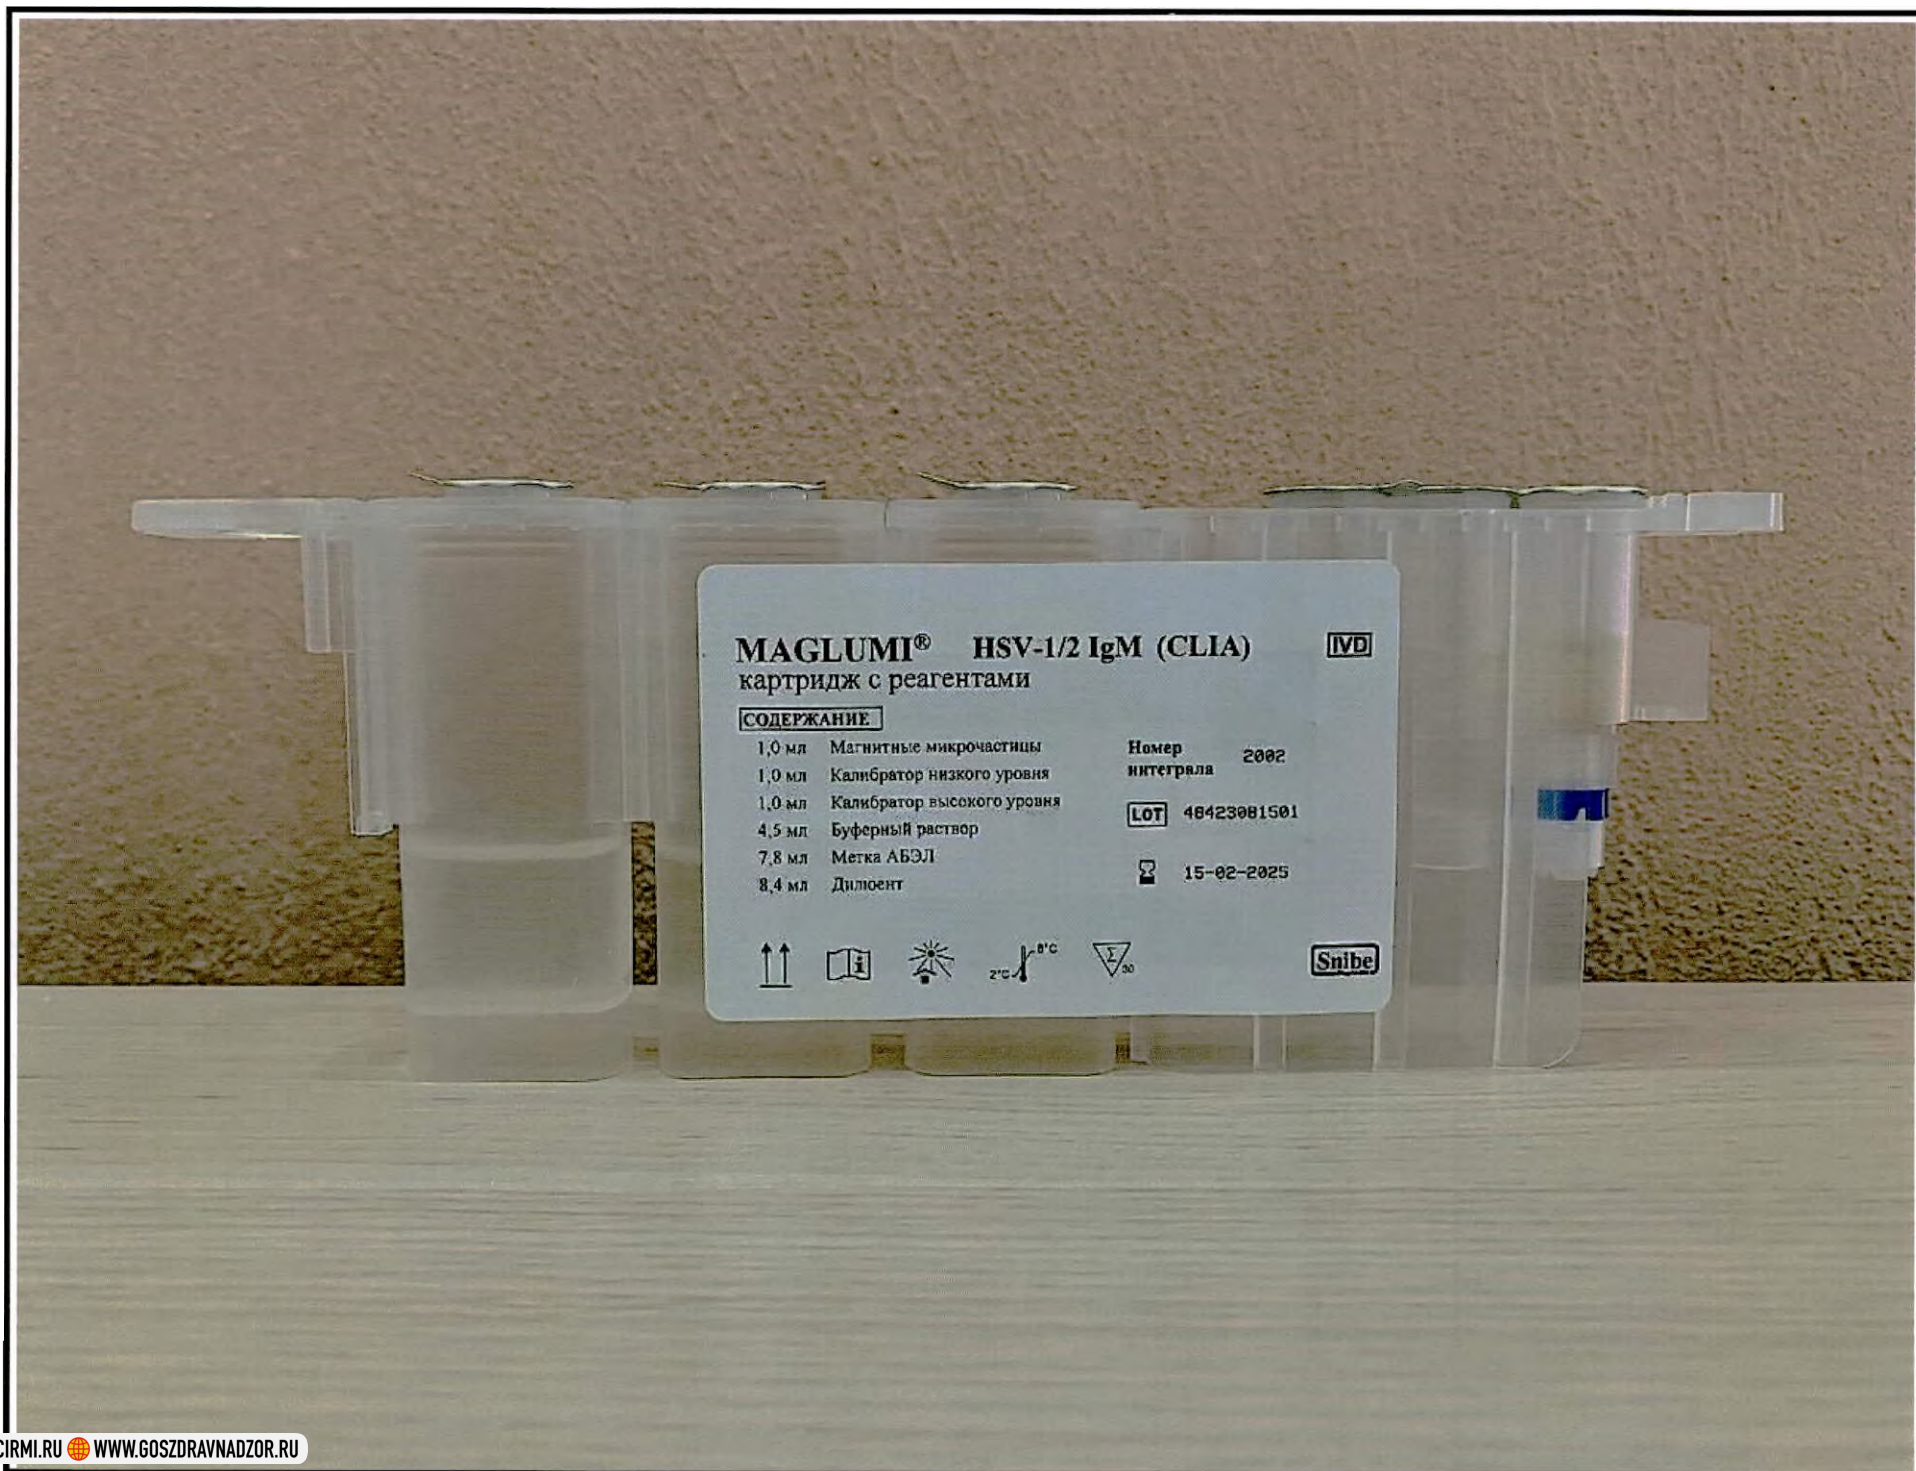

Отрицательный контроль



Положительный контроль

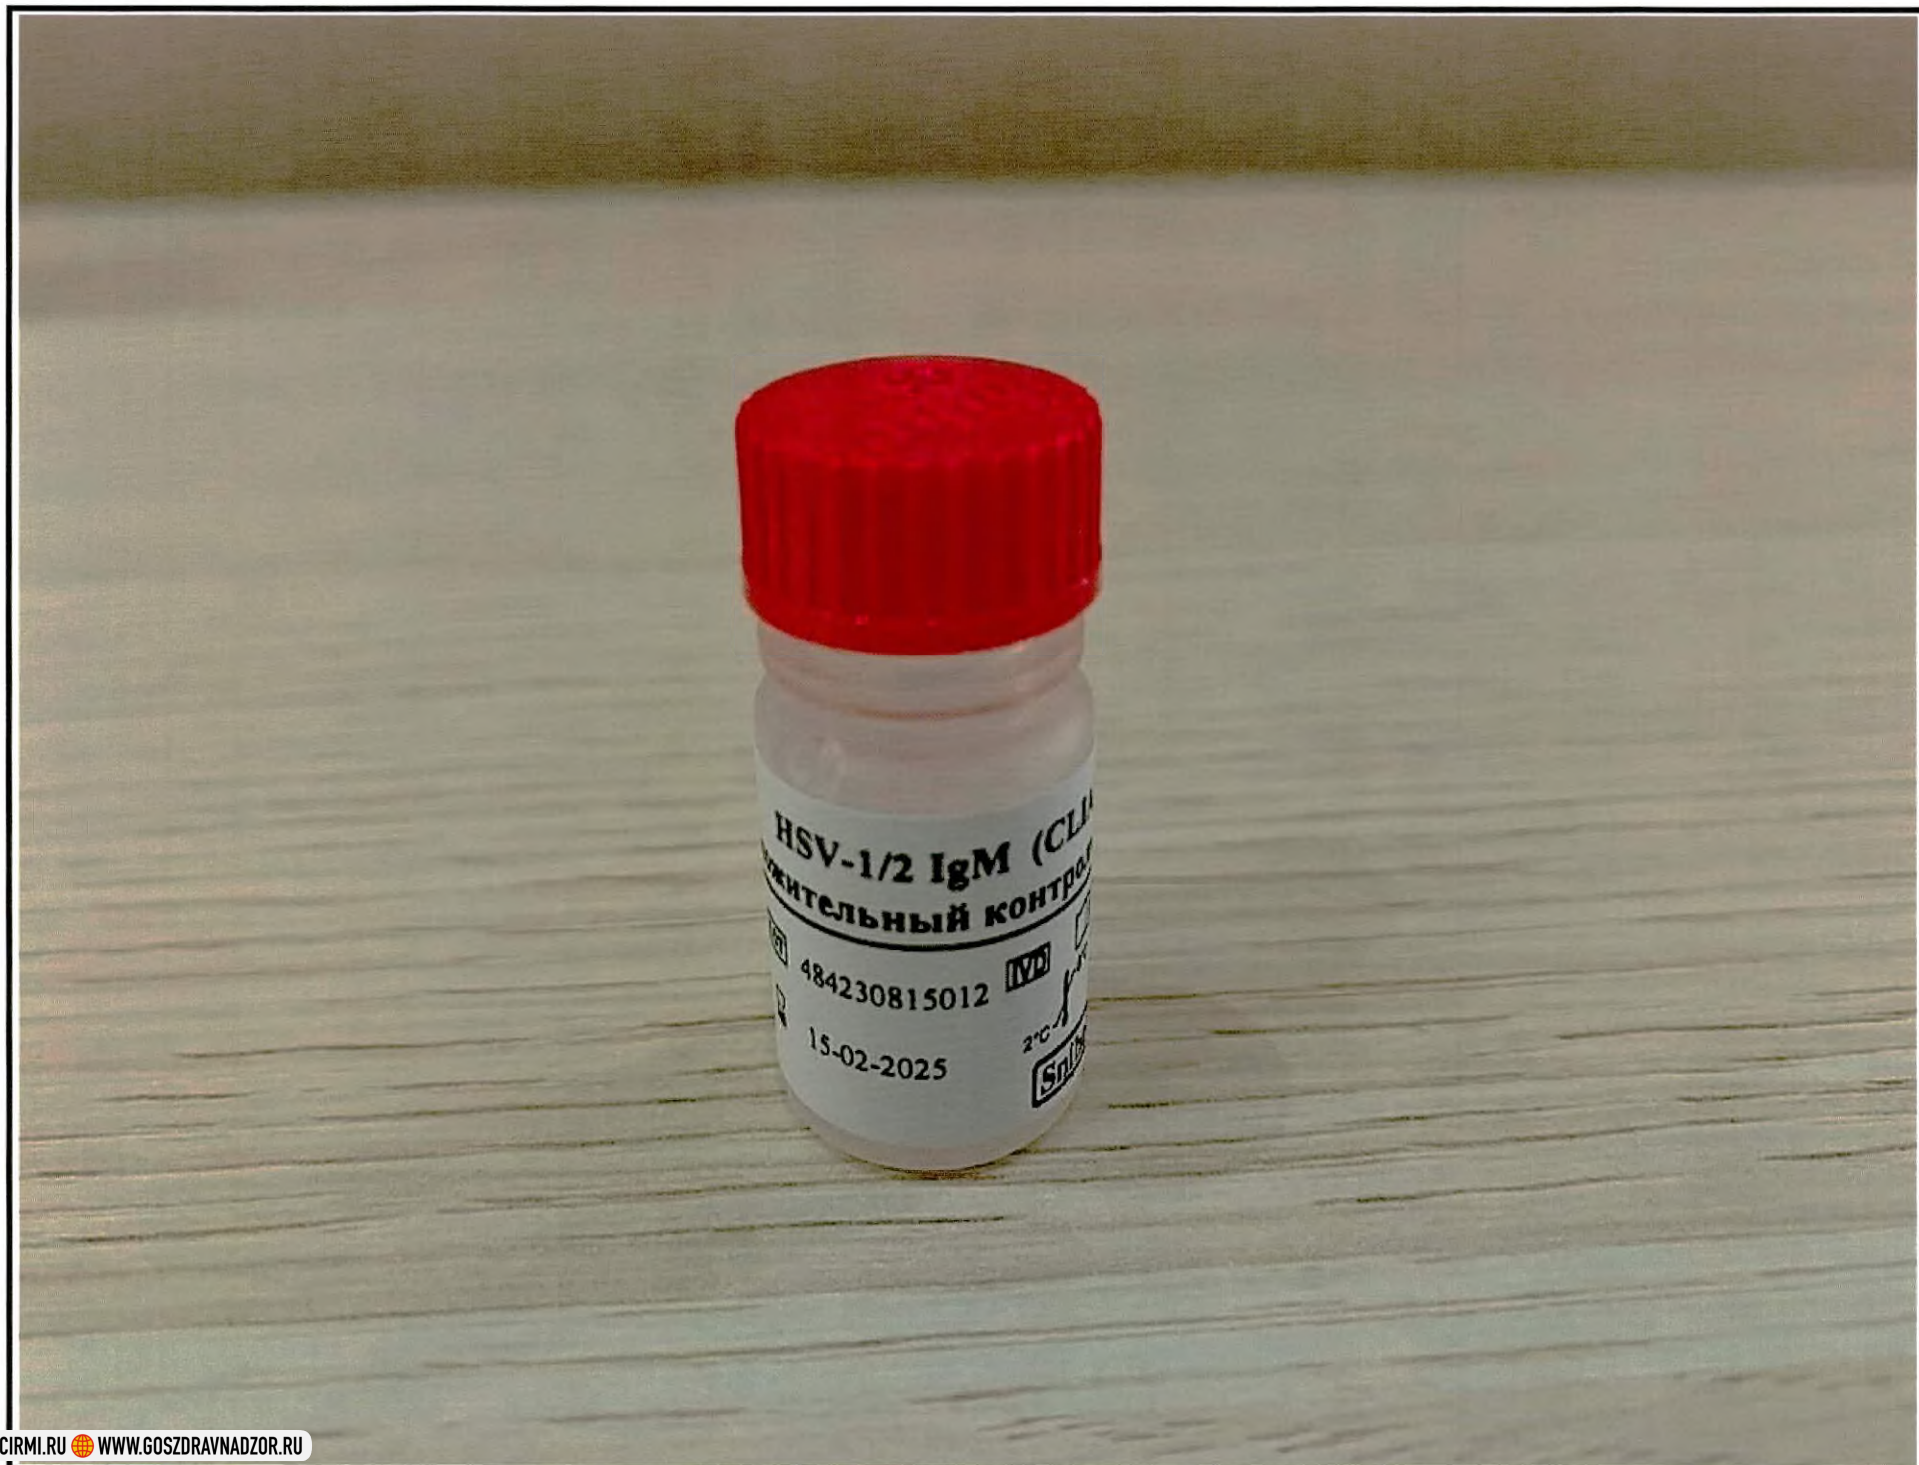



Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля



Наклейки со штрих-кодами для положительного контроля



CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130262009M: 100 тестов

130662009M: 50 тестов

130762009M: 30 тестов


Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (MAGLUMI® HSV-1/2 IgM (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов *in vitro* для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики инфекции вируса простого герпеса, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), является одним из наиболее распространенных вирусных заболеваний, передающихся половым путем, во всем мире¹. ВПГ представляет собой вирус с двуспиральной ДНК и относится к семейству вирусов герпеса человека, официально известному как *Herpesviridae*². Вирус существует в 2 формах: ВПГ-1 и ВПГ-2. Два типа ВПГ отличаются антигенными

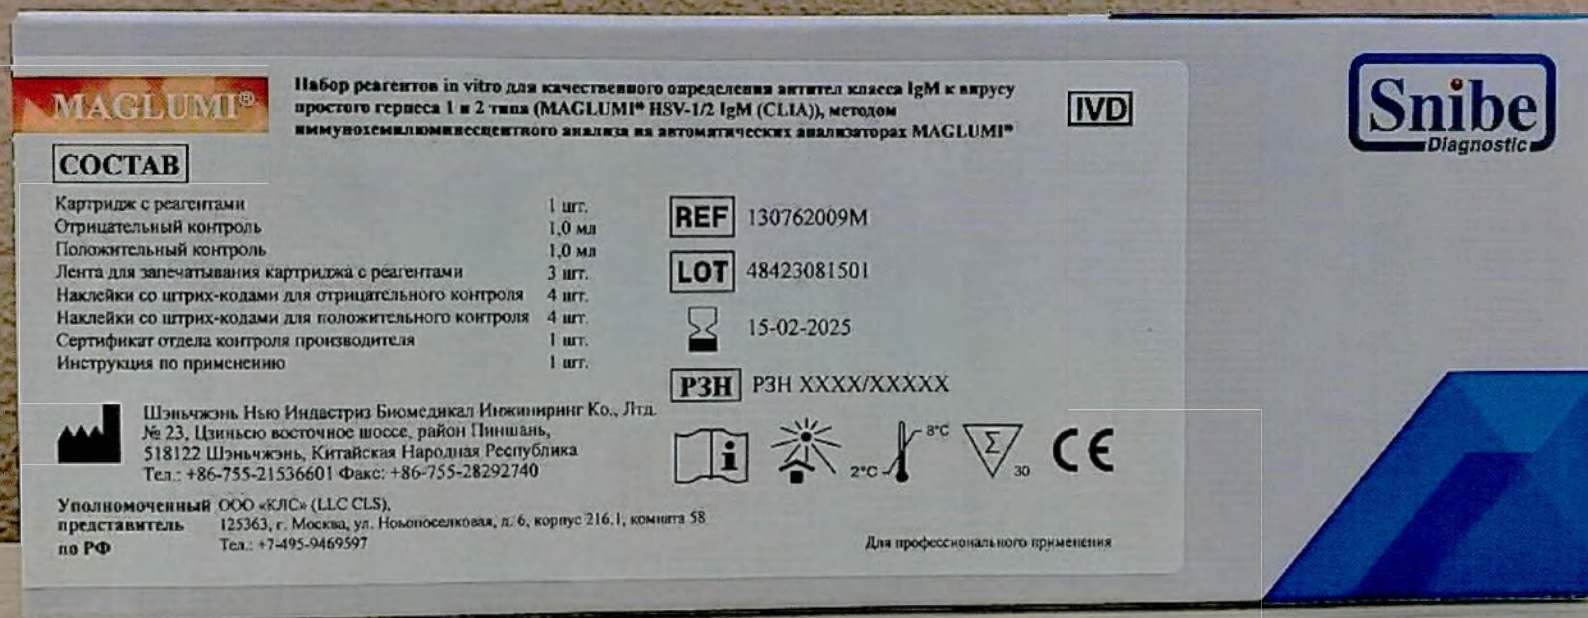


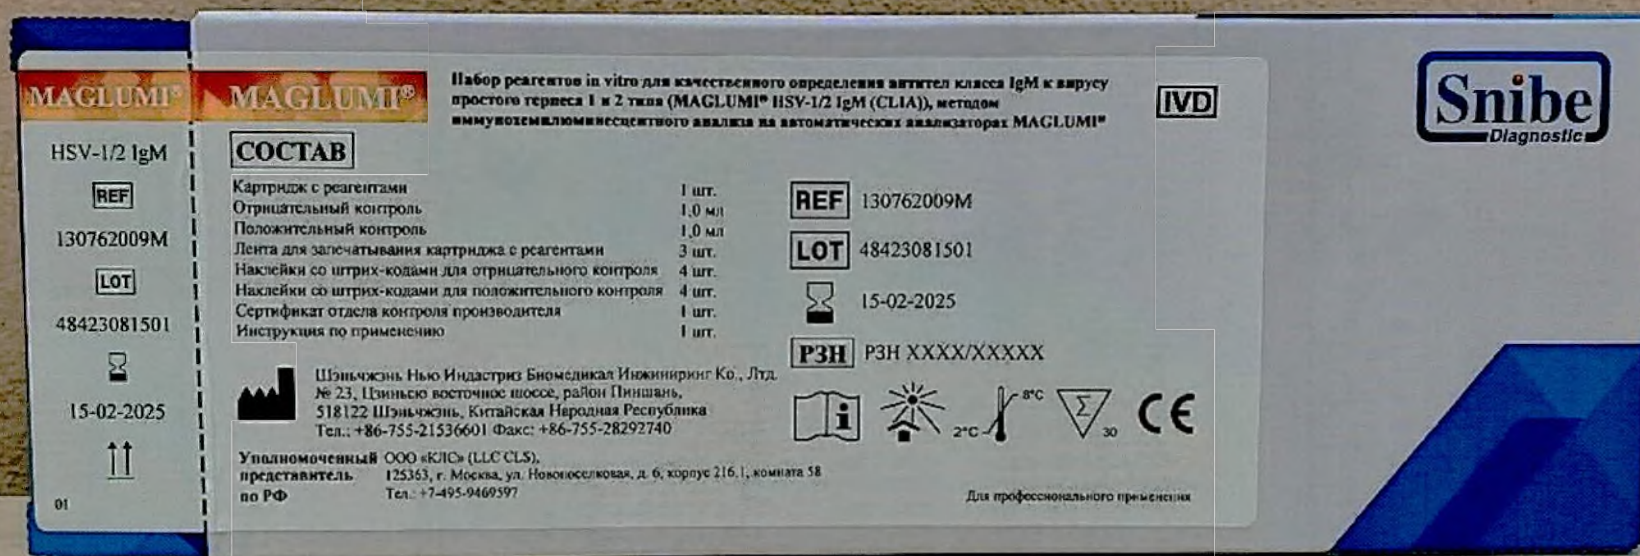

Вариант исполнения 2

***Набор реагентов in vitro для качественного определения анти-
тел класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа
(MAGLUMI® HSV-1/2 IgM (CLIA)), методом иммунохемилюми-
несцентного анализа на автоматических анализаторах MAG-
LUMI®, 50 тестов, в составе:***


Картридж с реагентами

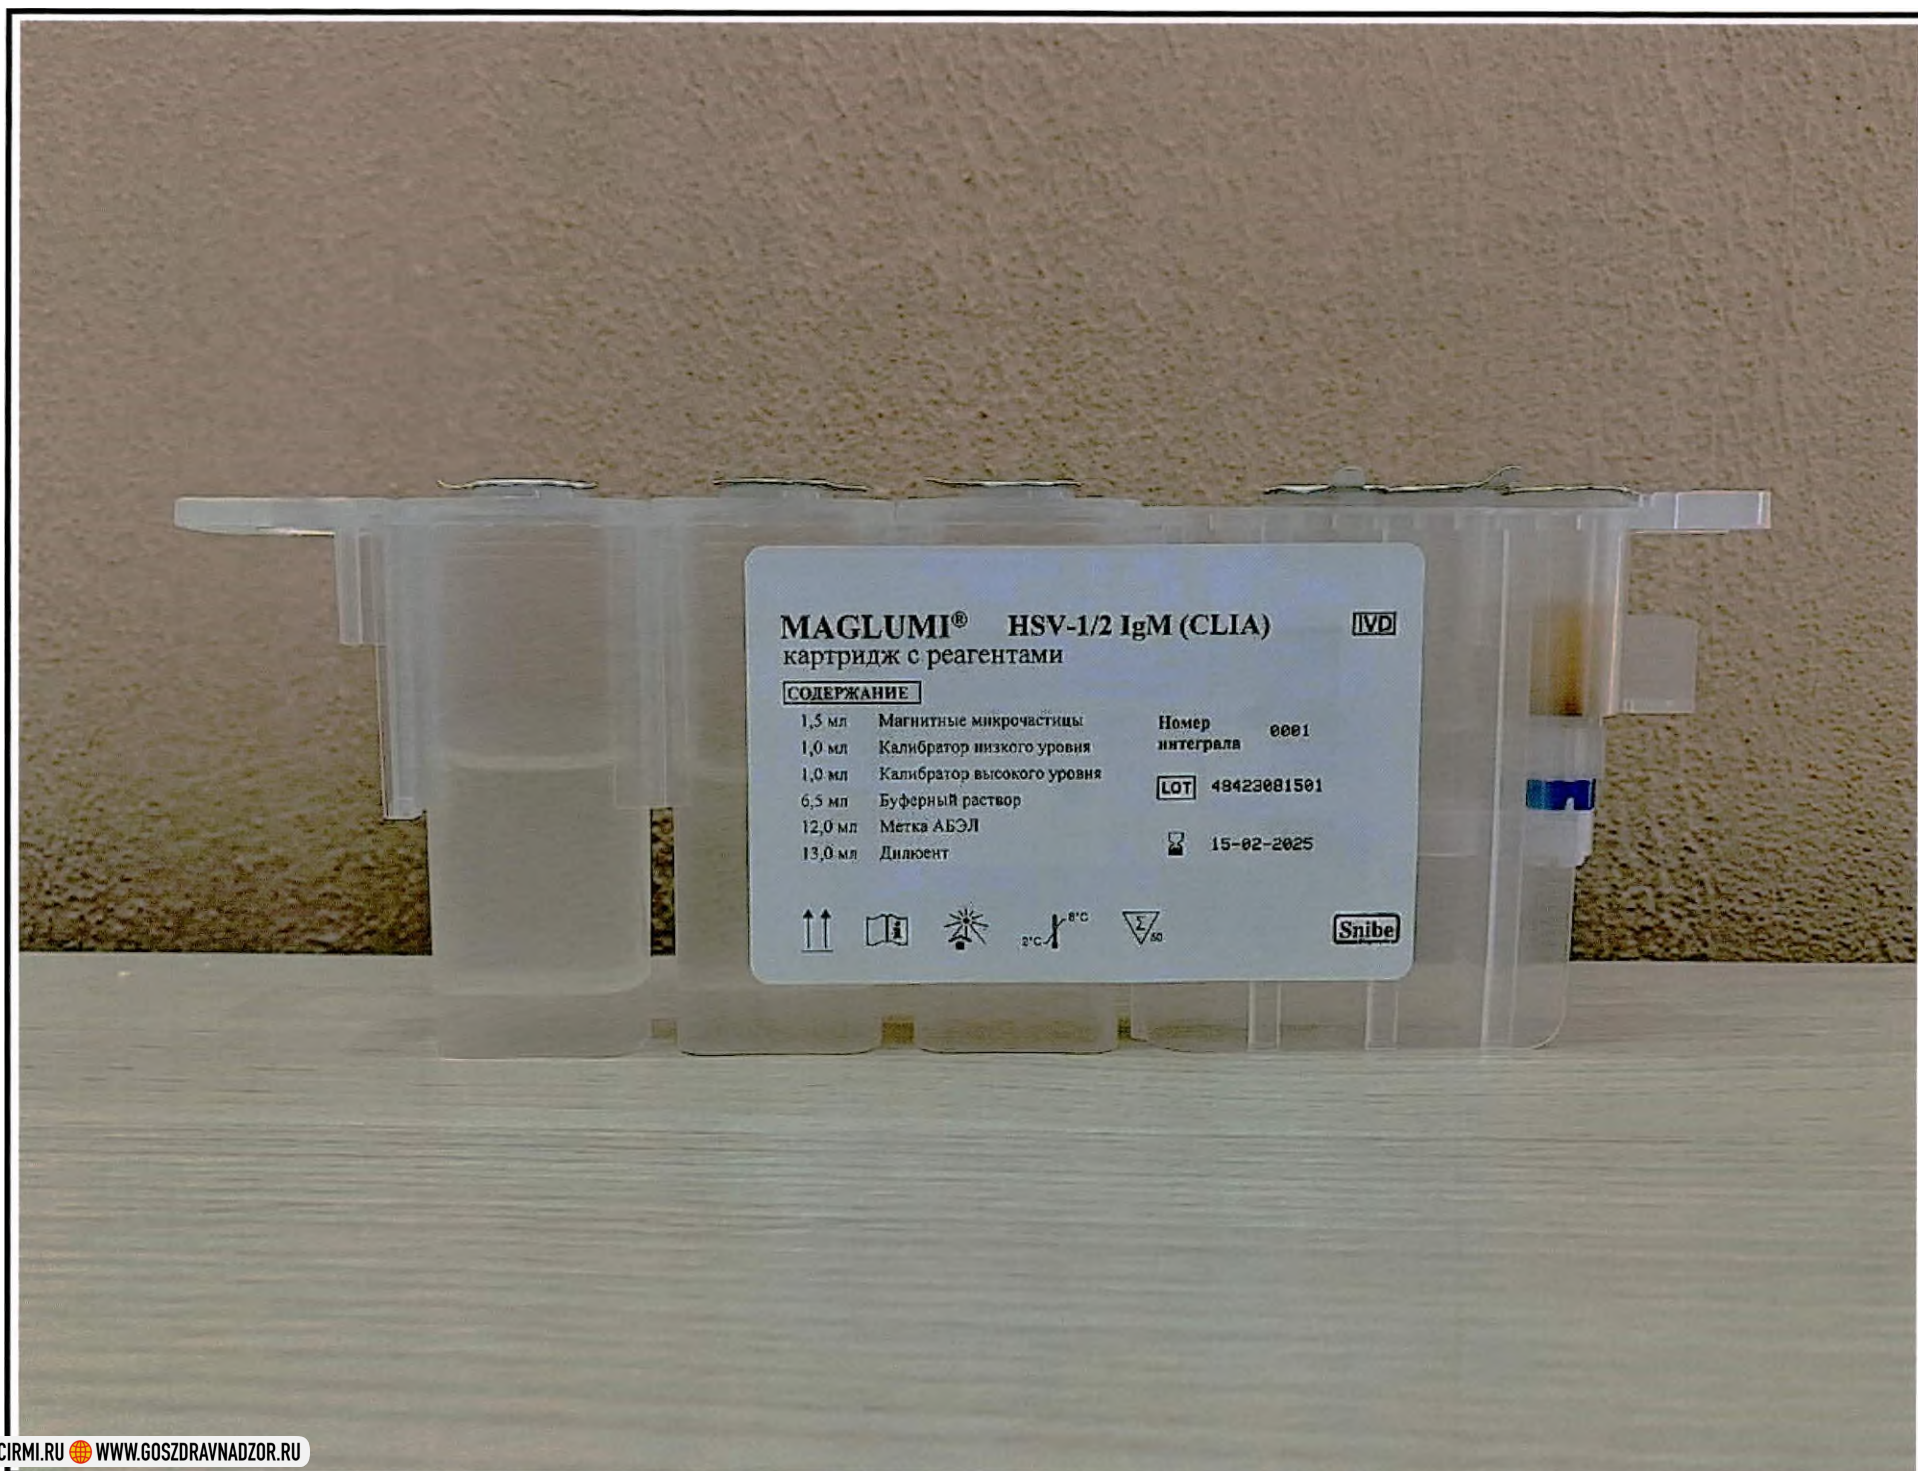


Отрицательный контроль



Положительный контроль

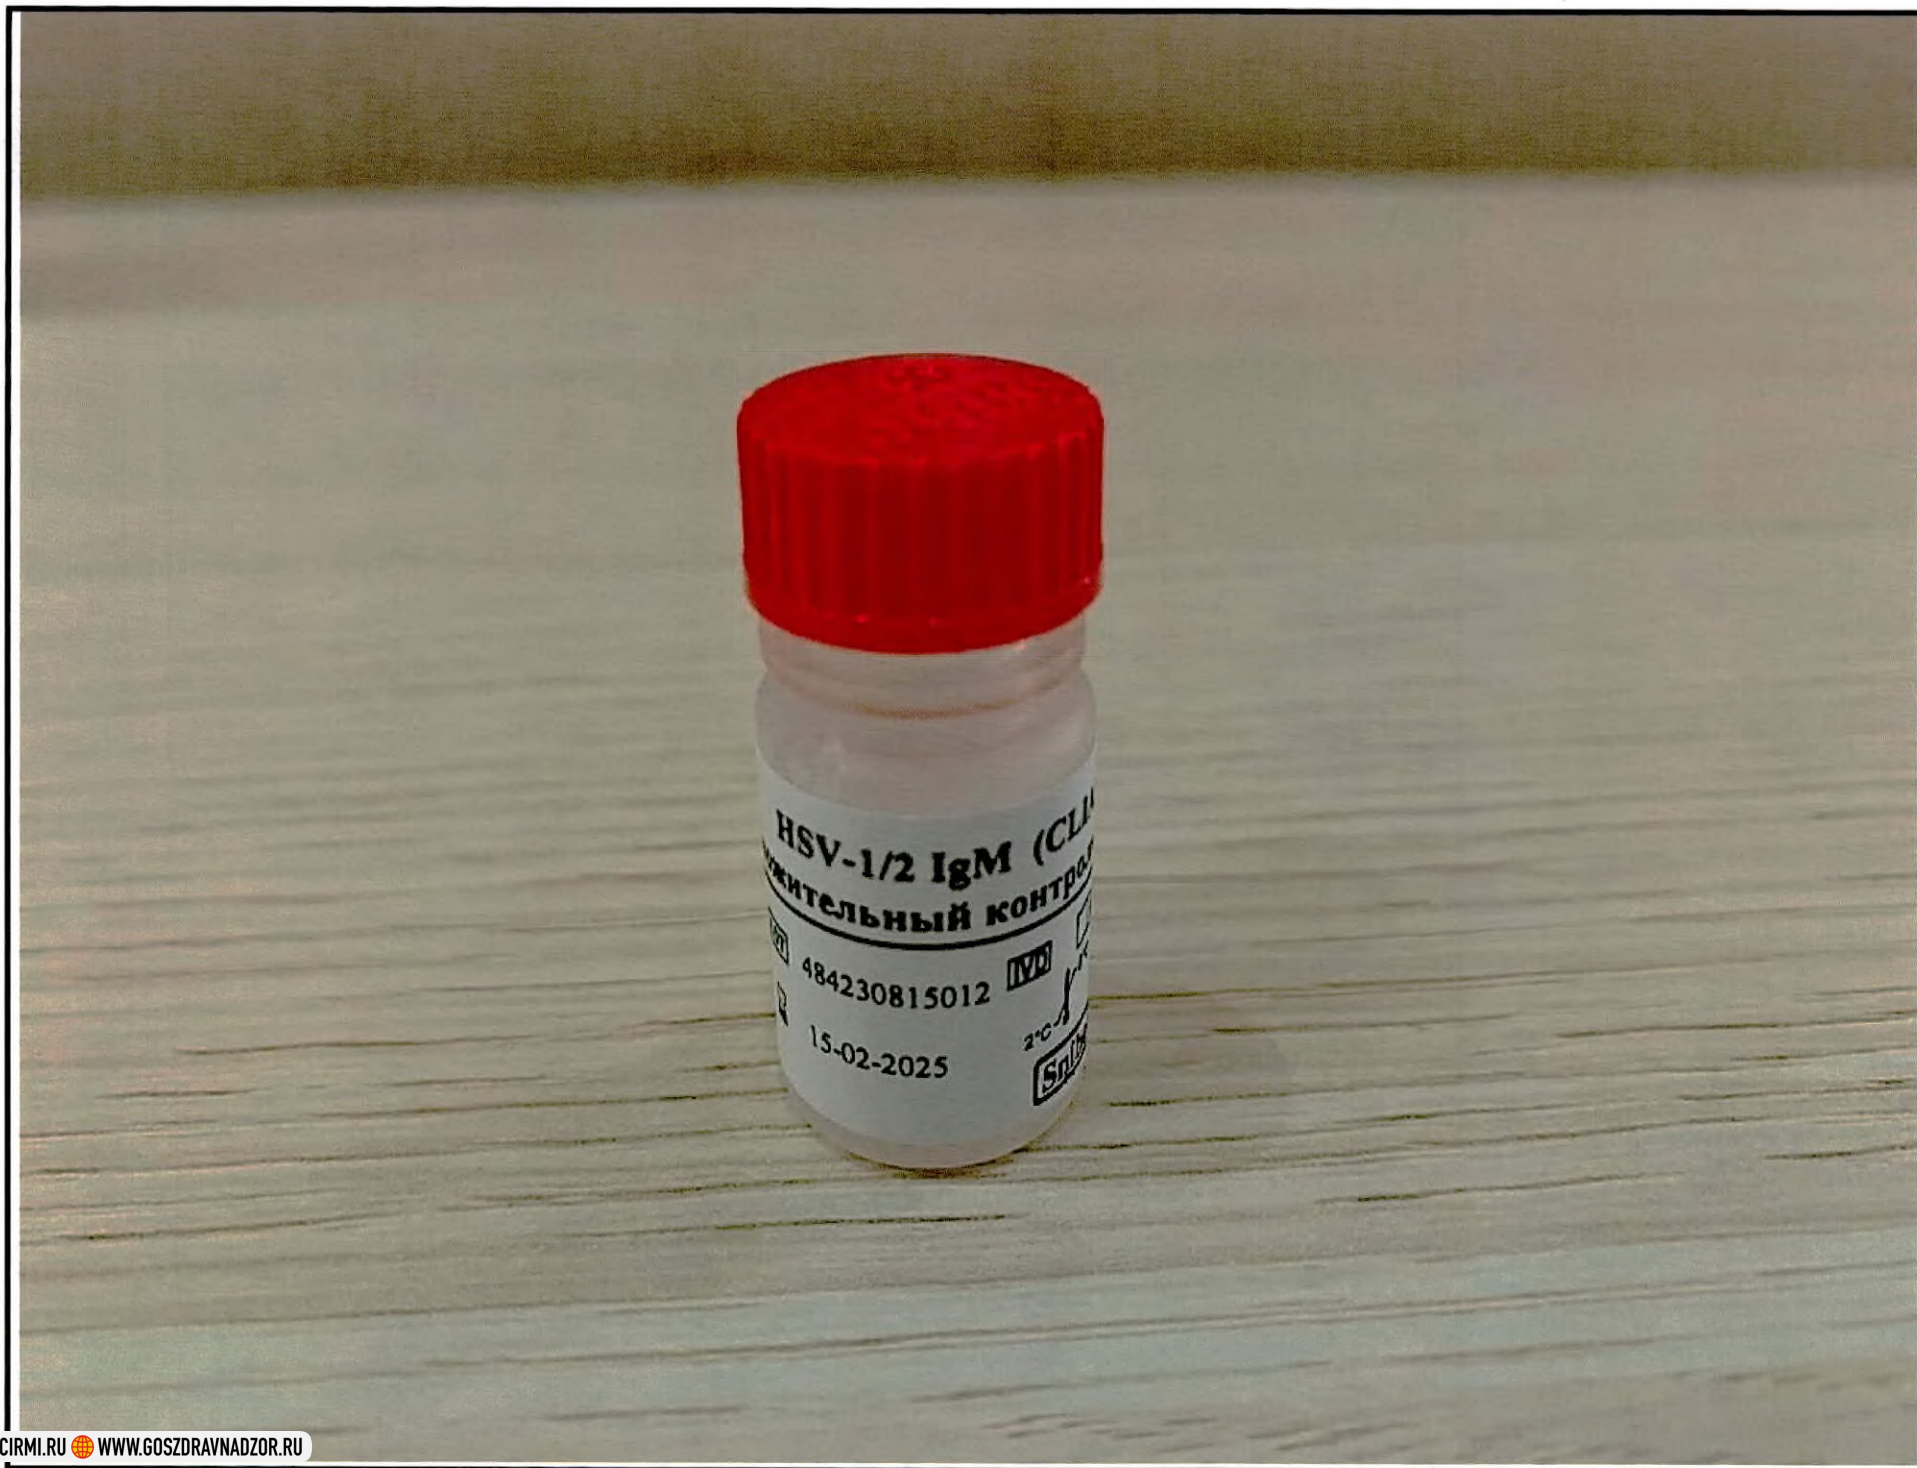

Лента для запечатывания картриджа с реагентами

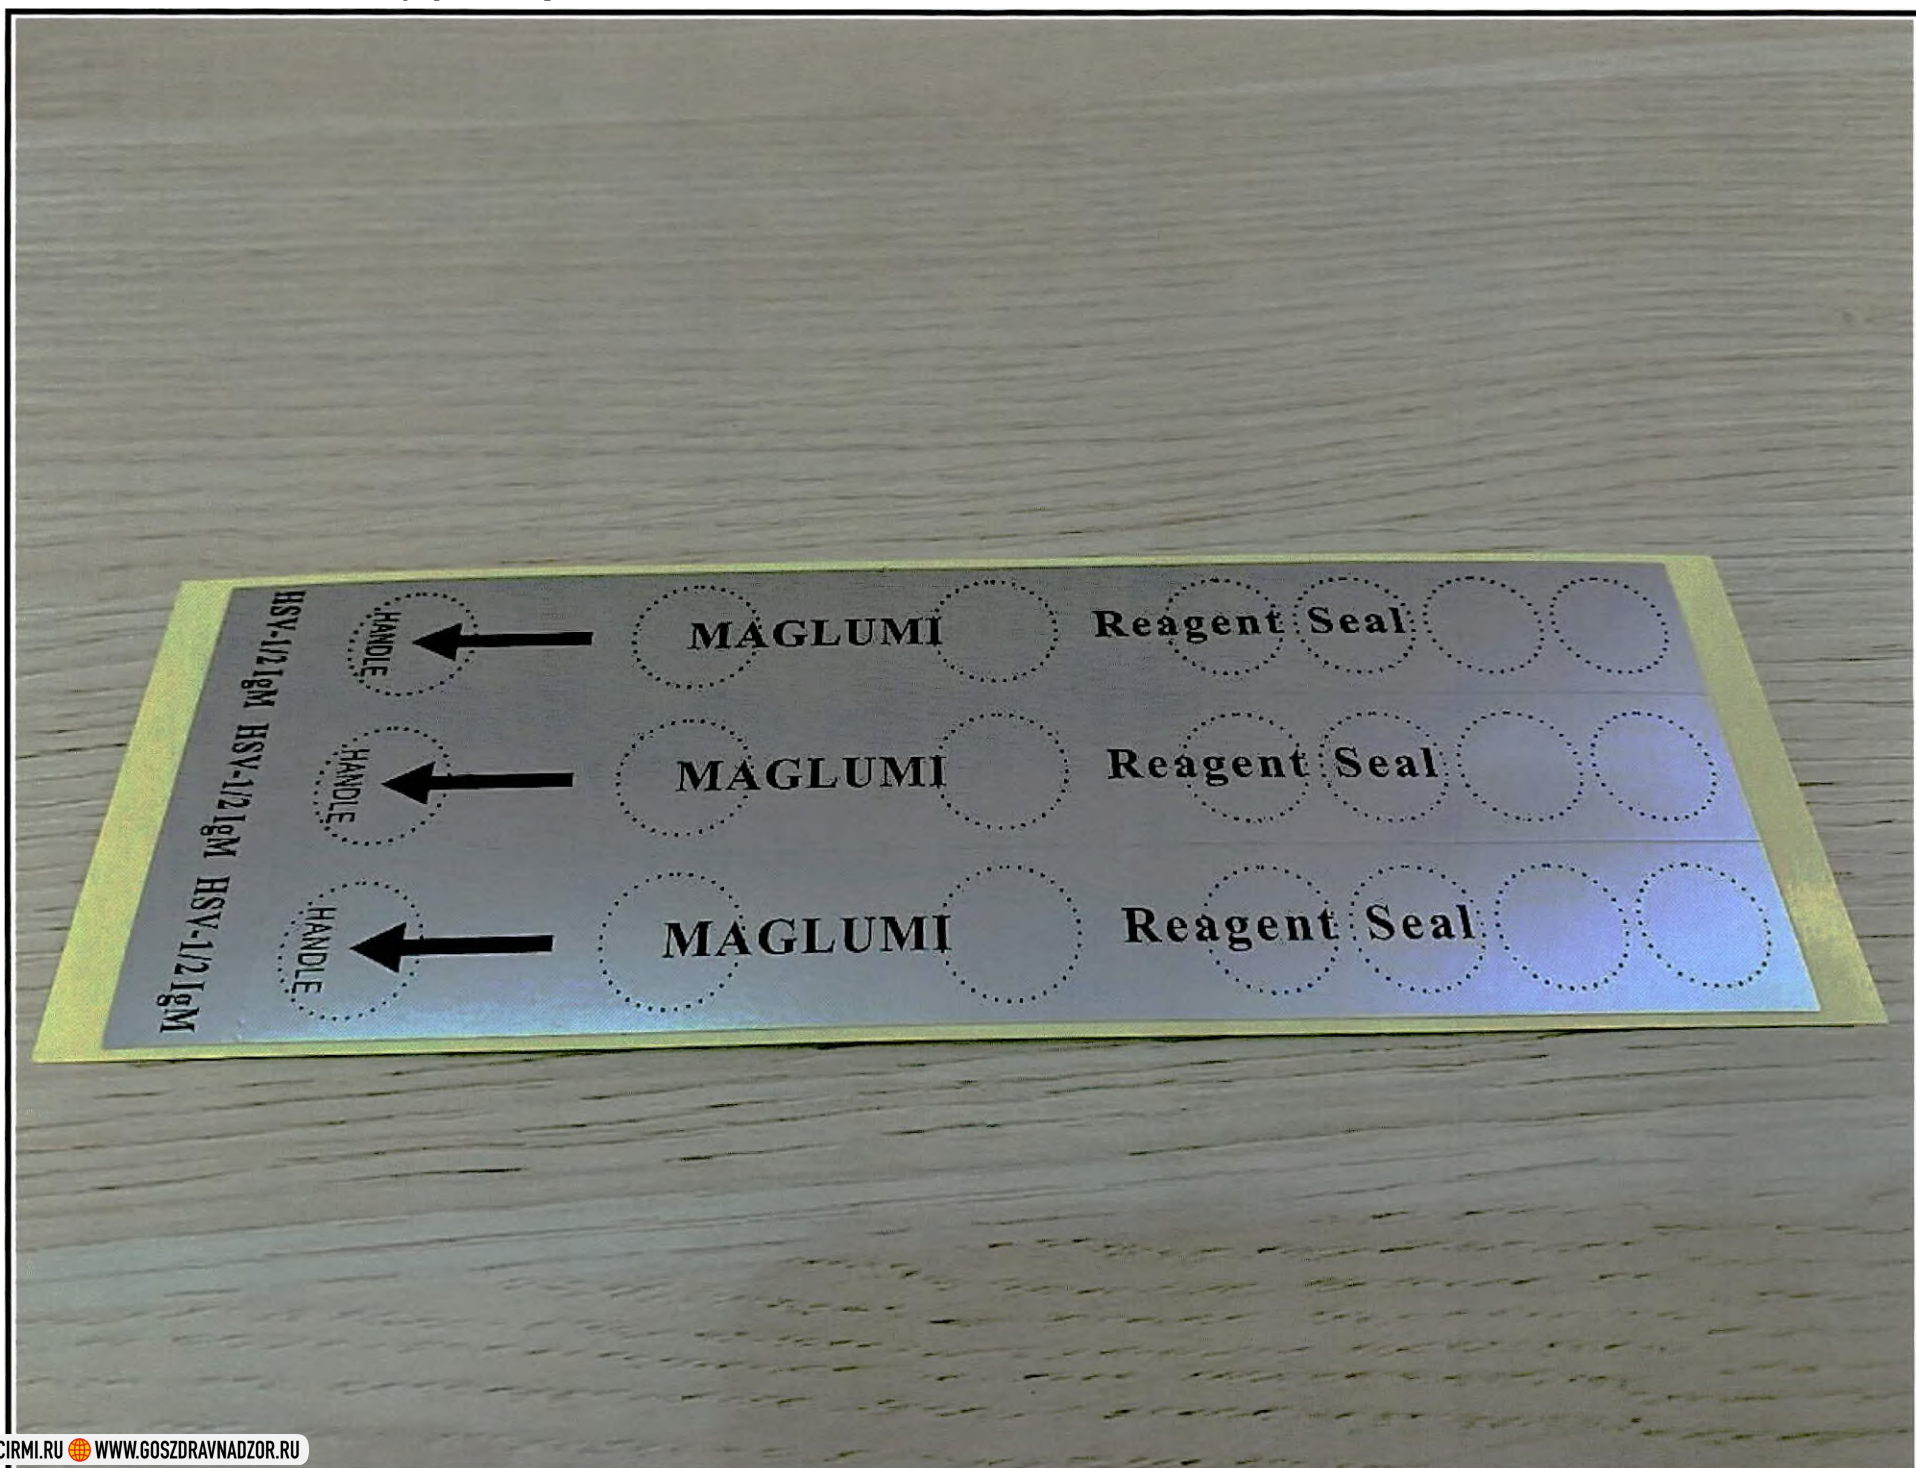

Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля





CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130262009M: 100 тестов
130662009M: 50 тестов
130762009M: 30 тестов


Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (MAGLUMI® HSV-1/2 IgM (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики инфекции вируса простого герпеса, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), является одним из наиболее распространенных вирусных заболеваний, передающихся половым путем, во всем мире¹. ВПГ представляет собой вирус с двуспиральной ДНК и относится к семейству вирусов герпеса человека, официально известному как *Herpetoviridae*². Вирус существует в 2 формах: ВПГ-1 и ВПГ-2. Два типа ВПГ отличаются антигенными

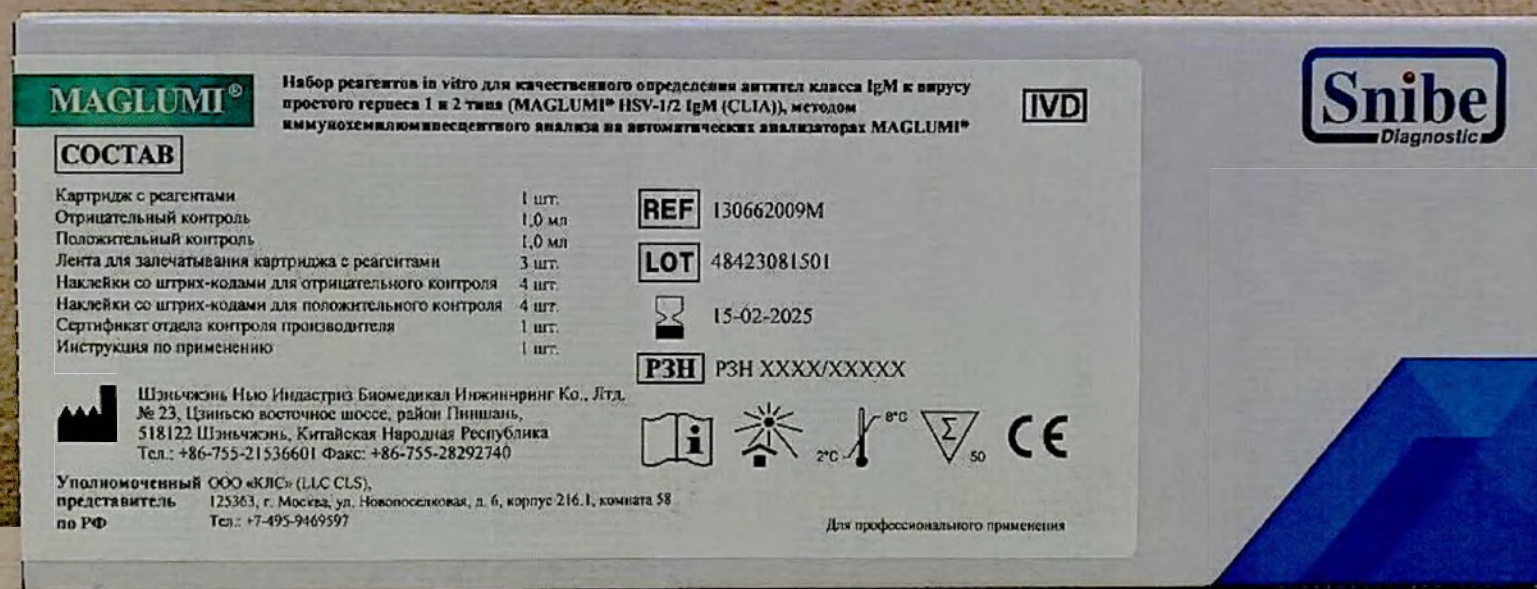

Макет маркировки потребительской упаковки

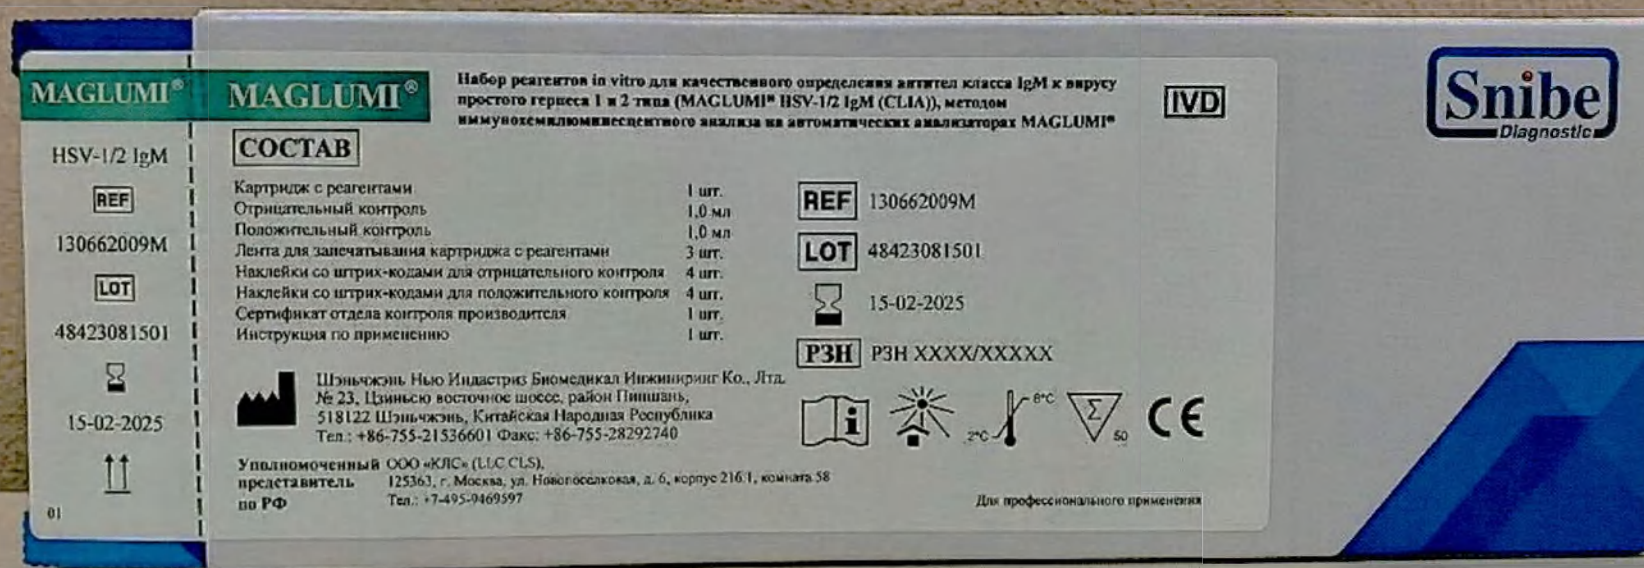

Вариант исполнения 3

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (MAGLUMI® HSV-1/2 IgM (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, 100 тестов, в составе:


Картридж с реагентами



Отрицательный контроль



Положительный контроль

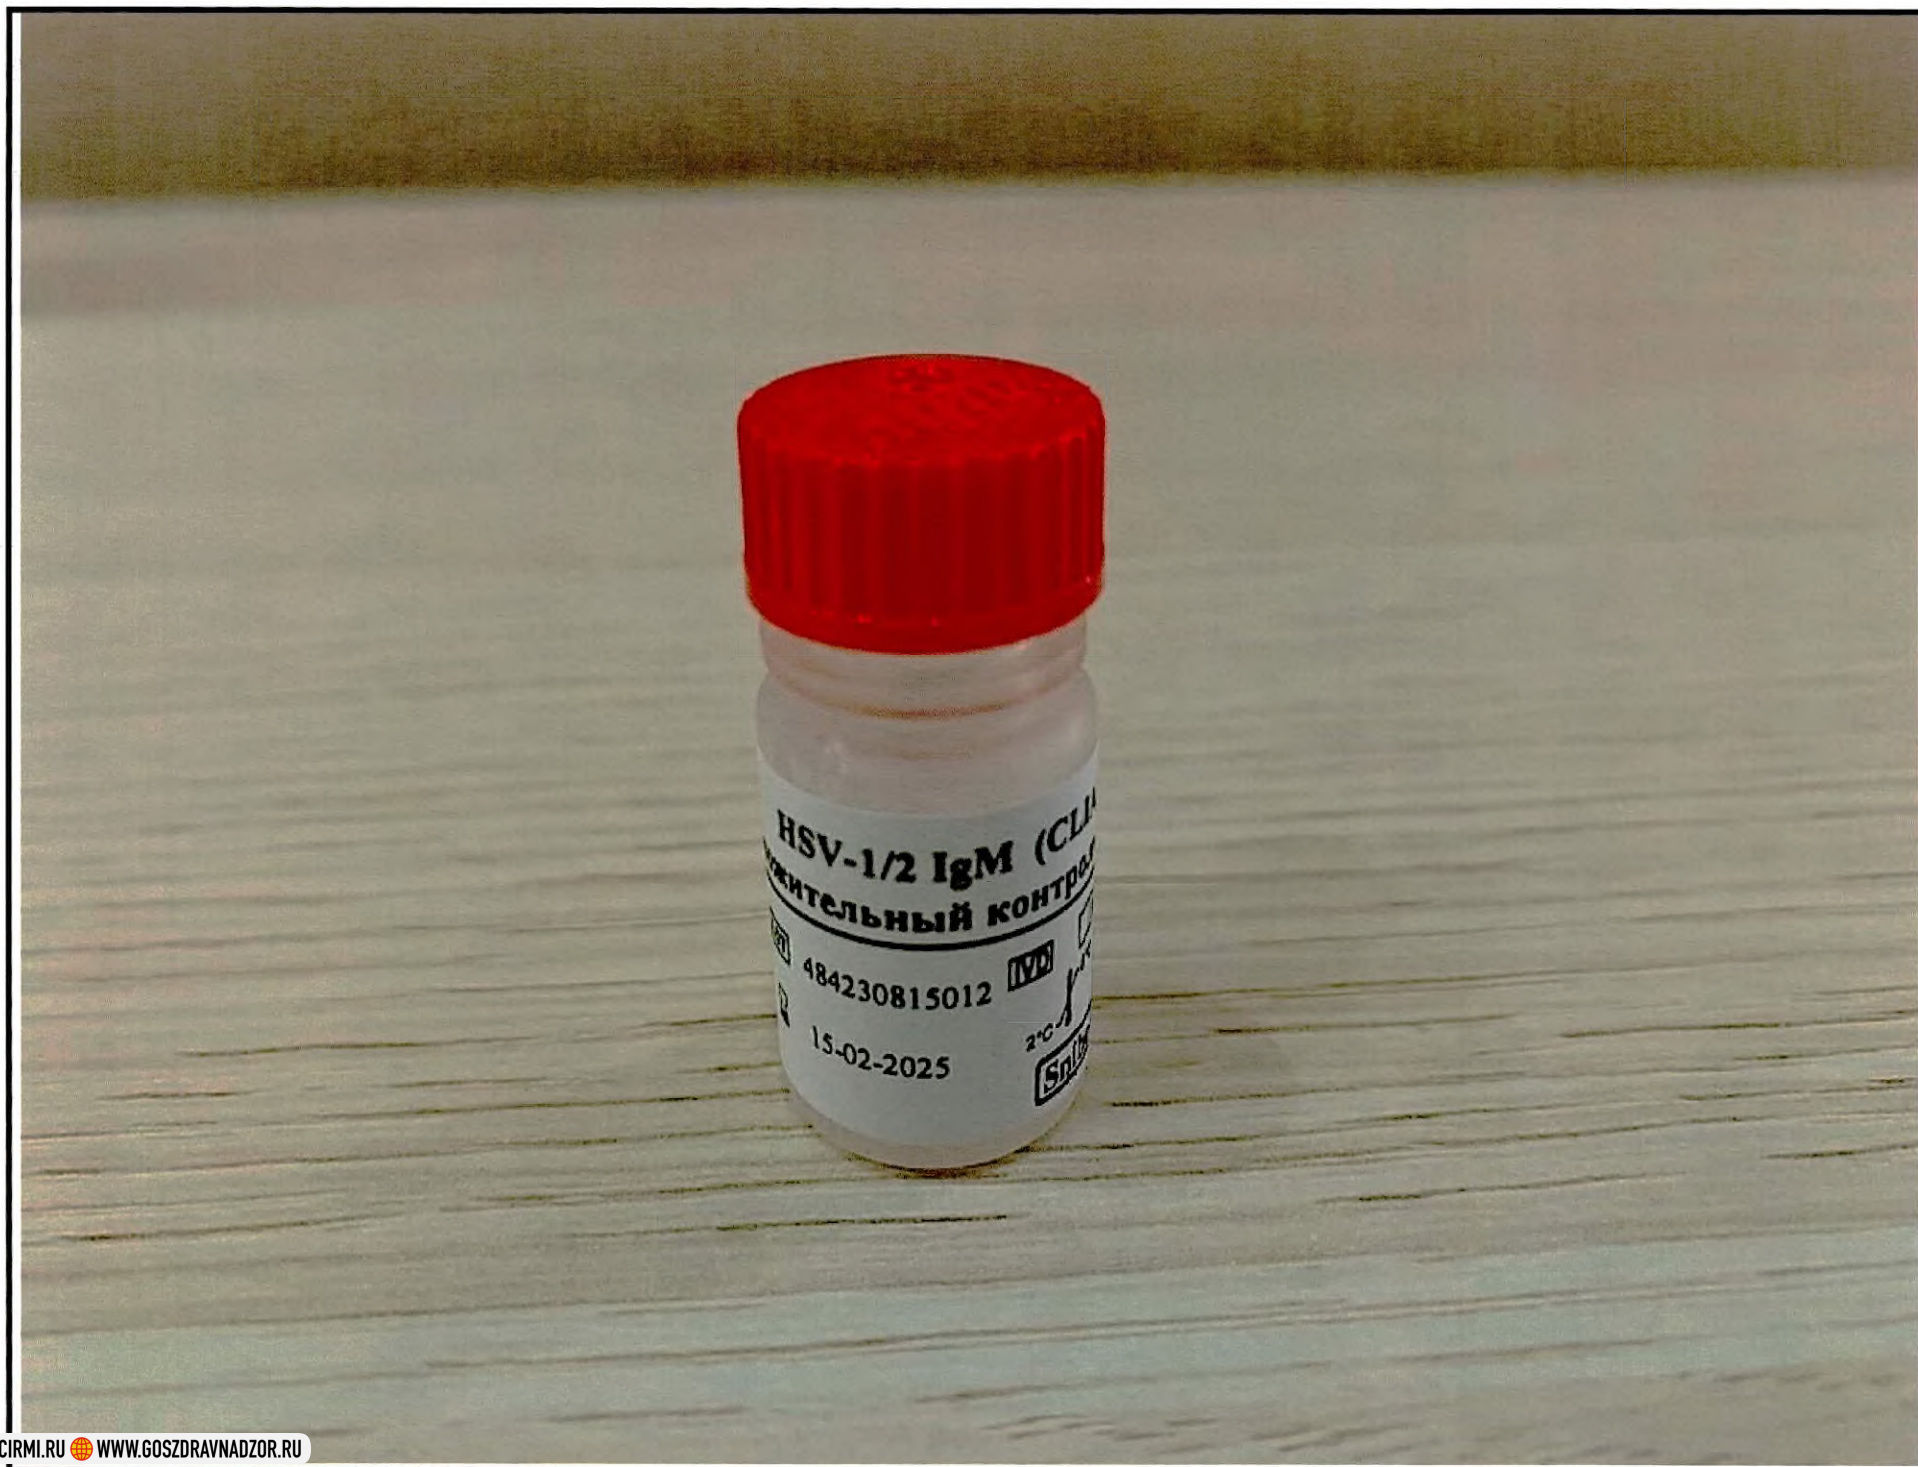

Лента для запечатывания картриджа с реагентами



Наклейки со штрих-кодами для отрицательного контроля





CERTIFICATE

Quality Inspector: 01

**Inspection Qualified & Approved
For Release**

**Shenzhen New Industries Biomedical
Engineering Co., Ltd.**



130262009M: 100 тестов
130662009M: 50 тестов
130762009M: 30 тестов


Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (MAGLUMI® HSV-1/2 IgM (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах MAGLUMI®, в вариантах исполнения


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов in vitro для качественного определения антител класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах MAGLUMI®. Результаты исследования предназначены для диагностики инфекции вируса простого герпеса, в комбинации с другими клиническими и лабораторными данными.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АНАЛИЗА

Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ), является одним из наиболее распространенных вирусных заболеваний, передающихся половым путем, во всем мире¹. ВПГ представляет собой вирус с двуспиральной ДНК и относится к семейству вирусов герпеса человека, официально известному как *Herpesviridae*². Вирус существует в 2 формах: ВПГ-1 и ВПГ-2. Два типа ВПГ отличаются антигенными

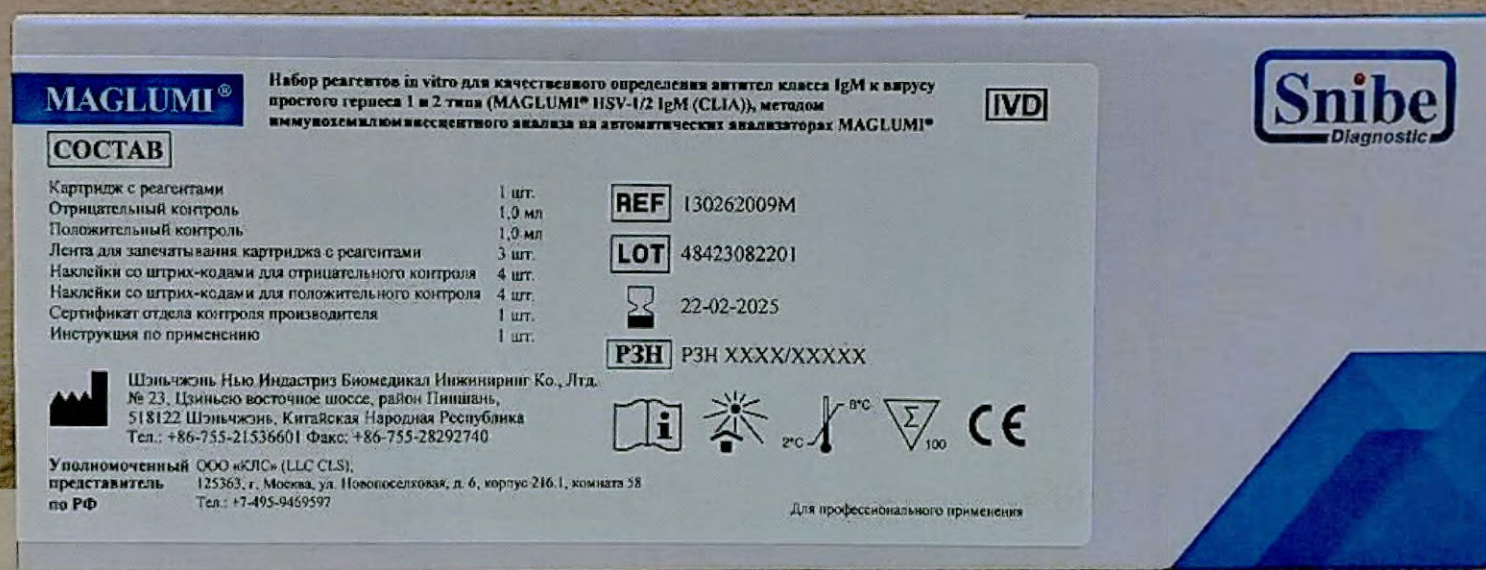

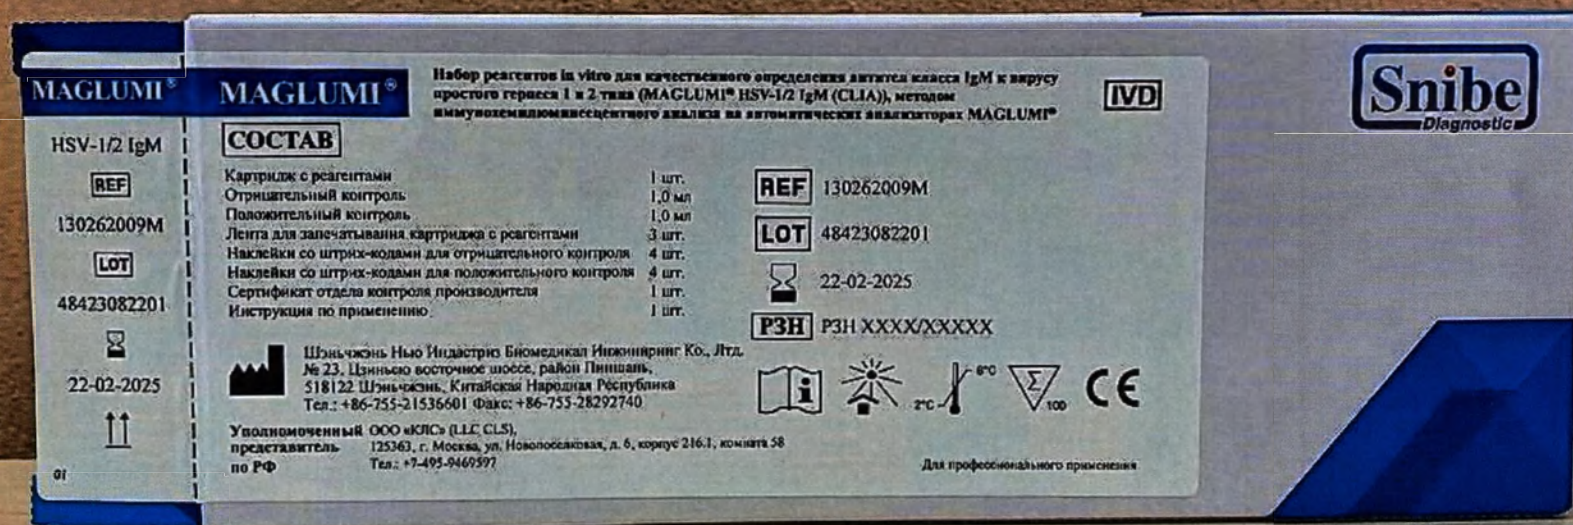

Всего прошнуровано и
скреплено 35 лист «ОВ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.

