


**Набор для катетеризации центральных вен
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023 в вариантах исполнения (далее – Набор)**

**Фотографические изображения Набора (с одним просветом)
на примере Варианта исполнения 1**


Набор для катетеризации центральных вен с одним просветом модели НКВЦ-1-20-13, диаметром 20G, длиной 13 см



Фотографические изображения Набора (с двумя просветами)

на примере Варианта исполнения 5


Набор для катетеризации центральных вен с двумя просветами модели НКВЦ-2-40-5, диаметром 4 Fr, длиной 5 см



Набор для катетеризации центральных вен с тремя просветами модели НКВЦ-3-70-15, диаметром 7 Fr, длиной 15 см




Набор для катетеризации центральных вен с одним просветом модели НКВЦ-1-20-13, диаметром 20G, длиной 13 см



Катетер с одним просветом




Катетер с двумя просветами






Проводник (стальной)

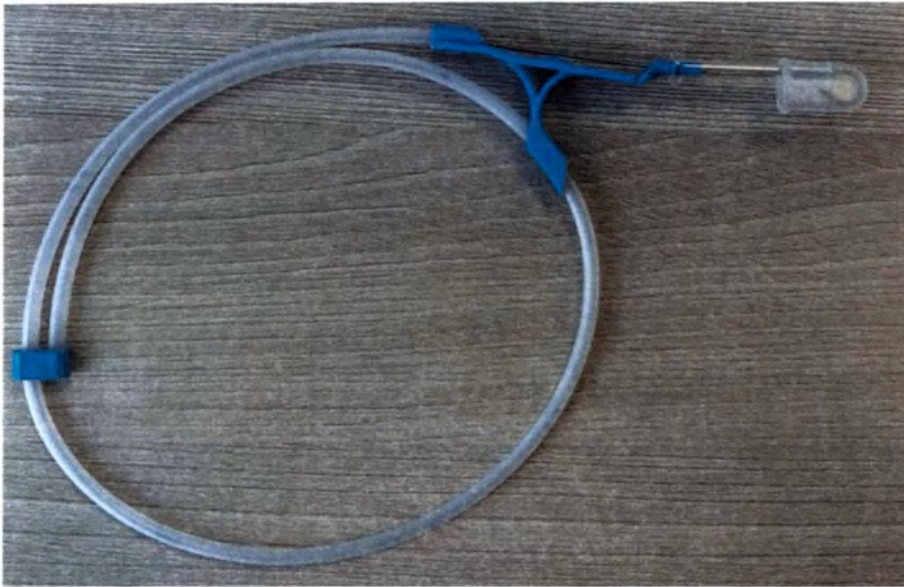

Проводник (нитиноловый)

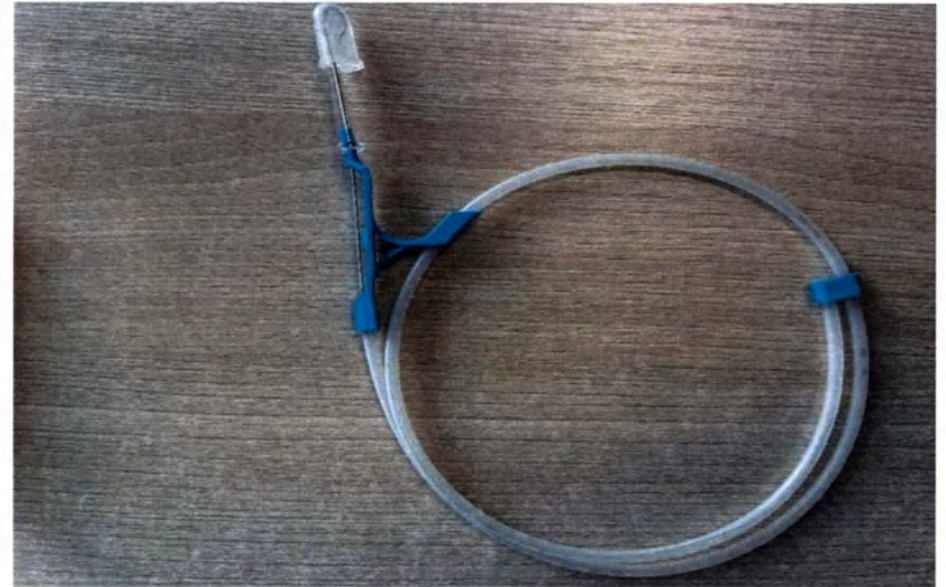

Расширитель тканей



Пункционная игла (Сельдингера)




Пункционная игла (Y-образная)



Зажим катетера



Заглушка Луер-Лок

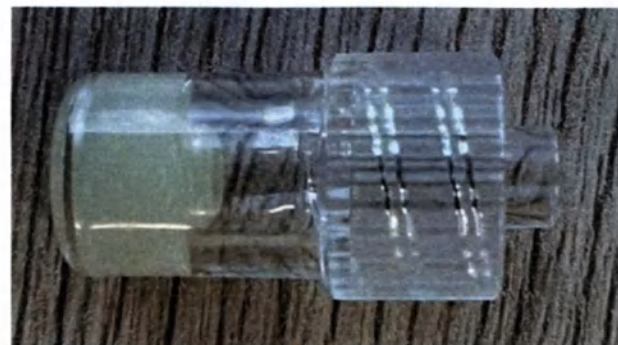

Съемный фиксатор мягкий



Съемный фиксатор жесткий



Скальпель



Шприц Раулersona





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 10 листов.

Генеральный директор
ООО «Пилот Групп»

Будаев Б.Б.

Маркировка индивидуальной упаковки

**Набор для катетеризации центральных вен
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023 в вариантах исполнения**

на примере Варианта исполнения 1 (с одним просветом)

**Набор для катетеризации центральных вен с одним просветом модели НКВЦ-1-20-13,
диаметром 20G, длиной 13 см**



**Набор для катетеризации центральных вен с
одним просветом модель НКВЦ-1-20-13,
диаметром 20G, длиной 13 см
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023**

В составе:

Катетер с одним просветом	- 1 шт
Проводник (стальной) или	
Проводник (нитиноловый), 0,53 мм x 60 см	- 1 шт
Расширитель тканей, 5 Fr	- 1 шт
Пункционная игла (Сальдингера) или	
Пункционная игла (У-образная), 20G, 38 мм	- 1 шт
Зажим катетера	- 1 шт
Заглушка Луер-Лок	- 1 шт
Съемный фиксатор (мягкий и жесткий)	- по 1 шт
Скальпель (при необходимости)	- 1 шт
Шприц Раулера (при необходимости)	- 1 шт
Инструкция по применению	- 1 шт

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

REF НКВЦ-1-20-13 

LOT 



STERILE



Не вводить катетер в правое предсердие или правый желудочек и не оставлять его там.
Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти пациента.

 **ООО «Пилот Групп»**

670000, Республика Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, зд.15, пом. CXLV
Тел.: +7 (964) 409 66 67 E-mail: info@pgmed.ru

Место производства:

Пейан Таргет Медикал Текнолоджис Инк. (Beijing Target Medical Technologies, Inc.)
No.60, Shunren Rd., Shunyi District, 101300 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Маркировка транспортной упаковки

Набор для катетеризации центральных вен
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023 в вариантах исполнения

на примере Варианта исполнения 1 (с одним просветом)

Набор для катетеризации центральных вен с одним просветом модели НКВЦ-1-20-13,
диаметром 20G, длиной 13 см



Набор для катетеризации центральных вен с
одним просветом модель НКВЦ-1-20-13,
диаметром 20G, длиной 13 см
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023

В составе:

Катетер с одним просветом	- 1 шт
Проводник (стальной) или	
Проводник (нитиноловый), 0,53 мм x 60 см	- 1 шт
Расширитель тканей, 5 Fr	- 1 шт
Пункционная игла (Сельдингера) или	
Пункционная игла (Y-образная), 20G, 38 мм	- 1 шт
Зажим катетера	- 1 шт
Заглушка Луер-Лок	- 1 шт
Съемный фиксатор (мягкий и жесткий)	- по 1 шт
Скальпель (при необходимости)	- 1 шт
Шприц Раулера (при необходимости)	- 1 шт
Инструкция по применению	- 1 шт

Регистрационное удостоверение №

от


REF НКВЦ-1-20-13



LOT



50 штук



STERILEEO



Не вводить катетер в правое предсердие или правый желудочек и не оставлять его там.
Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти пациента.



ООО «Пилот Групп»

670000, Республика Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, зд.15, пом. CXLV
Тел.: +7 (964) 409 86 67 E-mail: info@pgmed.ru

Место производства:

Пекин Таргет Медикал Технолоджис Инк. (Beijing Target Medical Technologies, Inc.)
No.60, Shuren Rd., Shunyi District, 101300 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Маркировка индивидуальной упаковки

**Набор для катетеризации центральных вен
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023 в вариантах исполнения**

на примере Варианта исполнения 5 (с двумя просветами)

**Набор для катетеризации центральных вен с двумя просветами модели НКВЦ-2-40-5,
диаметром 4 Fr, длиной 5 см**



Набор для катетеризации центральных вен с
двумя просветами модель НКВЦ-2-40-5,
диаметром 4 Fr, длиной 5 см
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023

В составе:

Катетер с двумя просветами	- 1 шт
Проводник (стальной) или	
Проводник (нитиноловый), 0,53 мм x 60 см	- 1 шт
Расширитель тканей, 5 Fr	- 1 шт
Пункционная игла (Сельдингера) или	
Пункционная игла (Y-образная), 20G, 38 мм	- 1 шт
Зажим катетера	- 2 шт
Заглушка Луер-Лок	- 2 шт
Съемный фиксатор (мягкий и жесткий)	- по 1 шт
Скальпель (при необходимости)	- 1 шт
Шприц Раулера (при необходимости)	- 1 шт
Инструкция по применению	- 1 шт


Регистрационное удостоверение №

от

REF НКВЦ-2-40-5



LOT



STERILEEO



Не вводить катетер в правое предсердие или правый желудочек и не оставлять его там.
Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти пациента.



ООО «Пилот Групп»

670000, Республика Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, зд.15, пом. СХЛV
Тел.: +7 (964) 409 86 67 E-mail: info@pgmed.ru

Место производства:

Пекин Target Медикал Технолоджис Инк. (Beijing Target Medical Technologies, Inc.)
No.60, Shunren Rd., Shunyi District, 101300 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Маркировка транспортной упаковки

Набор для катетеризации центральных вен
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023 в вариантах исполнения

на примере Варианта исполнения 5 (с двумя просветами)

Набор для катетеризации центральных вен с двумя просветами модели НКВЦ-2-40-5,
диаметром 4 Fr, длиной 5 см



Набор для катетеризации центральных вен с
двумя просветами модель НКВЦ-2-40-5,
диаметром 4 Fr, длиной 5 см
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023

В составе:

Катетер с двумя просветами	- 1 шт
Проводник (стальной) или	
Проводник (нитиноловый), 0,53 мм x 60 см	- 1 шт
Расширитель тканей, 5 Fr	- 1 шт
Пункционная игла (Сельдингера) или	
Пункционная игла (Y-образная), 20G, 38 мм	- 1 шт
Зажим катетера	- 2 шт
Заглушка Луер-Лок	- 2 шт
Съемный фиксатор (мягкий и жесткий)	- по 1 шт
Скальпель (при необходимости)	- 1 шт
Шприц Раулера (при необходимости)	- 1 шт
Инструкция по применению	- 1 шт

Регистрационное удостоверение №

от

REF НКВЦ-2-40-5



LOT



50 штук



STERILE EO



Не вводить катетер в правое предсердие или правый желудочек и не оставлять его там.
Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти пациента.



ООО «Пилот Групп»

670000, Республика Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, зд.15, пом. CXLV

Тел.: +7 (964) 409 86 67

E-mail: info@pgmed.ru

Место производства:

Пекинг Target Медикал Технолоджис Инк. (Beijing Target Medical Technologies, Inc.)

No.60, Shunren Rd., Shunyi District, 101300 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Маркировка индивидуальной упаковки
Набор для катетеризации центральных вен
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023 в вариантах исполнения

на примере Варианта исполнения 8 (с тремя просветами)
Набор для катетеризации центральных вен с тремя просветами модели НКВЦ-3-70-15,
диаметром 7 Fr, длиной 15 см



Набор для катетеризации центральных вен с
тремя просветами модель НКВЦ-3-70-15,
диаметром 7 Fr, длиной 15 см
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023


В составе:

Катетер с тремя просветами	- 1 шт
Проводник (стальной) или	
Проводник (нитиноловый), 0,89 мм x 60 см	- 1 шт
Расширитель тканей, 8 Fr	- 1 шт
Пункционная игла (Сельдингера) или	
Пункционная игла (Y-образная), 18G, 70 мм	- 1 шт
Зажим катетера	- 3 шт
Заглушка Луер-Лок	- 3 шт
Съемный фиксатор (мягкий и жесткий)	- по 1 шт
Скальпель (при необходимости)	- 1 шт
Шприц Раулера (при необходимости)	- 1 шт
Инструкция по применению	- 1 шт

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

REF НКВЦ-3-70-15

LOT



STERILE EO



Не вводить катетер в правое предсердие или правый желудочек и не оставлять его там.
Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти пациента.



ООО «Пилот Групп»

670000, Республика Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, зд.15, пом. CXLV

Тел.: +7 (964) 409 86 67

E-mail: info@pgmed.ru

Место производства:

Пекин Target Медикал Технолоджис Инк. (Beijing Target Medical Technologies, Inc.)

No.60, Shunren Rd., Shunyi District, 101300 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Маркировка транспортной упаковки

**Набор для катетеризации центральных вен
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023 в вариантах исполнения**

на примере Варианта исполнения 8 (с тремя просветами)

**Набор для катетеризации центральных вен с тремя просветами модели НКВЦ-3-70-15,
диаметром 7 Fr, длиной 15 см**



**Набор для катетеризации центральных вен с
тремя просветами модель НКВЦ-3-70-15,
диаметром 7 Fr, длиной 15 см
по ТУ 32.50.13-002-90031004-2023**

В составе:

Катетер с тремя просветами	- 1 шт
Проводник (стальной) или	
Проводник (нитиноловый), 0,89 мм x 60 см	- 1 шт
Расширитель тканей, 8 Fr	- 1 шт
Пункционная игла (Сельдингера) или	
Пункционная игла (У-образная), 18G, 70 мм	- 1 шт
Зажим катетера	- 3 шт
Заглушка Луер-Лок	- 3 шт
Съемный фиксатор (мягкий и жесткий)	- по 1 шт
Скальпель (при необходимости)	- 1 шт
Шприц Раулера (при необходимости)	- 1 шт
Инструкция по применению	- 1 шт

Регистрационное удостоверение №

от

REF НКВЦ-3-70-15



LOT



50 штук



STERILE



Не вводить катетер в правое предсердие или правый желудочек и не оставлять его там.
Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезной травме или смерти пациента.



ООО «Пилот Групп»

670000, Республика Бурятия, г.о. город Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Балтасянова, зд.15, пом. СХ.У

Тел.: +7 (964) 409 86 67

E-mail: info@pgmed.ru

Место производства:

Павел Таргет Медицинские Технологии Инк. (Beijing Target Medical Technologies, Inc.)

No.80, Shuang Rd, Shuang District, 10000 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листов.

Генеральный директор
ООО «Пилот Групп»

Будаев Б.Б.

