

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ЮНИТОН»

Головнева В.А.

«28» Марта 2024 г



Макеты маркировки медицинского изделия
Игла-бабочка для вливания в малые вены в вариантах исполнения


Производитель: «Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.», Китай /
«Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.», China

Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian County, Nanchang City, Jiangxi Province, China,
Китай

2024

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**
Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм),
TW, длина магистрали 30 см
Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Количество в упаковке: 1 шт.
Не использовать по истечении срока годности.

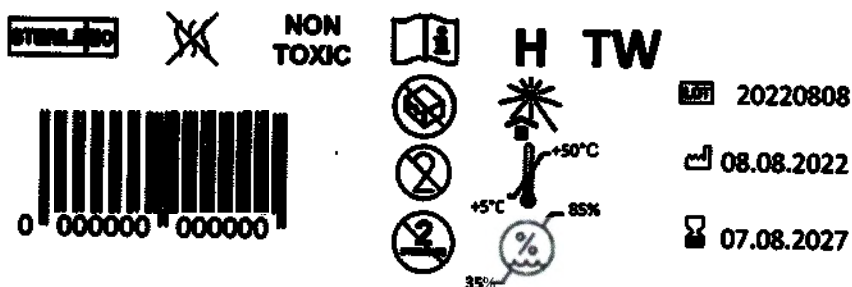

«Джингси Хонгда Медикал Инвонмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/terral

Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1,
офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Рисунок 1 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».

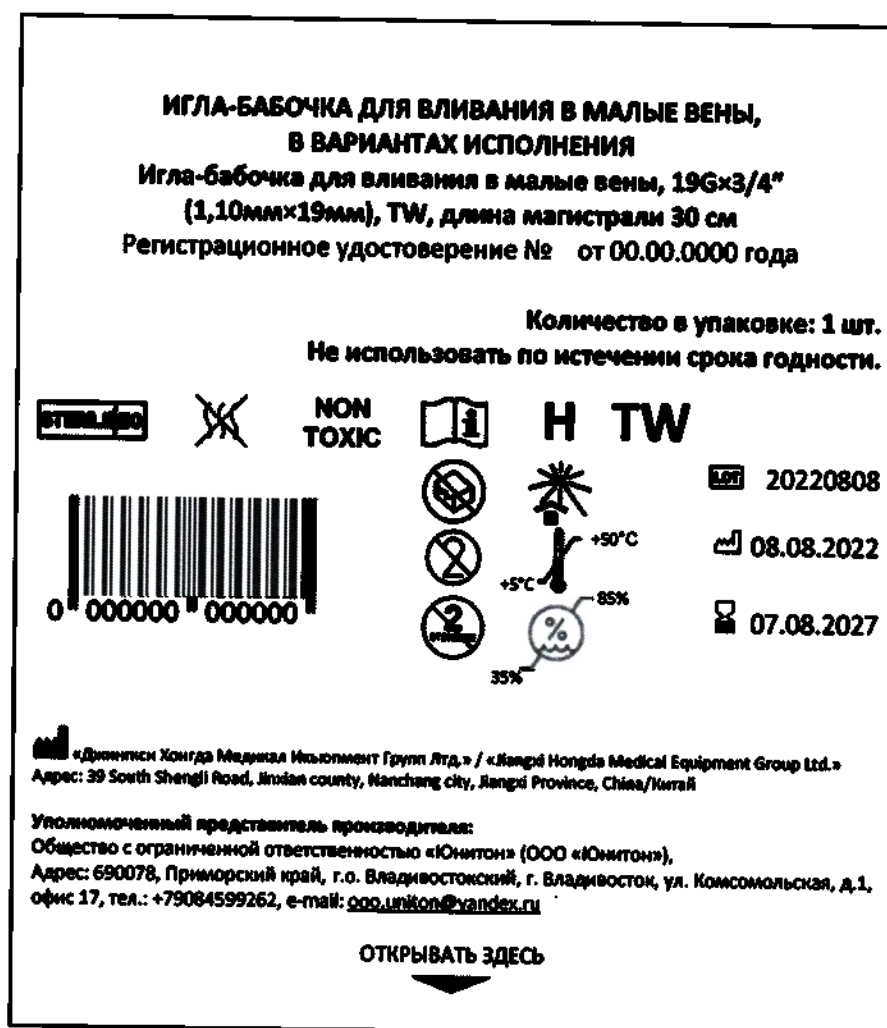


Рисунок 2 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».



Рисунок 3 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4" (0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».

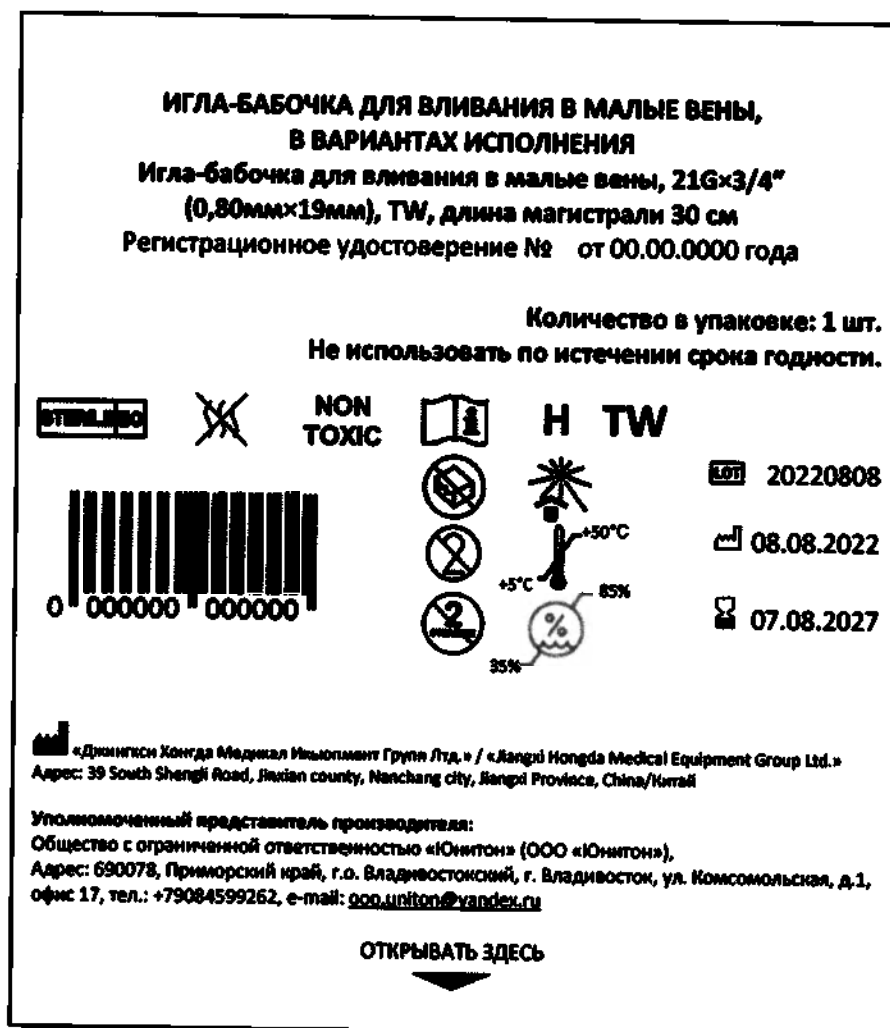


Рисунок 4 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4" (0,80мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».



Рисунок 5 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4" (0,70мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».



Рисунок 6 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 23G×3/4" (0,60мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».



Рисунок 7 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 24G×3/4" (0,55мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

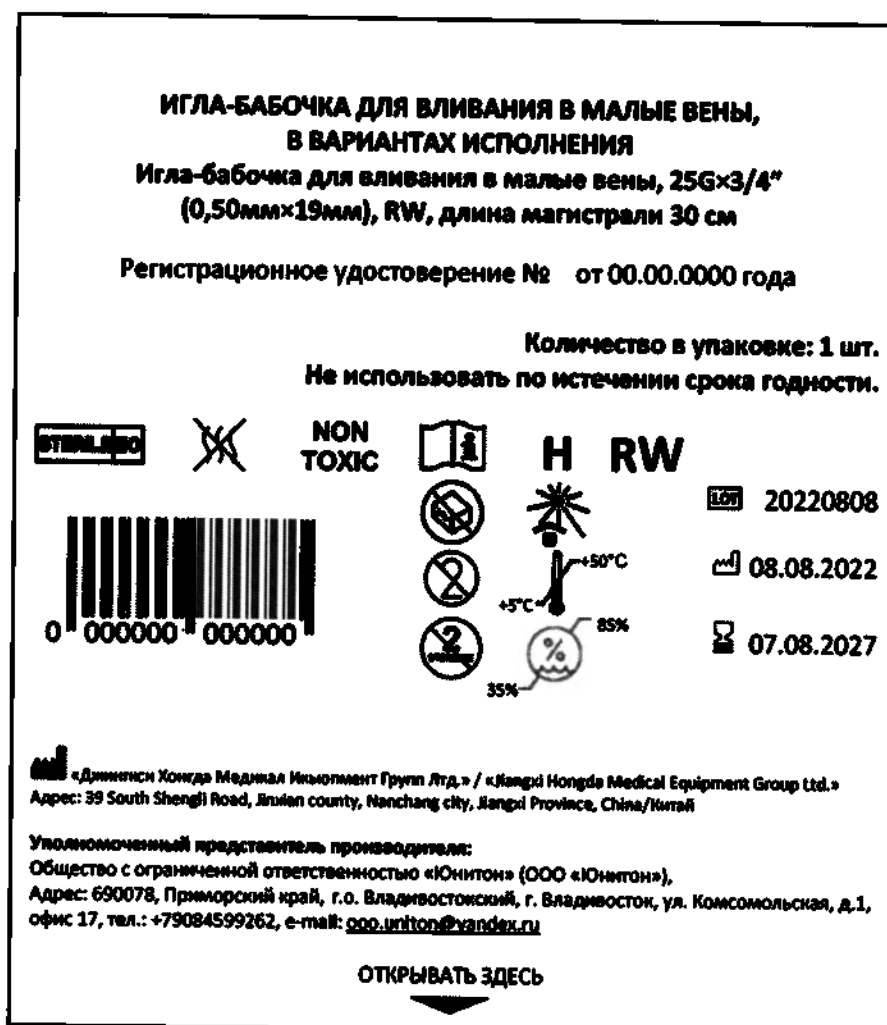


Рисунок 8 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».



Рисунок 9 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».



Рисунок 10 – Макет маркировки индивидуальной упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 100 штук Не использовать по истечении срока годности. NON TOXIC H TW «Джингси Хонгда Медикал Иньюмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см 0 000000 000000 LOT 20220808 08.08.2022 07.08.2027	Инструкция по применению: Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов. -Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску. -Заполните систему для инфузий, переверните флакон и закрепите на штативе. -Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха. -Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску. -Вскройте упаковку с катетером. -Под конечность пациента подложите валик, наложите иглу поверх тонкой одежды или салфетки. -Проверьте пульс ниже места наложения иглы. -Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру. При введении в локтевую вену пациенту предлагают сжать кулак. -Выберите место для введения. -Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место. -Присоедините изделие к инфузионной системе и дождитесь появления капли раствора. -Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок. -Нажмите кончик чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену. -Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови. -Левой рукой ослабьте и снимите иглу. Откройте зажим на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене. - Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем. Отрегулируйте скорость введения раствора. Наблюдайте пациента в течение 30 минут. Требования утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях. Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см 0 000000 000000 LOT 20220808 08.08.2022 07.08.2027
---	---	--	---

Рисунок 11 – Макет маркировки групповой упаковки для варианта исполнения
«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».



ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 100 штук Не использовать по истечении срока годности.   NON TOXIC H TW «Джингси Хонгда Медикал Эквипмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.yuniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см   20220808  08.08.2022  07.08.2027	Инструкция по применению: Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов. -Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску. -Заполните систему для инфузий, переверните флакон и закрепите на штативе. -Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха. -Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску. -Вскройте упаковку с катетером. -Под конечность пациента подложите валик, наложите жгут поверх тонкой одежды или салфетки. -Проверьте пульс ниже места наложения жгута. -Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру. При введении в локтевую вену пациенту предлагают сжать кулак. -Выберите место для введения. -Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место. -Присоедините изделие к инфузионной системе и дождитесь появления капли раствора. -Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок. -Напните кожу чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену. -Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови. -Левой рукой ослабьте и снимите жгут. Откройте зажим на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене. -Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем. Отрегулируйте скорость введения раствора. Наблюдайте пациента в течение 30 минут. Требования утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях. Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см   20220808  08.08.2022  07.08.2027
--	--	---	---

Рисунок 12 – Макет маркировки групповой упаковки для варианта исполнения
«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».

ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4" (0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 100 штук Не использовать по истечении срока годности.   NON TOXIC H TW «Джингси Хонгда Медикал Эквипмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: goo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4" (0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027	Инструкция по применению: Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов. -Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску. -Заполните систему для инфузий, переверните флакон и закрепите на штативе. -Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха. -Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску. -Вскройте упаковку с катетером. -Под конечность пациента подложите валик, наложите жгут поверх тонкой одежды или салфетки. -Проверьте пульс ниже места наложения жгута. -Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру. При введении в локтевую вену пациенту предлагают спать кулак. -Выберите место для введения. -Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место. -Присоедините изделие к инфузионной системе и дождитесь появления капля раствора. -Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок. -Нажмите кожу чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену. -Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови. -Левой рукой ослабьте и снимите жгут. Откройте замок на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене. -Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем. Отрегулируйте скорость введения раствора. Наблюдайте пациента в течение 30 минут. Требования утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях. Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4" (0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027
---	---	--	--

**Рисунок 13 – Макет маркировки групповой упаковки для варианта исполнения
«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4" (0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».**

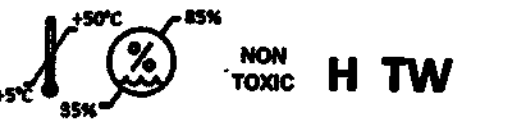
ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4" (0,80мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 100 штук Не использовать по истечении срока годности.   «Джингси Хонгда Медикал Эквипмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Nixian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4" (0,80мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027	Инструкция по применению: Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов. -Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску. -Заполните систему для инфузий, проверните флакон и закрепите на штативе. -Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха. -Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску. -Вскройте упаковку с катетером. -Под конечность пациента подложите валик, наложите жгут поверх тонкой одежды или салфетки. -Проверьте пульс ниже места наложения жгута. -Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру. При введении в локтевую вену пациенту предлагают сжать кулак. -Выберите место для введения. -Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место. -Присоедините изделие к инфузионной системе и дождитесь появления капли раствора. -Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок. -Нажмите кожу чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену. -Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови. -Левой рукой ослабьте и снимите жгут. Откройте зажим на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене. -Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем. -Отрегулируйте скорость введения раствора. -Наблюдайте пациента в течение 30 минут. Требования утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях. Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4" (0,80мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027
--	---	--	--

Рисунок 14 – Макет маркировки групповой упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4" (0,80мм×19мм). TW, длина магистрали 30 см».


ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4" (0,70мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 100 штук Не использовать по истечении срока годности.   «Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4" (0,70мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027	Инструкция по применению: Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов. -Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску. -Заполните систему для инфузий, переверните флакон и закрепите на штативе. -Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха. -Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску. -Вскройте упаковку с катетером. -Под конечность пациента подложите валик, наложите жгут поверх тонкой одежды или салфетки. -Проверьте пульс ниже места наложения жгута. -Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру. При введении в локтевую вену пациенту предлагают снять кулак. -Выберите место для введения. -Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место. -Присоедините изделие к инфузионной системе и дождитесь появления капли раствора. -Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок. -Напните кожу чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену. -Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови. -Левой рукой ослабьте и снимите жгут. Откройте зажим на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене. -Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем. -Отрегулируйте скорость введения раствора. -Наблюдайте пациента в течение 30 минут. Требования утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях. Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4" (0,70мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027
--	---	---	--

Рисунок 15 – Макет маркировки групповой упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4" (0,70мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».


Игла-бабочка для вливания в малые вены, 23Gx3/4"
(0,60mmx19mm), TW, длина магистрали 30 см
Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Не использовать по истечении срока годности.



**NON
TOXIC H TW**

Общество с ограниченной ответственностью «Юнистон» (ООО «Юнистон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Комсомольская, д.1, офис 17,
тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniston@yandex.ru



07.08.2027

«Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.

Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

(0,60mm×19mm), TW, длина
магистралей 30 см




07.08.2027

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 24Gx3/4"
(0,55mmx19mm), RW, длина магистрали 30 см
Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года



Не использовать по истечении срока годности.



**NON
TOXIC**

H RW


Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Комсомольская, д.1, офис 17,
тел.: +7904599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru

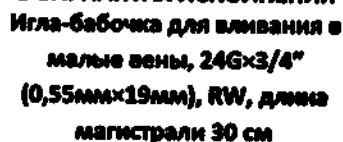

После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.

Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

**Игла-бабочка для вливания в
малые вены, 24Gx3/4"
(0,55ммx19мм), RW, длина
магистралы 30 см**



«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 24G×3/4" (0,55мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

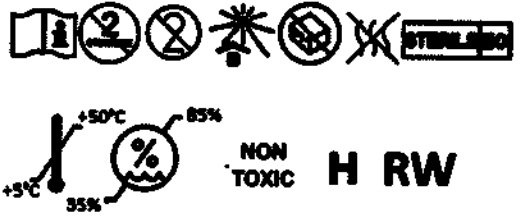
ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 100 штук Не использовать по истечении срока годности.  «Джингси Хонгда Медикал Импормент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027	Инструкция по применению: Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов. -Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску. -Заполните систему для инфузий, проверните флакон и закрепите на штативе. -Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха. -Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску. -Вскройте упаковку с катетером. -Под конечность пациента подложите валик, наложите жгут поверх тонкой одежды или салфетки. -Проверьте пульс ниже места наложения жгута. -Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру. При введении в локтевую вену пациенту предлагают сжать кулак. -Выберите место для введения. -Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место. -Присоедините наделение к инфузионной системе и дождитесь появления капли раствора. -Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок. -Нажмите кожу чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену. -Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови. -Левой рукой ослабьте и снимите жгут. Откройте зажим на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене. -Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем. Отрегулируйте скорость введения раствора. Наблюдайте пациента в течение 30 минут. Требования утилизации: После применения наделения по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях. Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027
--	---	---	--

Рисунок 18 – Макет маркировки групповой упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».



ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 100 штук Не использовать по истечении срока годности.   «Джэнгис Хонгда Медикал Импломент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Nixian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Kитай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@vandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027	Инструкция по применению: Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов. -Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску. -Заполните систему для инфузий, проверните флакон и закрепите на штативе. -Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха. -Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску. -Вскройте упаковку с катетером. -Под конечность пациента подложите валик, наложите жгут поверх тонкой одежды или салфетки. -Проверьте пульс ниже места наложения жгута. -Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру. При введении в локтевую вену пациенту предлагают сжать кулак. -Выберите место для введения. -Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место. -Присоедините изделие к инфузионной системе и дождитесь появления капли раствора. -Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок. -Нажмите кожу чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену. -Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови. -Левой рукой ослабьте и снимите жгут. Откройте зажим на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене. -Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем. Отрегулируйте скорость введения раствора. Наблюдайте пациента в течение 30 минут. Требования утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях. Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027
---	---	--	--

Рисунок 19 – Макет маркировки групповой упаковки для варианта исполнения

«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 100 штук Не использовать по истечении срока годности.   «Дингхиси Хонгда Медикал Икспломент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jindan county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.yuniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027	Инструкция по применению: Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов. -Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску. -Заполните систему для инфузий, проверните флакон и закрепите на штативе. -Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха. -Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску. -Вскройте упаковку с катетером. -Под конечность пациента подложите валик, наложите жгут поверх тонкой одежды или салфетки. -Проверьте пульс ниже места наложения жгута. -Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру. При введении в локтевую вену пациенту предлагают сжать кулак. -Выберите место для введения. -Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место. -Присоедините изделие к инфузионной системе и дождитесь появления капли раствора. -Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок. -Натяните кожу чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену. -Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови. -Левой рукой ослабьте и снимите жгут. Откройте зажим на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене. -Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем. Отрегулируйте скорость введения раствора. Наблюдайте пациента в течение 30 минут. Требования утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях. Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см  20220808 08.08.2022 07.08.2027
--	---	---	--

Рисунок 20 – Макет маркировки групповой упаковки для варианта исполнения «Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 2000 штук Не использовать по истечении срока годности.          «Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см     Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.   20220808  08.08.2022  07.08.2027
--	---

**Рисунок 21 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения
«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».**


ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 2000 штук Не использовать по истечении срока годности.             «Джингси Хонгда Медикал Импормент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Kитай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см     Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.   20220808  08.08.2022  07.08.2027
--	--

Рисунок 22 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения
«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».



ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4" (0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 2000 штук Не использовать по истечении срока годности.         «Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4" (0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см     Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.  0 000000 000000  20220808  08.08.2022  07.08.2027
--	--

Рисунок 23 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения
«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4" (0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4" (0,80мм×19мм),
TW, длина магистрали 30 см

Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Количество: 2000 штук

Не использовать по истечении срока годности.



«Джингси Хонгда Медикал Иквипмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай
Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17,
тел.: +79084599262, e-mail: ooo.unikon@yandex.ru

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4" (0,80мм×19мм),
TW, длина магистрали 30 см



Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.



20220808

08.08.2022

07.08.2027

Рисунок 24 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения

«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4" (0,80мм×19мм). TW, длина магистрали 30 см».

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4" (0,70мм×19мм),
TW, длина магистрали 30 см

Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Количество: 2000 штук


Не использовать по истечении срока годности.



«Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай
Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17,
тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4" (0,70мм×19мм),
TW, длина магистрали 30 см

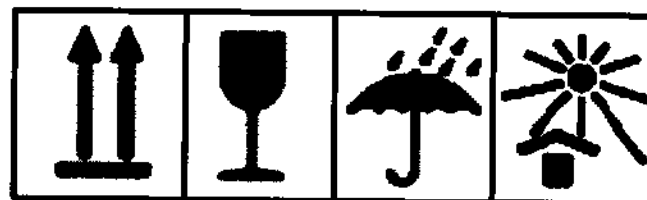

Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть
утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные
отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.



20220808

08.08.2022

07.08.2027

Рисунок 25 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения

«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4" (0,70мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 23G×3/4" (0,60мм×19мм),
TW, длина магистрали 30 см
Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Количество: 2000 штук


Не использовать по истечении срока годности.



«Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай
Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.2, офис 17,
тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 23G×3/4" (0,60мм×19мм),
TW, длина магистрали 30 см

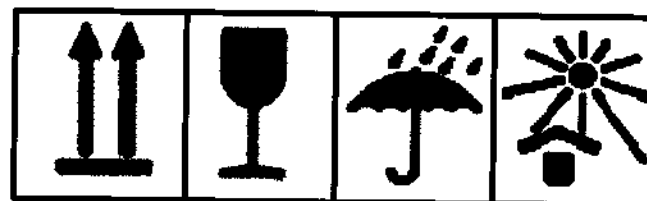

Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.



20220808
08.08.2022
07.08.2027

Рисунок 26 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения

«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 23G×3/4" (0,60мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см».



ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 24G×3/4" (0,55мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года Количество: 2000 штук Не использовать по истечении срока годности. RW        NON TOXIC «Джингси Хонгда Медикал Икьюипмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.» Адрес: 39 South Shengli Road, Jindan county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай Уполномоченный представитель производителя: Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»), Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru	ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ Игла-бабочка для вливания в малые вены, 24G×3/4" (0,55мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см     Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.  0 000000 000000  20220808  08.08.2022  07.08.2027
--	---

Рисунок 27 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения
«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 24G×3/4" (0,55мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50мм×19мм),
RW, длина магистрали 30 см
Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Количество: 2000 штук


Не использовать по истечении срока годности.



«Джунгси Хонгда Медикал Иквипмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай
Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17,
тел.: +79084599262, e-mail: ooo.yunikon@yandex.ru

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50мм×19мм),
RW, длина магистрали 30 см

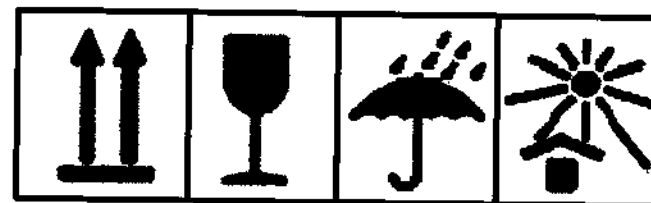

Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.



20220808

08.08.2022

07.08.2027

Рисунок 28 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения

«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19мм),
RW, длина магистрали 30 см

Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Количество: 2000 штук

Не использовать по истечении срока годности.



«Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shangji Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай
Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17,
тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19мм),
RW, длина магистрали 30 см



Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.



20220808

08.08.2022

07.08.2027

Рисунок 29 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения

«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19мм),
RW, длина магистрали 30 см
Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Количество: 2000 штук

Не использовать по истечении срока годности.



«Джингиси Хонгда Медикал Импормент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shengli Road, Jindan county, Nanchang city, Jiangxi Province, China/Китай
Уполномоченный представитель производителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д.1, офис 17,
тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19мм),
RW, длина магистрали 30 см



Требования к утилизации: После применения изделия по назначению оно должно быть
утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные
отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.



20220808

08.08.2022

07.08.2027

Рисунок 30 – Макет маркировки транспортной упаковки для варианта исполнения

«Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см».

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

31 лист

Генеральный Директор

ООО «ЮНИТОН»

В.А. Головнева Головнева В.А.



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ООО «ЮНИТОН»

Головнева В.А.

« 28 » марта 2024

**Фотографические изображения медицинского изделия
Игла-бабочка для вливания в малые вены в вариантах исполнения**


Производитель: «Джингкси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.», Китай /
«Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.», China

Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian County, Nanchang City, Jiangxi Province,
China, Китай

2024



Фотографическое изображение 1- Игла-бабочка для вливания в малые вены, 18G×3/4" (1,20мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см;

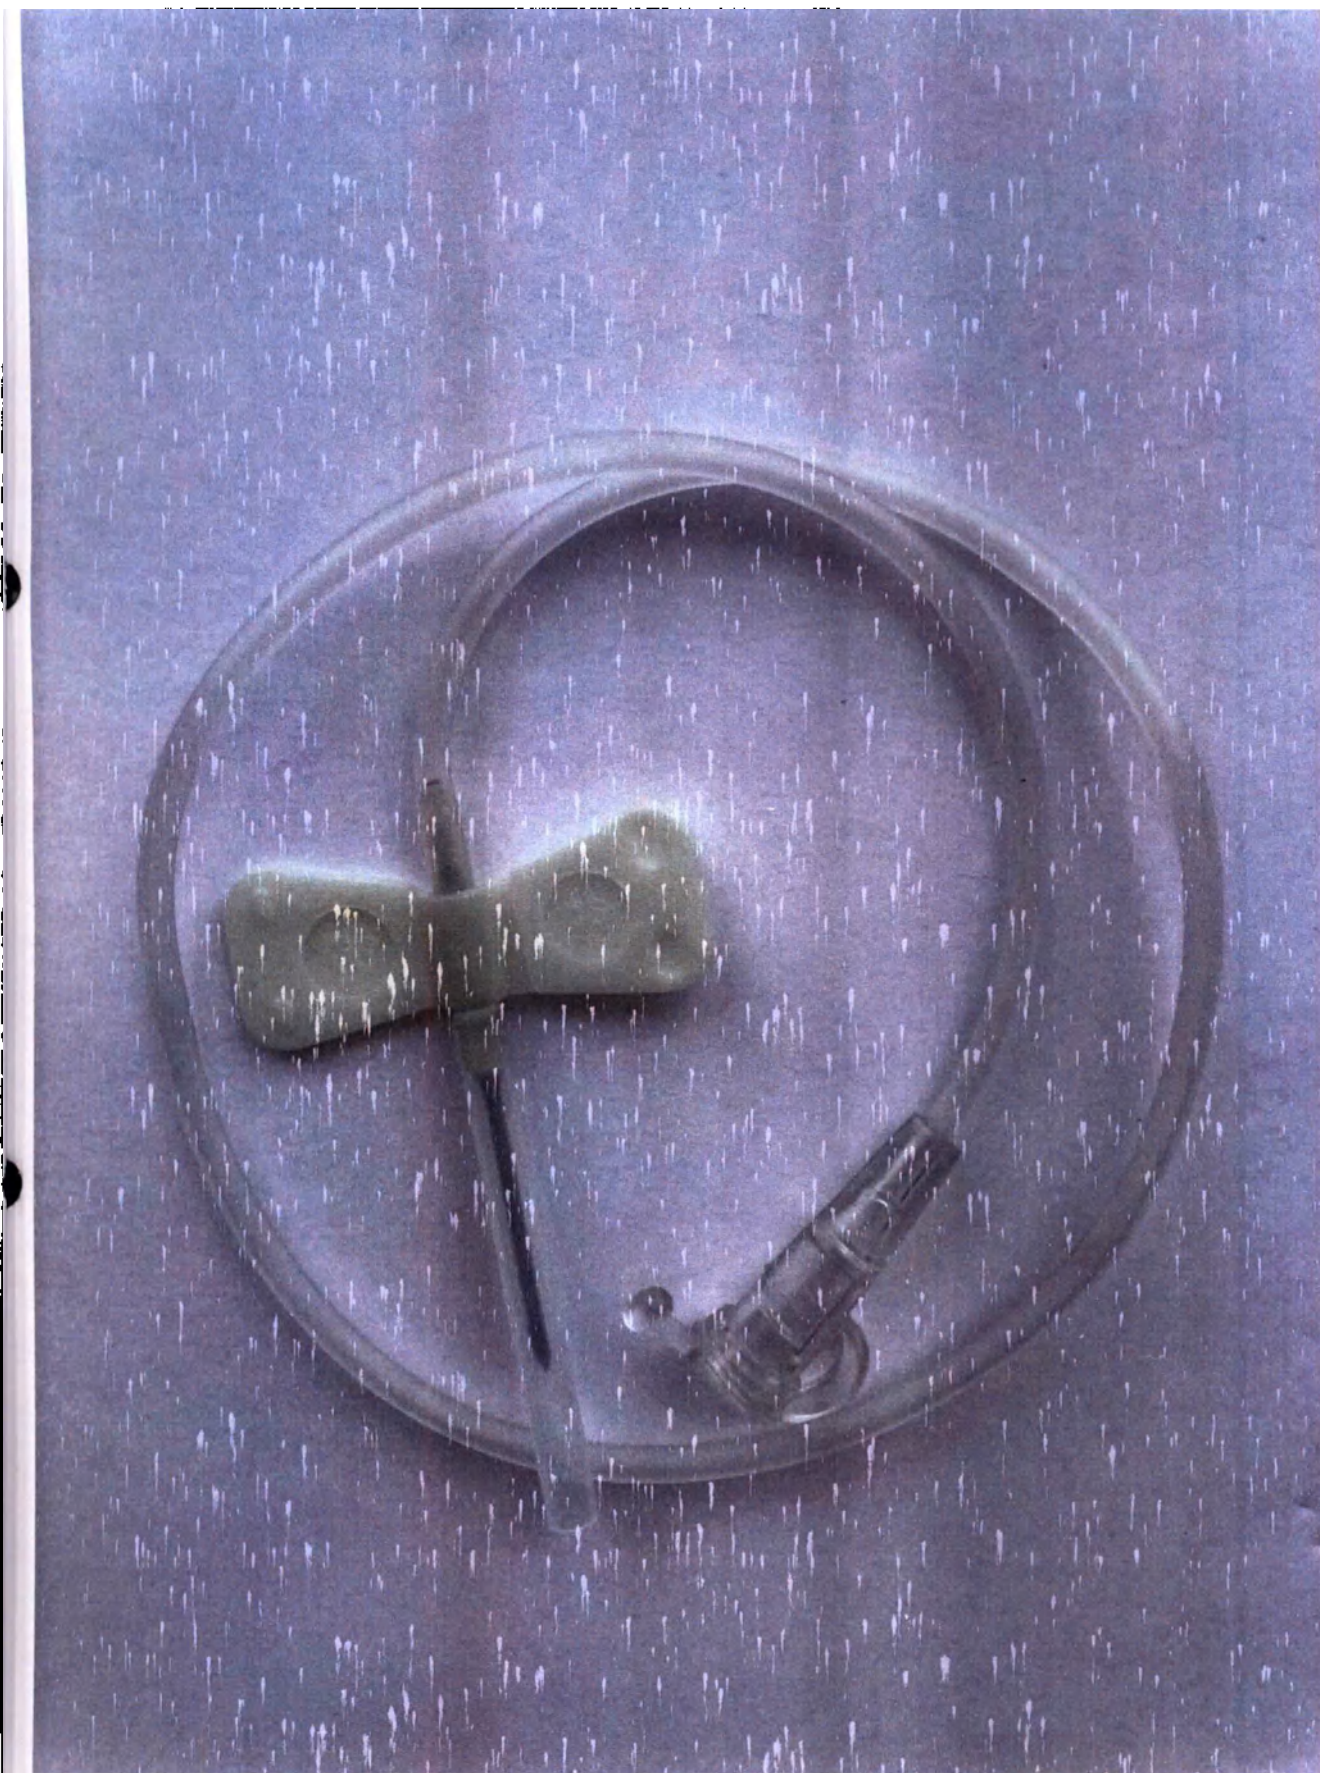

Фотографическое изображение 2 - Игла-бабочка для вливания в малые вены, 19G×3/4" (1,10мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см;




Фотографическое изображение 3 - Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G×3/4"
(0,90мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см;



Фотографическое изображение 4 - Игла-бабочка для вливания в малые вены, 21G×3/4"
(0,80мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см;




Фотографическое изображение 5 - Игла-бабочка для вливания в малые вены, 22G*3/4"
(0,70мм×19мм), TW, длина магистрали 30 см;

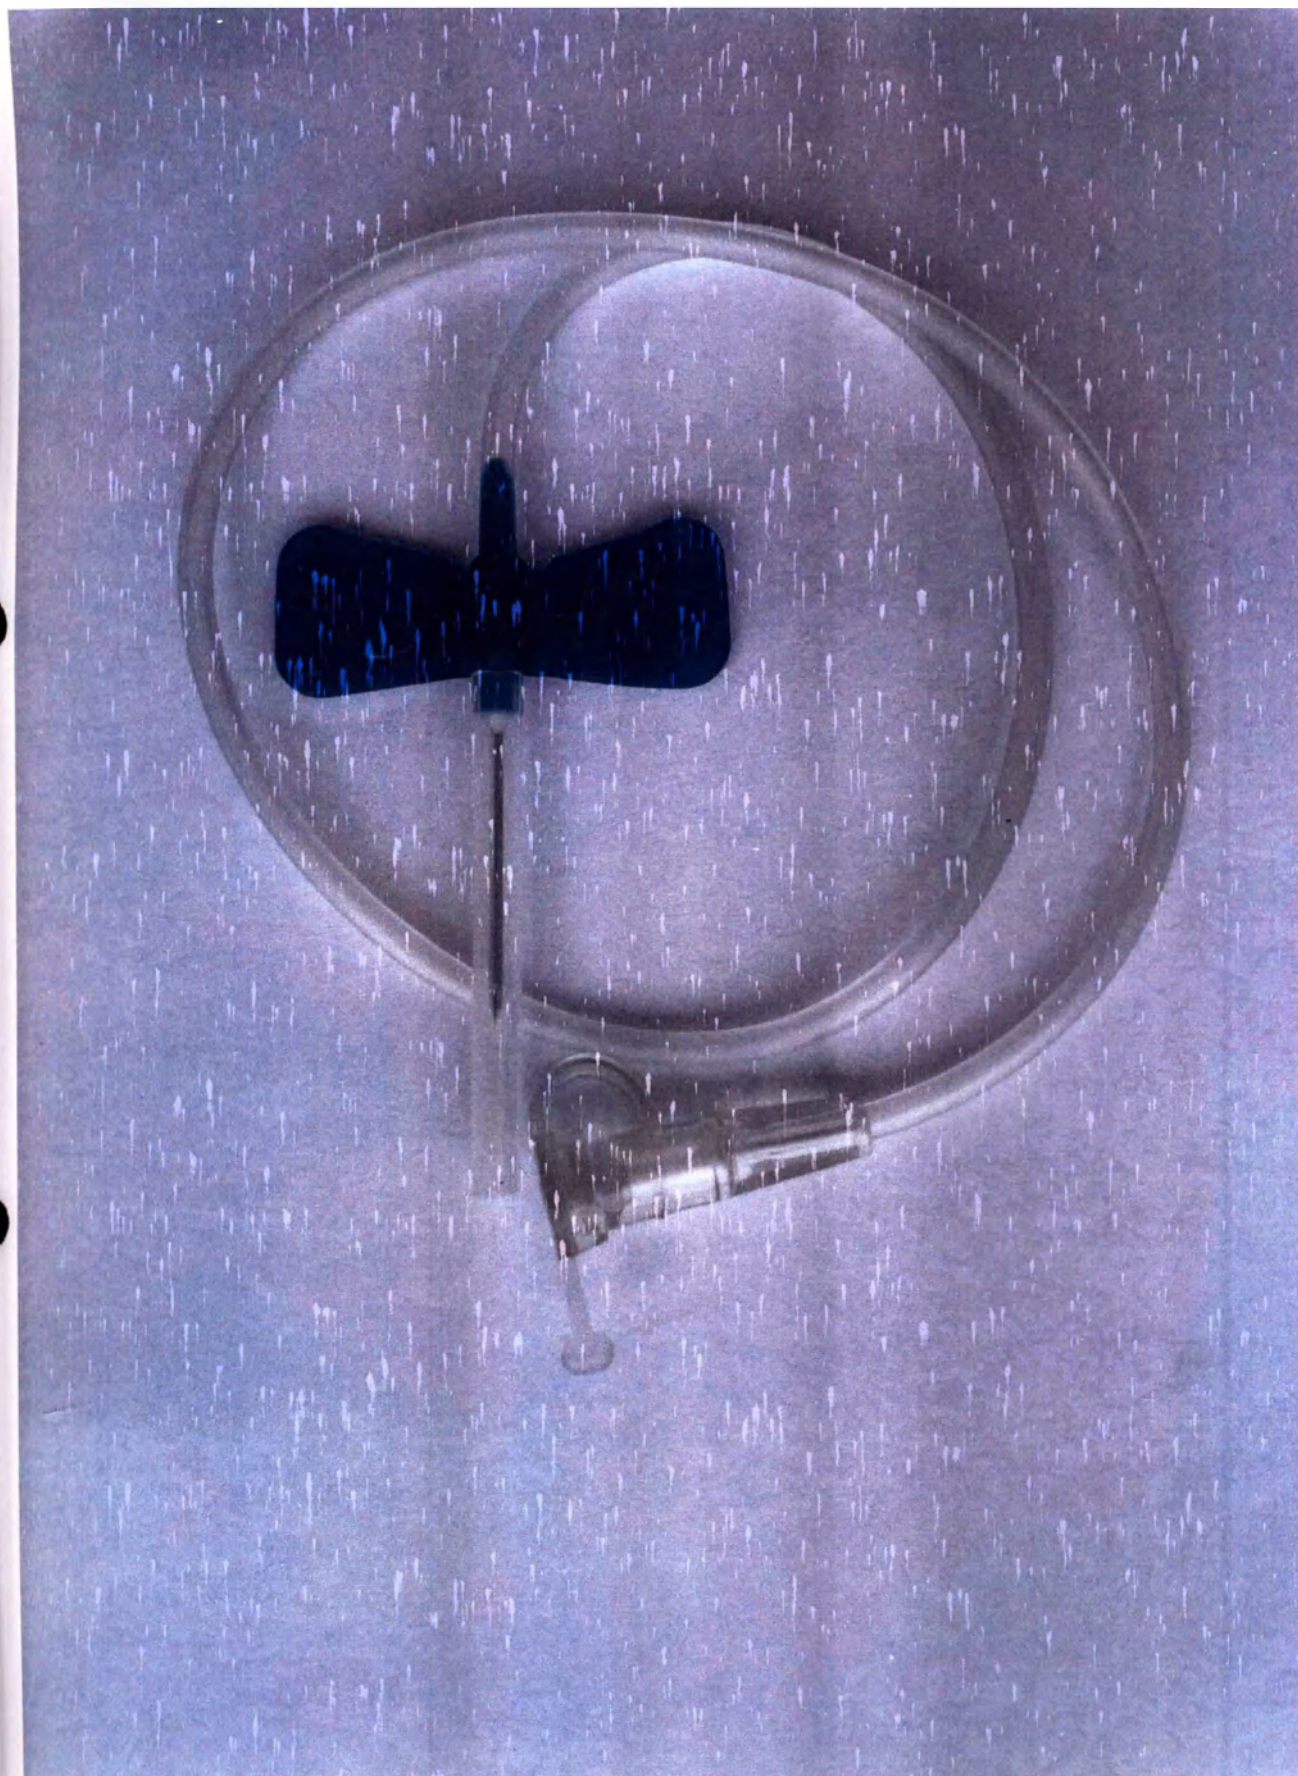

Фотографическое изображение 6 - Игла-бабочка для вливания в малые вены, 23G×3/4" (0,60мм×19мм), ТW, длина магистрали 30 см;



Фотографическое изображение 7 - Игла-бабочка для заливания в малые вены, 24G×3/4" (0,55мм×19мм), RW, длина магистрали 30 см;

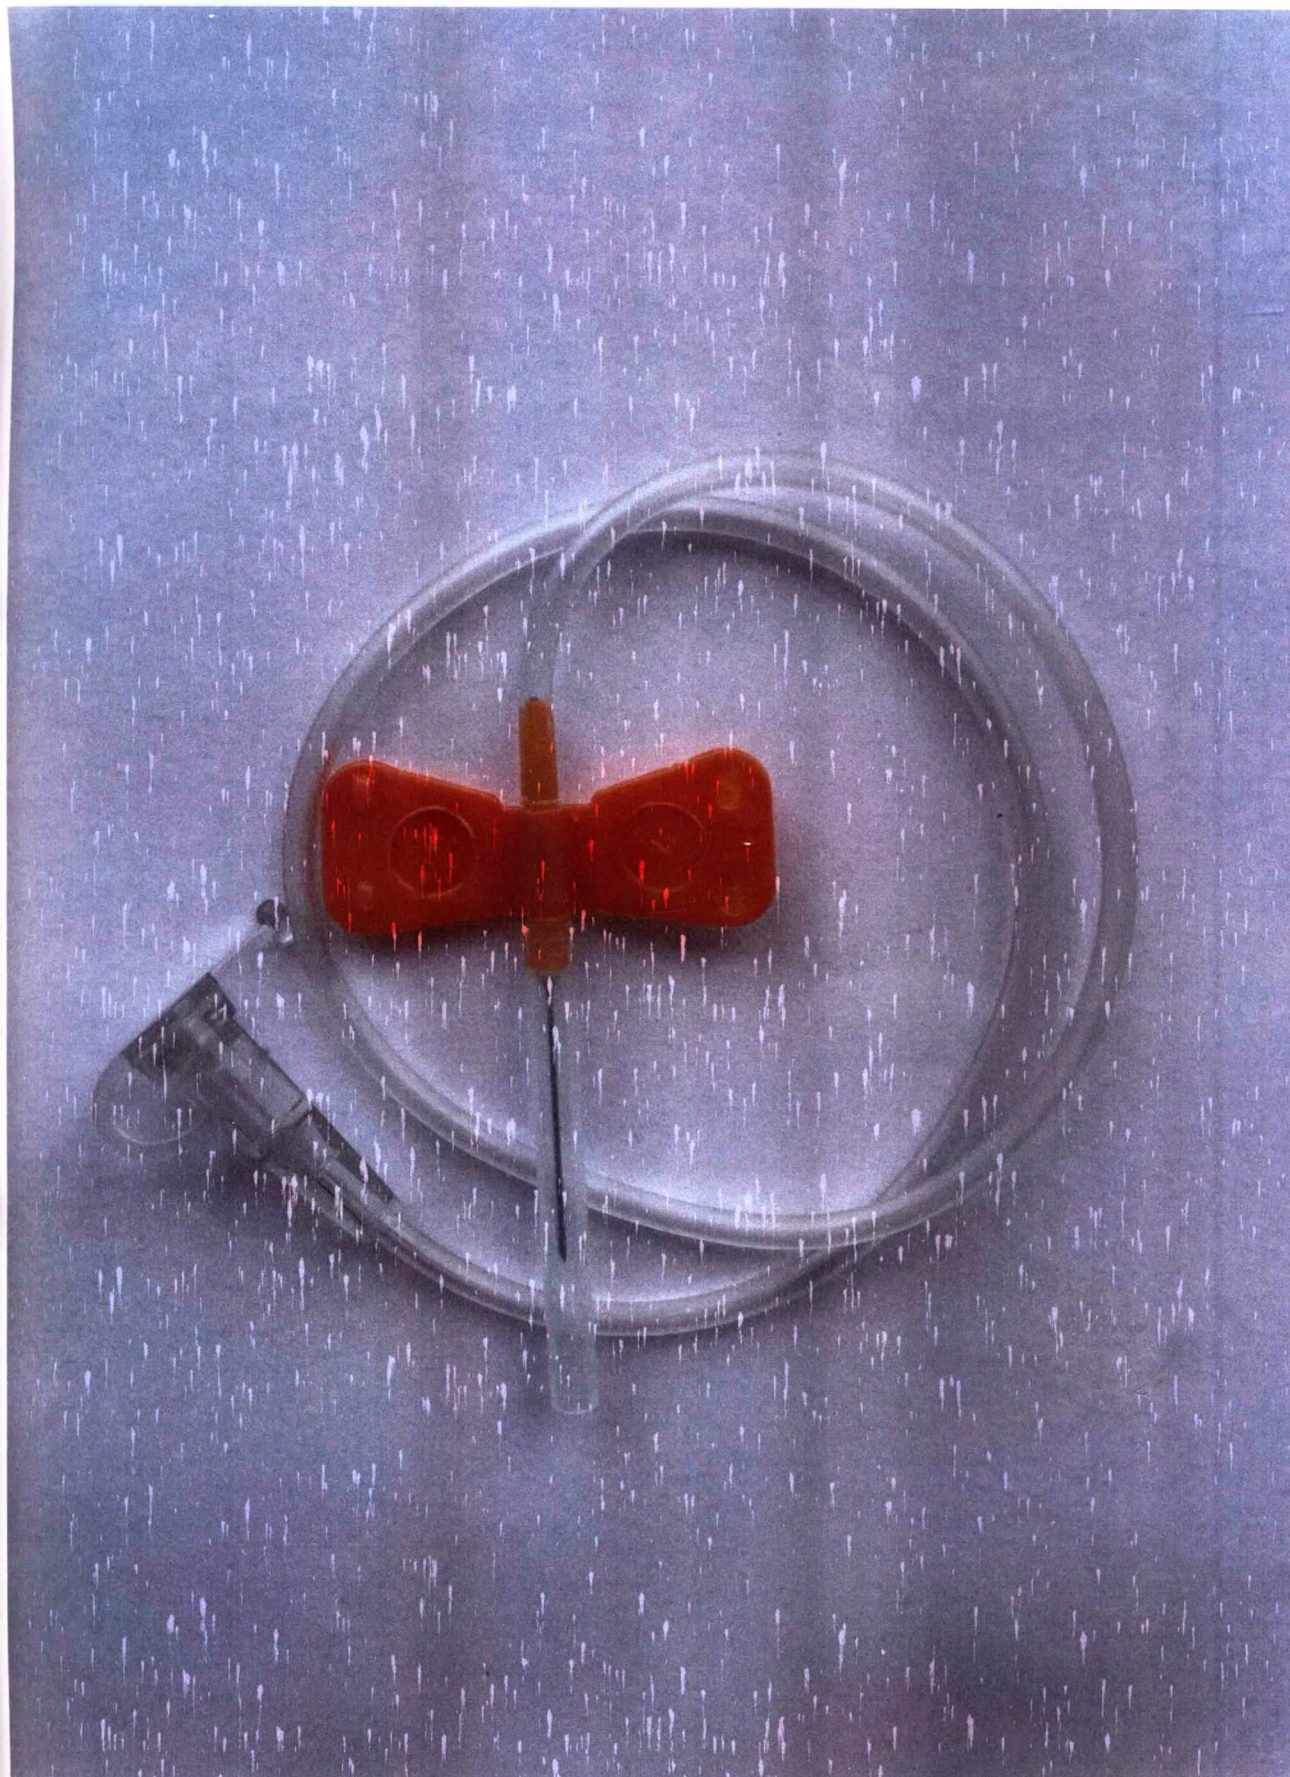

Фотографическое изображение 8 - Игла-бабочка для вливания в малые вены, 25G×3/4" (0,50 мм×19 мм), RW, длина магистрали 30 см;



Фотографическое изображение 9 - Игла-бабочка для вливания в малые вены, 26G×3/4" (0,45мм×19 мм), RW, длина магистрали 30 см;



Фотографическое изображение 10 - Игла-бабочка для вливания в малые вены, 27G×3/4" (0,40мм×19 мм), RW, длина магистрали 30 см;

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**
Игла-бабочка для вливания в малые вены, 20G 3/4" (0,55мм х 19мм),
RW, длина магистрали: 30 см

Регистрационное удостоверение № от 00.10.10000 года

Количество в упаковке: 1 шт.

Не использовать по истечении срока годности.

STERILE



NON
TOXIC



H RW



LOY 20220808



08.08.2022



07.08.2027

35%

«Джонгси Хонгда Медикал Инвент Групп Лтд.» / «Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Jianchang city, Jiangxi Province, China/Kитай

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),

Адрес: 690078, Приморский край, г. о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Комсомольская,
д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@yandex.ru

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Фотографическое изображение 11 – Индивидуальная упаковка «Игла-бабочка для вливания в малые вены»;



Фотографическое изображение 12 – Изделие в групповой упаковке

Инструкция по применению:

Необходимо подготовить рабочее место. Разместить на столе приспособление с катетером, флакон для капельных вливаний, установить штатив. Для проведения процедуры понадобится стерильный материал, емкость с дезинфицирующим составом, пластырь, перчатки, столик для инструментов.

-Вымойте руки, обработайте кожу антисептиком, наденьте перчатки и маску.

-Заполните систему для инфузий, переверните флакон и закрепите на штативе.

-Откройте воздушный клапан, убедитесь в отсутствии воздуха.

-Проведите повторную гигиеническую обработку рук, наденьте перчатки и маску.

-Вскройте упаковку с катетером.

-Под конечность пациента подложите валик, наложите жгут поверх тонкой одежды или салфетки.

-Проверьте пульс ниже места наложения жгута.

-Помассируйте место постановки катетера ребром ладони от периферии к центру.

-Выберите место для введения.

-Смочите ватный шарик антисептиком, обработайте место.

-Присоедините изделие к инфузионной системе и дождитесь появления капли раствора.

-Расположите иглу срезом вверх, согните крылышки и уберите колпачок.

-Натяните кожу чуть ниже места прокола и зафиксируйте вену.

-Выполните прокол под углом 10-15 градусов, дождитесь появления крови.

-Левой рукой ослабьте и снимите жгут. Откройте зажим на системе. Если инфильтрация отсутствует, устройство находится в вене.

-Удерживая «бабочку», чтобы не допустить ее сдвига или извлечения, зафиксируйте приспособление лейкопластырем.

-Отрегулируйте скорость введения раствора.

-Наблюдайте пациента в течение 30 минут.

Требования утилизации:

После применения изделия по назначению оно должно быть утилизировано как потенциально опасные отходы класса «Эпидемиологически опасные отходы» в соответствии с правилами, действующими в медицинских учреждениях.

Регистрационное удостоверение № 0100000000 года

**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ
ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
Игла-бабочка для вливания в
малые вены,
24G*3/4" (0,55ммх19мм),
RW, длина магистрали 30 см**



LOT 20220808
 08.08.2022
 07.08.2027

Фотографическое изображение 14 – Групповая упаковка «вид сбоку»;


**ИГЛА-БАБОЧКА ДЛЯ ВЛИВАНИЯ В МАЛЫЕ ВЕНЫ,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Игла-бабочка для вливания в малые вены,
24G*3/4" (0,55ммх19мм),
RW, длина магистрали 30 см

Регистрационное удостоверение № от 00.00.0000 года

Количество: 100 штук

Не использовать по истечении срока годности.

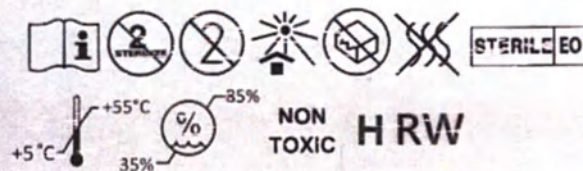

 «Джингси Хонгда Медикал Икьюпмент Групп Лтд.» / «Jiangxi
Hongda Medical Equipment Group Ltd.»
Адрес: 39 South Shengli Road, Jinxian county, Nanchang city, Jiangxi
Province, China/Китай

Уполномоченный представитель производителя:

Общество с ограниченной ответственностью «Юнитон» (ООО «Юнитон»),
Адрес: 690078, Приморский край, г.о.Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Комсомольская, д.1, офис 17, тел.: +79084599262, e-mail: ooo.uniton@vandex.ru



Фотографическое изображение 16 – Транспортная упаковка «вид сбоку»;



Фотографическое изображение 17 – Транспортная упаковка.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

18 лист *об*

Генеральный Директор

ООО «ЮНИТОН»

В. Чен Голосева

