

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного
определения антител к тиреопероксидазе методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в
сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-271-65614693-2022»**

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.;
 Реагент - конъюгат (R2), 6,5 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3),
 10,0 мл/уп.)



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон



Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон



Пароизоляционные крышки



QR-code



Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного определения антител к тиропероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *In vitro* по TY 21.20.23-271-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВМН-1.2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Анти-ТПО

Набор реагентов на 100 тестов

Состав изделия

- Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; Реагент - конъюгат (R2), 6.5 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 10.0 мл/уп.) - 2 шт.
- Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
- Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
- Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
- Пароизоляционные крышки - 8 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.
- Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного определения антител к тиропероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *In vitro* по TY 21.20.23-271-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВМН-1.2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Анти-ТПО

Набор реагентов на 200 тестов

Состав изделия

- Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; Реагент - конъюгат (R2), 6.5 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 10.0 мл/уп.) - 4 шт.
- Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 2 шт.
- Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 2 шт.
- Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 2 шт.
- Пароизоляционные крышки - 16 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.
- Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного определения антител к тиропероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *In vitro* по TY 21.20.23-271-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВМН-1.2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

Лидлаб Амур Анти-ТПО

Набор реагентов на 500 тестов

Состав изделия

- Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; Реагент - конъюгат (R2), 6.5 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 10.0 мл/уп.) - 10 шт.
- Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 5 шт.
- Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 5 шт.
- Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 5 шт.
- Пароизоляционные крышки - 40 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.
- Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного определения антител к тиропероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *In vitro* по TY 21.20.23-271-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВМН-1.2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Место производства:
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Лидлаб Амур Анти-ТПО

Набор реагентов на 1000 тестов


Состав изделия

- Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; Реагент - конъюгат (R2), 6.5 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 10.0 мл/уп.) - 20 шт.
- Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 10 шт.
- Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 10 шт.
- Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 10 шт.
- Пароизоляционные крышки - 80 шт.
- Инструкция по применению - 1 шт.
- Аналитический паспорт - 1 шт.

Потребительская коробка

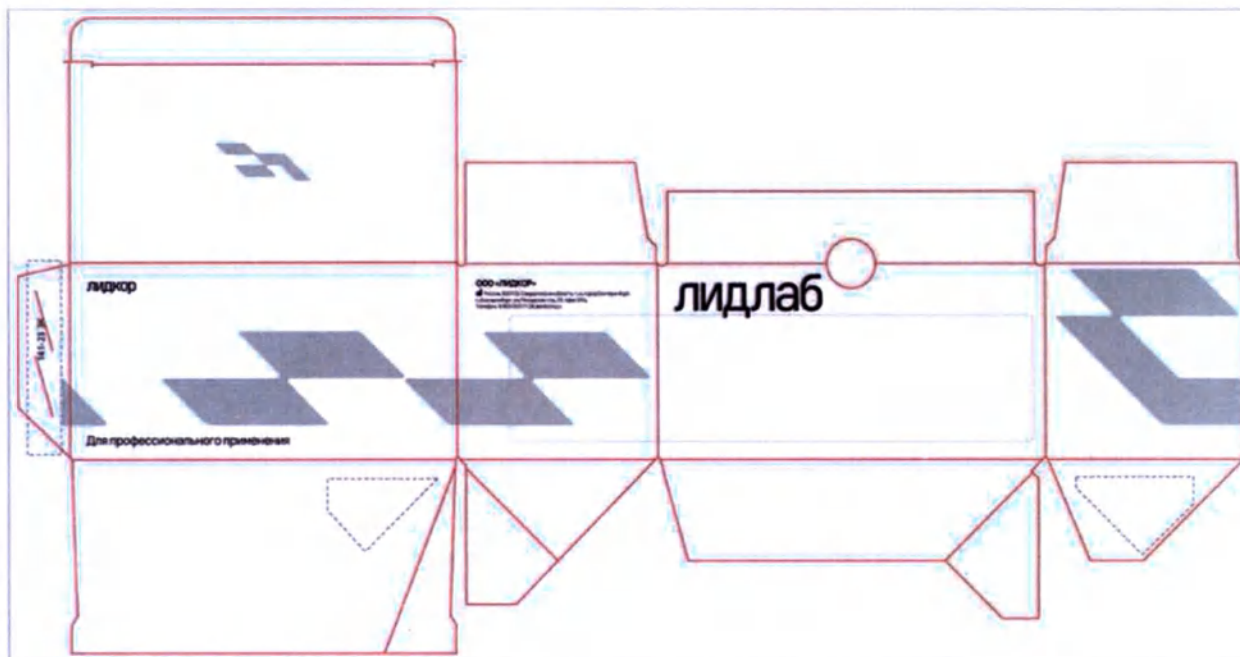

Транспортная упаковка

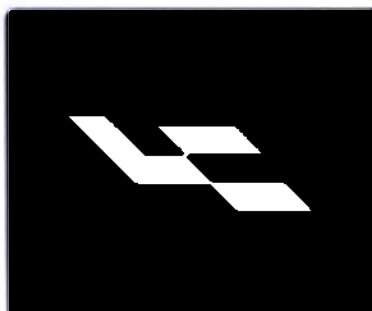

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного определения антител к тирео-пероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-271-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89004G




Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного определения антител к тирео-пероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-271-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89004G

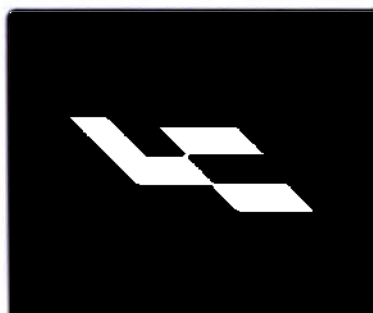

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного определения антител к тирео-пероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-271-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89004G



Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного определения антител к тиреопероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-271-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C89004G

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) л.



Директор
ООО «ЦИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гожгут


«01» июля 2023 г.

М.П.

Фотографические изображения общего вида

**«Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-ТПО» для количественного
определения антител к тиреопероксидазе методом
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на парамагнитных частицах в
сыворотке и плазме крови человека на анализаторе автоматическом «Лидлаб
Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-271-65614693-2022»**

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент - конъюгат (R2), 6,5 мл/уп.; Реагент для разведения образцов (R3), 10,0 мл/уп.)

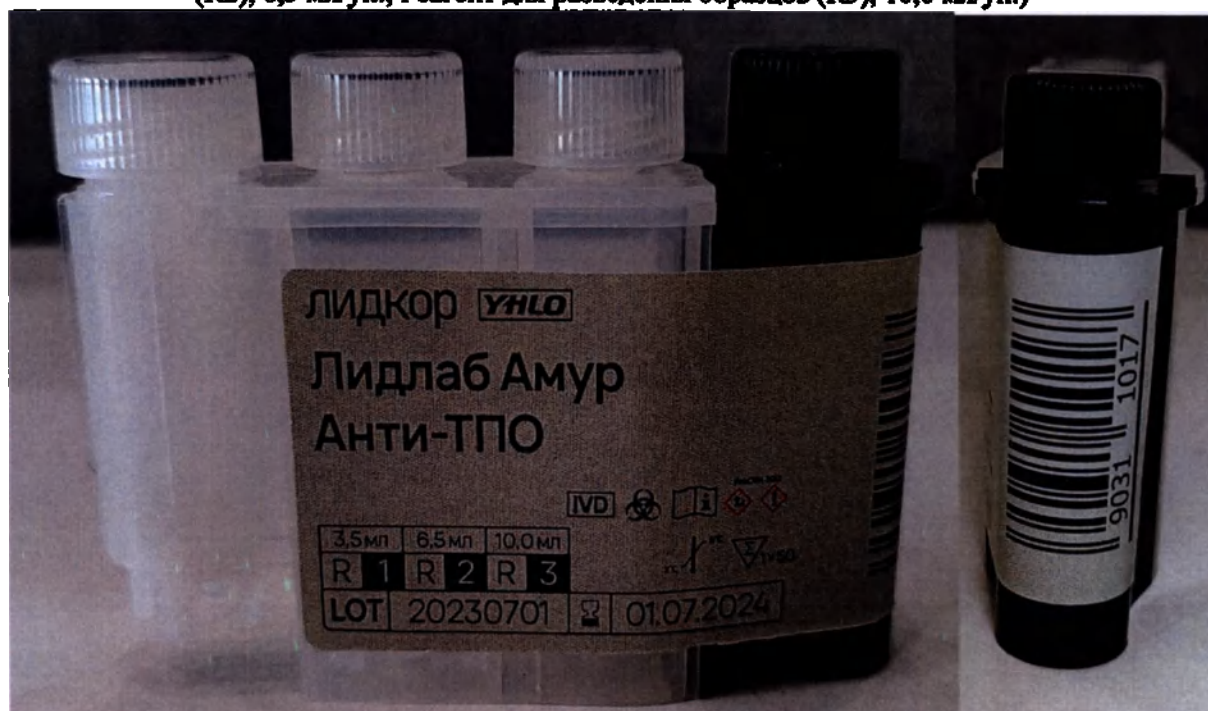


Пароизоляционные крышки




Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон



Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

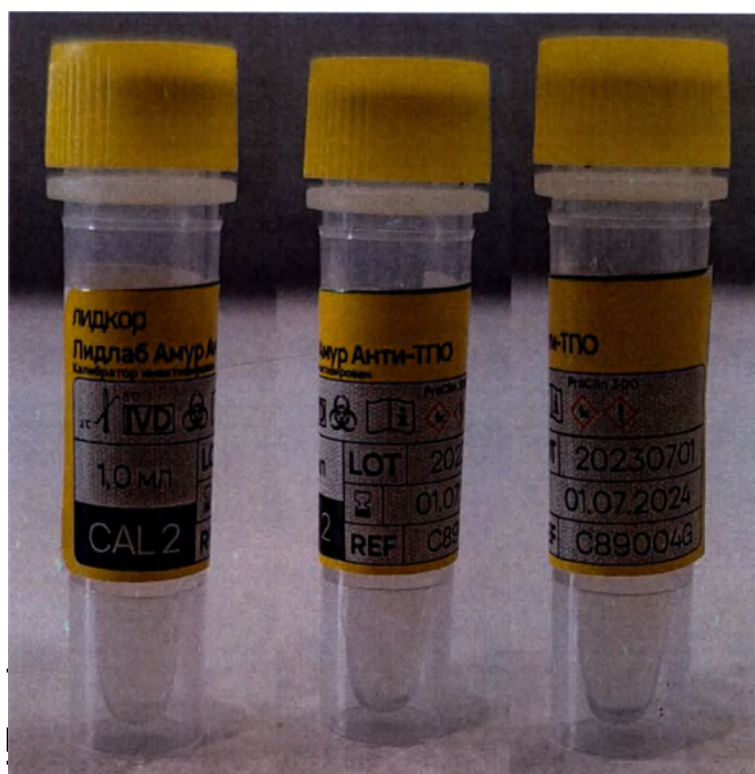

Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

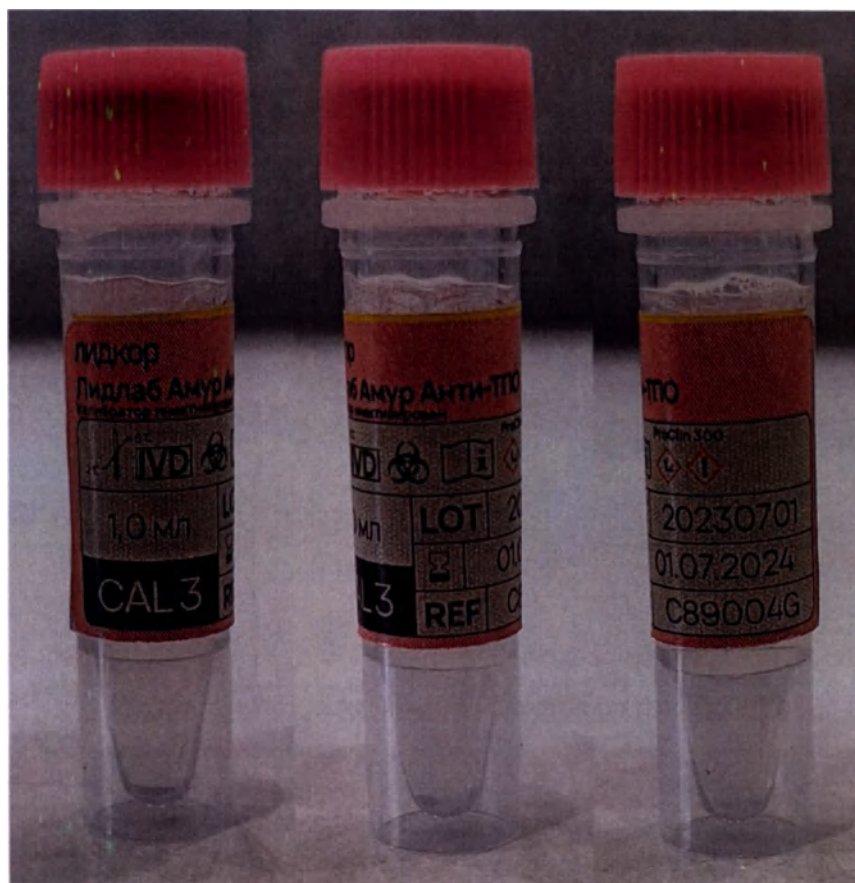




Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)




Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

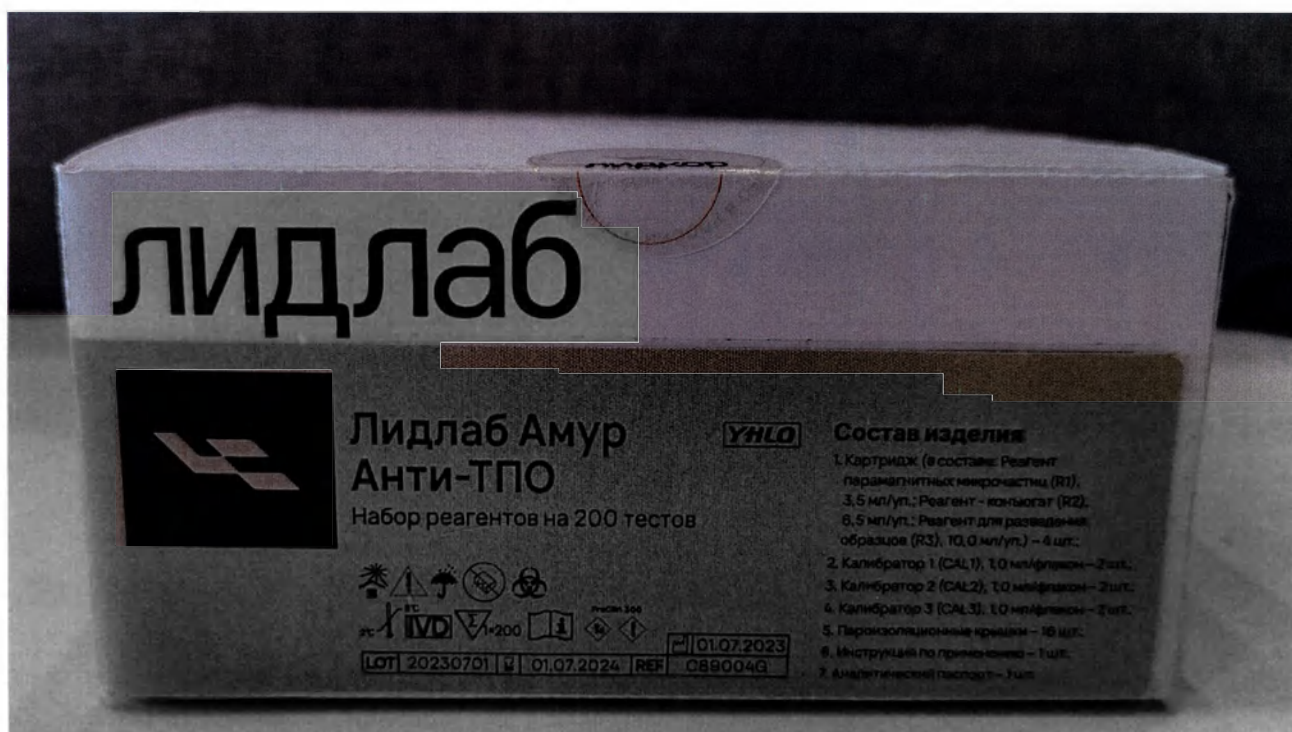


Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

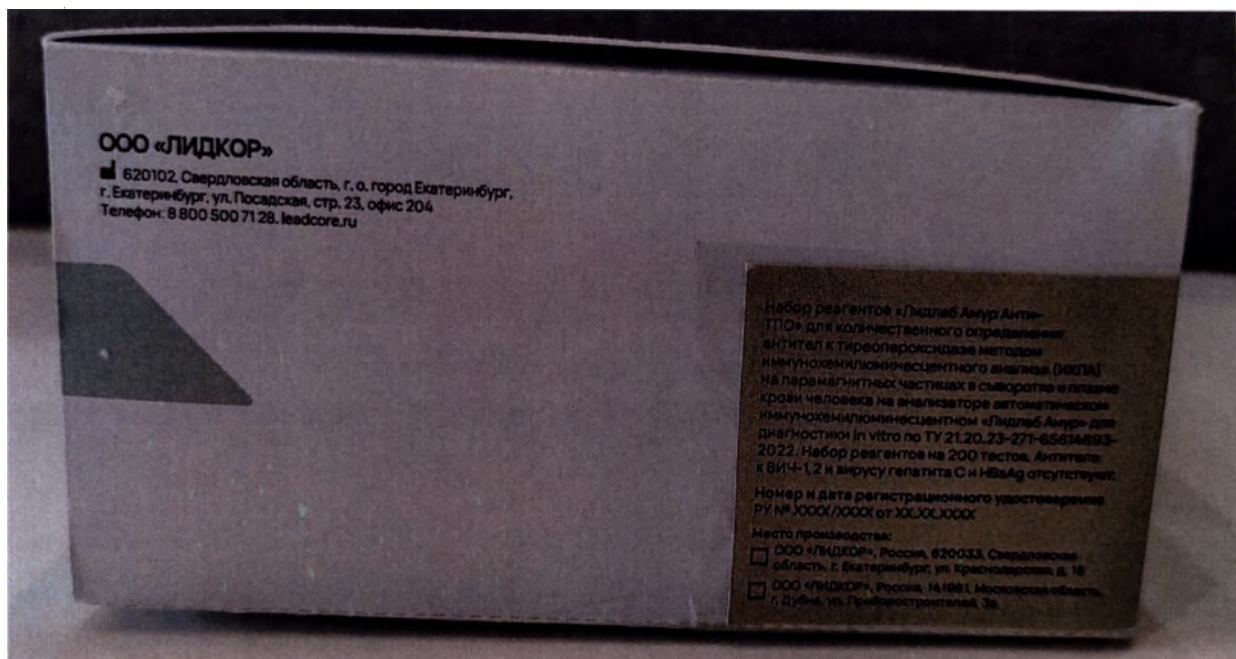


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)

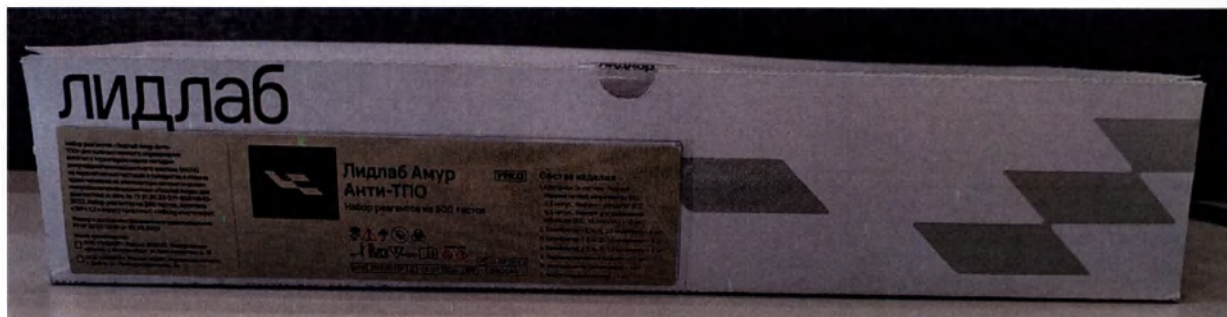

Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

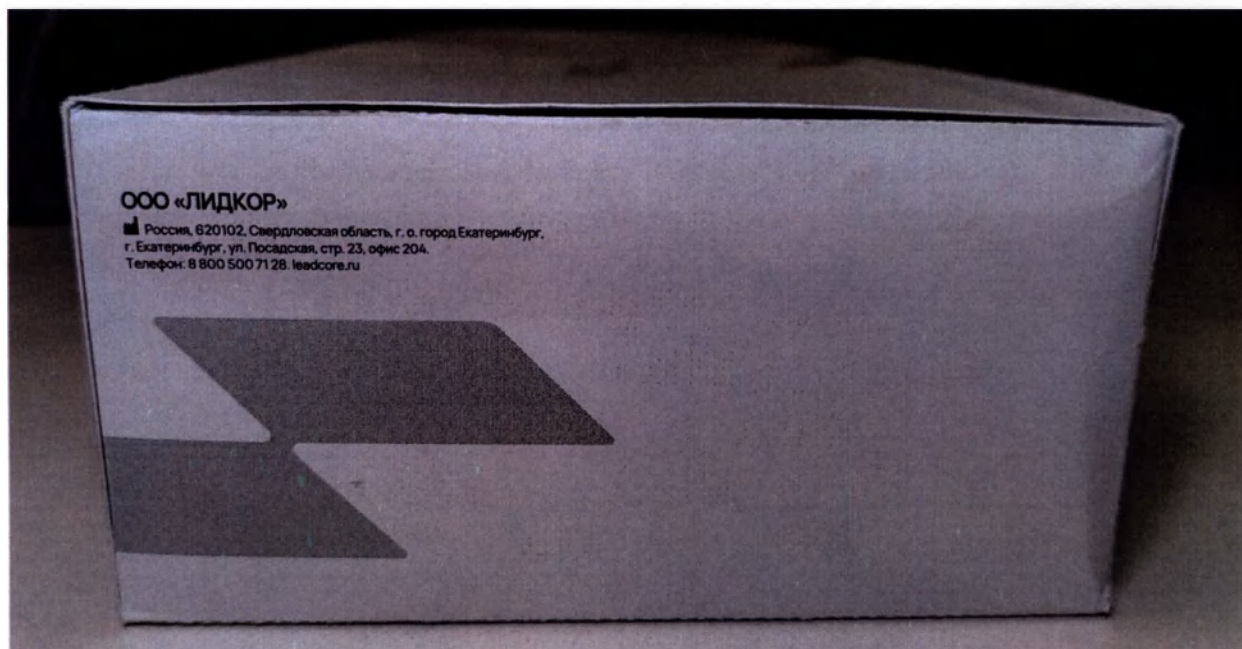

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

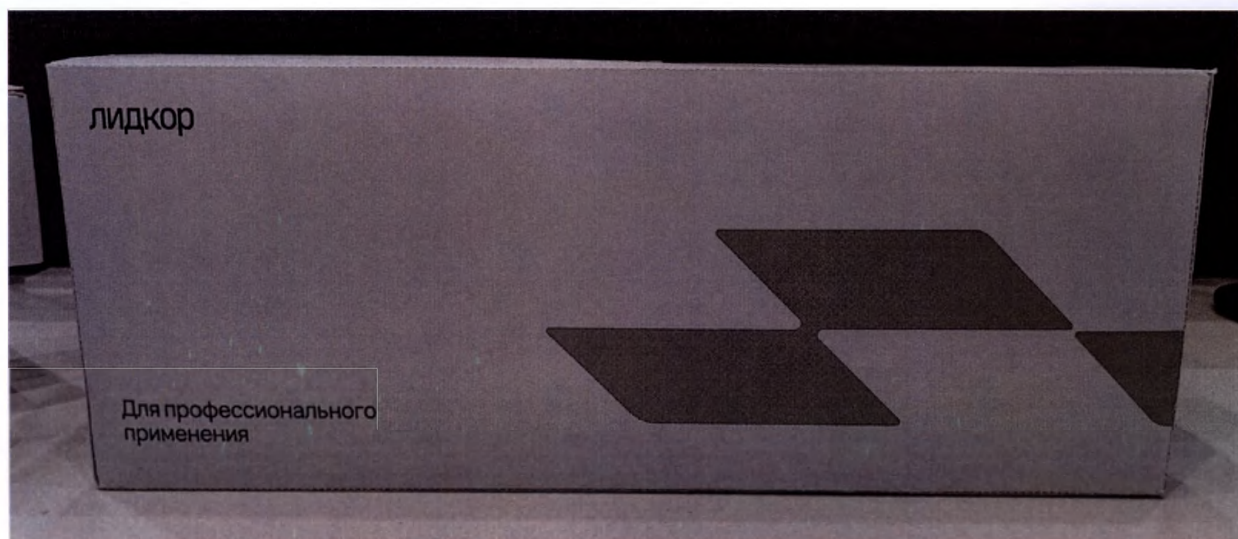


Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)

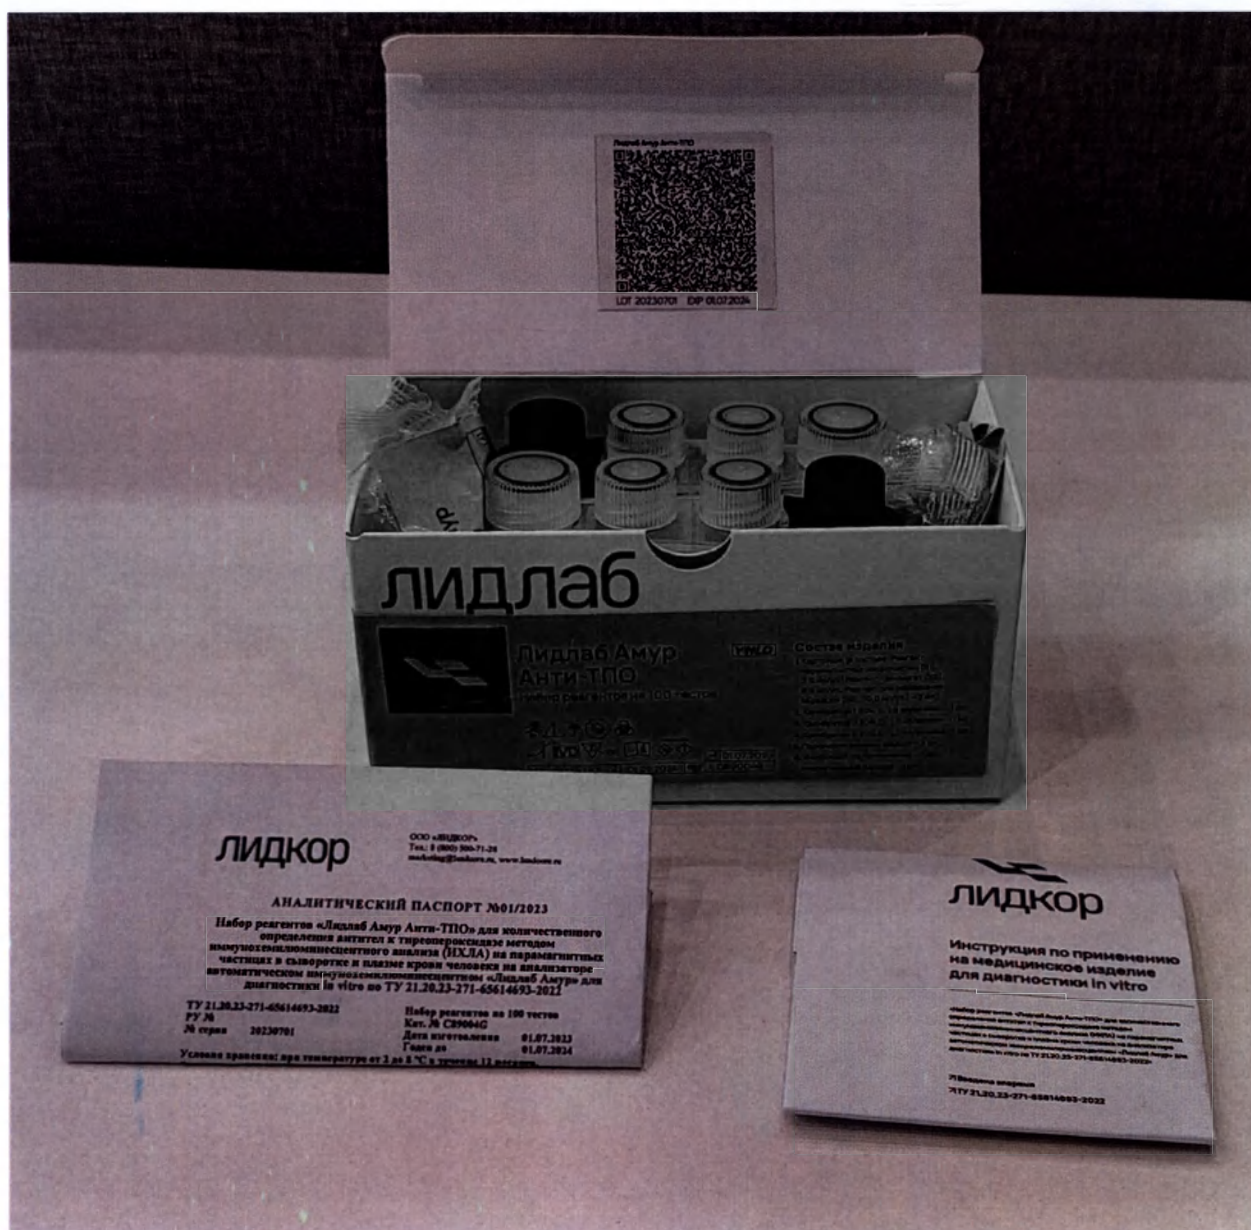



Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.

Групповое фото.

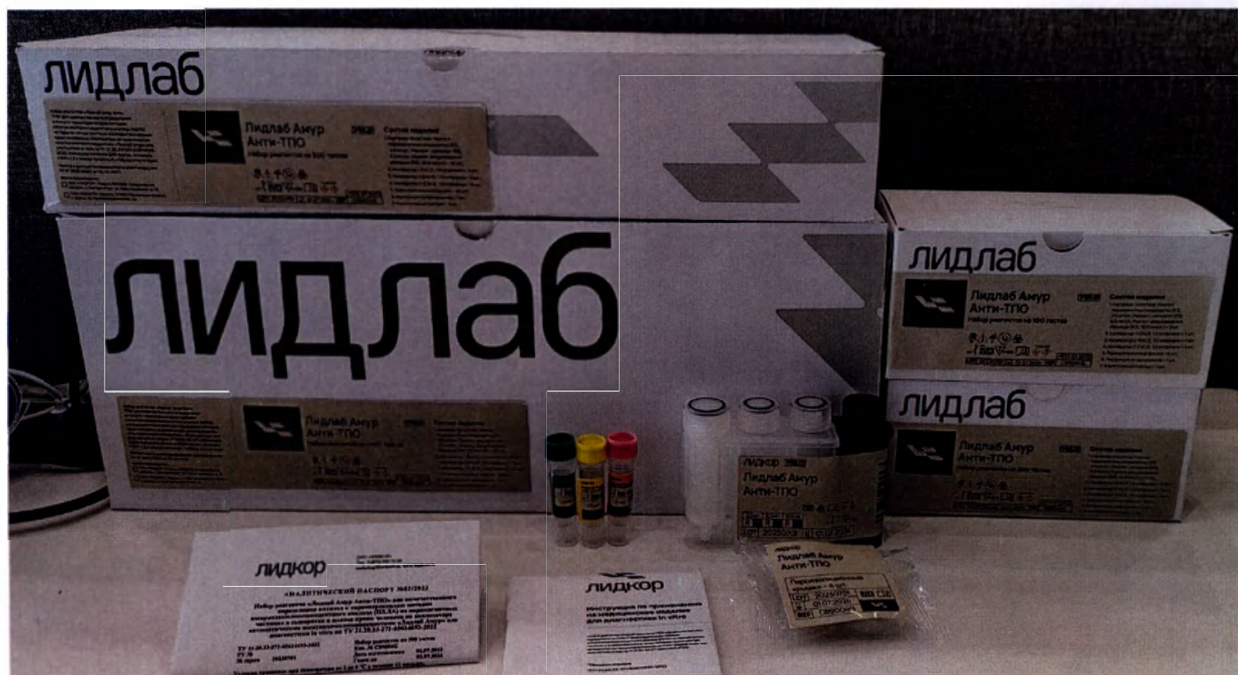

Транспортная упаковка



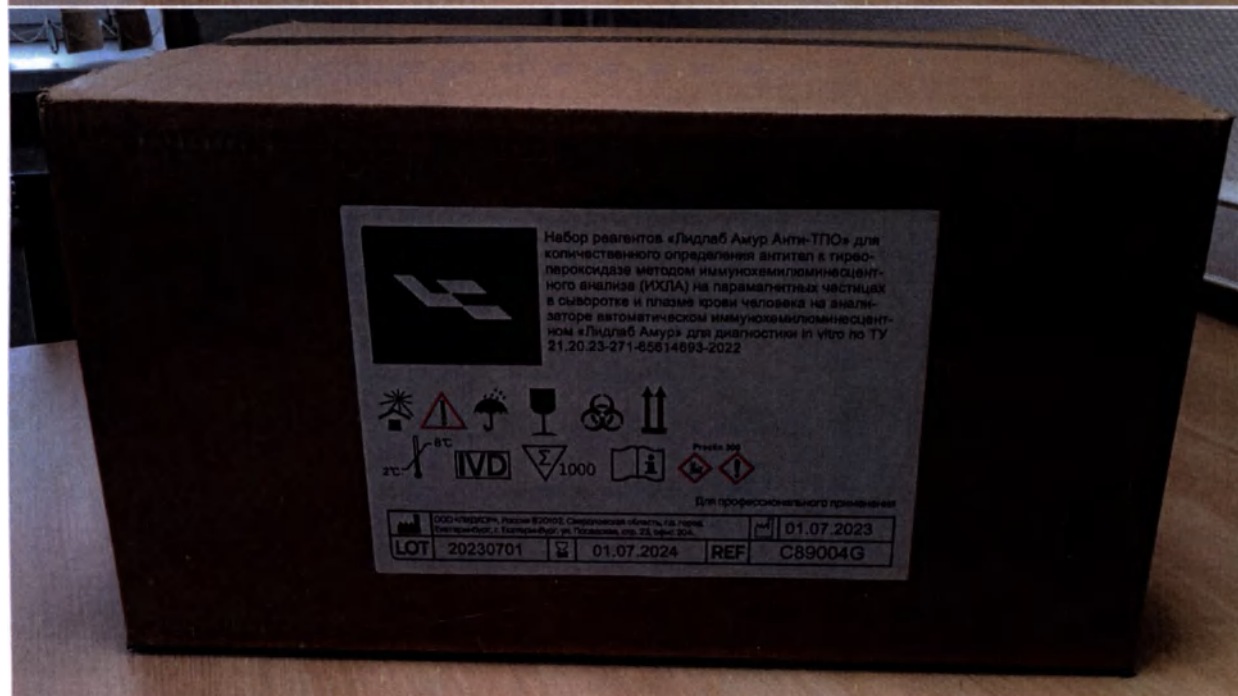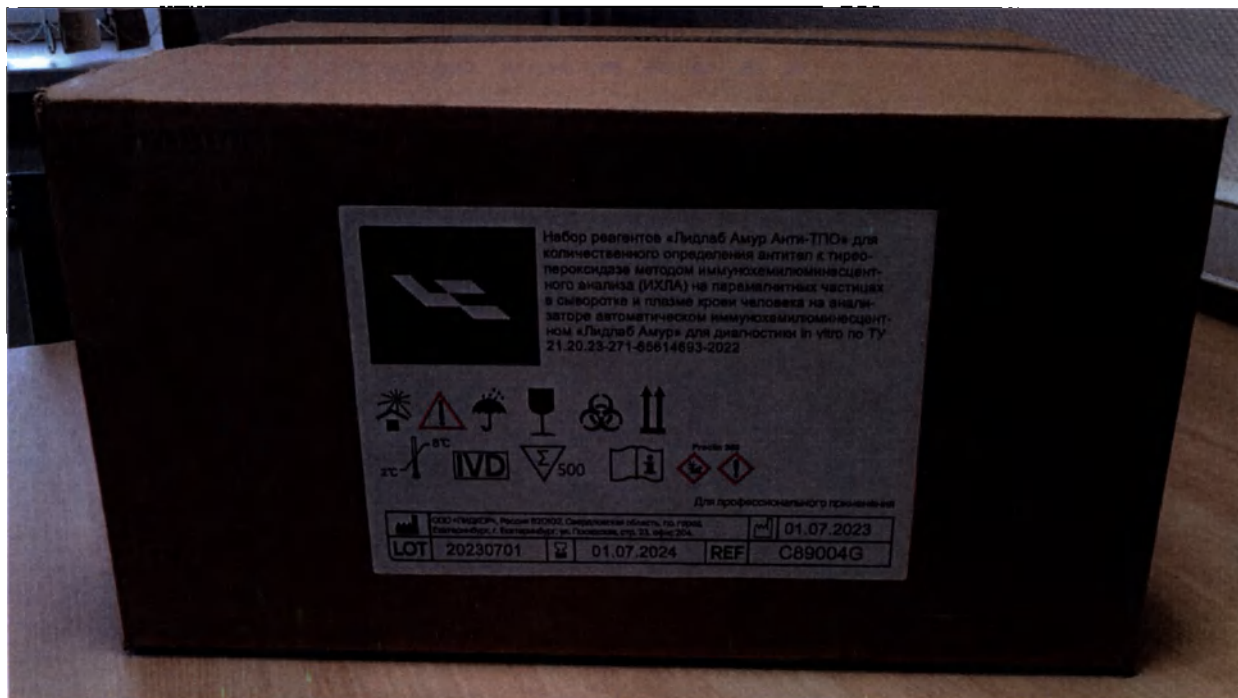

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (тринадцать) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»


/Е. Ю. Гохгут/

