

Фотографические изображения изделия

Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляции "Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES" по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

1. Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов: костыли и трости TRIVES, Костыли и трости TRIVES, модель CA8511.5, изготовитель «Фошань Шункангда Медикал Тех Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2010/08463
2. Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов: костыли и трости TRIVES, Костыли и трости TRIVES, модель CA8511.2, изготовитель «Фошань Шункангда Медикал Тех Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2010/08463
3. Костыли, артикул 104, изготовитель REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH, Германия, РУ ФСЗ 2009/04930



Костыль TRIVES, модель CA851L5,
изготовитель "Фошань Шункангда
Медикал Тех Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ
2010/08463



Костыль TRIVES, модель CA851L2,
изготовитель "Фошань Шункангда
Медикал Тех Ко., Лтд.", Китай, РУ ФСЗ
2010/08463



Костыль, артикул 104, изготовитель
REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH,
Германия, РУ ФСЗ 2009/04930

Директор ООО «НПФ
Реабилитационные технологии»
Емельянов А.В.



протокол, в 4 экземплярах, скреплено
печаткой 4 лист(ов)

Фотографические изображения изделия

**Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со
встроенной системой синхронизированной электростимуляции "Экзоскелет для
реабилитации E-Helper-FES" по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022**

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
 Роботизированный тренажер с БОС
 для восстановления навыков ходьбы
 со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
 "Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
 по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 8-К	Опция: ☐ К ☒ С
-----------------	---

Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
 С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания
 Параметры зарядного устройства: — 43.8 В / 1.65 А

Заводской номер: 34

2022

IP10    



ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
 Роботизированный тренажер с БОС
 для восстановления навыков ходьбы
 со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
 "Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
 по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 8-К	Опция: ☒ К ☐ С
-----------------	---

Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
 С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания
 Параметры зарядного устройства: — 43.8 В / 1.65 А

Заводской номер: 35


2022

IP10



ООО НПФ «Ревитационные технологии»
 Роботизированный тренажер с БОС
 для восстановления навыков ходьбы
 со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
 "Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
 по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 16-К	Опция: ☒ К ☐ С
Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза) С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)	
Изделие с внутренним источником питания Параметры зарядного устройства: — 43.8 В / 1.65 А	
Заводской номер: 32	
2022	IP10    

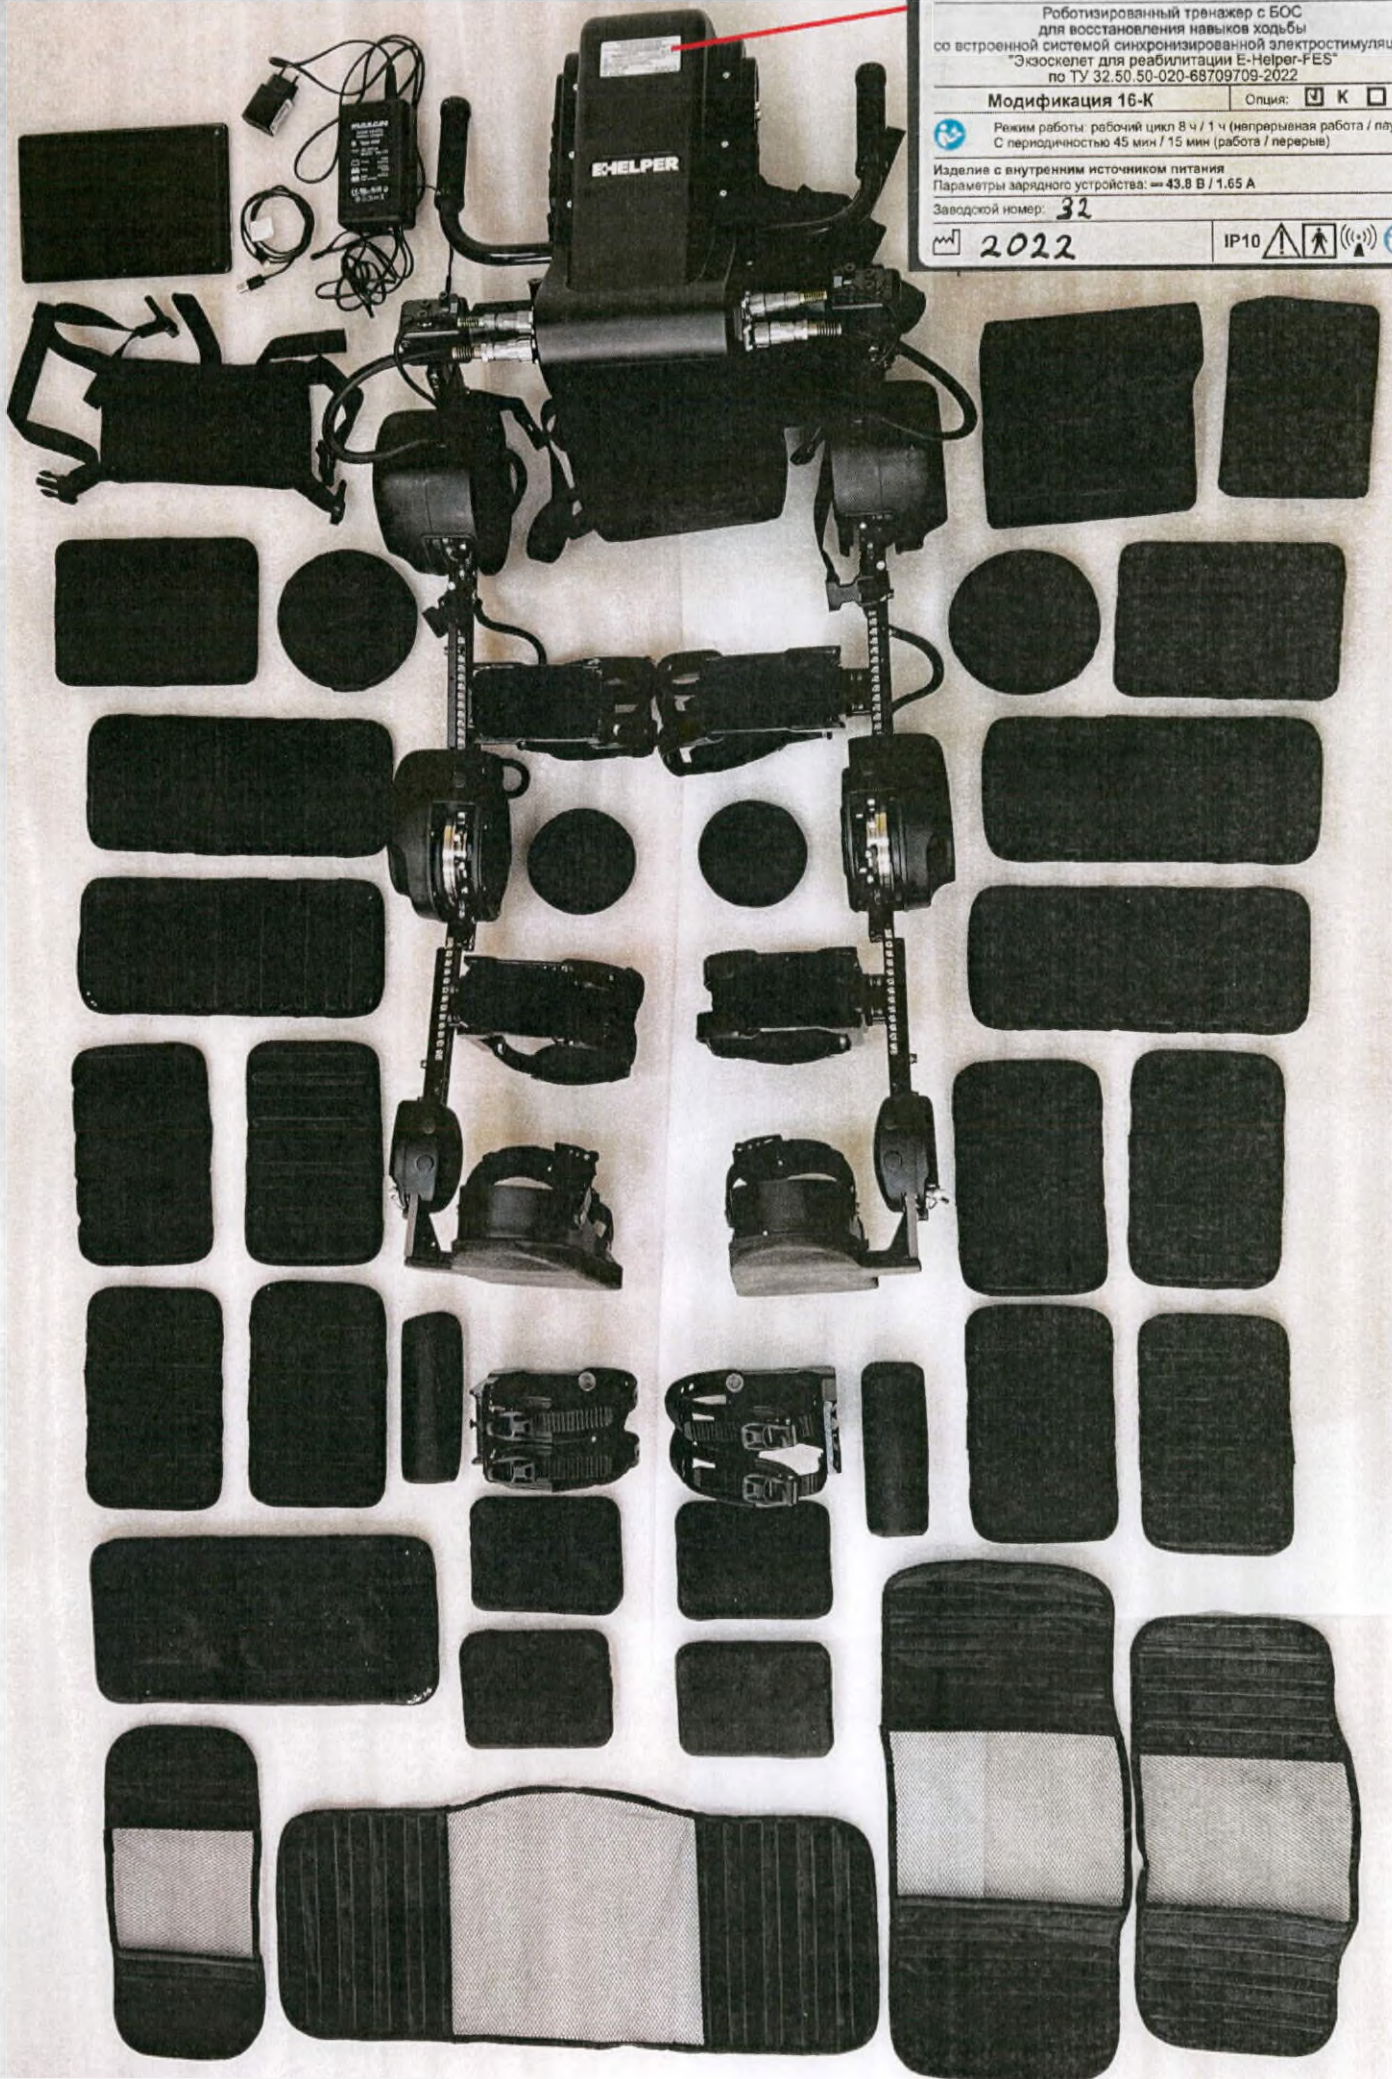

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
 Роботизированный тренажер с БОС
 для восстановления навыков ходьбы
 со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
 "Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
 по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 16-K Опция: ☐ K ☒ Ц ☐ С

Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
 С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)


Изделие с внутренним источником питания
 Параметры зарядного устройства: = 43,8 В / 1,65 А

Заводской номер: 33

2022 IP10





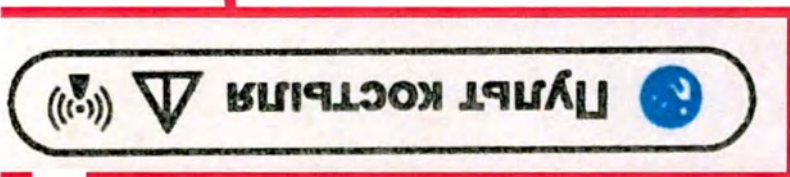





**Выносная кнопка
для ручного пульта**


Выносная кнопка
для ручного пульта




**Тазовый (седалищный)
ремень**



стирка с вещами,
схожими по цвету

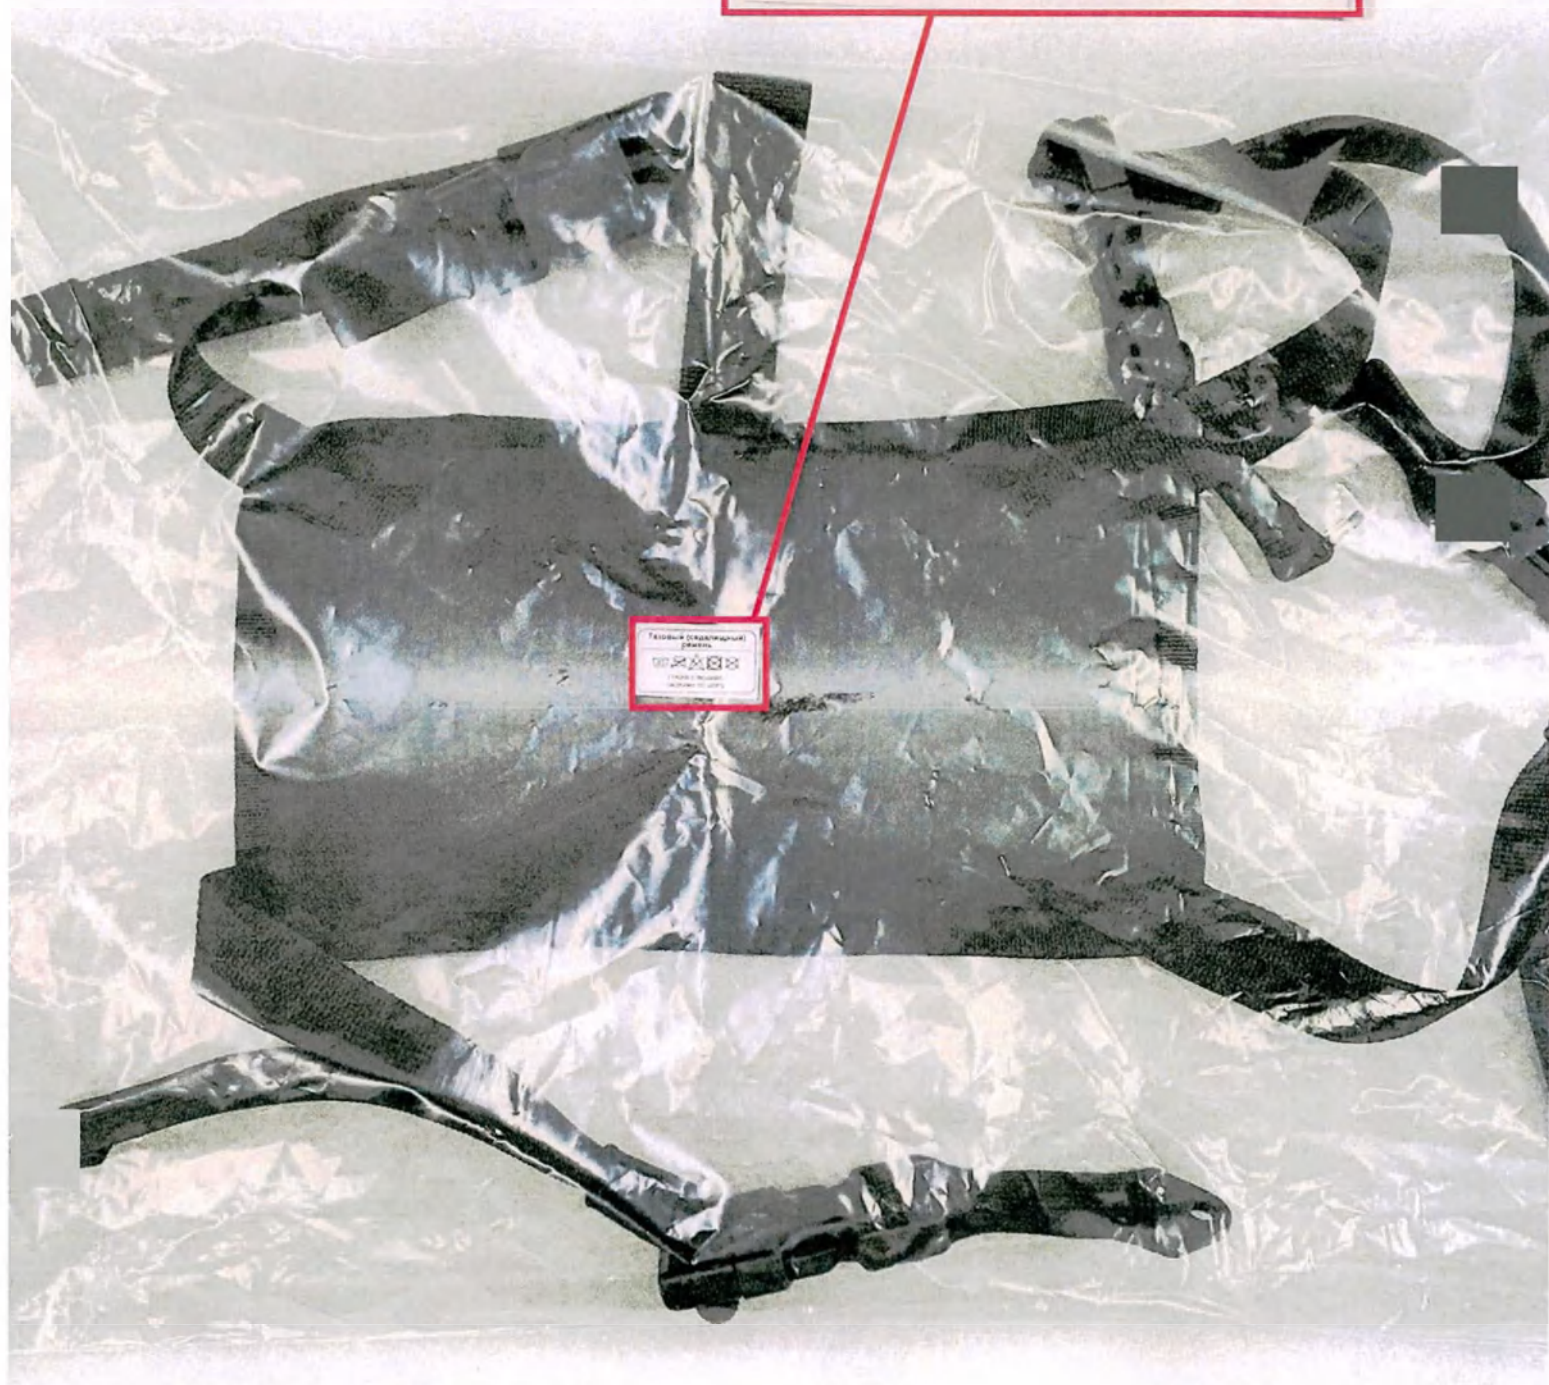

Подушка для живота
размер 1



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Подушка для живота
размер 2**



стирка с вещами,
схожими по цвету





**Подушка для живота
размер 3**



стирка с вещами,
схожими по цвету

**Подушка для живота
размер 4**





стирка с вещами,
схожими по цвету



Спинальная подушка



стирка с вещами,
схожими по цвету

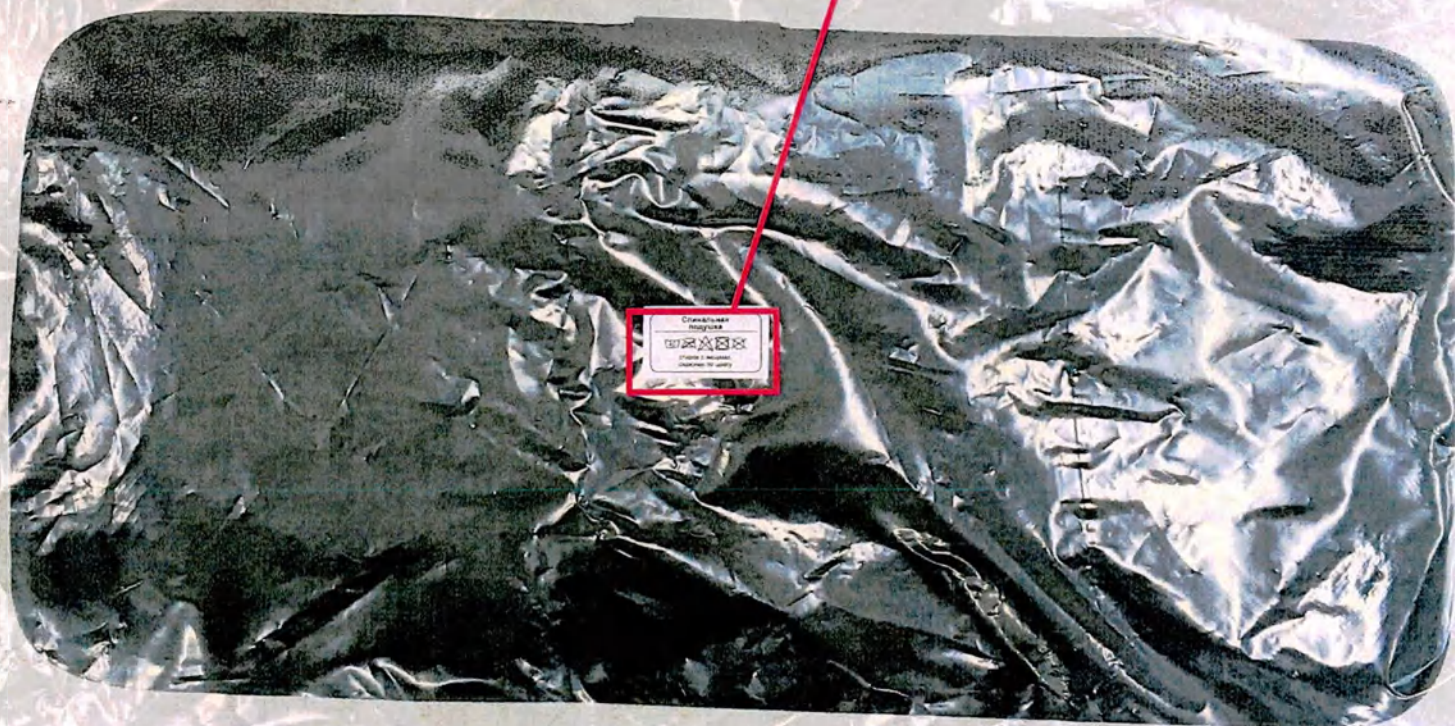

Поясничная подушка



стирка с вещами,
схожими по цвету



Суставная подушка бедренная




стирка с вещами,
схожими по цвету




**Суставная подушка
коленная**



стирка с вещами,
схожими по цвету

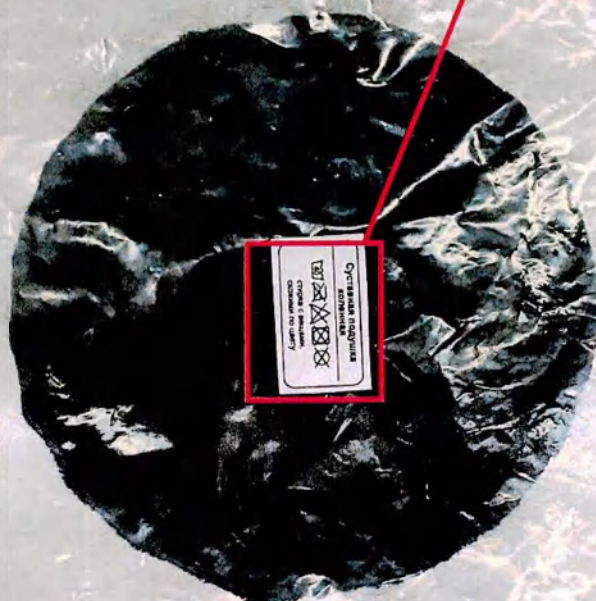

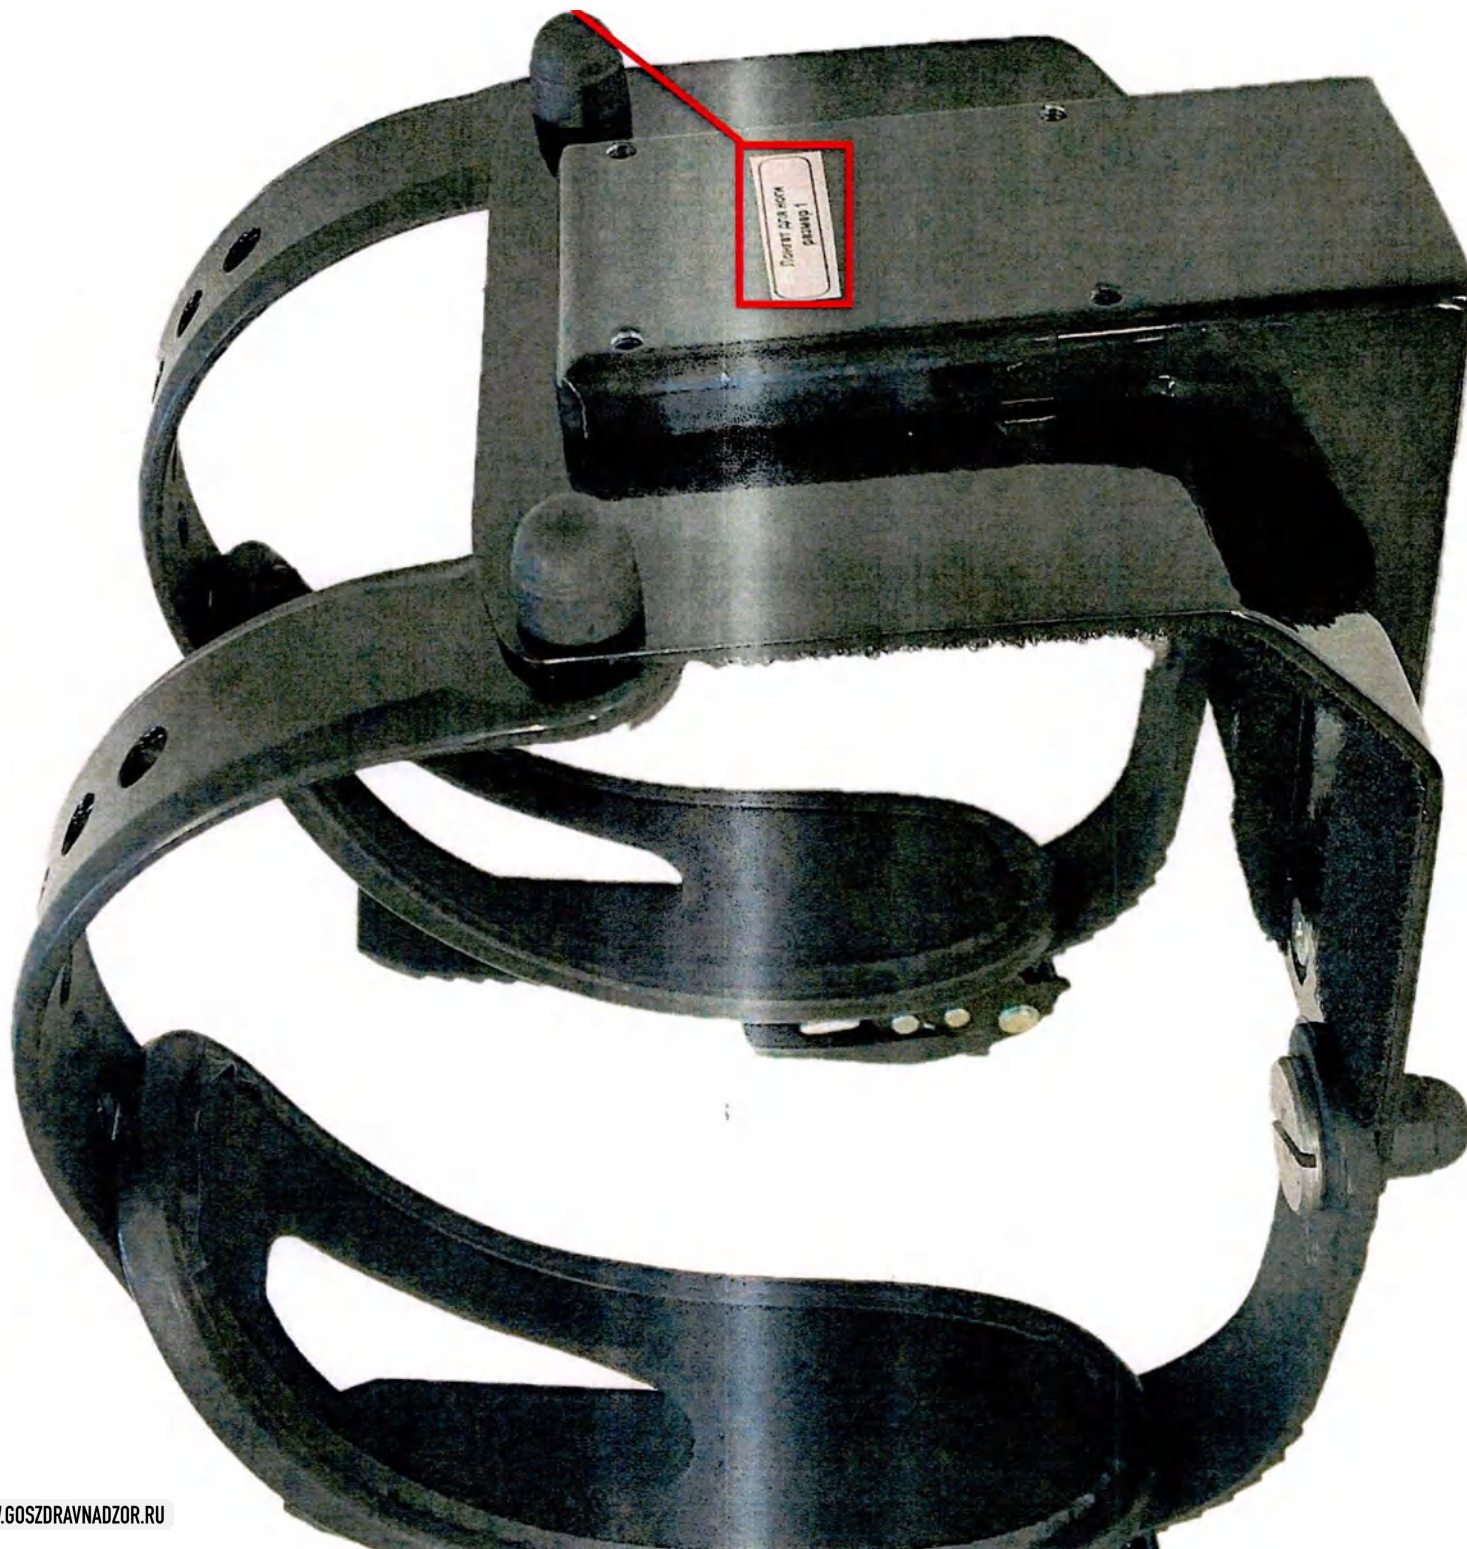




Лонгет для ноги
размер 2


**Лонгет для ноги
размер 2**

**Подушка лонгета
передняя, размер 1**

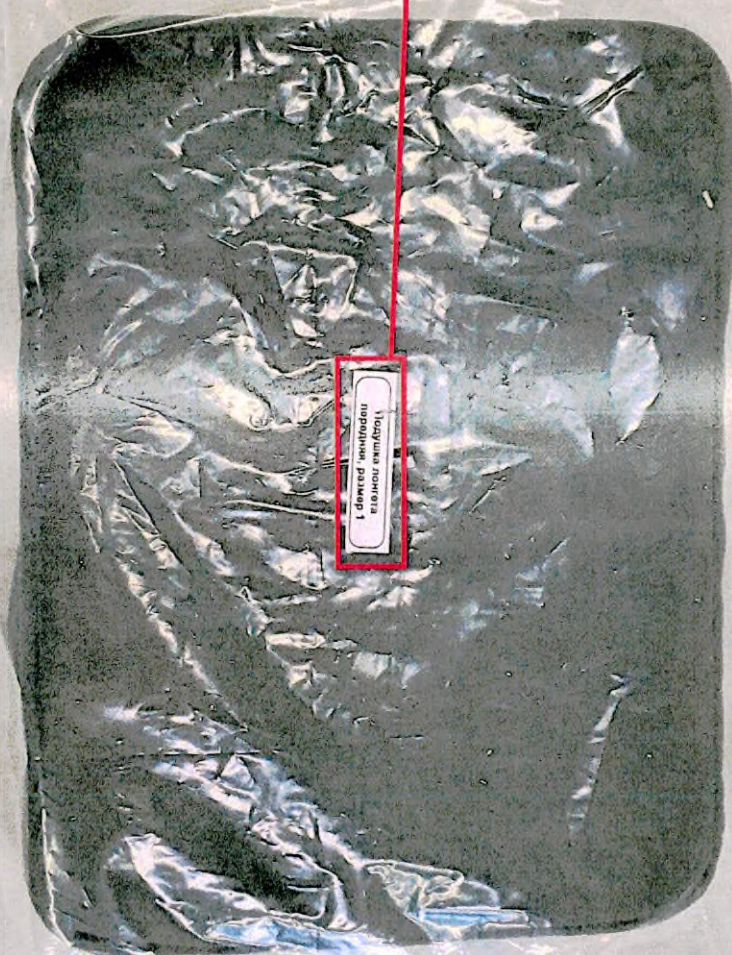

Подушка лонгета
передняя, размер 1

**Подушка лонгета
передняя, размер 2**

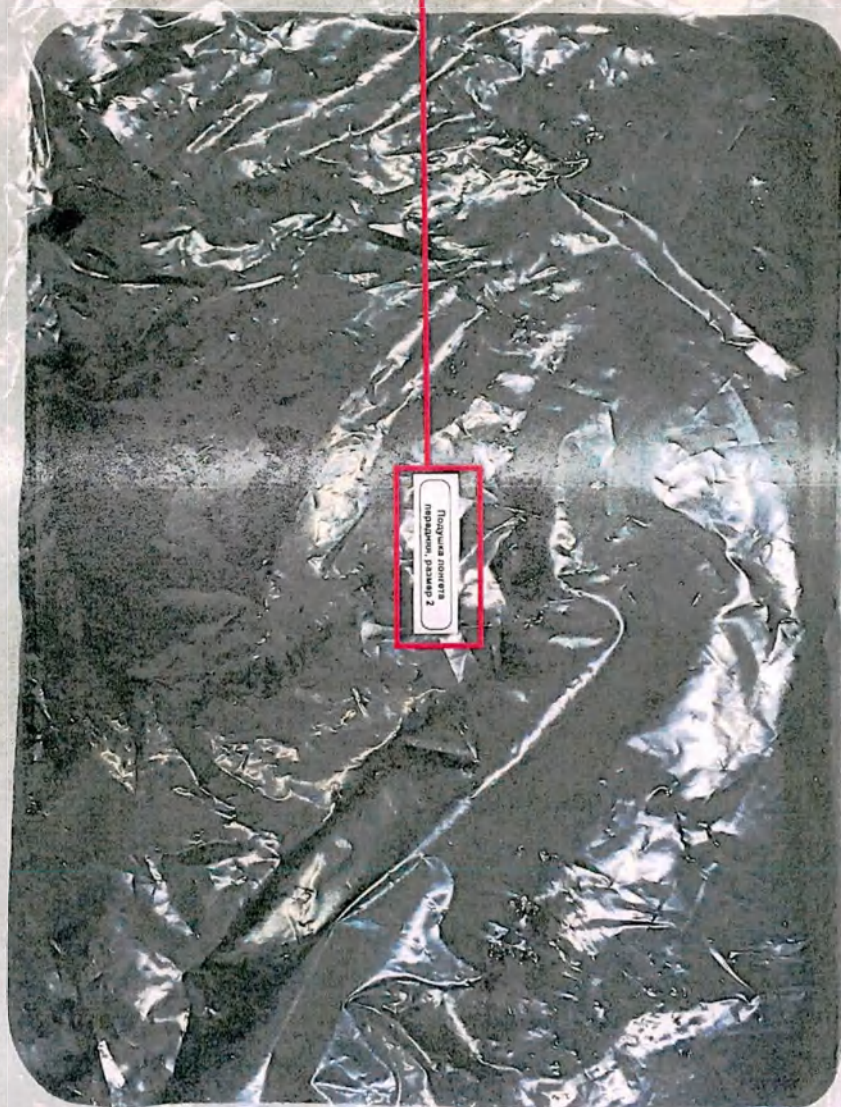


Подушка лонгета
передняя, размер 2

**Подушка лонгета
внутренняя, размер 1**




**Подушка лонгета
внутренняя, размер 2**

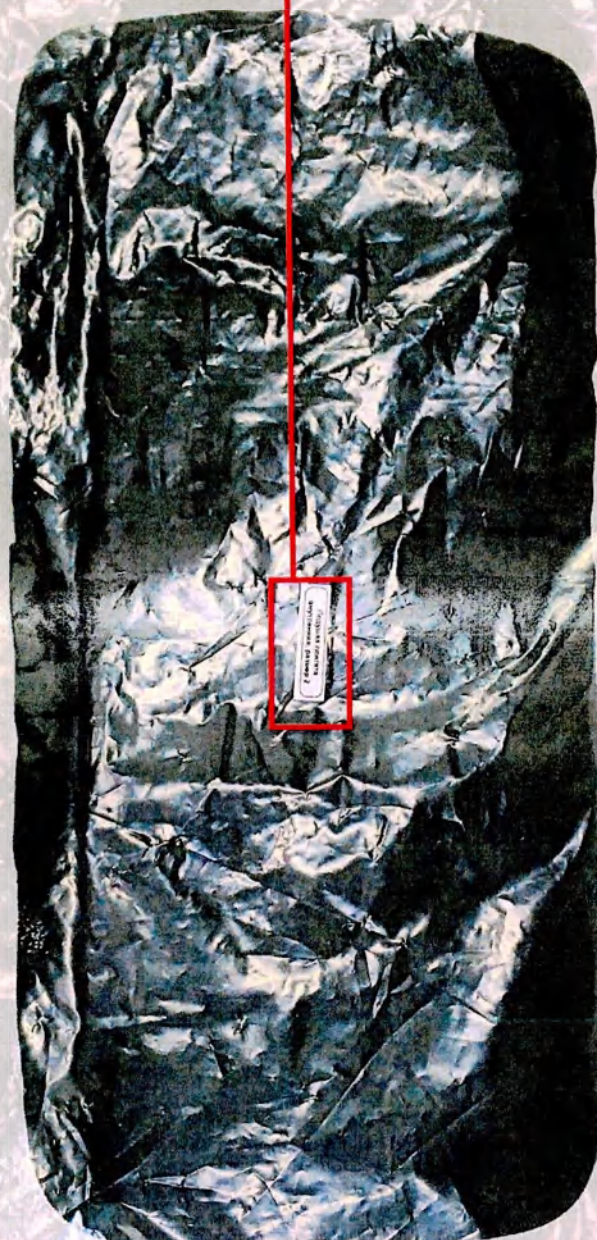



Беспроводное устройство управления

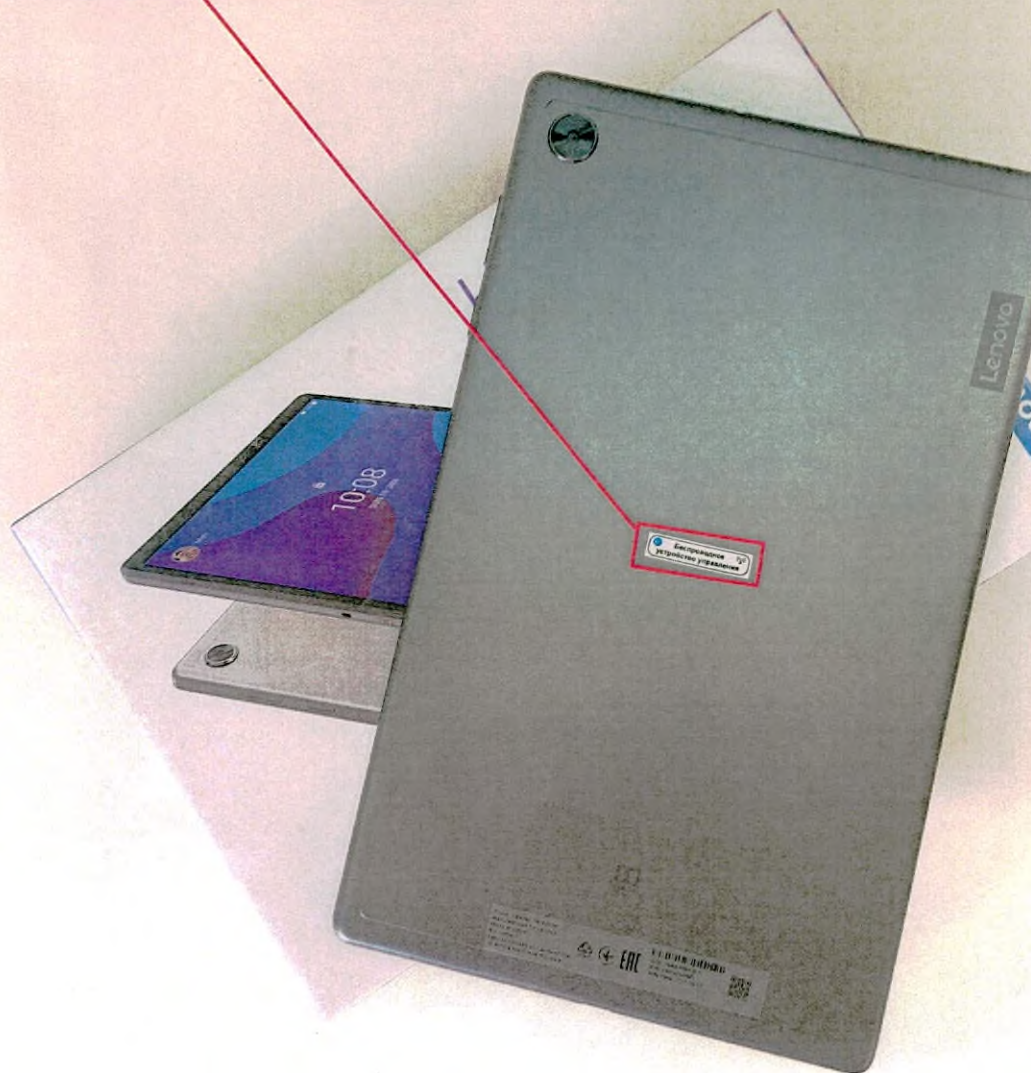


 ООО НПФ «Реабилитационные технологии»		
 Зарядное устройство 		
Ном. частота напряжения питания 50 Гц	Ном. напряжение питания 220 В ~	Макс. потребляемая мощность 20 В · А






Кронштейн крепления пульта костыля

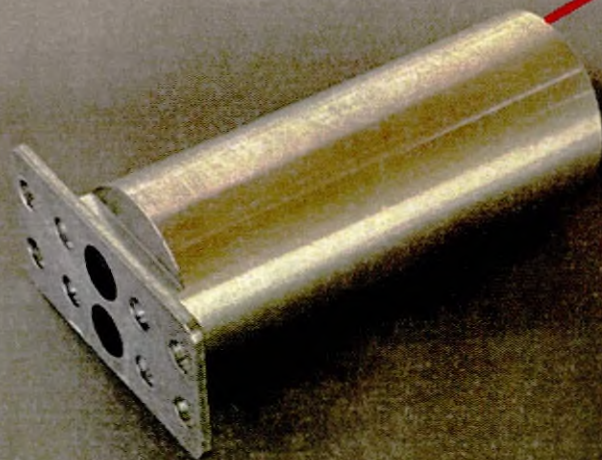




Костыль с опорой под локоть, модель CA851L5,
изготовитель CareMax Rehabilitation Equipment Co.Ltd
Китай, РУ ФСЗ 2010/08463

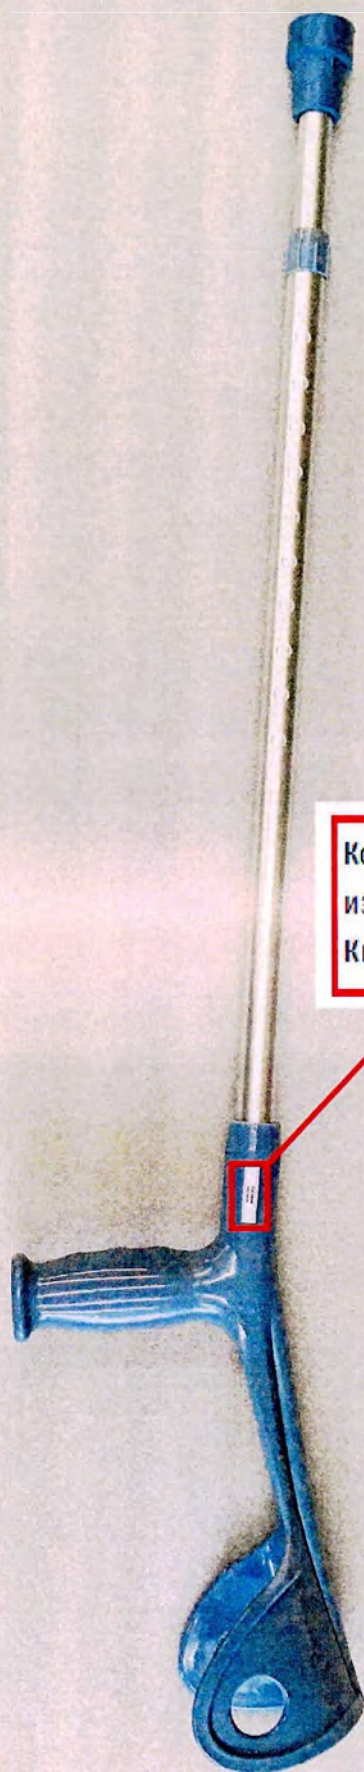

Костыль с опорой под локоть, модель CA851L2,
изготовитель CareMax Rehabilitation Equipment Co.Ltd
Китай, РУ ФСЗ 2010/08463

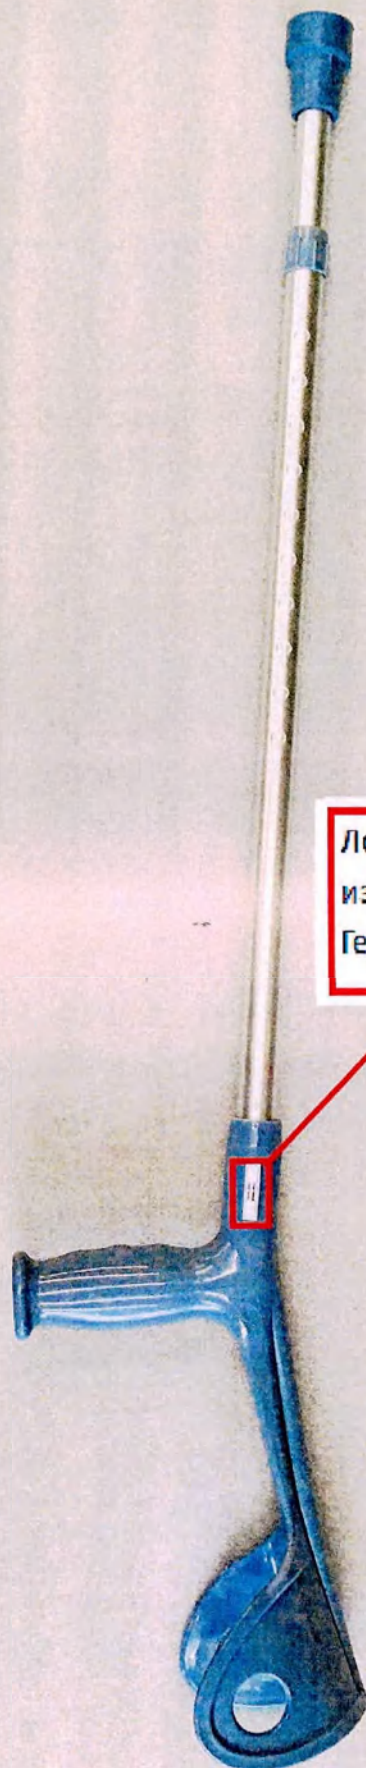

Локтевой костыль Экстраланг, модель 104,
изготовитель REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH,
Германия, РУ ФСЗ 2009/04930

**Отвертка Т-образная
с шестигранными битами
3мм, 4мм, 5мм и 6 мм**

Отвертка Т-образная
с шестигранными битами
3мм, 4мм, 5мм и 6 мм




JTC-72506 Ключ шестигранный
образный 6мм HEX удлиненный
L=135мм JTC

Инструмент слесарно-монтажный.
Импортер ДИВЕИТИСИ ТУЛС КО., ПТД JTC TOOL & CO.
Дунгуань, Тайвань, Тайвань, Ист. Дистрикт, Дунгуань, Ян-Дун-Дун.
No 146, Duing Guang Yuan Road, E. District
Duingping, Taiwan
Импортер и поставщик: ООО "АвтоОптТорг", Россия
120 г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 2, этаж 2.
Тел. 492, Тел. 47 (495) 2-2-1347.
Гарантия не подлежит обязательной сертификации.
Информация! Использовать только по назначению.
Сделано в Тайване
Срок годности не ограничен



Ключ шестигранный 6 мм

Ключ шестигранный 6 мм

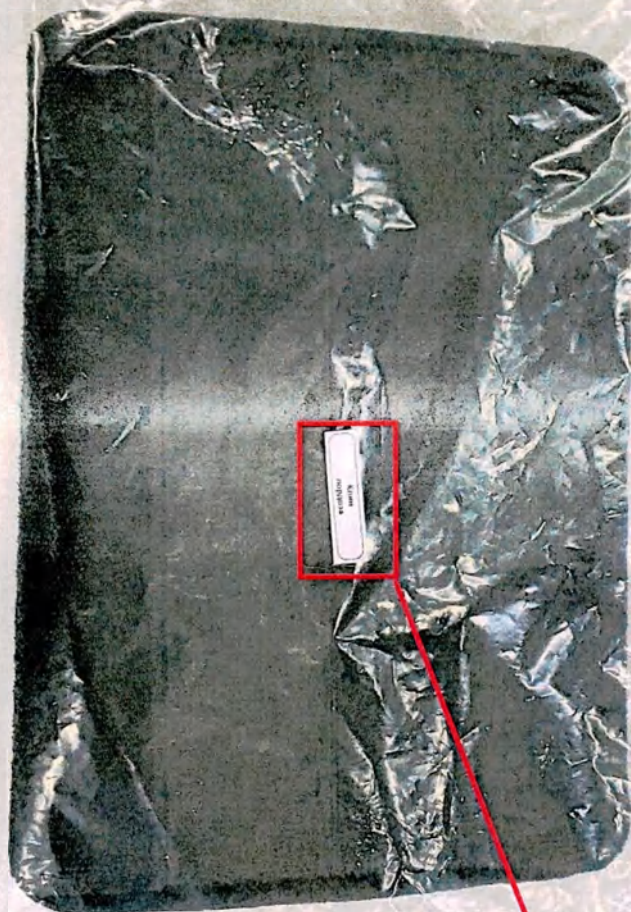


**Клин
лордоза**

**Клин лордоза
увеличенный**



Кабель ФЭС
тип БН размер 1

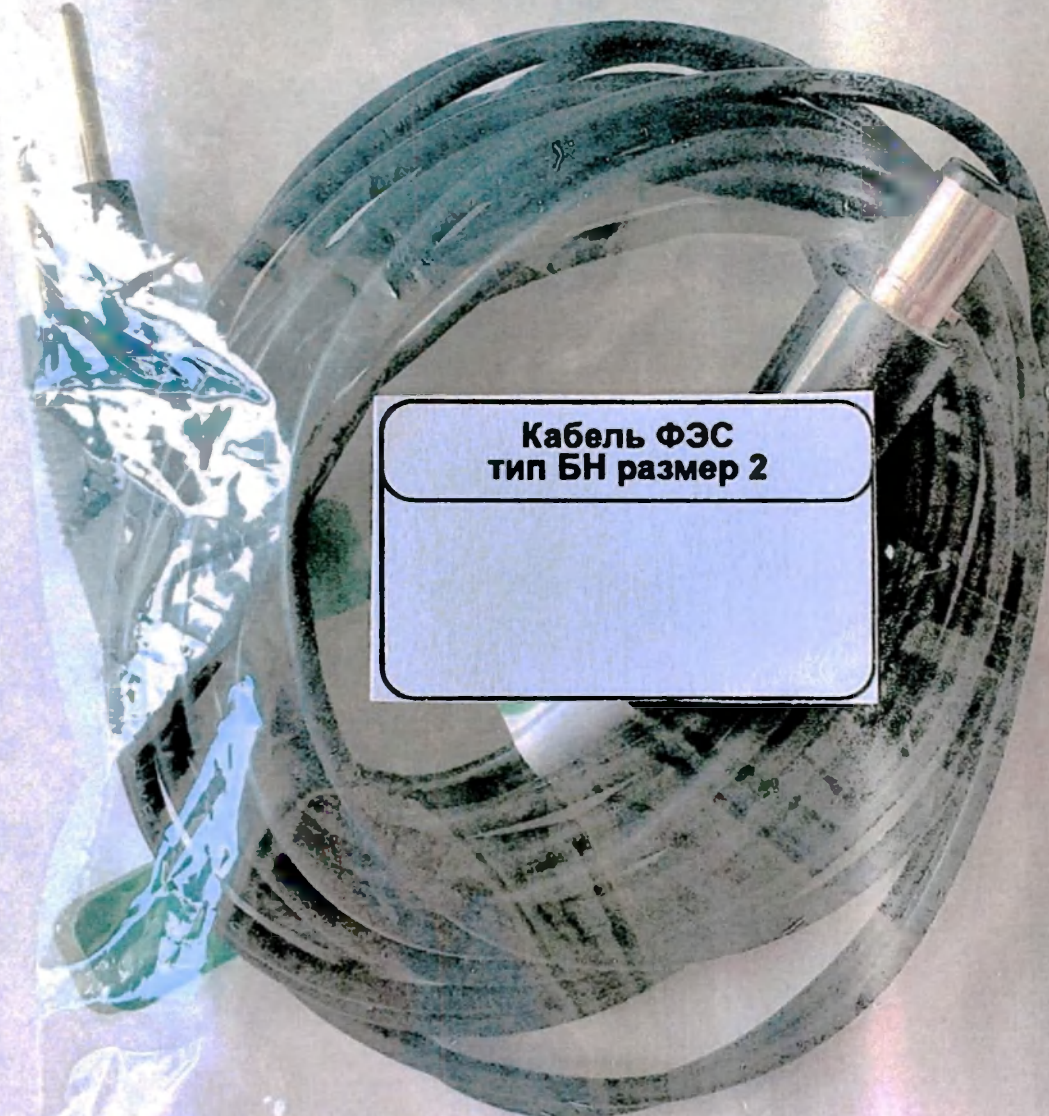

Кабель ФЭС
тип БН размер 2



**Кабель ФЭС
тип КР размер 1**



Кабель ФЭС
тип КР размер 2



Кабель ФЭС
тип КН размер 1



Кабель ФЭС
тип КН размер 2



**Кабель ФЭС
тип КН-3 размер 1**



Кабель ФЭС
тип КН-3 размер 2



Лента фиксирующая
для электродов размер 2



стирка с вещами,
схожими по цвету

Электрод
Электрод
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Ялмова» (АО «ПО «УОМЗ»)

Электрод ЭКГ одноразовый ЭКО **30** штук



ЭЛЕКТРОД ЭКГ С ГЕЛЕМ Ag/AgCl;
PREGELLED ECG ELECTRODES Ag/AgCl;
ELECTRODES ECG PREGELIFIFES Ag/AgCl;
VORGELIERTE EKG ELEKTRODEN Ag/AgCl;
ELECTRODOS ECG Ag/AgCl;
ELETTRODI ECG PREGELLATI IN Ag/AgCl;

ELECTRODOS DE ECG Ag/AgCl COM GEL;
PREGELLED ECG ELECTRODEN Ag/AgCl;
PRÆFYLDE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
FÖRGELADE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
ESITÄYTETTYJÄ EKG-ELEKTRODEJA Ag/AgCl;
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓ Ag/AgCl ΜΕ ΖΕΛΕ.



ТУ 9441-096-07539541-2007

№ ФСР 2008/01666 от 07.02.2019

<http://www.uomz.com>

e-mail: kancelyariya@uomz.com

тел.: +7(343)229-83-84

ул. Восточная, 33 б, 620100, г. Екатеринбург, Россия

5220.00000000

ЭЛЕКТРОД

01	02	03	04	05	06	07
26	30	40	50	26	30	40
50	26	30	40	50	26	30

LOT

№ 01230785







Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ

Анционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яковлева» (АО «ПО «УОМЗ»)

УОМЗ


Электрод ЭКГ одноразовый ЭКО 30 штук



ЭЛЕКТРОД ЭКГ С ГЕЛЕМ Ag/AgCl;
 PREGELLED ECG ELECTRODES Ag/AgCl;
 ELECTRODES ECG PREGELIFIEES Ag/AgCl;
 VORGELEIETER ECG Ag/AgCl;
 ELECTRODOS ECG Ag/AgCl;
 ELETTRODI ECG PREGELLATI IN Ag/AgCl;

ELECTRODOS DE ECG Ag/AgCl COM GEL;
 PREGELLED ECG ELECTRODEN Ag/AgCl;
 PRÆFYLDE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 FÖRBEGLADE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 ESITÄYTETTYJÄ EKG-ELEKTRODEJA Ag/AgCl;
 КАРДИОЛОГИКА НАЛЕКТРОДИА НКГ Ag/AgCl ME ZELEN.

TY 9441-096-07539541-2007
 № ФСР 2008/01666 от 07.02.2019
 http://www.uomz.com
 e-mail: kancelyariya@uomz.com
 тел.: +7(343)229-83-84
 ул. Восточная, 33 б, 620100, г. Екатеринбург, Россия



3220.00000000	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	
ЭЛЕКТРОДА	26	30	40	50	26	30	40	50
LOT	31	19	2025					
No	01230283							



ЭЛЕКТРОТОНУС

REF CN3200S

LOT B200105

04/2023



Срок эксплуатации электродов – не более 30 циклов.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.



ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018

ПУ № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.

Декларация о соответствии № РОСС RU.Д-РУ.ИМ18.В.00371/19
Срок действия: 12.11.2019г. – 11.11.2022г.

Электрод адгезивный
низкочастотный
круглый диаметр 32 мм.

Электрод адгезивный самоклеящийся
для низкочастотной электротерапии
круглый диаметром 32 мм.

кнопочный контакт

Для индивидуального пользования

Количество в упаковке: 4 шт.



ЭЛЕКТРОТОНУС

REF CN5050S

02/2023

**Электрод адгезивный самоклеящийся
для низкочастотной электротерапии
квадратный 50х50 мм.**

кнопочный контакт

Для индивидуального пользования

Количество в упаковке: 4 шт.



Срок эксплуатации электродов – не более 30 циклов.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.



ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1,
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018

ПУ № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-РУ.ИМ18.В.00371/19

Срок действия: 12.11.2019г. – 11.11.2022г.



ЭЛЕКТРОТОНУС

REF CN50100S

LOT B200105

04/2023



**Электрод адгезивный самоклеящийся
для низкочастотной электротерапии
прямоугольный 50x100 мм.**

кнопочный контакт

Для индивидуального пользования

Количество в упаковке: 4 шт.

Срок эксплуатации электродов – не более 30 циклов.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.




ЭЛЕКТРОТОНУС

Электрод физиотерапевтический с токопроводящей углеродной тканью

не стерильно

LOT 347




10/2022

Гарантийный срок хранения – 2 года со
дня изготовления при хранении в закрытых
помещениях при температуре от -50 до $+40^{\circ}\text{C}$ и влажности 98% (при 25°C).




ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 9398-001-64660538-2014
ПУ № РЗН 2015/3490 от 31.12.2015г.

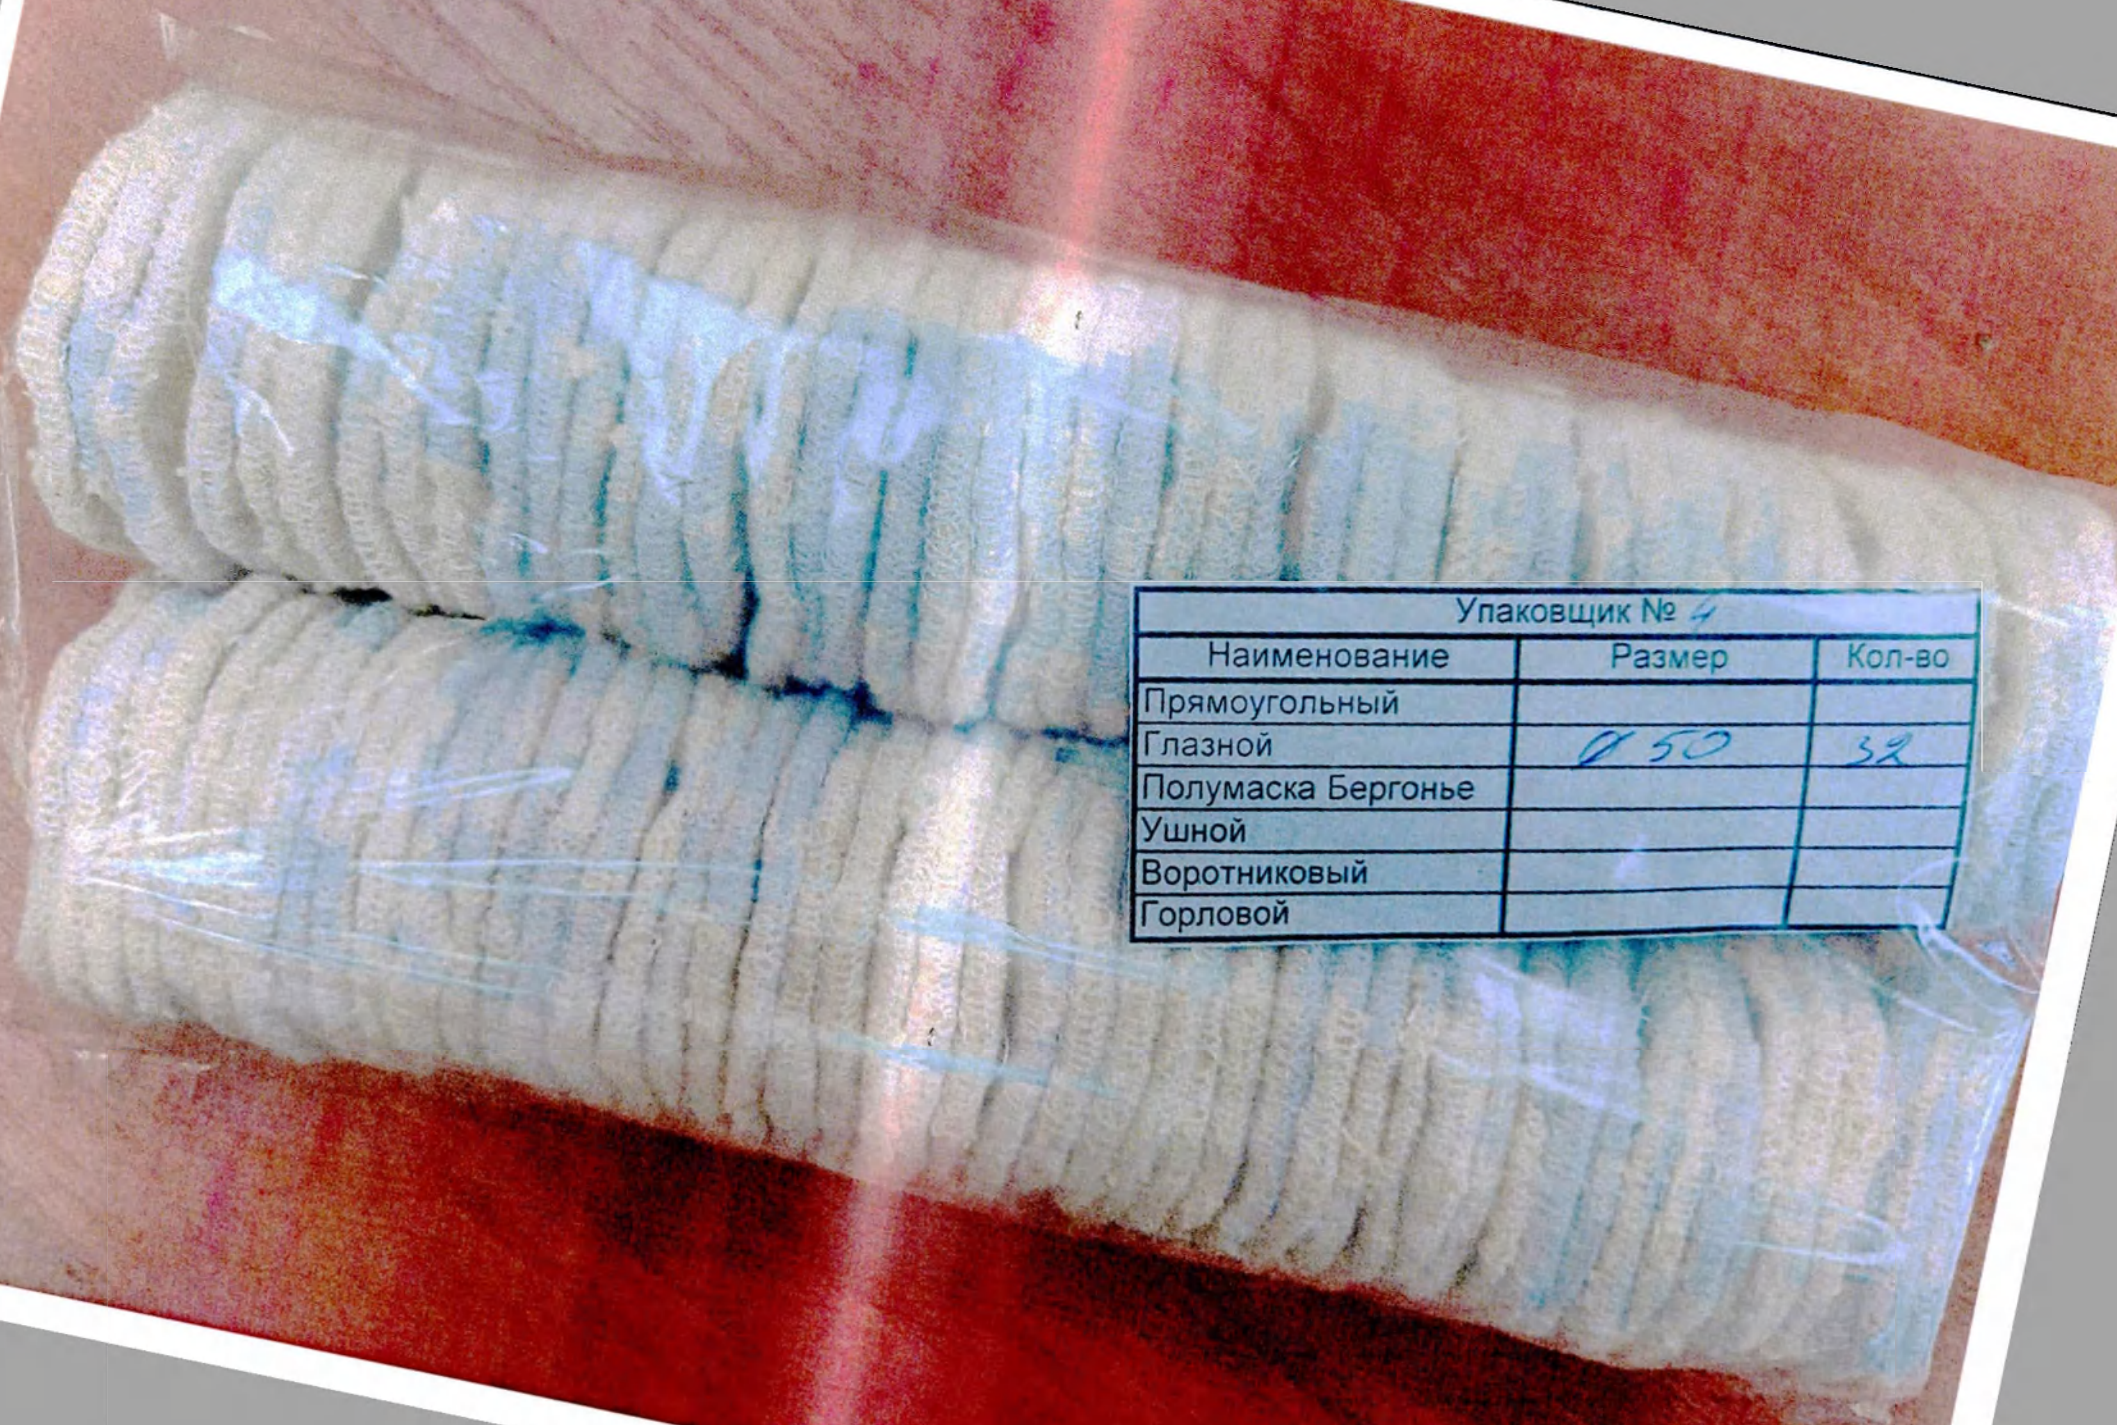

Упаковщик № 4		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный		
Глазной	Ø 50	32
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

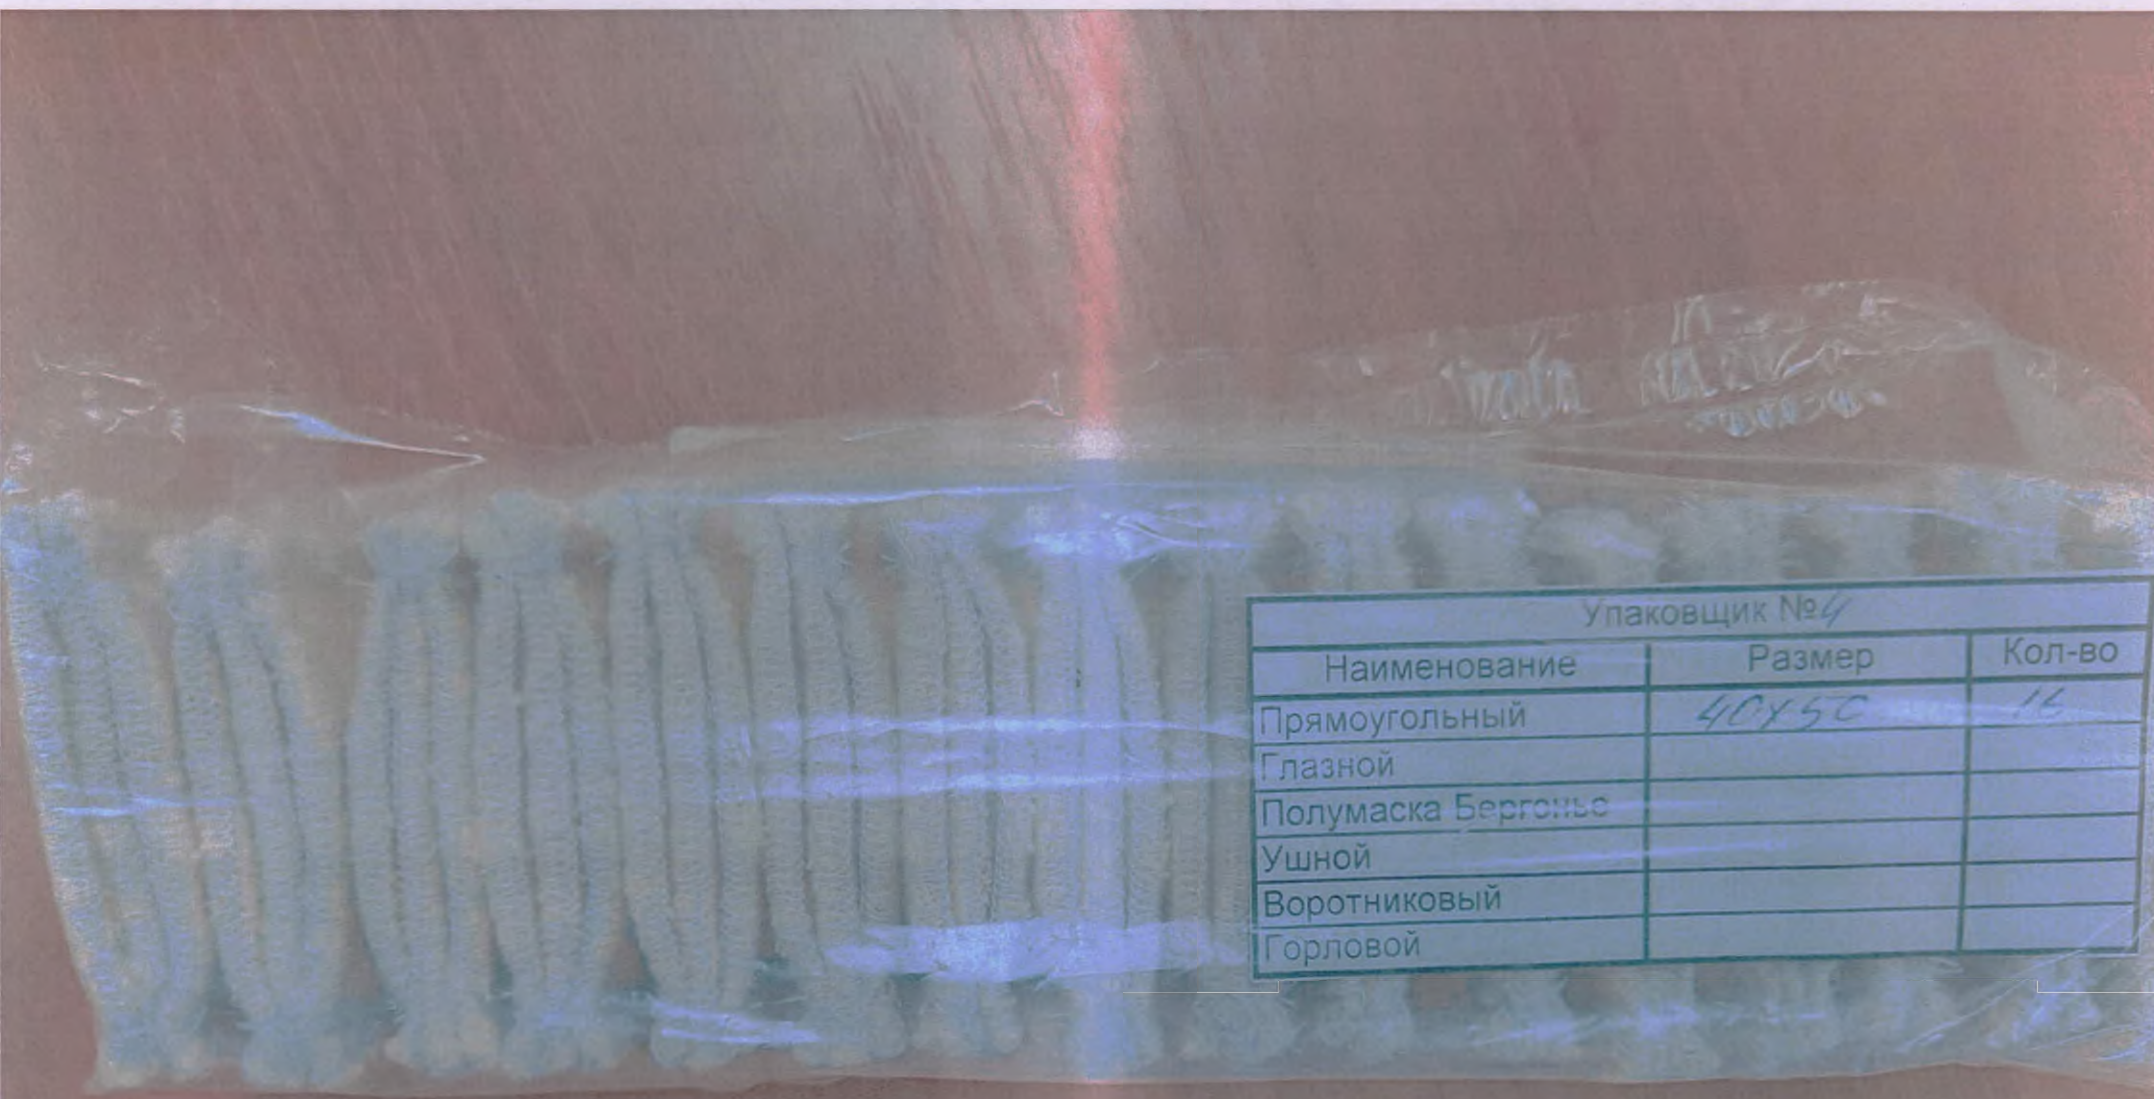

Упаковщик №4		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	40x50	16
Глазной		
Полумаска Бергоньс		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Упаковщик №

Наименование	Размер	
Прямоугольный	30 x 60	2
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Упаковщик №		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	40 x 100	2
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Упаковщик №		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	50 x 100	2
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Всё зафиксировано.

СДЕЛАНО В РОССИИ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ФИКСИРУЮЩИЙ
для фиксации предметов и
материалов медицинского
назначения

Ролепласт

на нетканой основе

10 см x 10 см
1 штука



Способ применения: 1. Извлечь из упаковки. 2. Отрезать с помощью ножниц кусок нужного размера. 3. Снять защитный слой. 4. Зафиксировать лейкопластырем предметы или материалы медицинского назначения.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по
ТУ 21.20.24-004-74639918-2020

Регистрационное удостоверение РУ ФСР 2007/00789 от 28.10.2020

Условия хранения: 2(С) ГОСТ 15150-69 (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69

Утилизация: в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для класса А опасности.

10 см x 10 м

1 штука



4 607021 270625



**Лейкопластырь фиксирующий,
нестерильный, «Ролепласт»
по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020;
ПУ № ФСР 2007/00789 от 05.07.2021г.**

Вид подложки	нетканая основа
Размер	10см x 10м
Количество	1шт.
Дата изготовления	03.06.22
Серия №	030622M3
Использовать до	06.2025

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для фиксации предметов и материалов медицинского назначения. **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** Извлечь из упаковки, отрезать с помощью ножниц кусок нужного размера, снять защитный слой, зафиксировать лейкопластырем предметы или материалы медицинского назначения.

СОСТАВ: полотно перфорированное нетканое, прерывный клеевой слой, бумага антиадгезионная. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** индивидуальная непереносимость компонентов/материалов. **УТИЛИЗАЦИЯ:** в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для класса А опасности. **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** 2(С) ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%.)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69


Беречь изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Не применять повторно.

Произведено для ООО «БИОТЕКФАРМ»
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл.
Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79
Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36
www.voscopran.ru ; Наш интернет магазин: www.stoprana.ru



4 607021 0275002

«Все заживет»®



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

фиксирующий, нестерильный, «Ролепласт»

по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020;

РУ № ФСР 2007/00789 от 05.07.2021г.

Вид подложки	нетканая основа
Размер	15см x 10м
Количество	1шт.
Дата изготовления	02 05 22
Серия №	020522M3
Использовать до	05 2025

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для фиксации предметов и материалов медицинского назначения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Извлечь из упаковки, отрезать с помощью ножниц кусок нужного размера, снять защитный слой, зафиксировать предметы или материалы медицинского назначения.

СОСТАВ: полотно перфорированное нетканое, прерывный клеевой слой, бумага антиадгезионная

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для класса А опасности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 2(С) ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%.)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69

Беречь изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Не применять повторно.

Произведено для ООО «БИОТЕКФАРМ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевозочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о, д. Жучки, д.2а. Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36

«Все заживет»®








ГЕЛЬТЕК™

УНИ СПРЕЙ

Жидкость электродная контактная
высокопроводящая

для ЭКГ и других электрофизиологических исследований

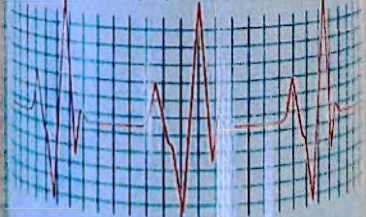

4 670014 15 04 6

Масса нетто 200 г

Исходность электродная высокопроводящая среда для ЭКГ, дефибрилляции, электрокардиостимуляции, электромагнитного сканирования, электроимпульсного лечения. Применение: наносится на электрод или электроды для обеспечения контакта с кожей. Жидкость снимается салфеткой, смоченной водой. Жидкость не вызывает аллергии.

Состав: вода, глицерин, хлорид калия, пропан-2-ол, поливинилпирролидон, консервант, перфторокислоты, дисодиум ЭДТА, краситель.

Производитель: ООО "Гельтек-Медика", Россия.

Адрес: г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 10.

Тел.: +7(495) 956-93-66.

серия № E4422 код: 31
дата изг.: 10.22 годен до: 10
№ 100-79063983-2005. Рег. уд. № СР 2110/08253 от 18
температурен от +5°C до +40°C
по классу А (СанПин 2.1.7.2 0-10)


Ремень для подвеса





**Сиденье
с ящиком**

**Крепление
для беспроводного
устройства управления**

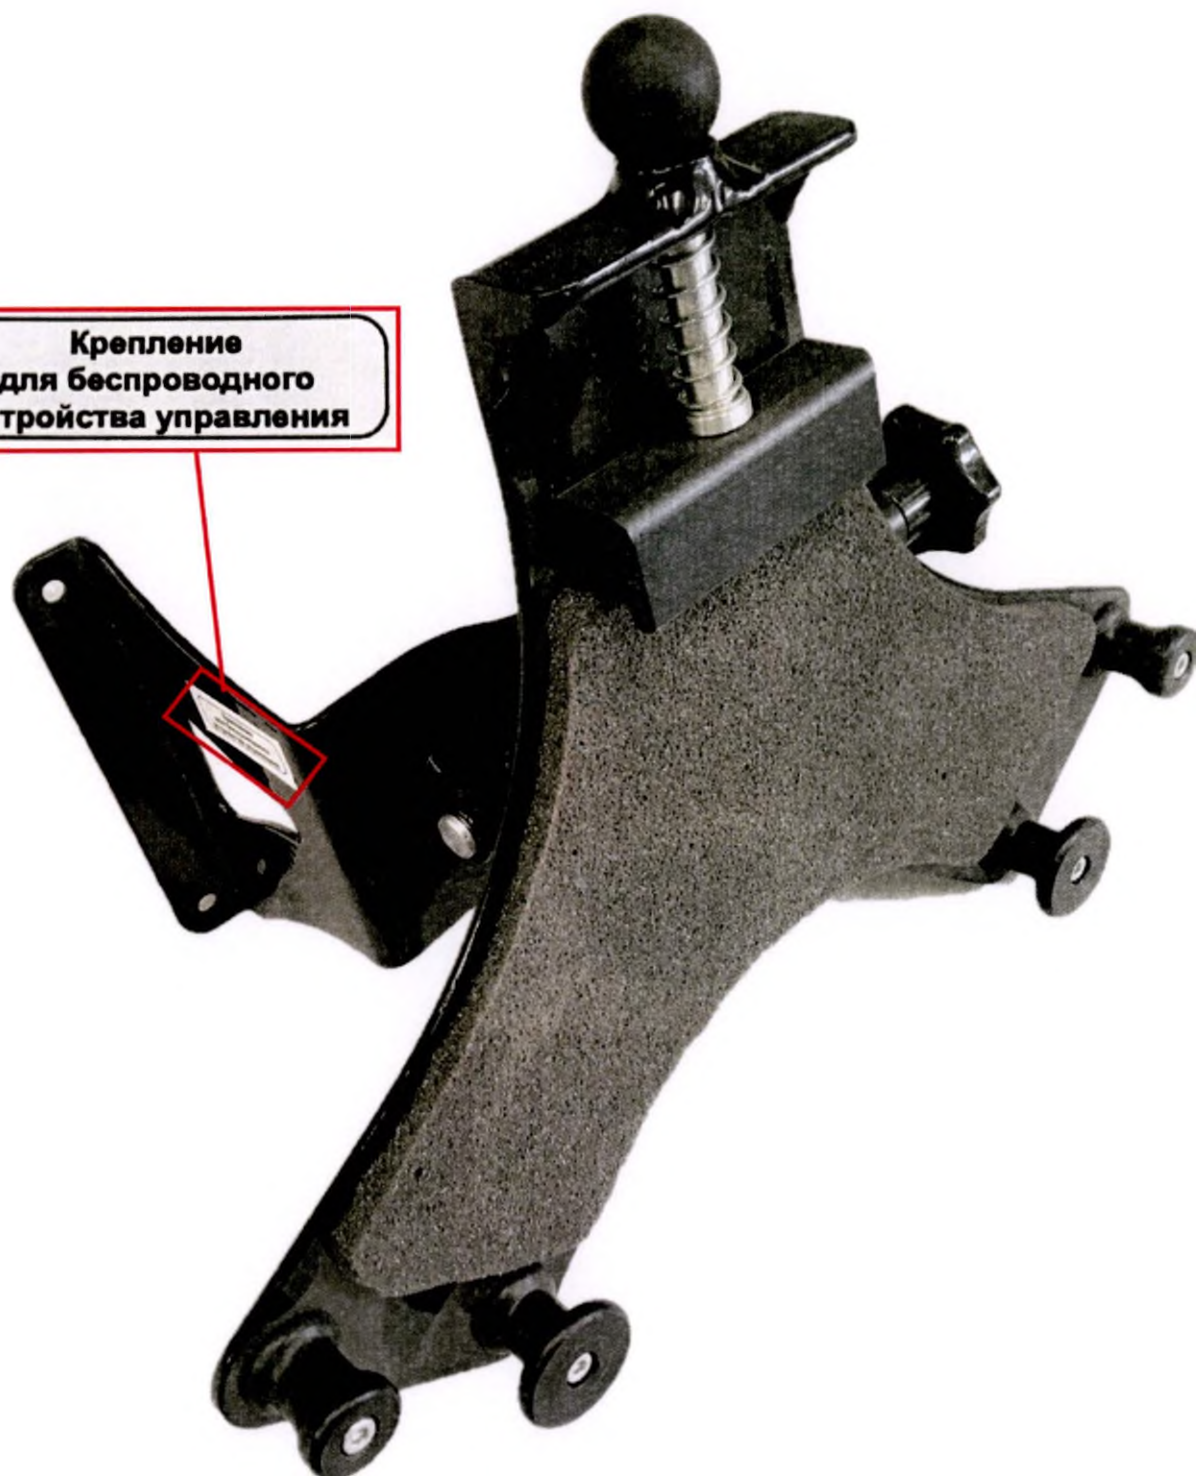




Роботизированный тренажер с БОС для восстановления навыков ходьбы со встроенной системой синхронизированной электростимуляции "Экзоскелет для реабилитации E-Heidet FES", модификация 1G-K с подключением для ФЭС на спинном модуле экзоскелета - опция [C].

Производитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
Заводской номер: 54
ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

ЭКЗоскелет



ЭКЗоскелет



30

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Роботизированный тренажер с БОС
для восстановления навыков ходьбы
со встроенной системой синхронизированной электростимуляции
"Экзоскелет для реабилитации E-Helper-FES"
по ТУ 32.50.50-020-68709709-2022

Модификация 16-K

Опция: ☐ К ☐ С

Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)



Максимальная масса пациента: 110 кг

Изделие с внутренним источником питания

Параметры зарядного устройства: $\approx 43.8 \text{ В} / 1.65 \text{ А}$

Заводской номер: 001



05 2022

IP10



Директор ООО «НПФ
Реабилитационные технологии»
Емельянов А.В.

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 22 лист(ов)

