

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

« 12 » декабря 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-240-65614693-2022»


2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 240-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Инсулин

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.01.2025	REF	C86036
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 240-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Инсулин

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.01.2025	REF	C86036
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия


1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 240-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а





Лидлаб Амур Инсулин

Набор реагентов на 500 тестов

YNLO



ProClin 300



01.07.2023

C86036

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 240-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а




Лидлаб Амур Инсулин

Набор реагентов на 1000 тестов

YNLO



ProClin 300



01.07.2023

C86036

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
6. Инструкция по применению – 1 шт.;
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

Лидлаб Амур
Инсулин

3,5мл 4,0мл
R 1 R 2

LOT 20230701 01.01.2025

IVD   ProClin 300  

2°C 8°C 1x50

9031 1017

лидкор
Лидлаб Амур Инсулин

1,0 мл

CAL 1

LOT 20230701
01.01.2025
REF C86036

IVD   ProClin 300  

2°C 8°C

лидкор
Лидлаб Амур Инсулин

1,0 мл

CAL 2

LOT 20230701
01.01.2025
REF C86036

IVD   ProClin 300  

2°C 8°C

лидкор
Лидлаб Амур Инсулин

1,0 мл

CAL 3

LOT 20230701
01.01.2025
REF C86036


IVD   ProClin 300  

2°C 8°C

лидкор
**Лидлаб Амур
Инсулин**

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701



01.01.2025


REF C86036




Лидлаб Амур Инсулин




LOT 20230701 EXP 01.01.2025

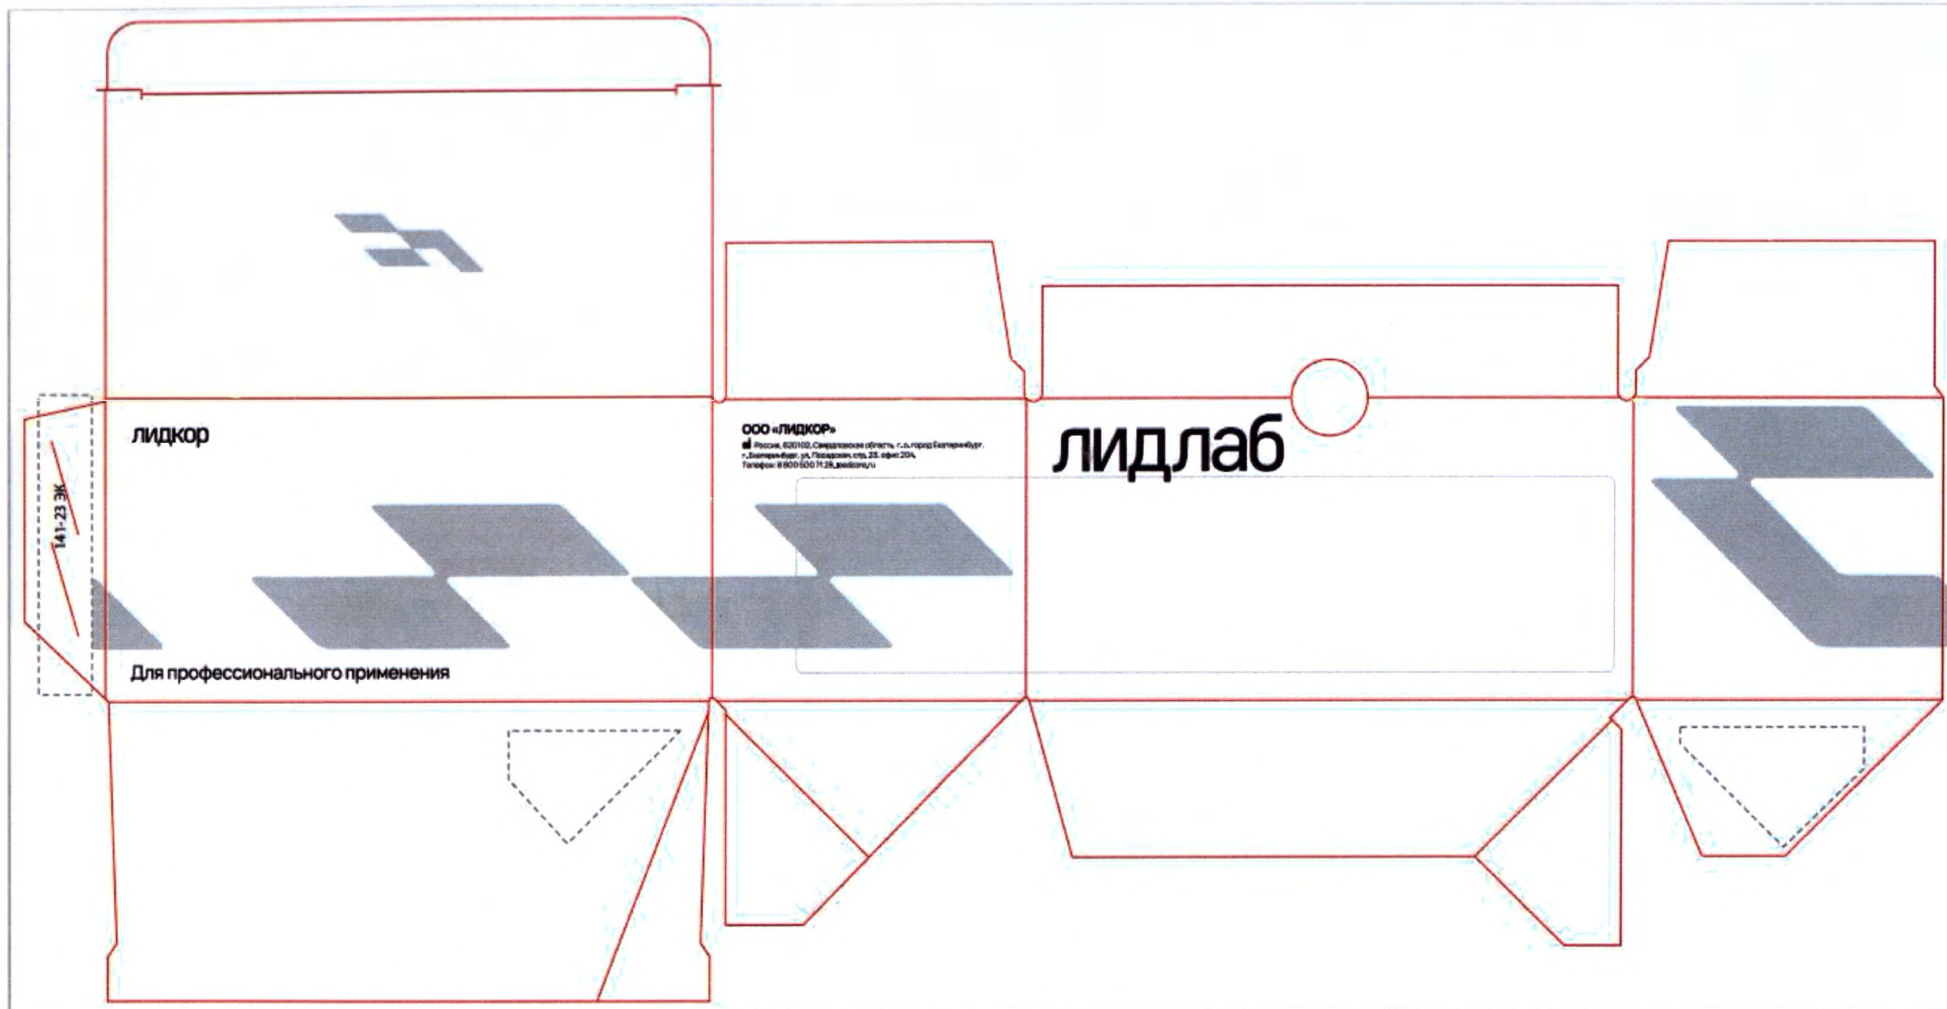

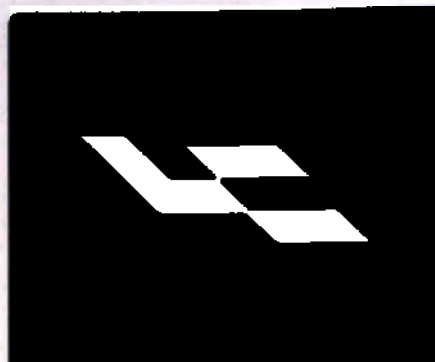

Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 240-65614693-2022

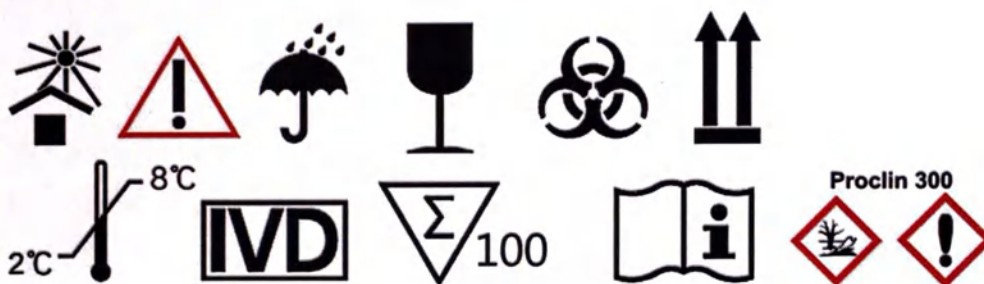

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.01.2025	REF	C86036

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (Семь) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут

« 28 » декабря 2023 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-240-65614693-2022»


2023




Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

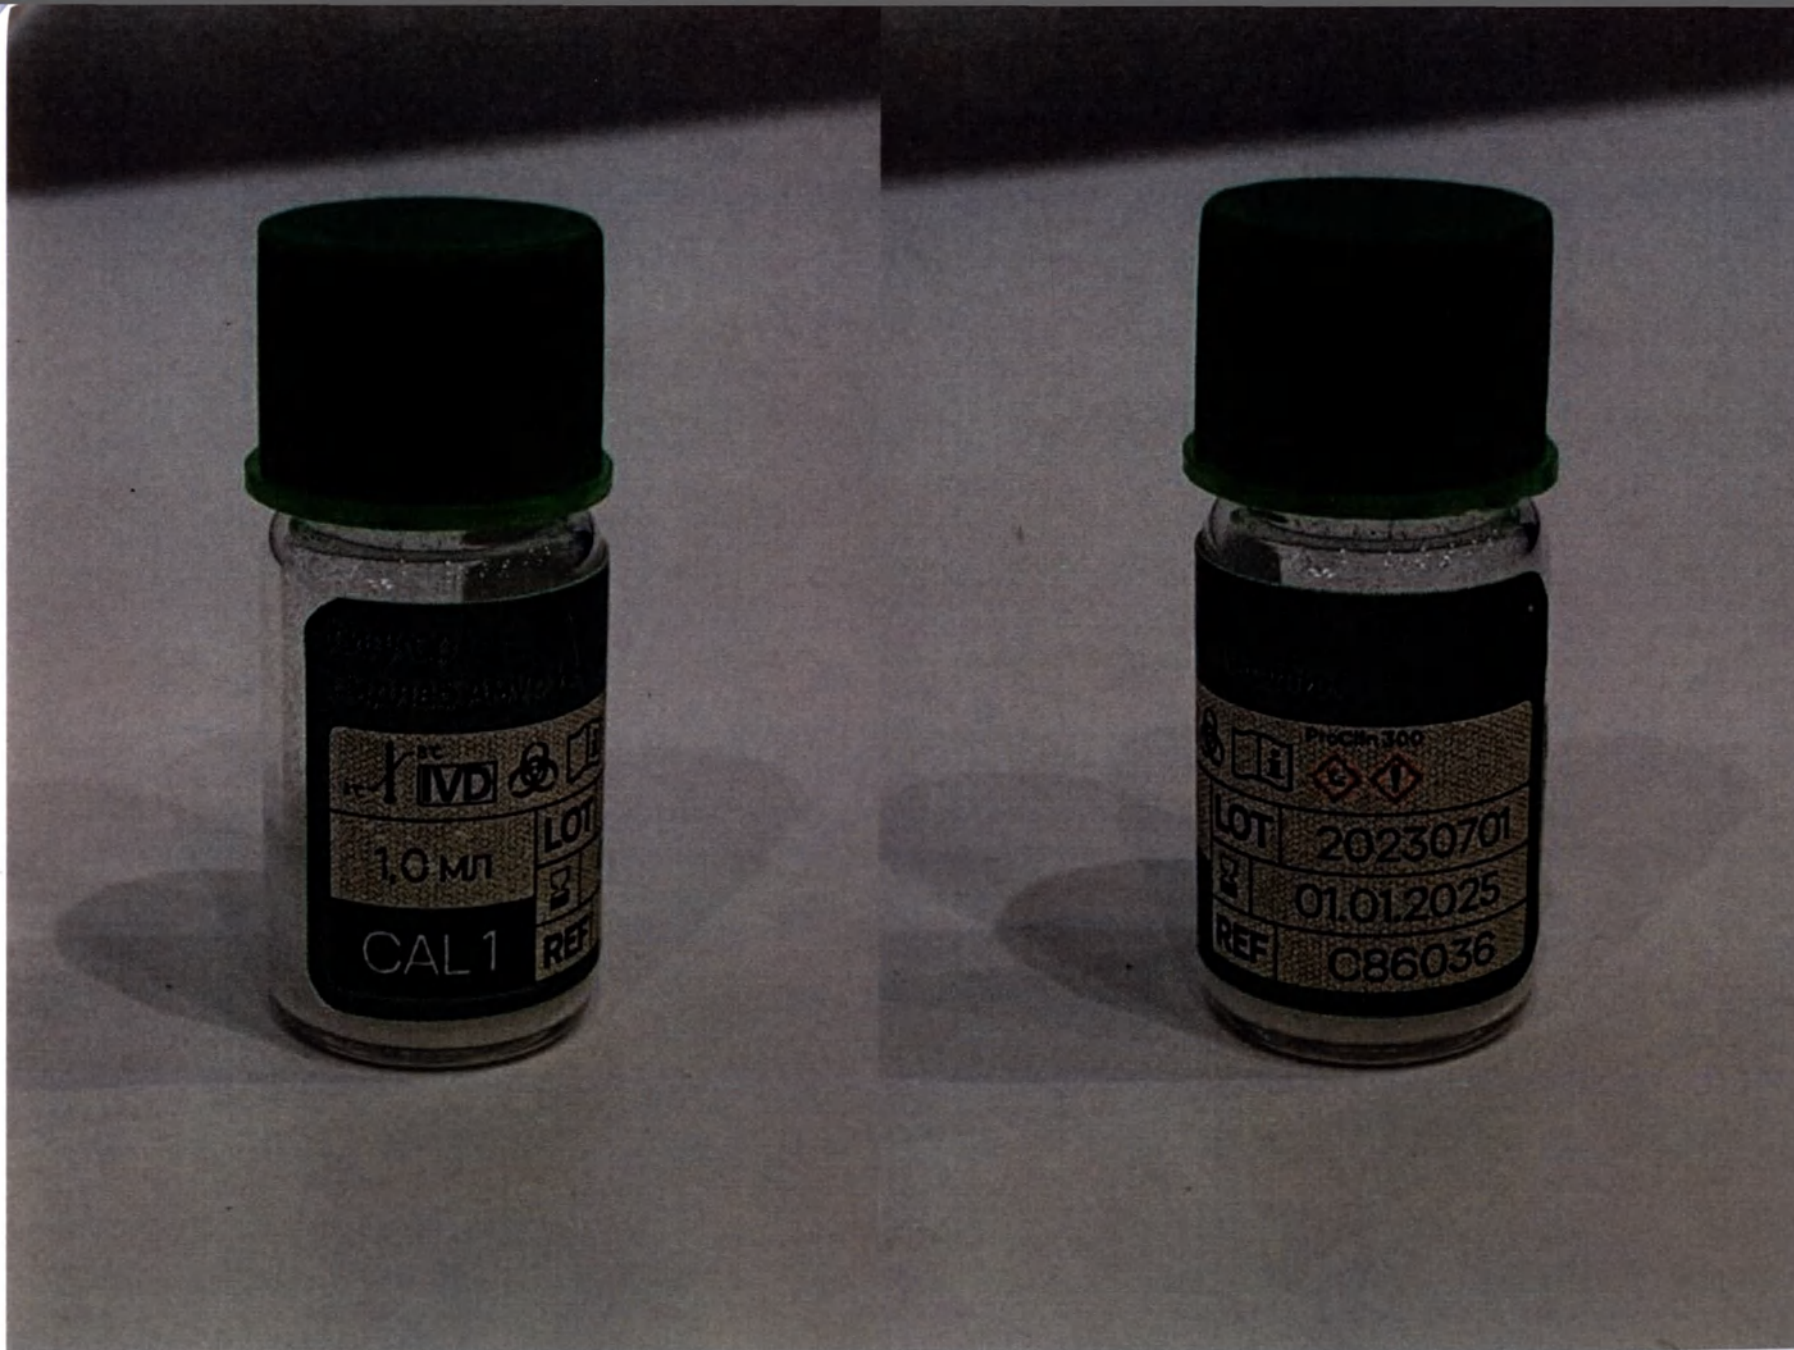


Калибратор 1 (CAL1)

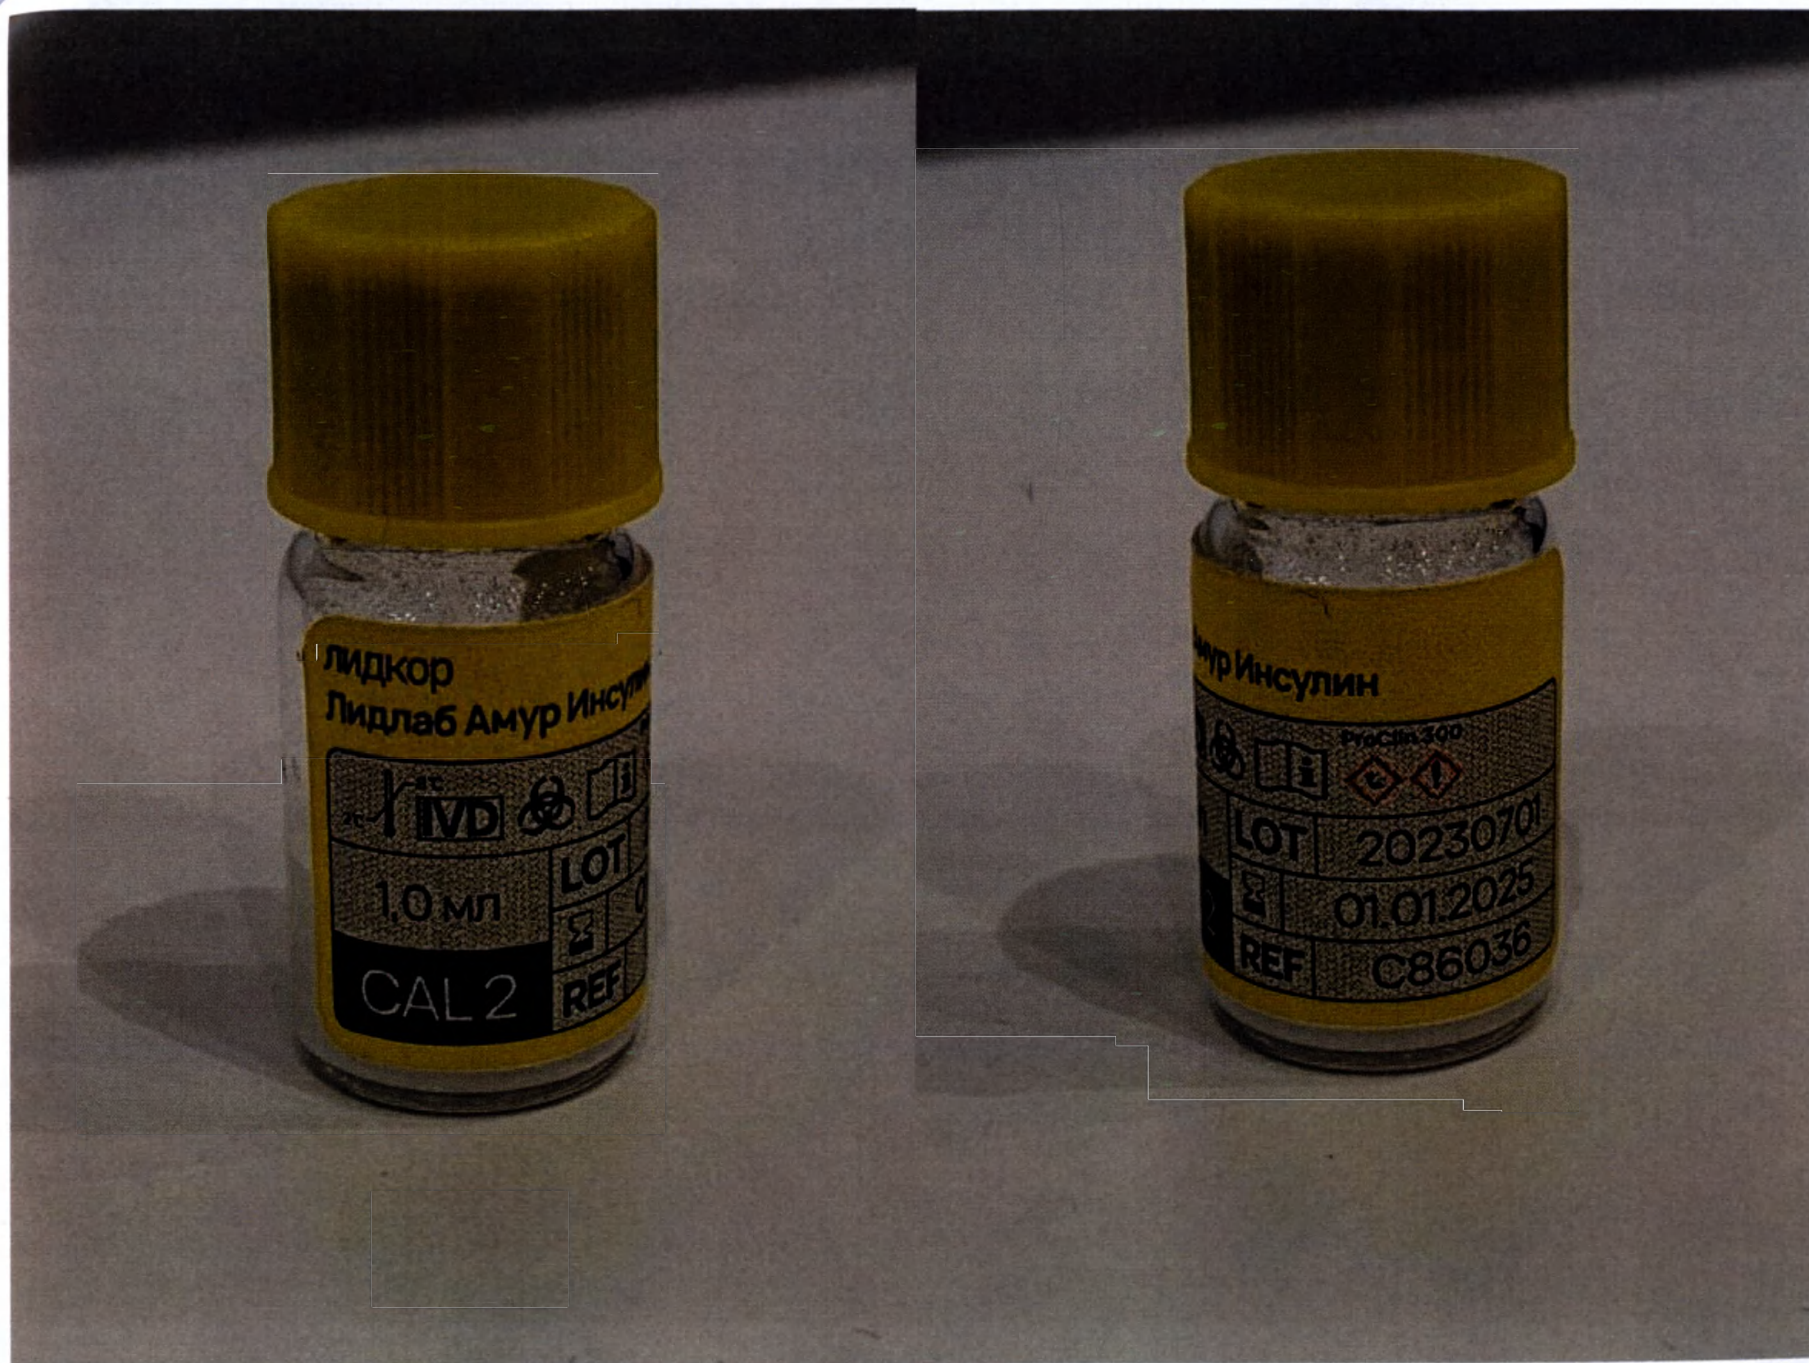

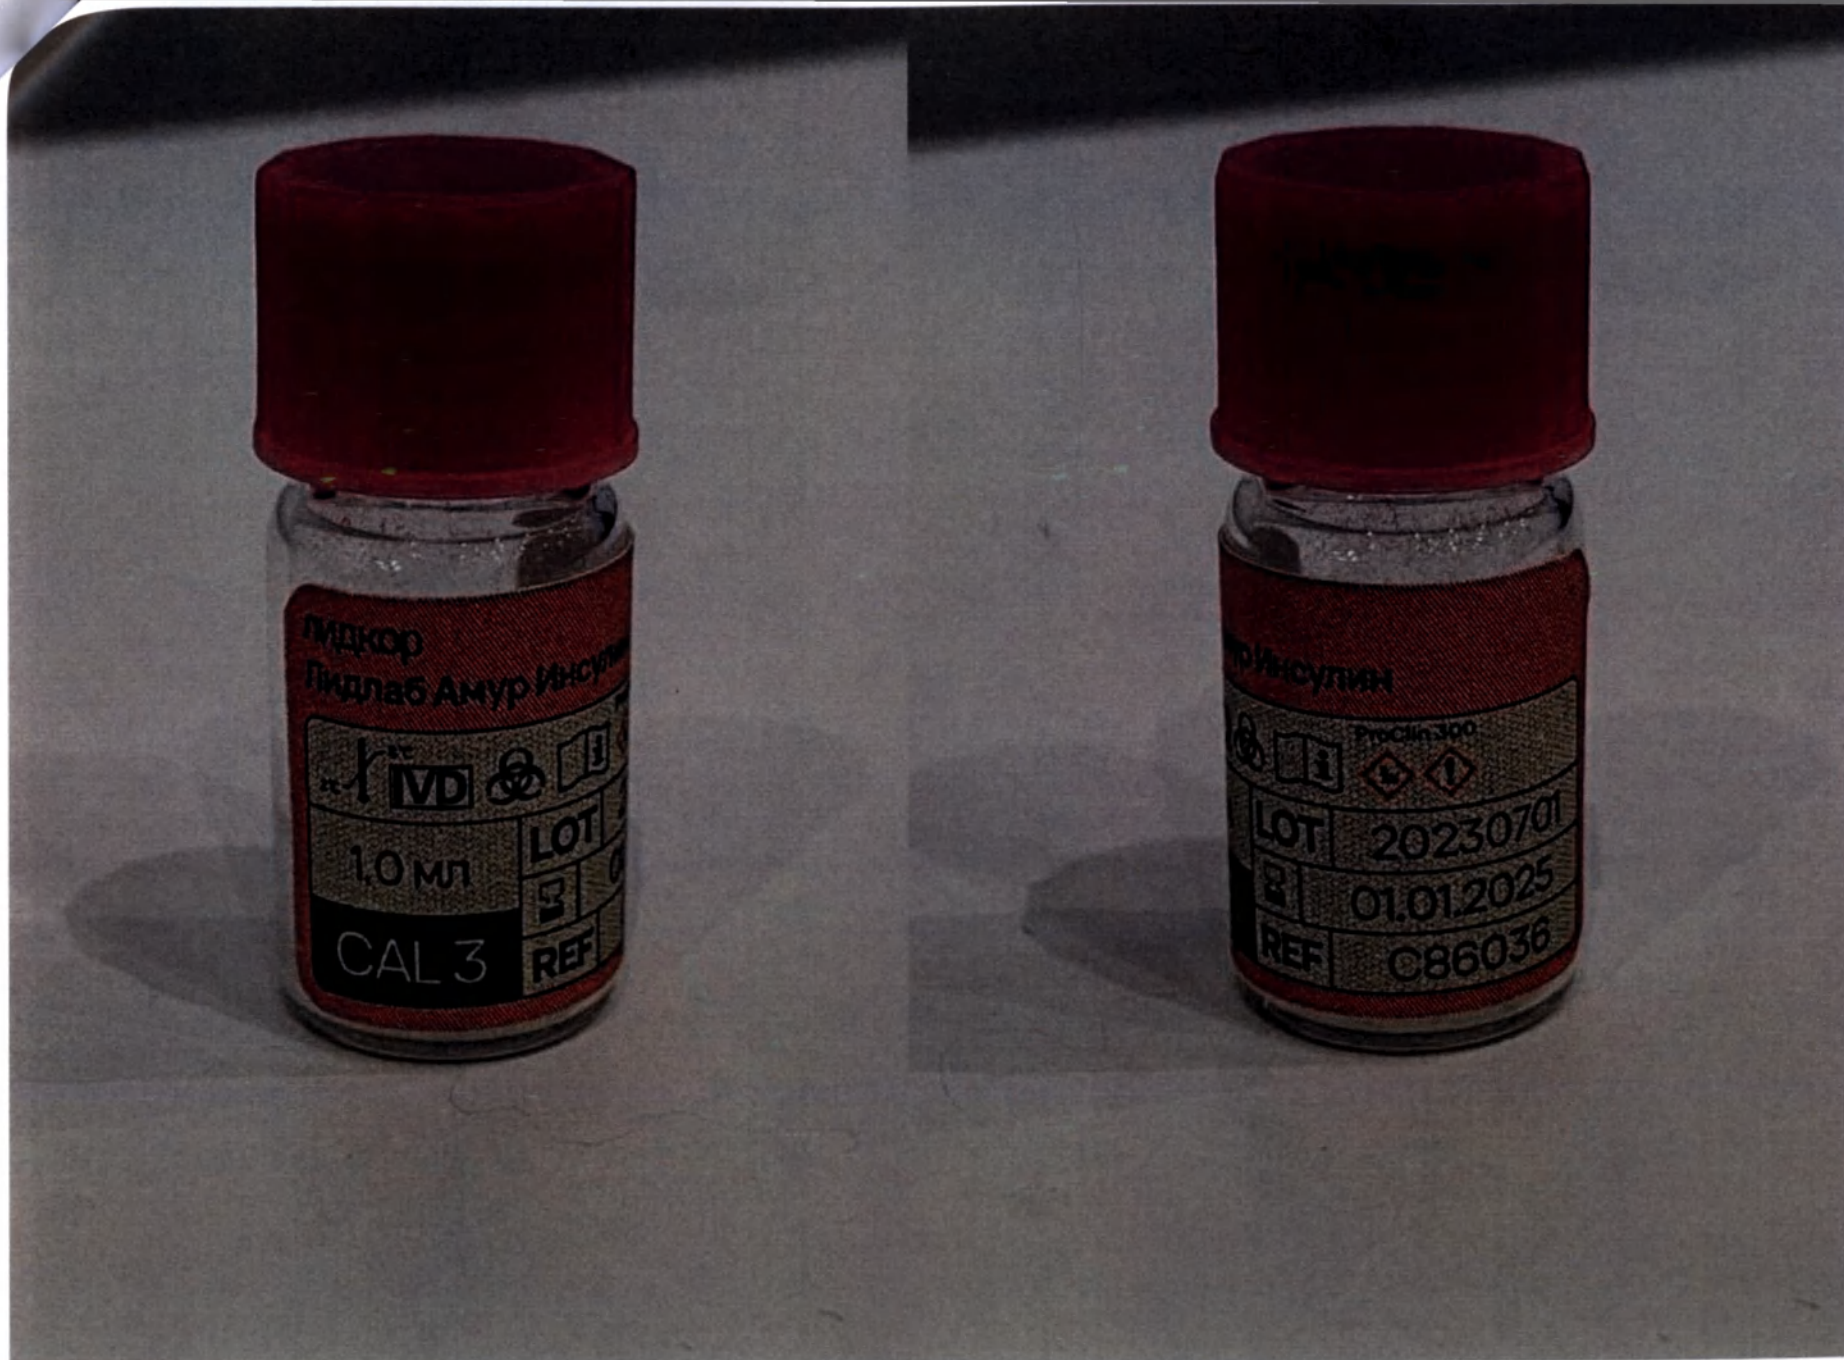

Калибратор 3 (CAL3)

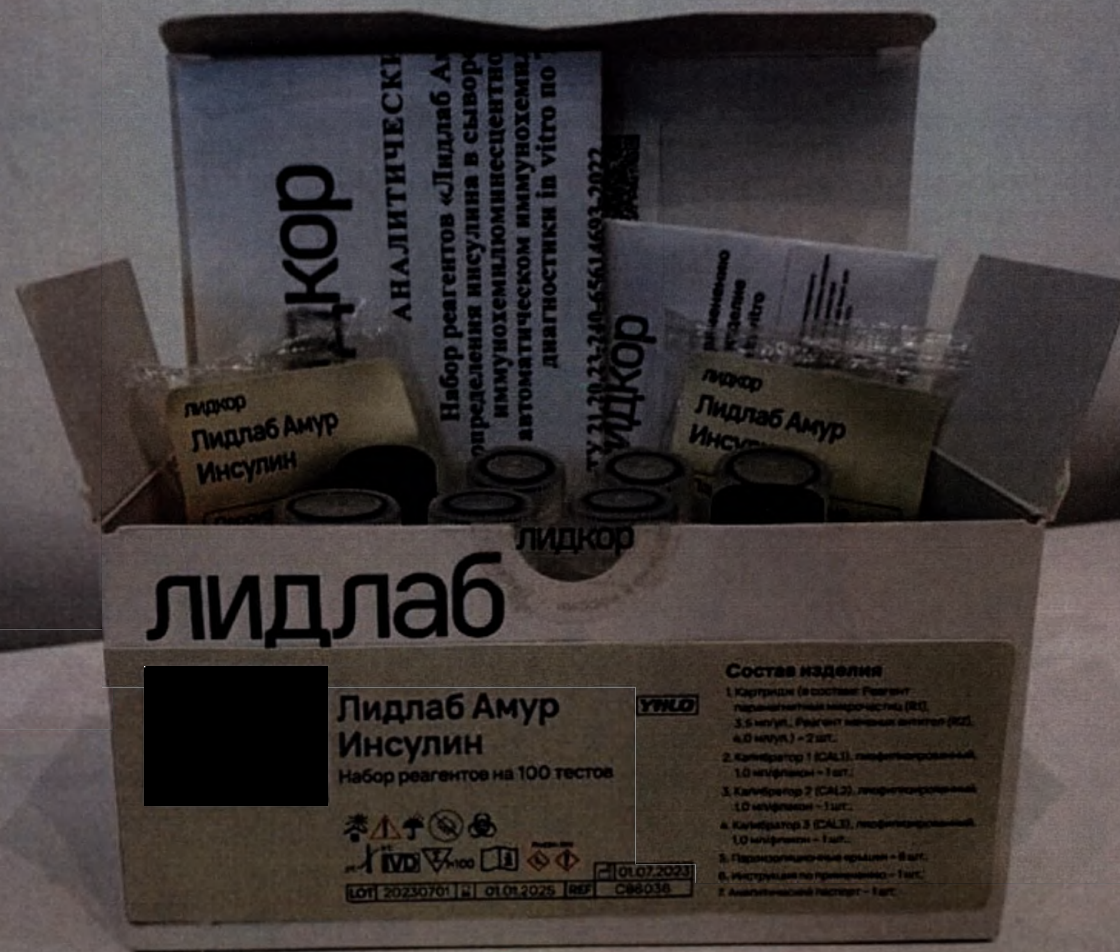

Набор реагентов на 100 тестов

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 7128. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин»
для количественного определения инсулина
в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23 - 240-65614693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX000X от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620053, Свердловская
область, г. Екатеринбург ул. Красноварская, д. 15
☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141061, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а

лидлаб

Лидлаб Амур Инсулин

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO



IVD

200

01.07.2023

01.01.2025

REF

C86036

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), лиофилизированный, 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов на 200 тестов

ООО «ЛИДКОР»


Россия, 620102 Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин»
для количественного определения инсулина
в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики In vitro по ТУ 21.20.23 – 240-658144-93-
2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Краснодеревская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

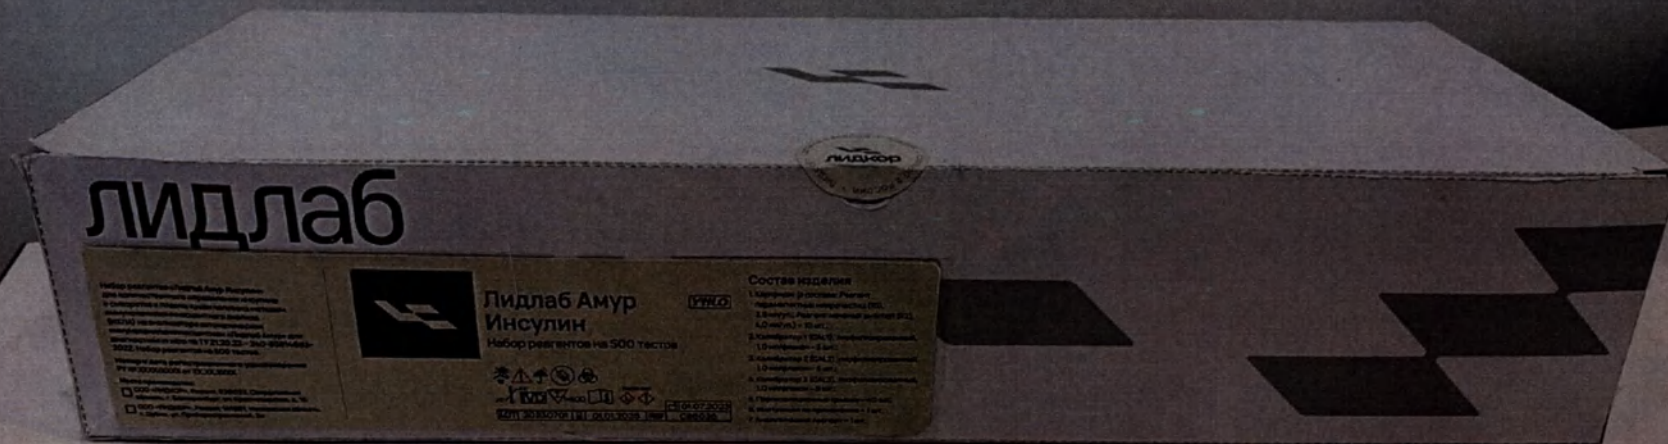

Набор реагентов на 500 тестов

лидлаб

Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохимическим с использованием антиинсулиновых антител (БИУА) на 1000 тестов. Реагент для диагностики (в виде по ТУ 21.20.23-240-99914.663-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Набор реагентов на 1000 тестов.

Идентификационный номер (сертификат)
RU 1000000000 от 10.01.2023

Место производства:

☐ ООО «Лидлаб», Россия, 630033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крайняя, д. 18
☐ ООО «Лидлаб», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приобшественная, 3а

**Лидлаб Амур
Инсулин**
Набор реагентов на 1000 тестов

YUNLO



LOT: 20230701 IN 01.01.2023 188 01.07.2023 016036

Состав изделия

1. Бюксеты (бюксы). Реагент перманентный индикаторный (PI), 2,8 мл/шт. Реагент индикаторный (PI), А.О. (милл.) - 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), модифицированный, 10 мл/шт. - 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), модифицированный, 10 мл/шт. - 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), модифицированный, 10 мл/шт. - 10 шт.
5. Калибратор 4 (CAL4), модифицированный, 10 мл/шт. - 10 шт.
6. Калибратор 5 (CAL5), модифицированный, 10 мл/шт. - 10 шт.
7. Калибратор 6 (CAL6), модифицированный, 10 мл/шт. - 10 шт.

Набор реагентов на 1000 тестов

лидкор
Лидлаб Амур
Инсулин

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701



01.01.2025

REF C86036



лидкор
Лидлаб Амур
Инсулин

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701



01.01.2025

REF C86036



Пароизоляционные крышки



Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23 – 240-65614693-2022



Для профессионального применения

 ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		 01.07.2023		
LOT	20230701	 01.01.2025	REF	C86036

Транспортная тара и ее маркировка



Набор реагентов «Лидлаб Амур Инсулин» для количественного определения инсулина в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-240-65614693-2022 выпускается в четырех вариантах исполнения: ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU на 100 тестов; Набор реагентов на 200 тестов; Набор реагентов на 500 тестов; Набор реагентов на 1000 тестов

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (Число) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

