



REGICOM
est. 2008



REGICOM in Kazakhstan

Phone: +7 (727) 267-31-20
Mobile: +7 701-786-82-79 (WhatsApp)
Mobile: +7 701-789-90-00
E-mail: i.kozlov@regicompany.com

REGICOM in Russia

Address: Moscow, Shmitovskiy proezd, house 39,
apartment 10

Phone: +7 495 609-41-15
Mobile: +7 969-197-44-33
Mobile: +7 701-786-82-79 (WhatsApp)
E-mail: i.kozlov@regicompany.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РЕГИКОМ»

_____ Козлов И.

20 _____ г.



Фотографические изображения

«Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDP II»

Производитель: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.

(СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.),

No. 2 Ansheng Road, Jinfeng Town, 215625 Zhangjiagang City, Jiangsu Province, P.R.China (Китай)

1. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагитальной хирургической аккумуляторной GD-11, размером: 25 x 0,97 x 100




2. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагитальной хирургической аккумуляторной



3. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагитальной хирургической аккумуляторной GDF-1, размером: 25 x 1,27 x 100 мм




4. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагитальной хирургической аккумуляторной GDI, размером: 18 x 0,97 x 90 мм

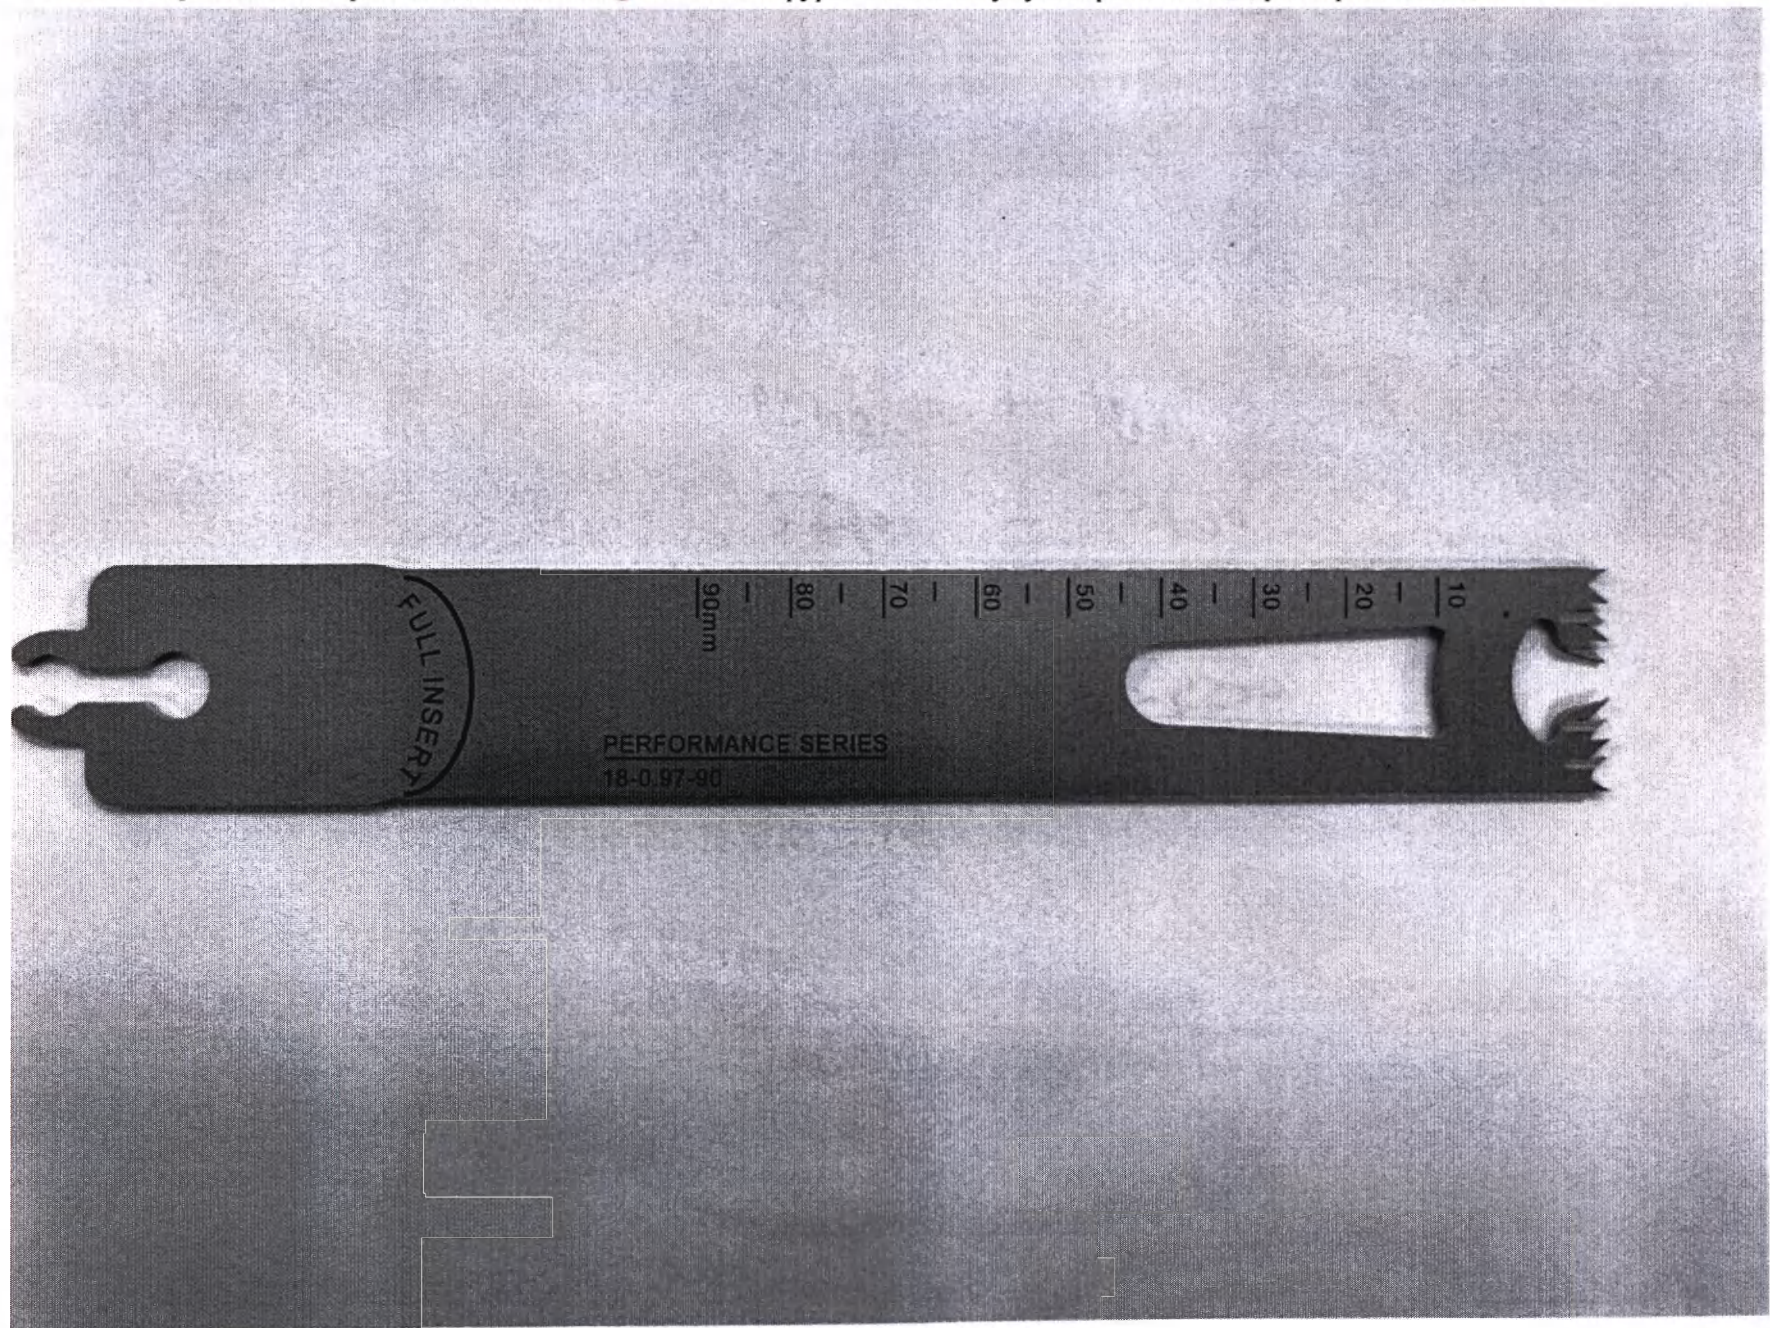


5. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сабельной хирургической аккумуляторной GDI, размером: 18 x 1,2 x 90 мм




6. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагитальной хирургической аккумуляторной GDR, размером: 18 x 1,27 x 90 мм

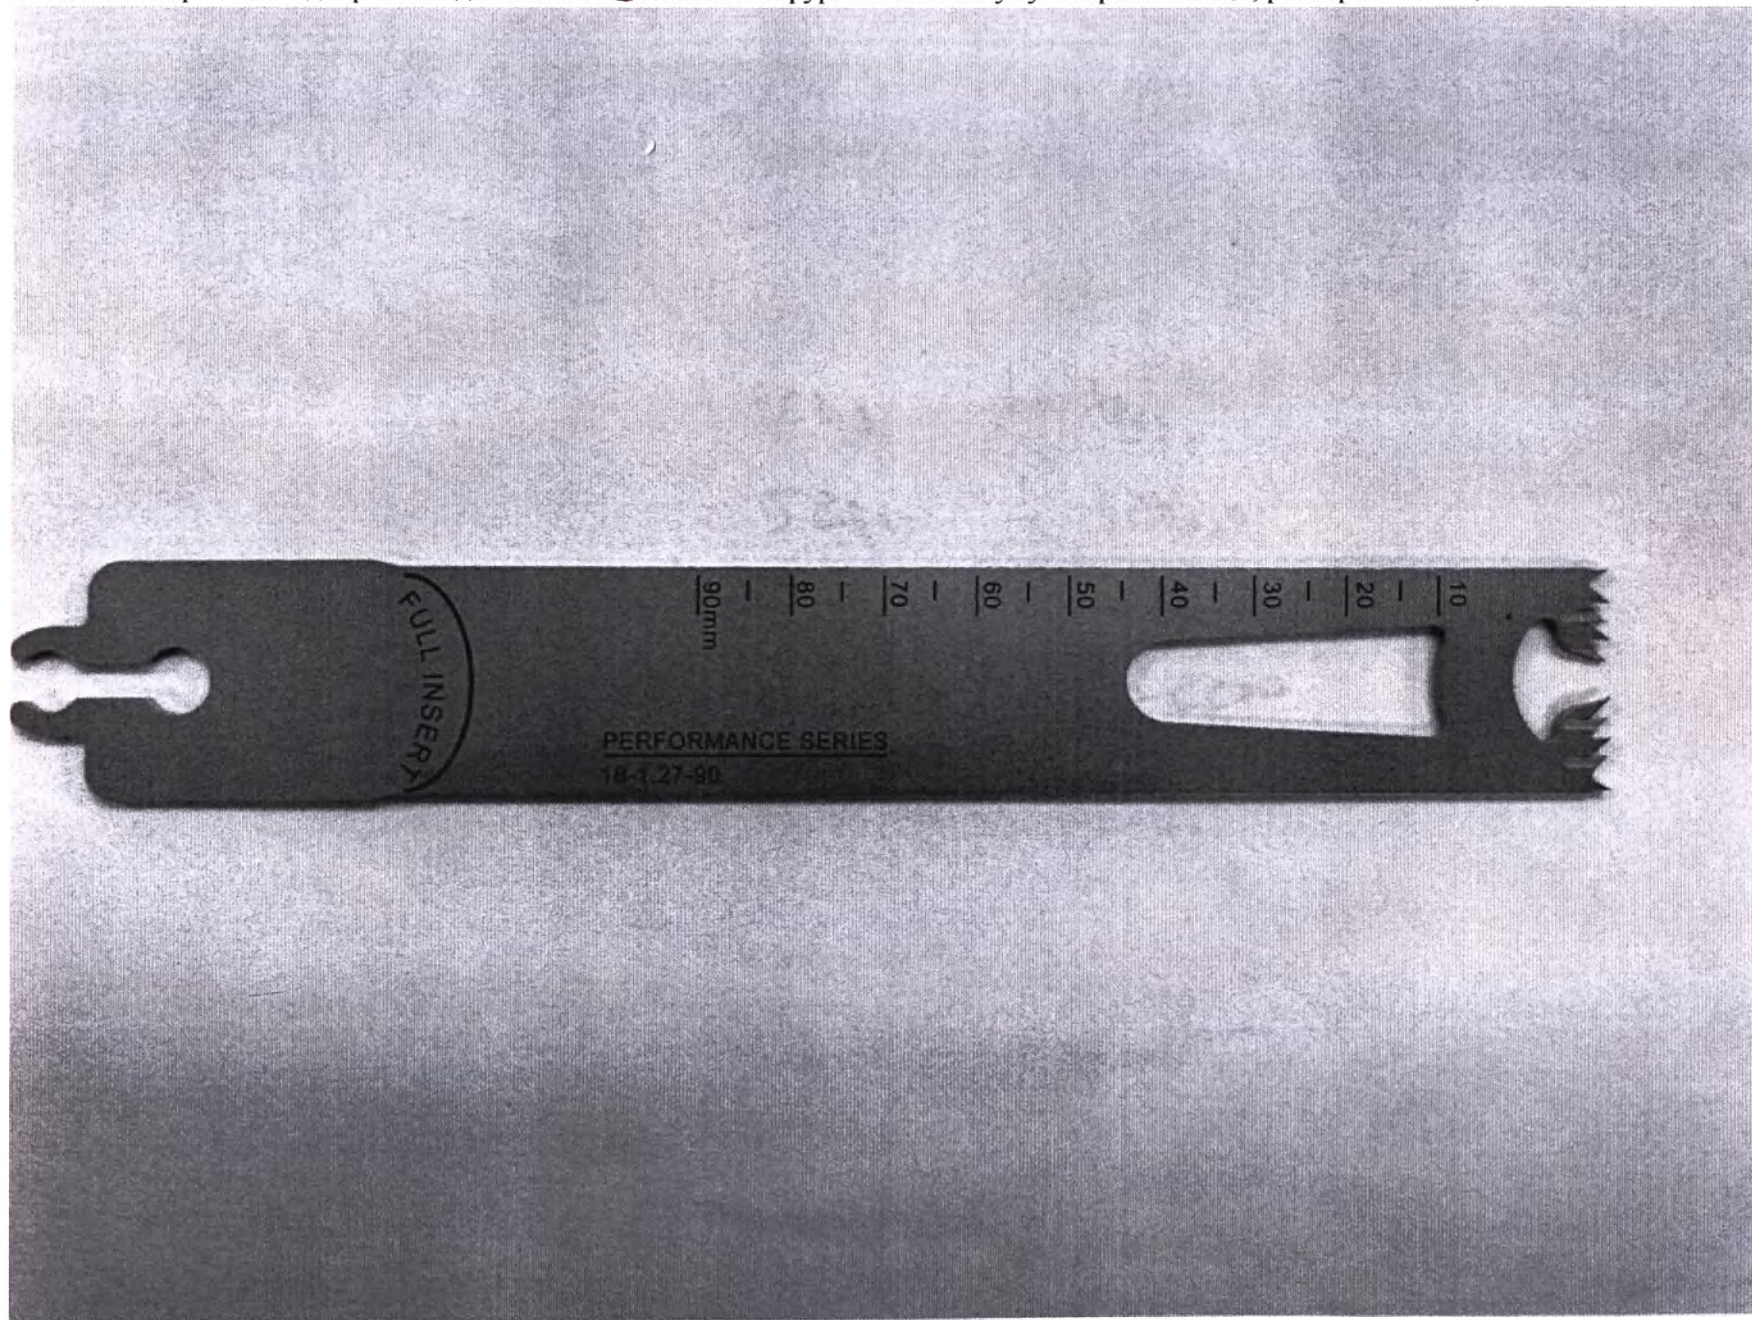


7. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагитальной хирургической аккумуляторной GDI, размером: 13 x 0,97 x 90 мм

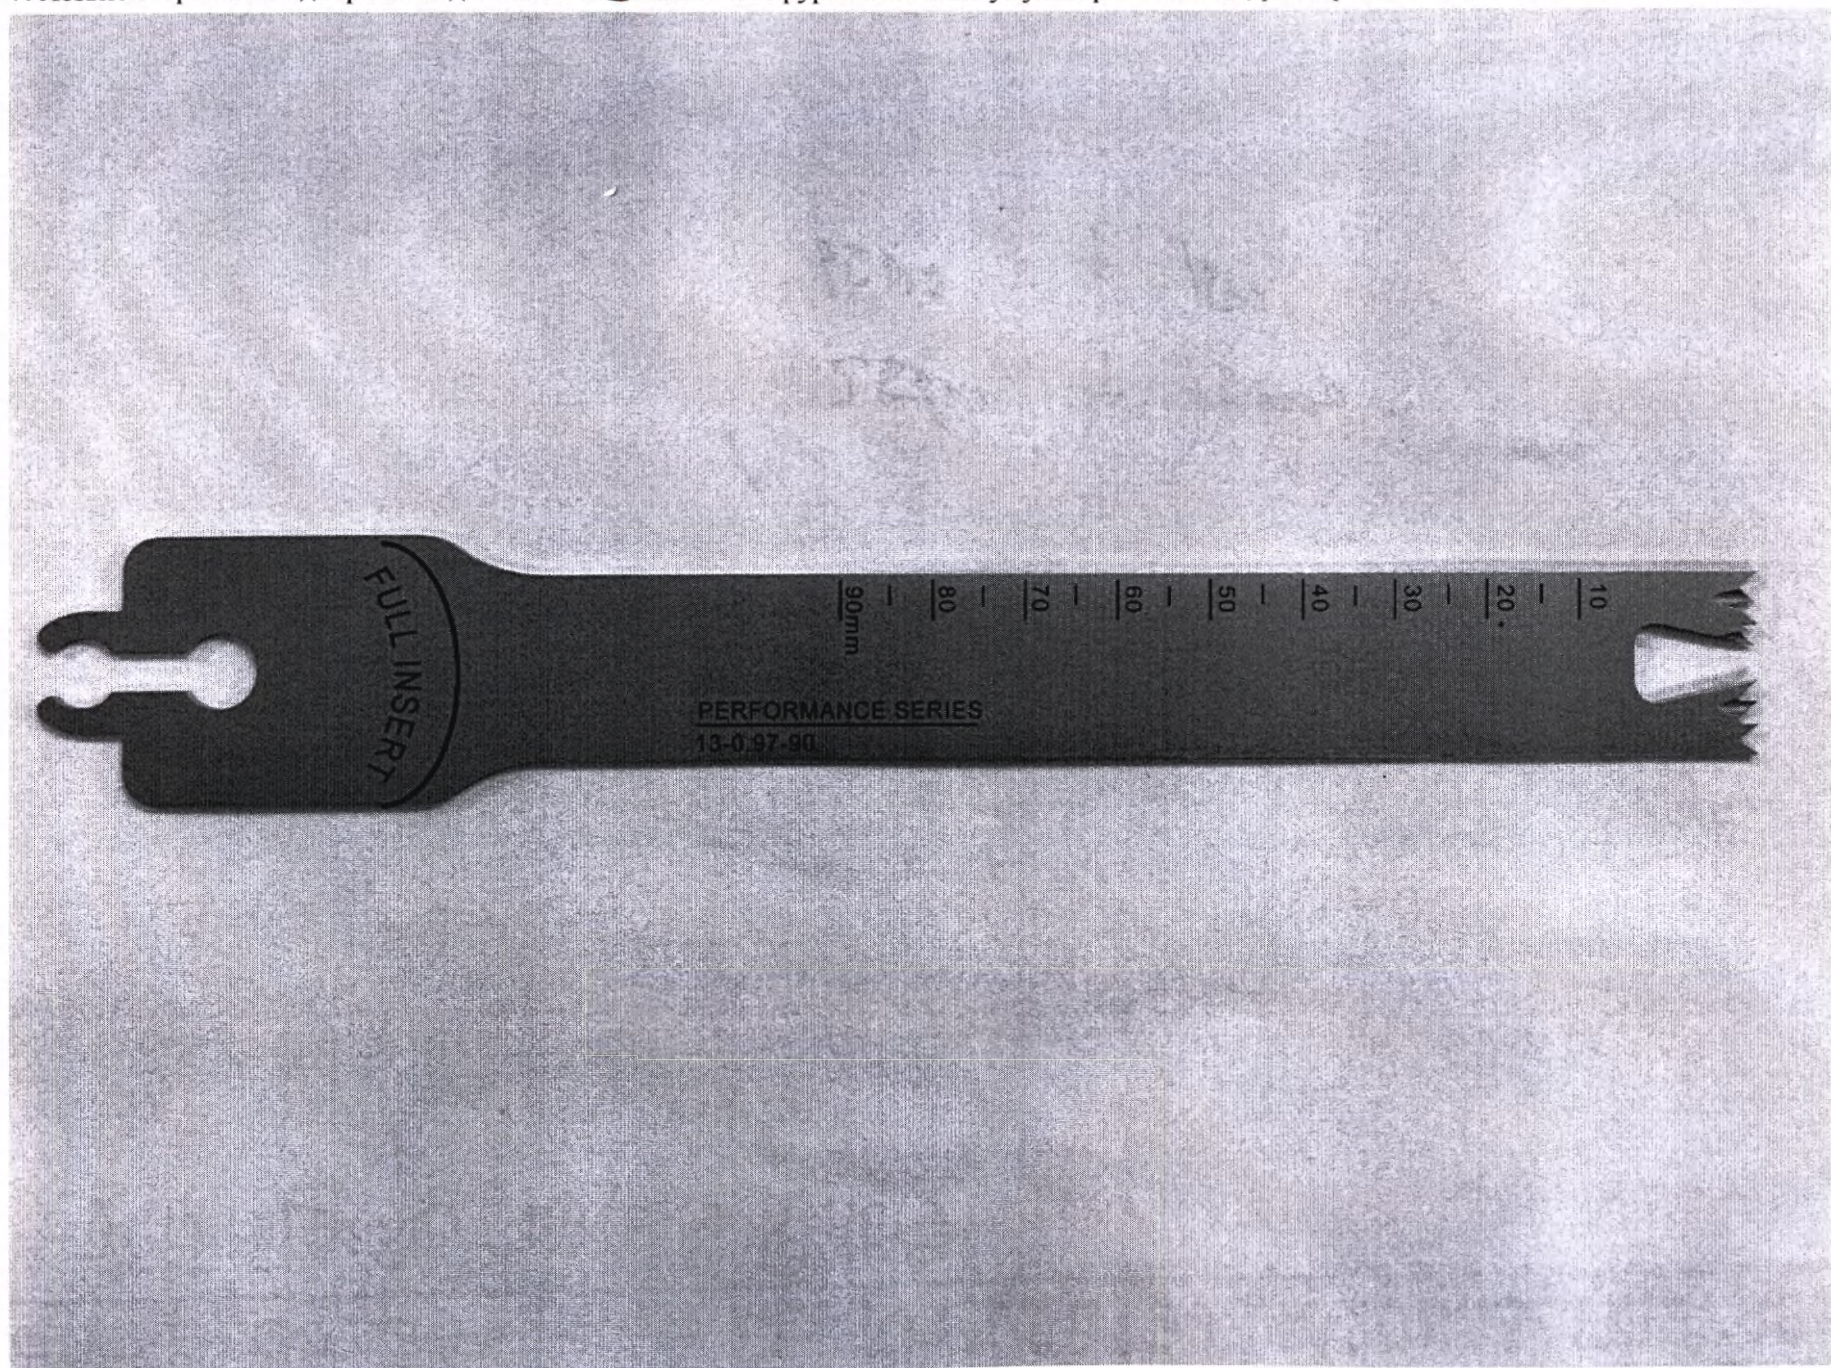


8. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDF-11, размером: 13 x 1,2 x 90 мм

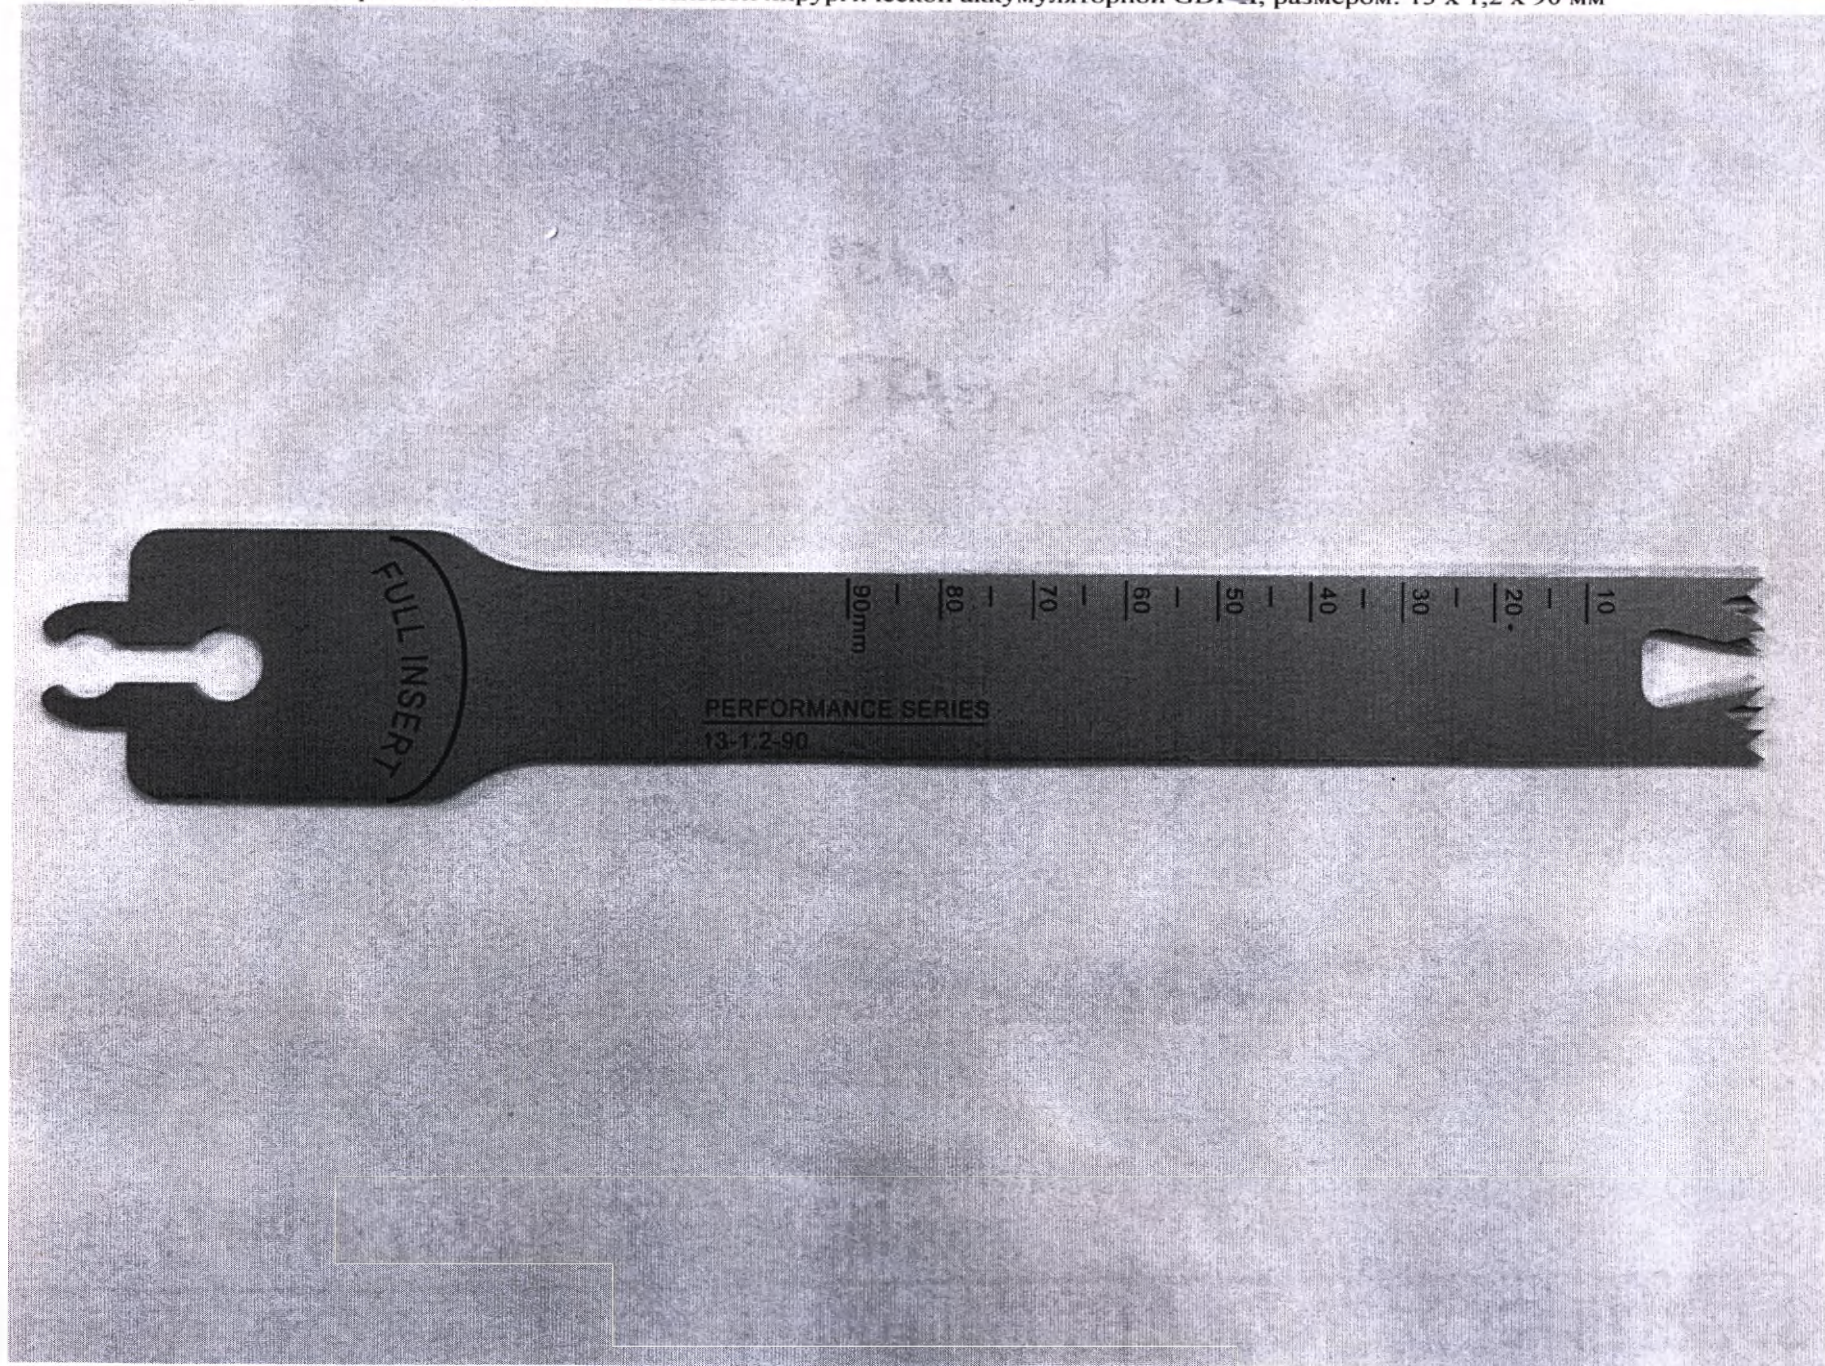


9. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагитальной хирургической аккумуляторной GDR, размером: 13 x 1,27 x 90 мм

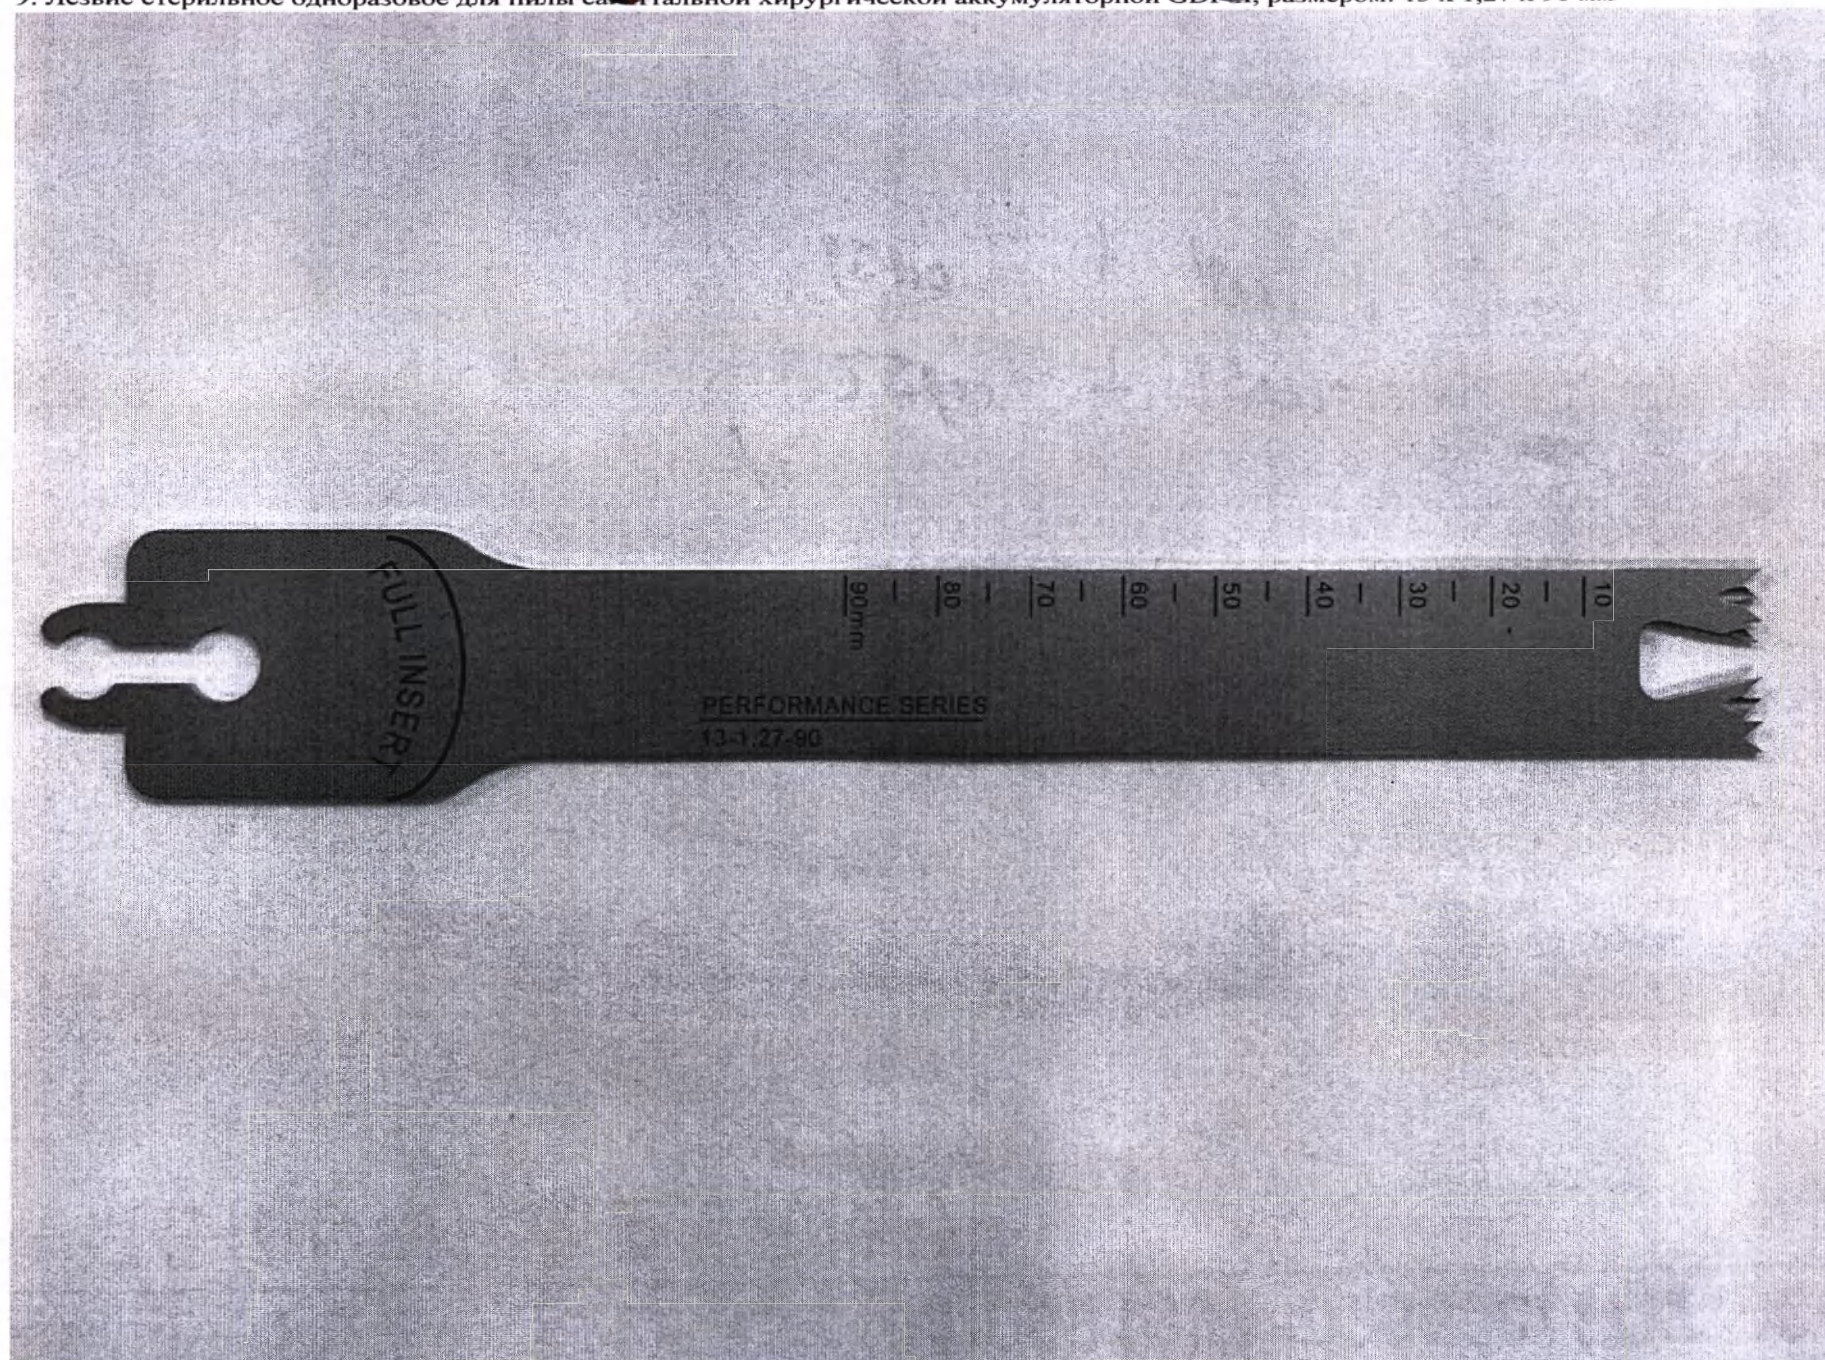


10. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GILSON, размером: 13 x 1,2 x 110 мм

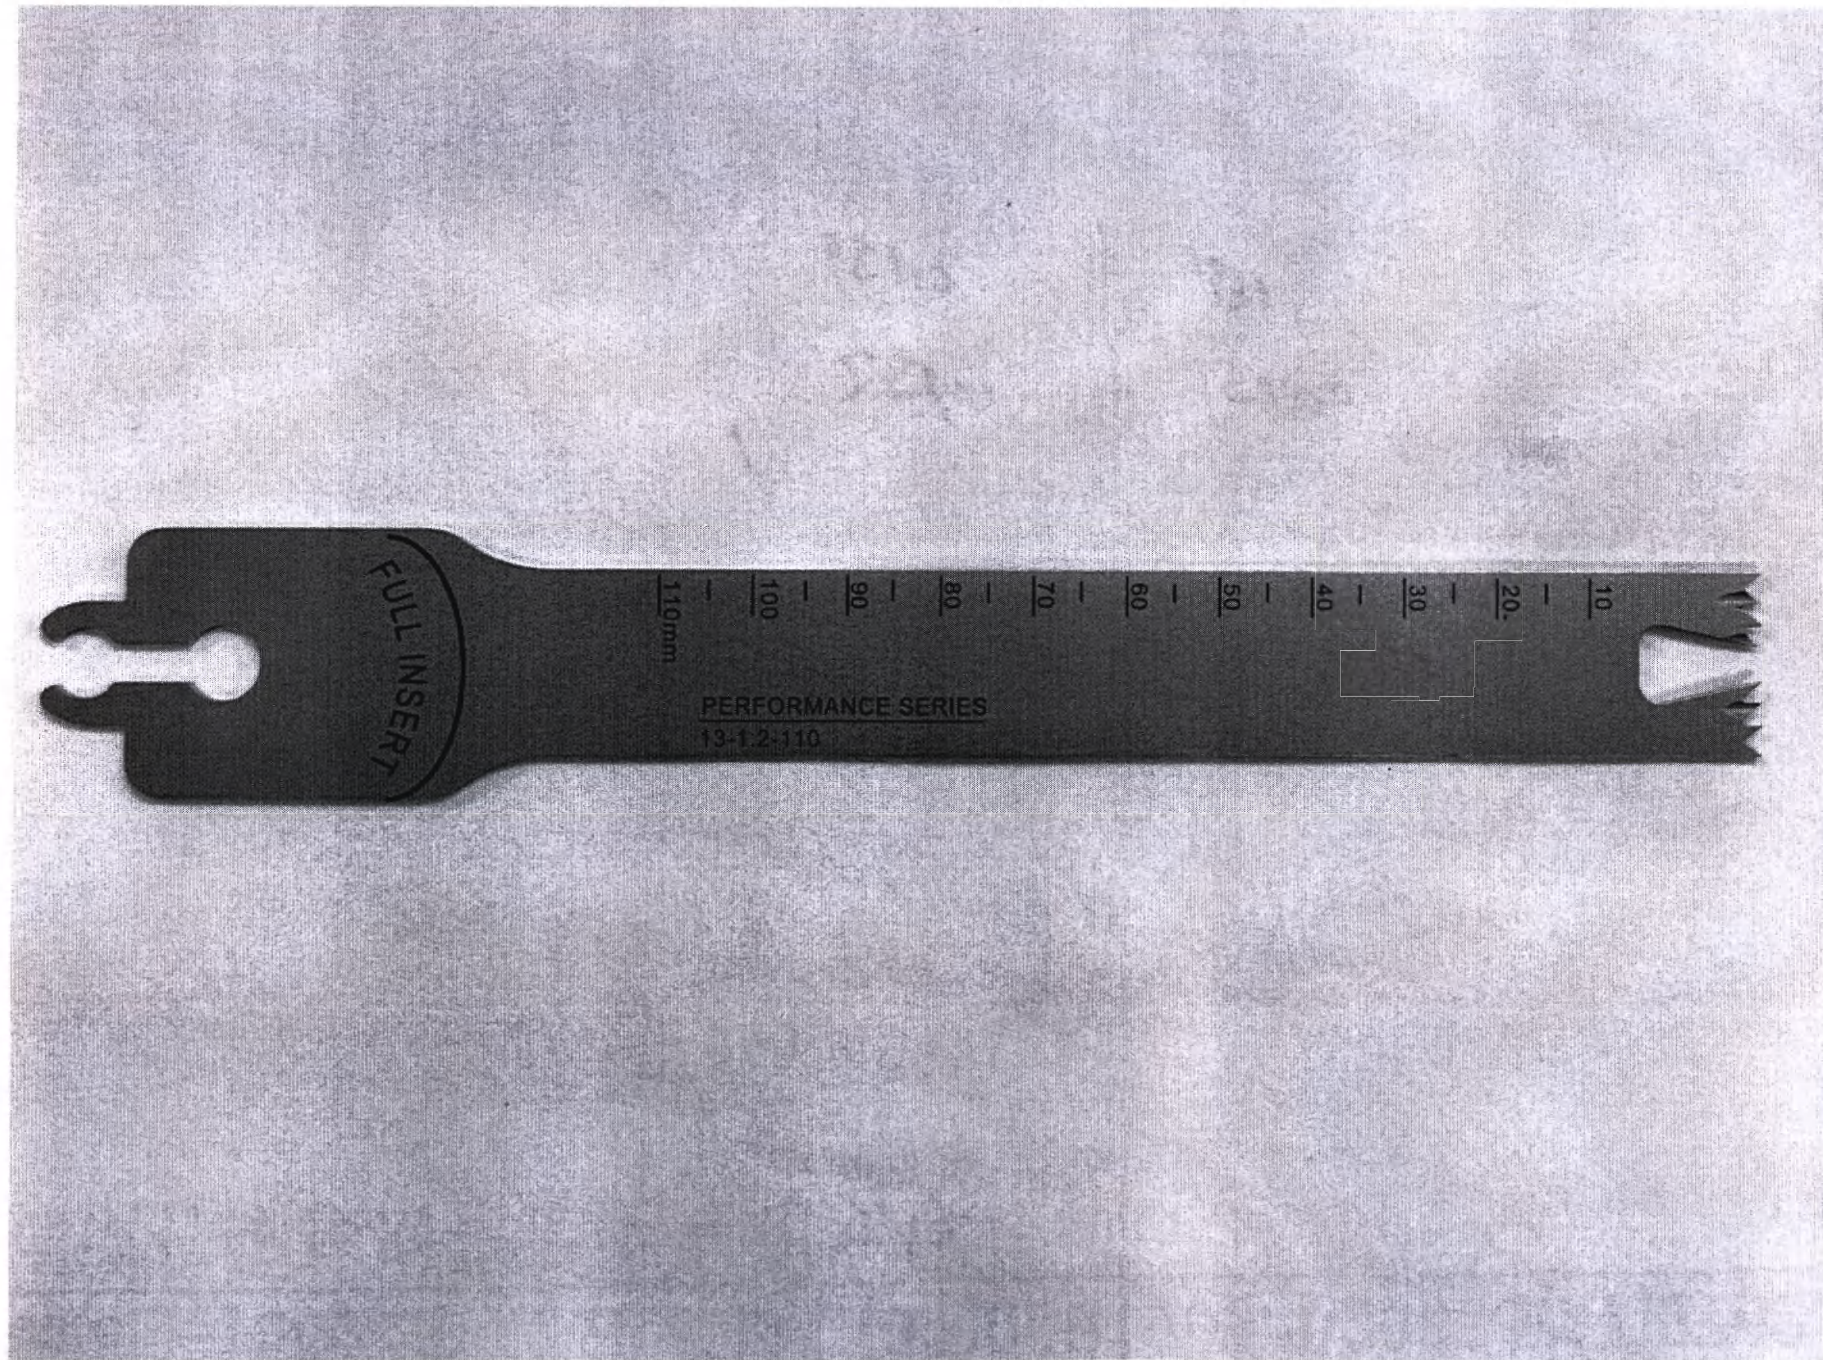



11. Лезвие стерильное одноразовое для пилы скальпельной хирургической аккумуляторной GDS II, размером: 14 x 1,0 x 90 мм

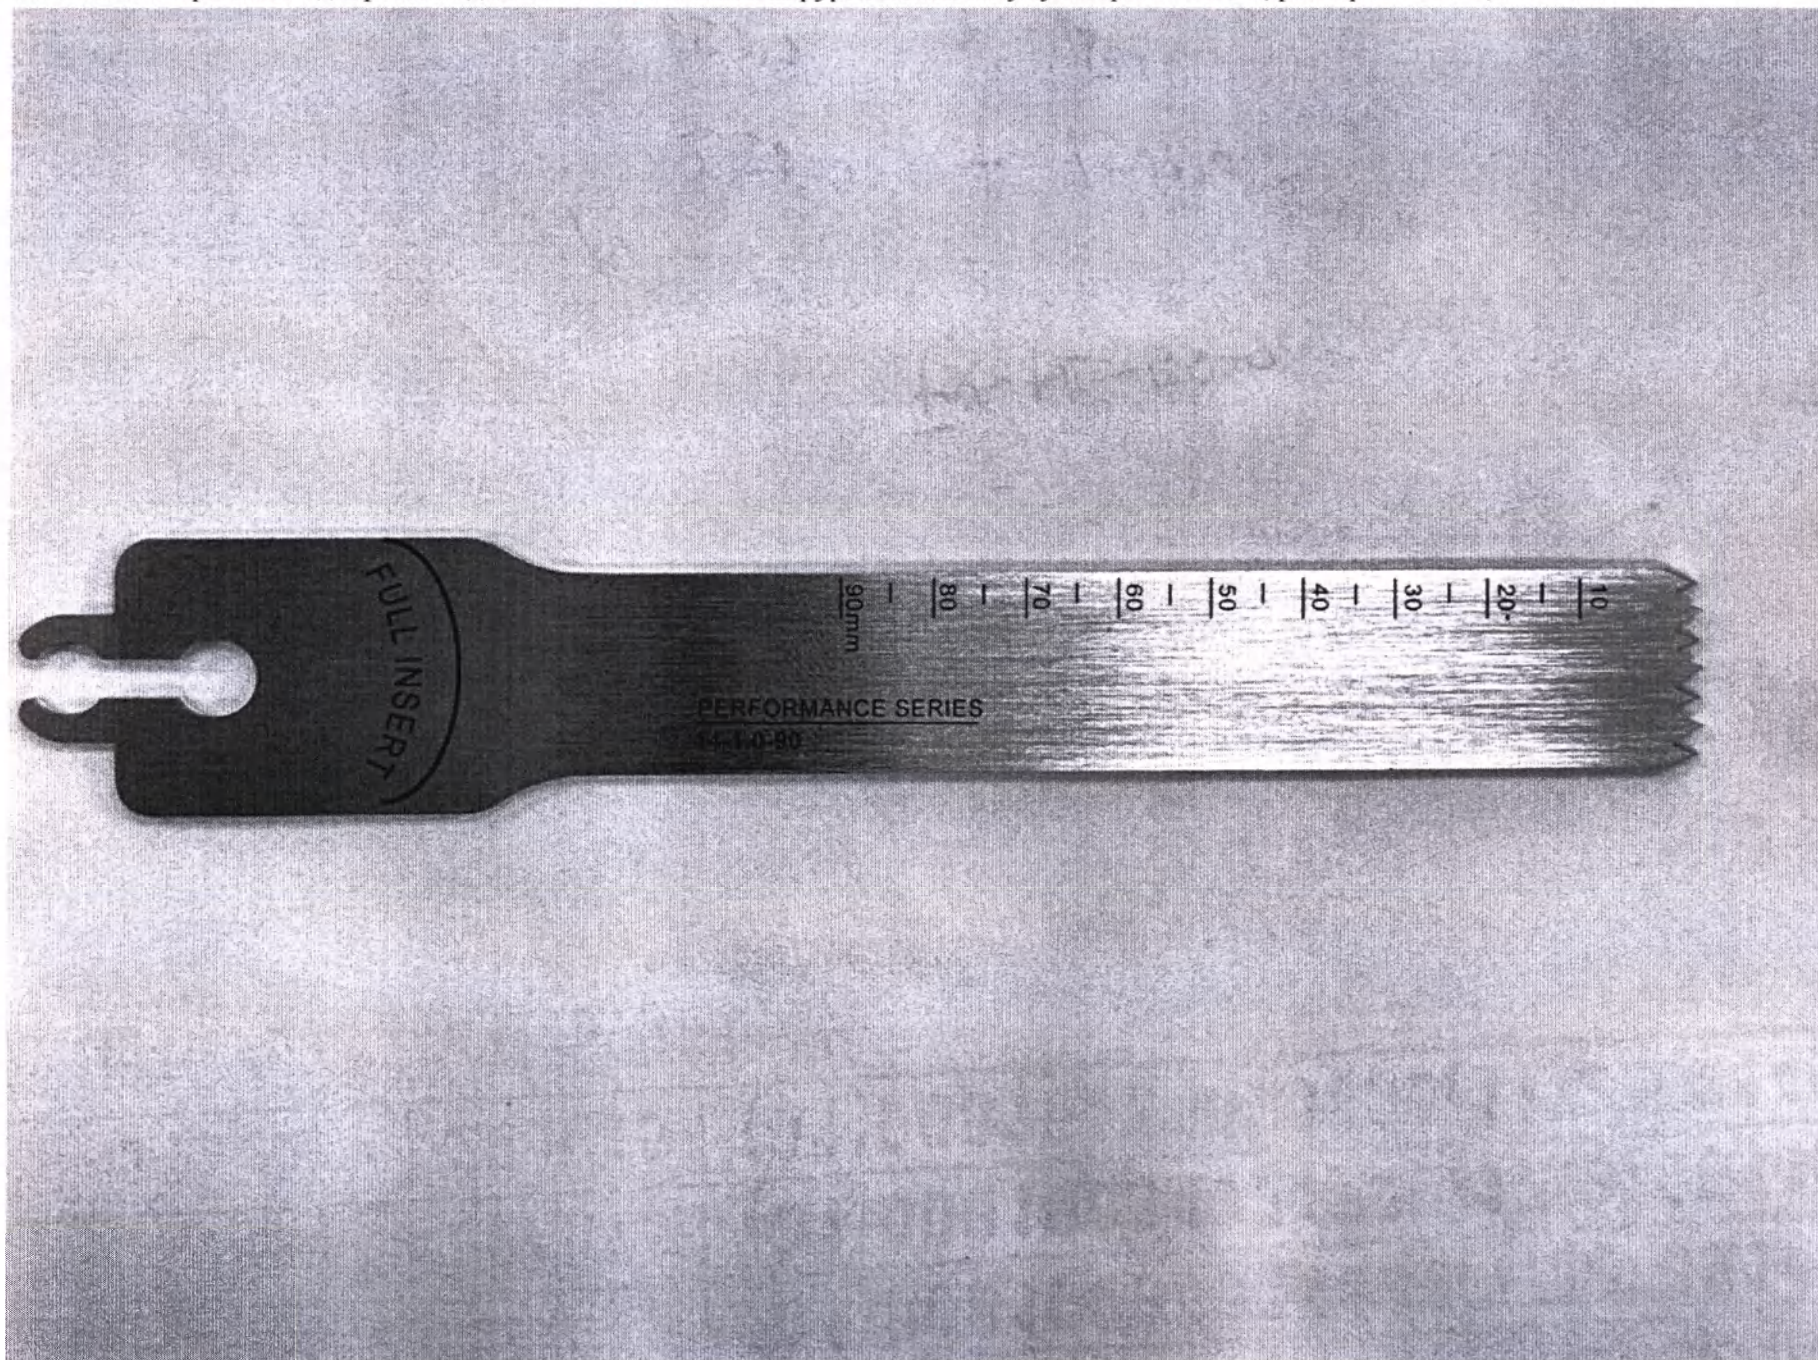

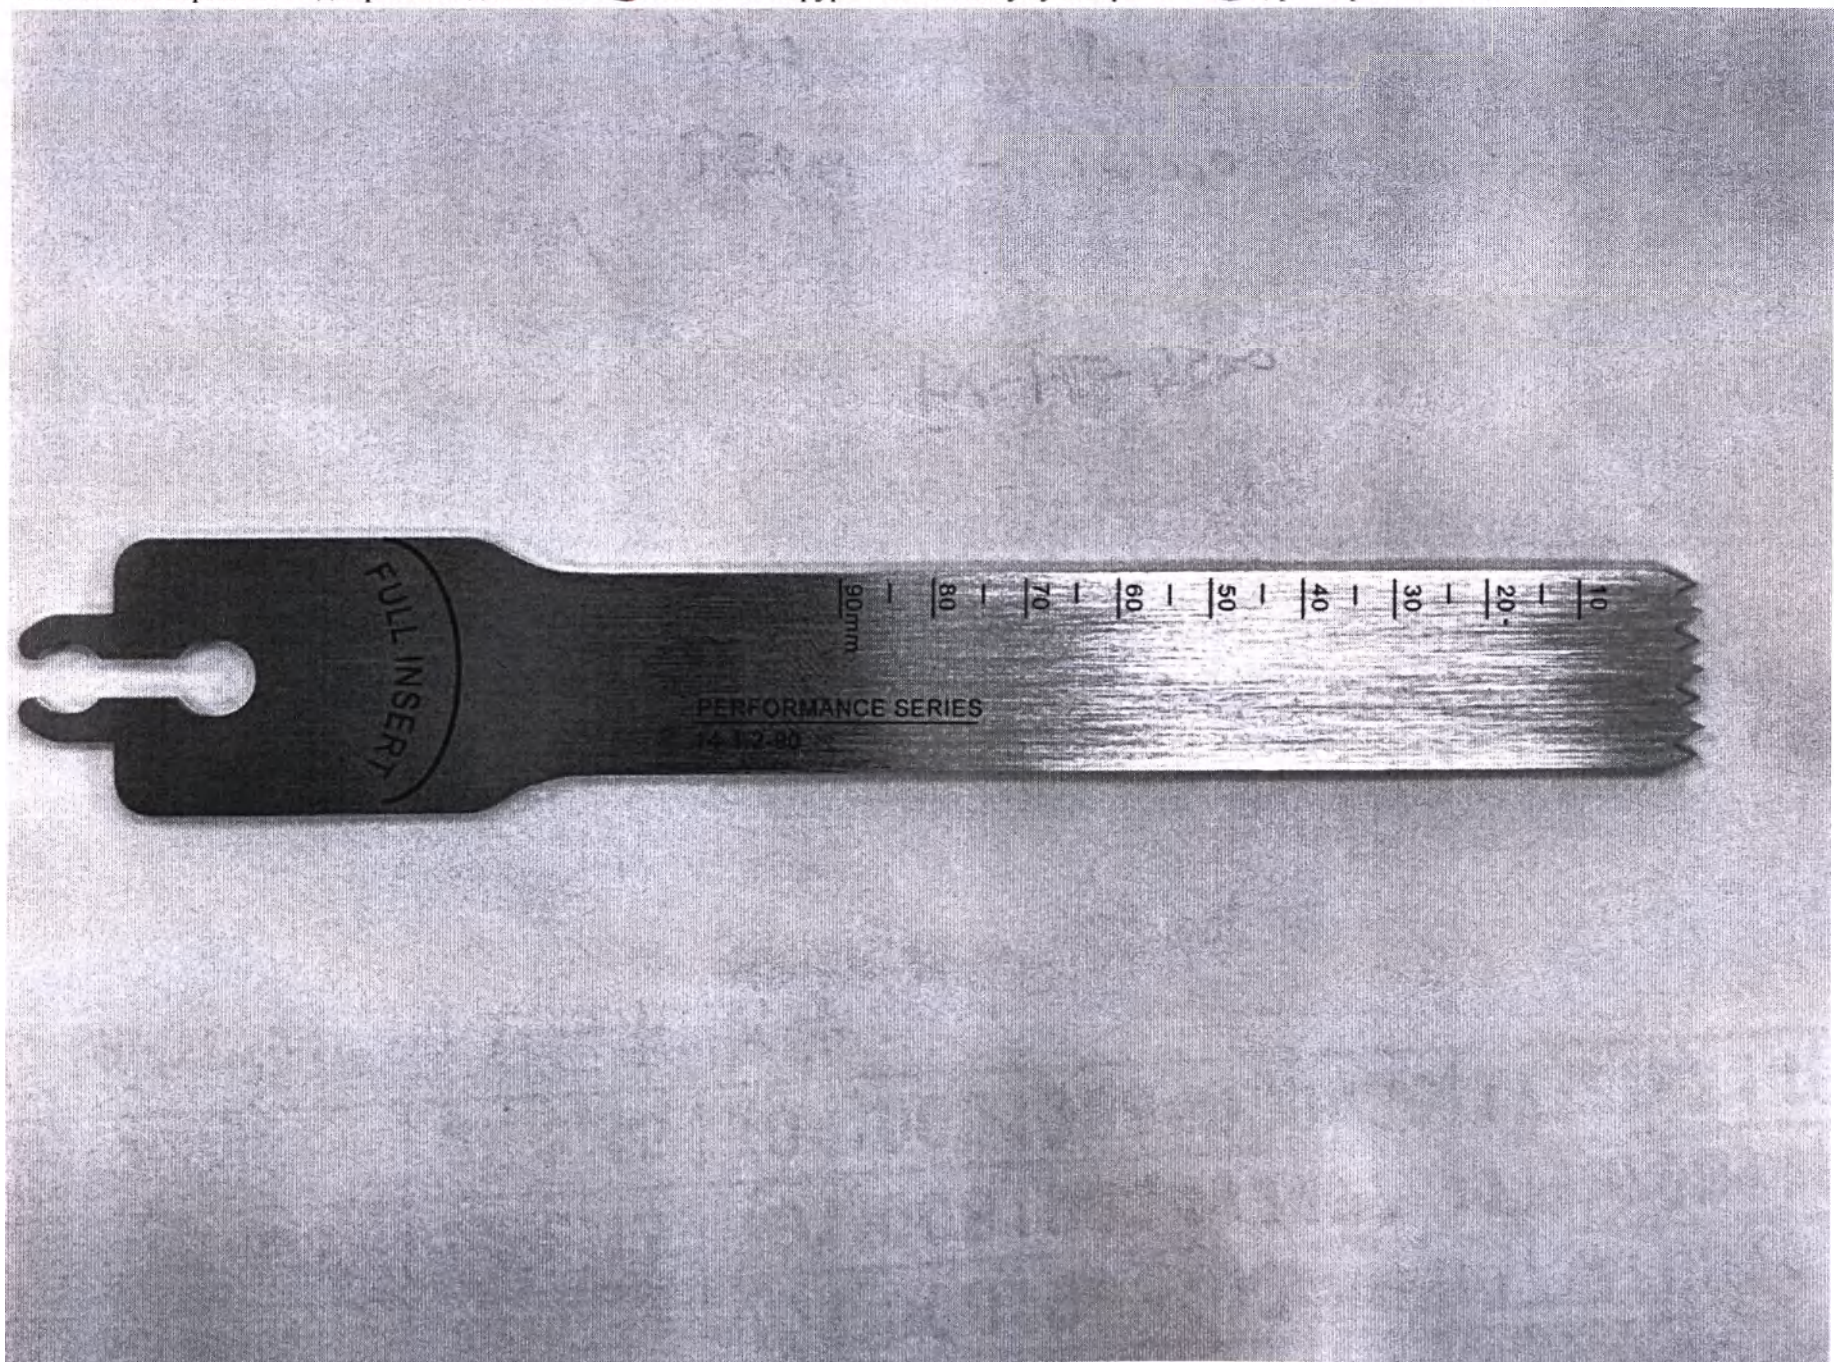

13. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GBS II, размером: 14 x 1,3 x 90 мм

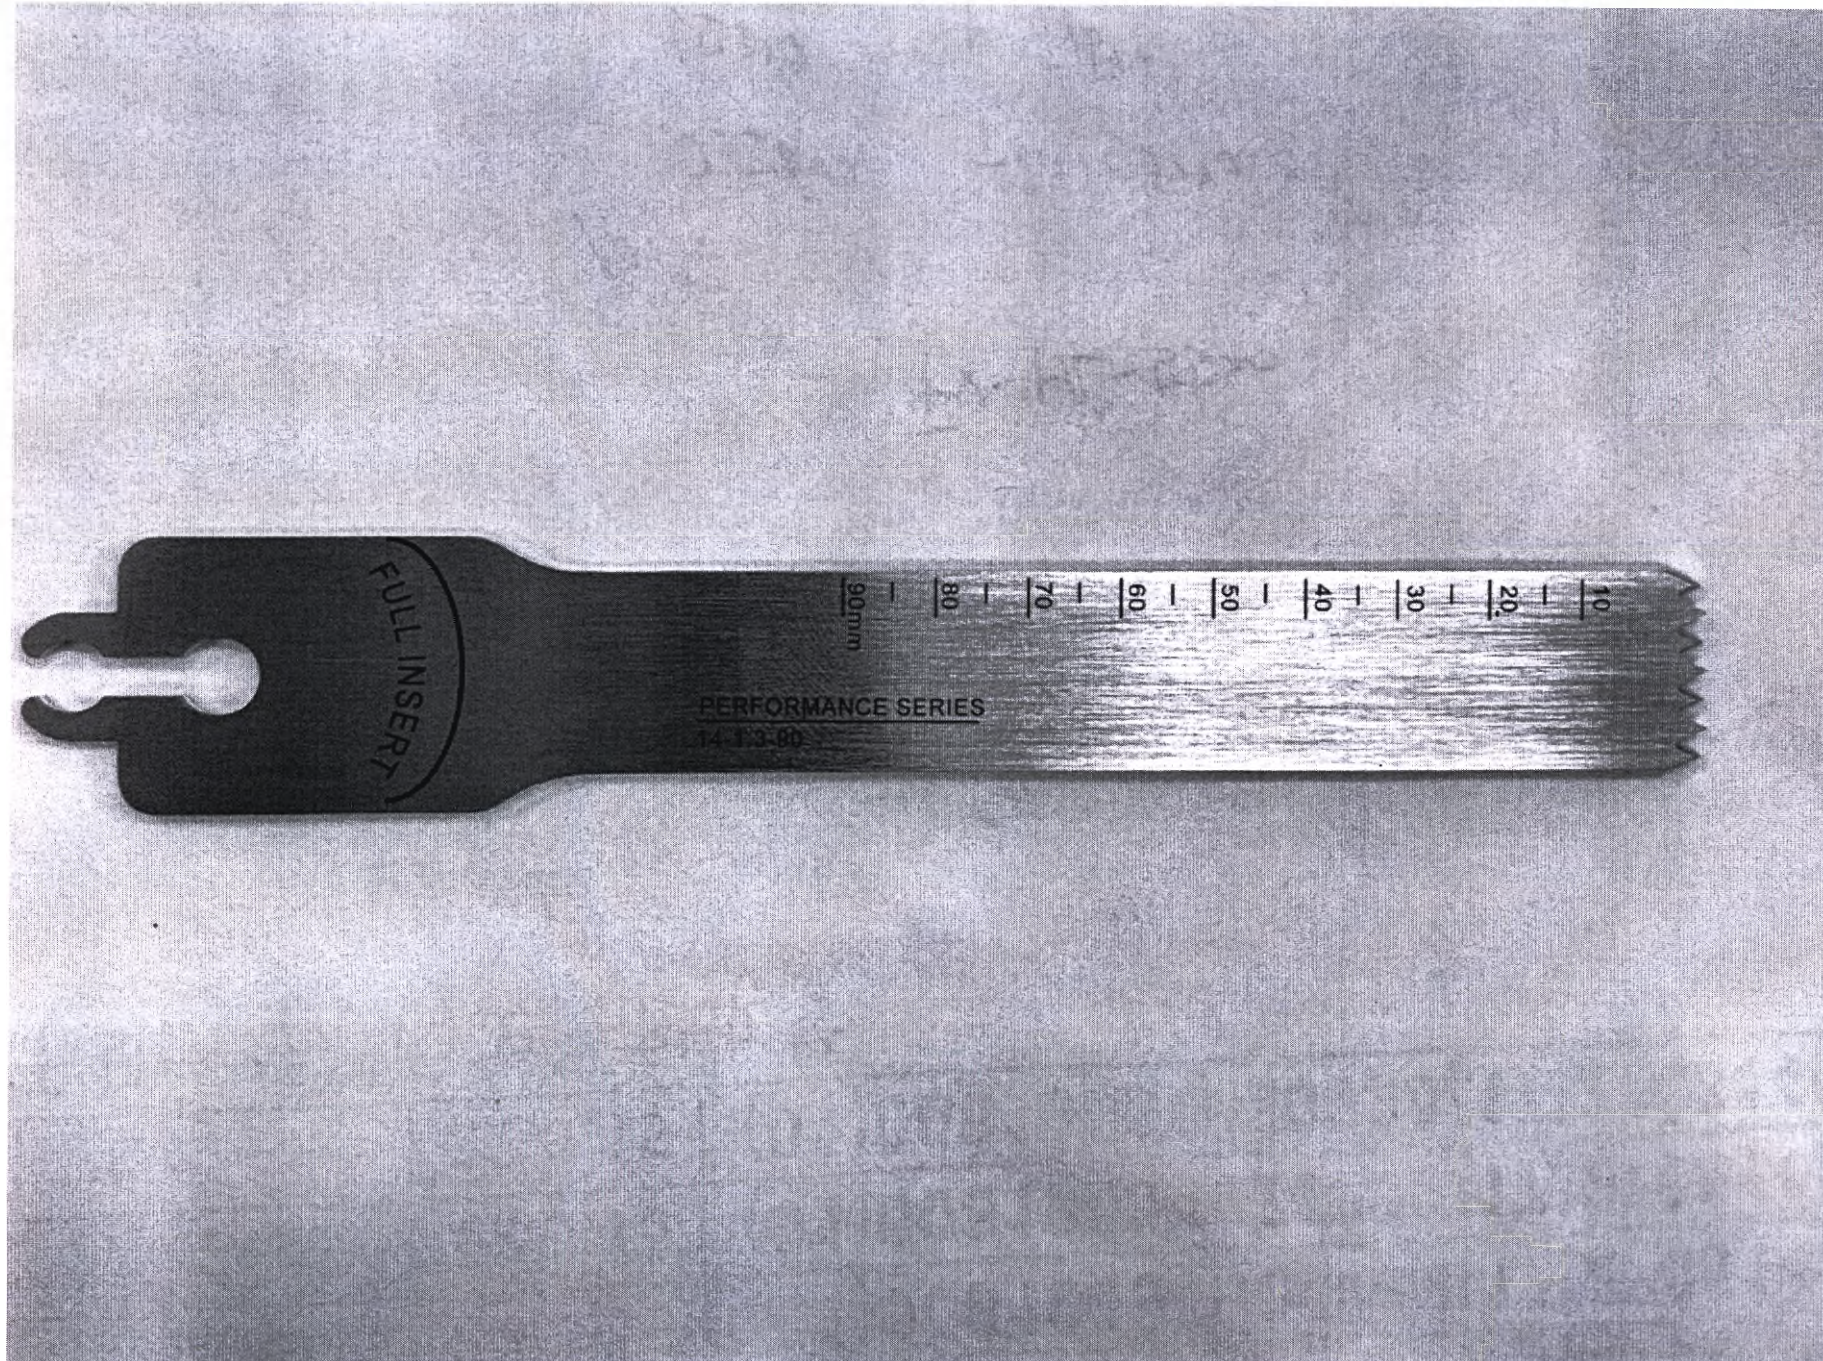


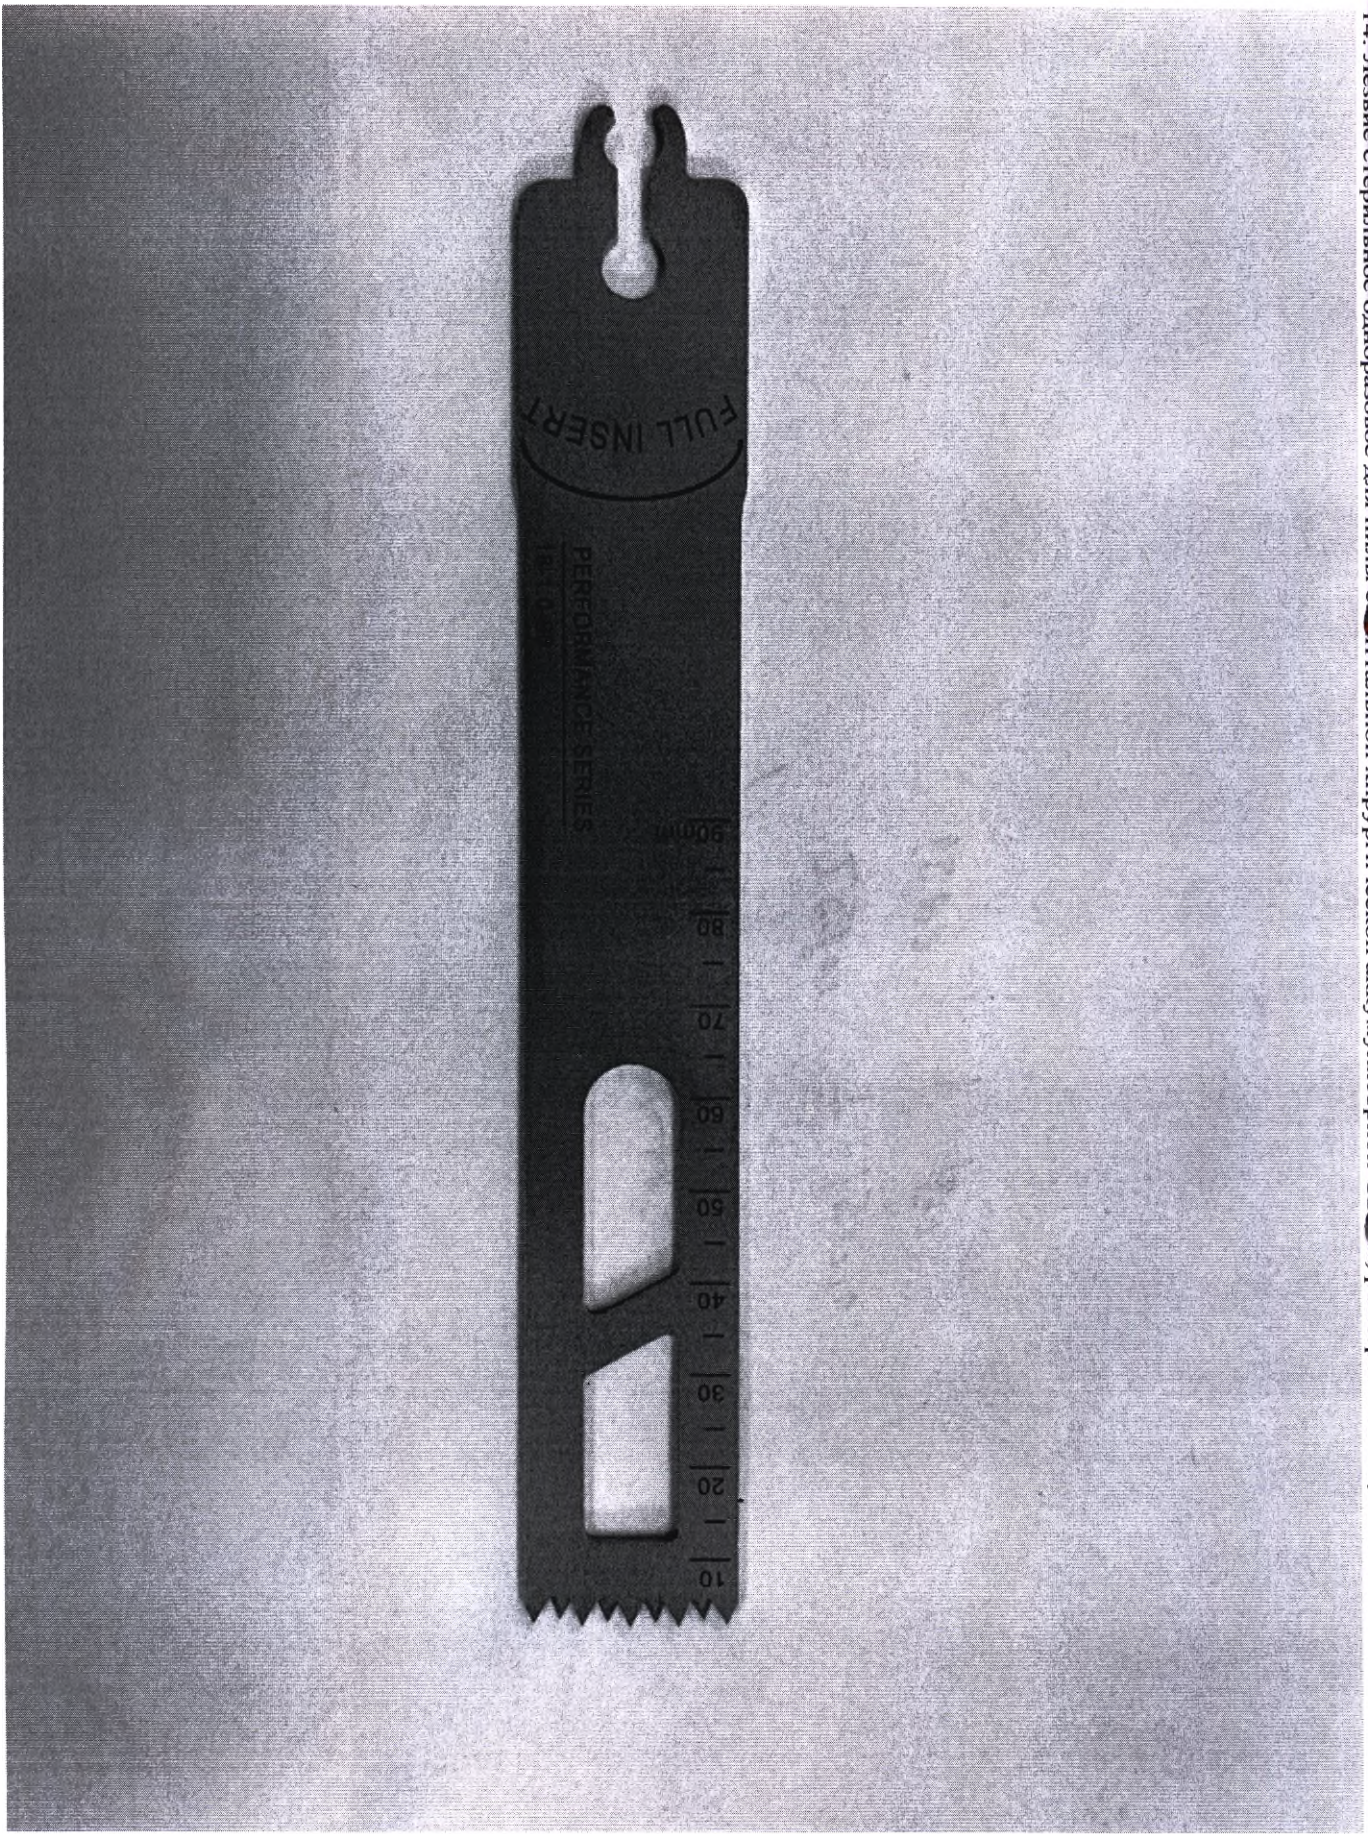






17. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDS-II, размером: 22 x 0,8 x 90 мм

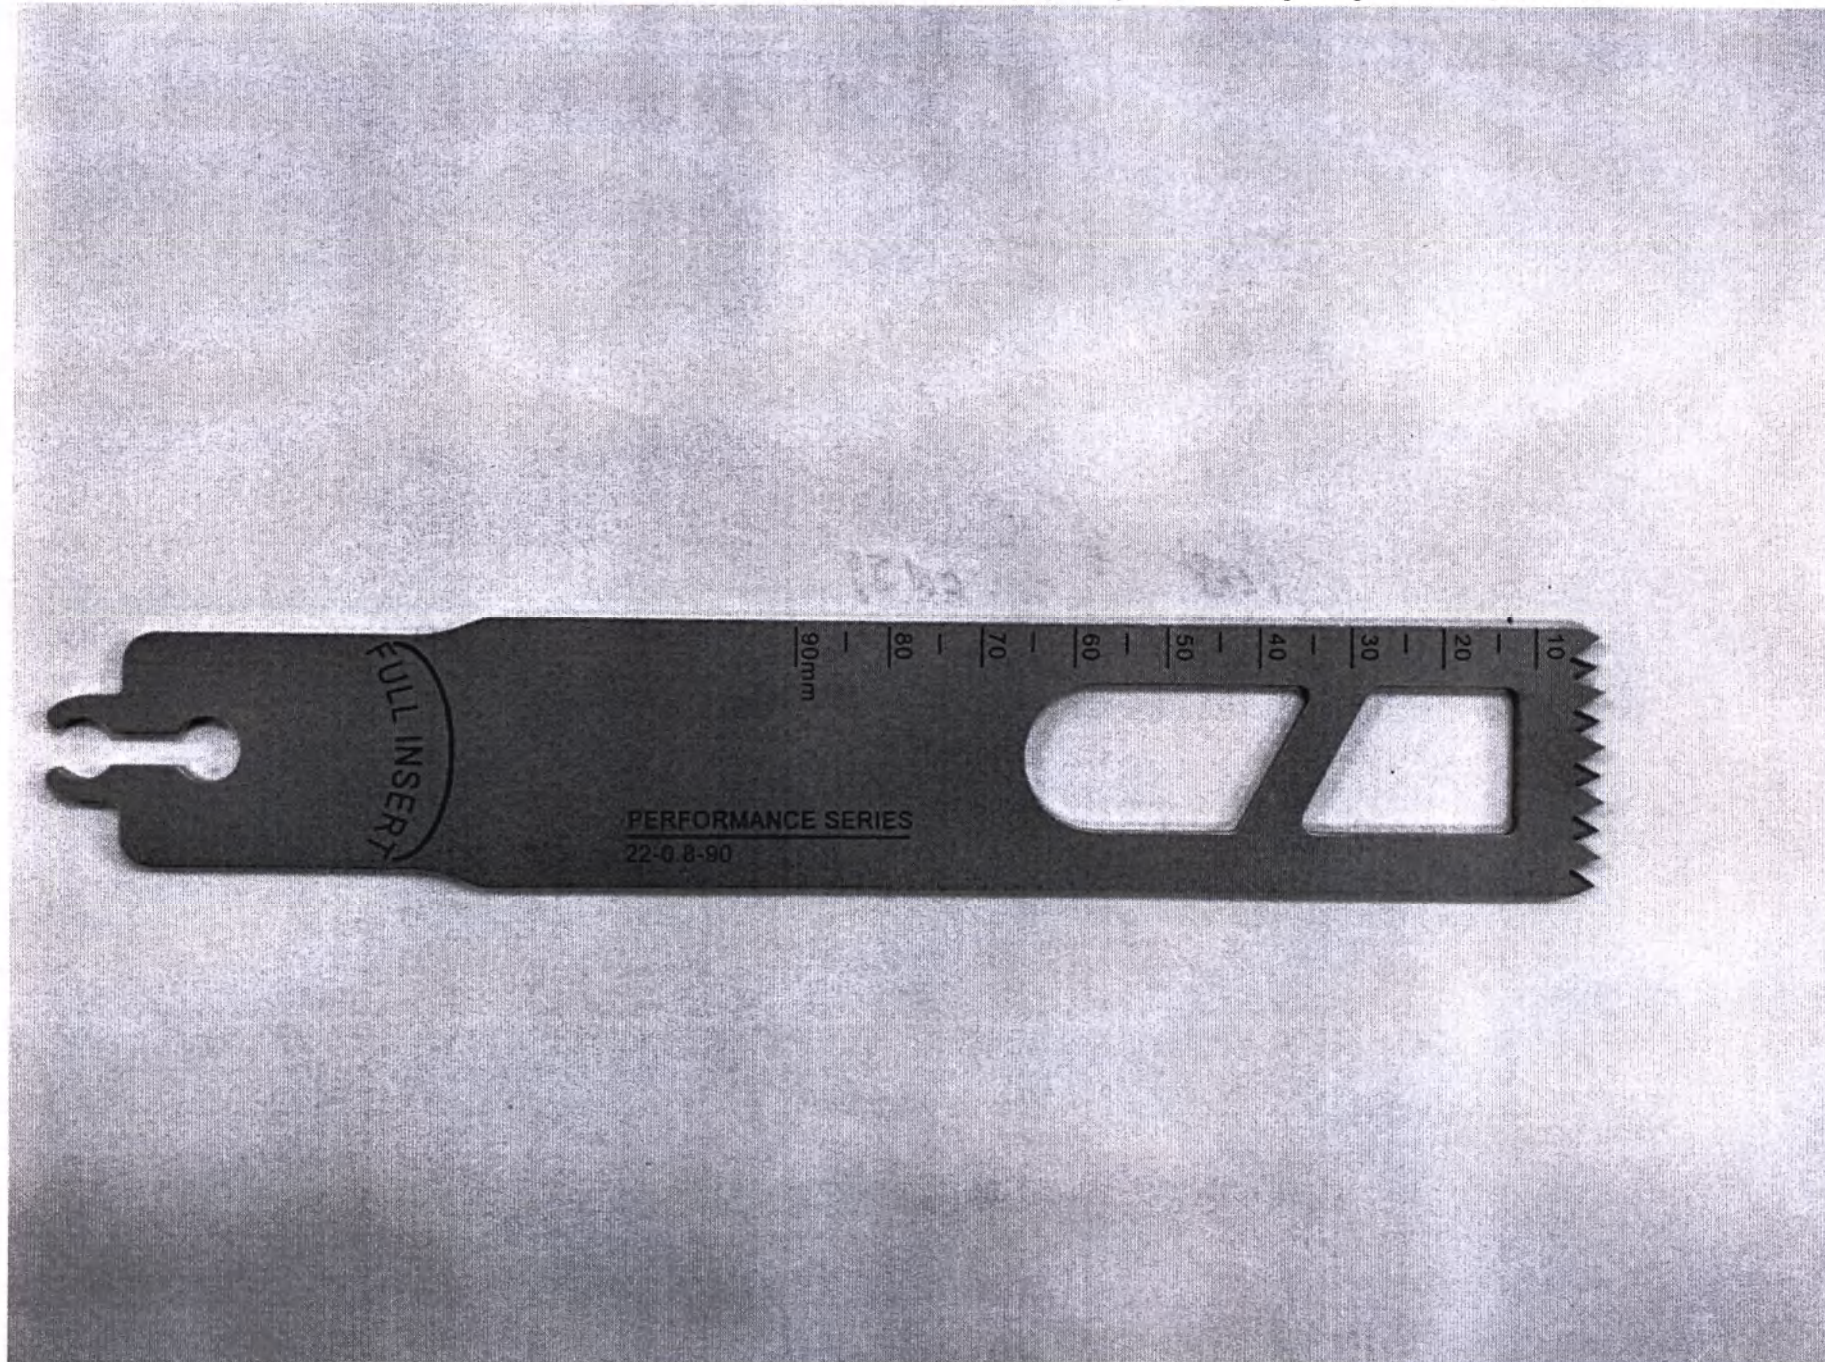


18. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагитальной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: 22 x 1,0 x 90 мм

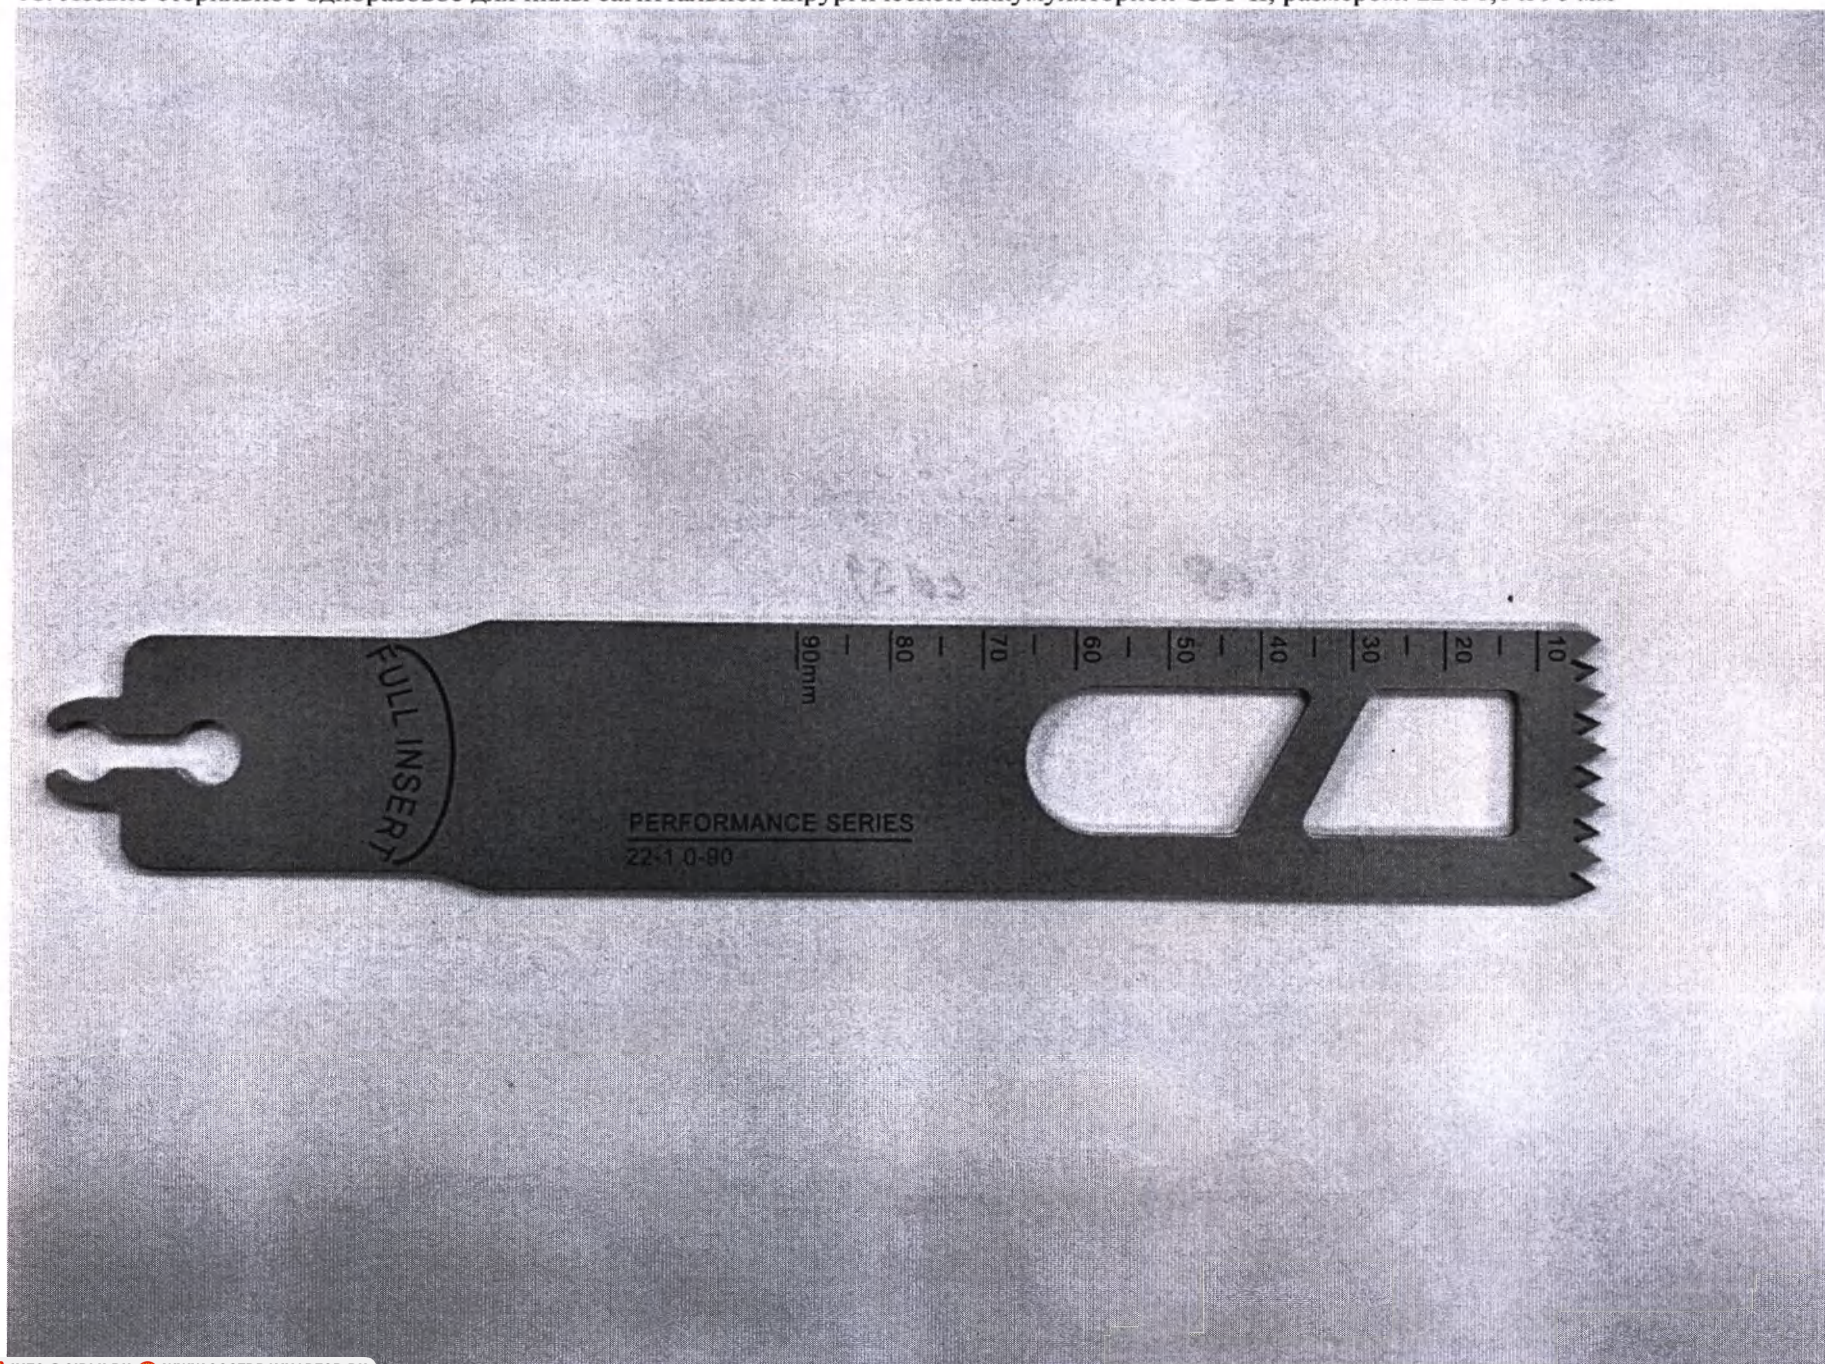


19. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GBS-1, размером: 22 x 1,2 x 90 мм




20. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: 22 x 1,3 x 90 мм

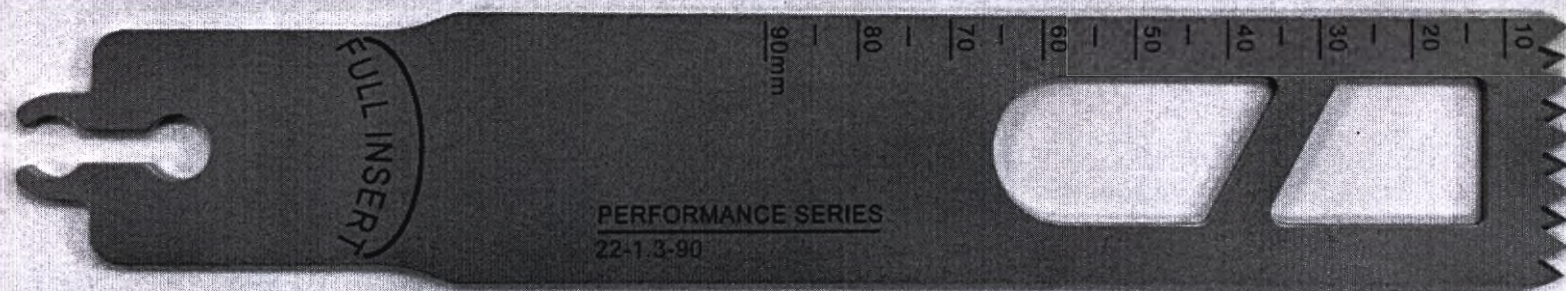


21. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: 22 x 1,0 x 100 мм

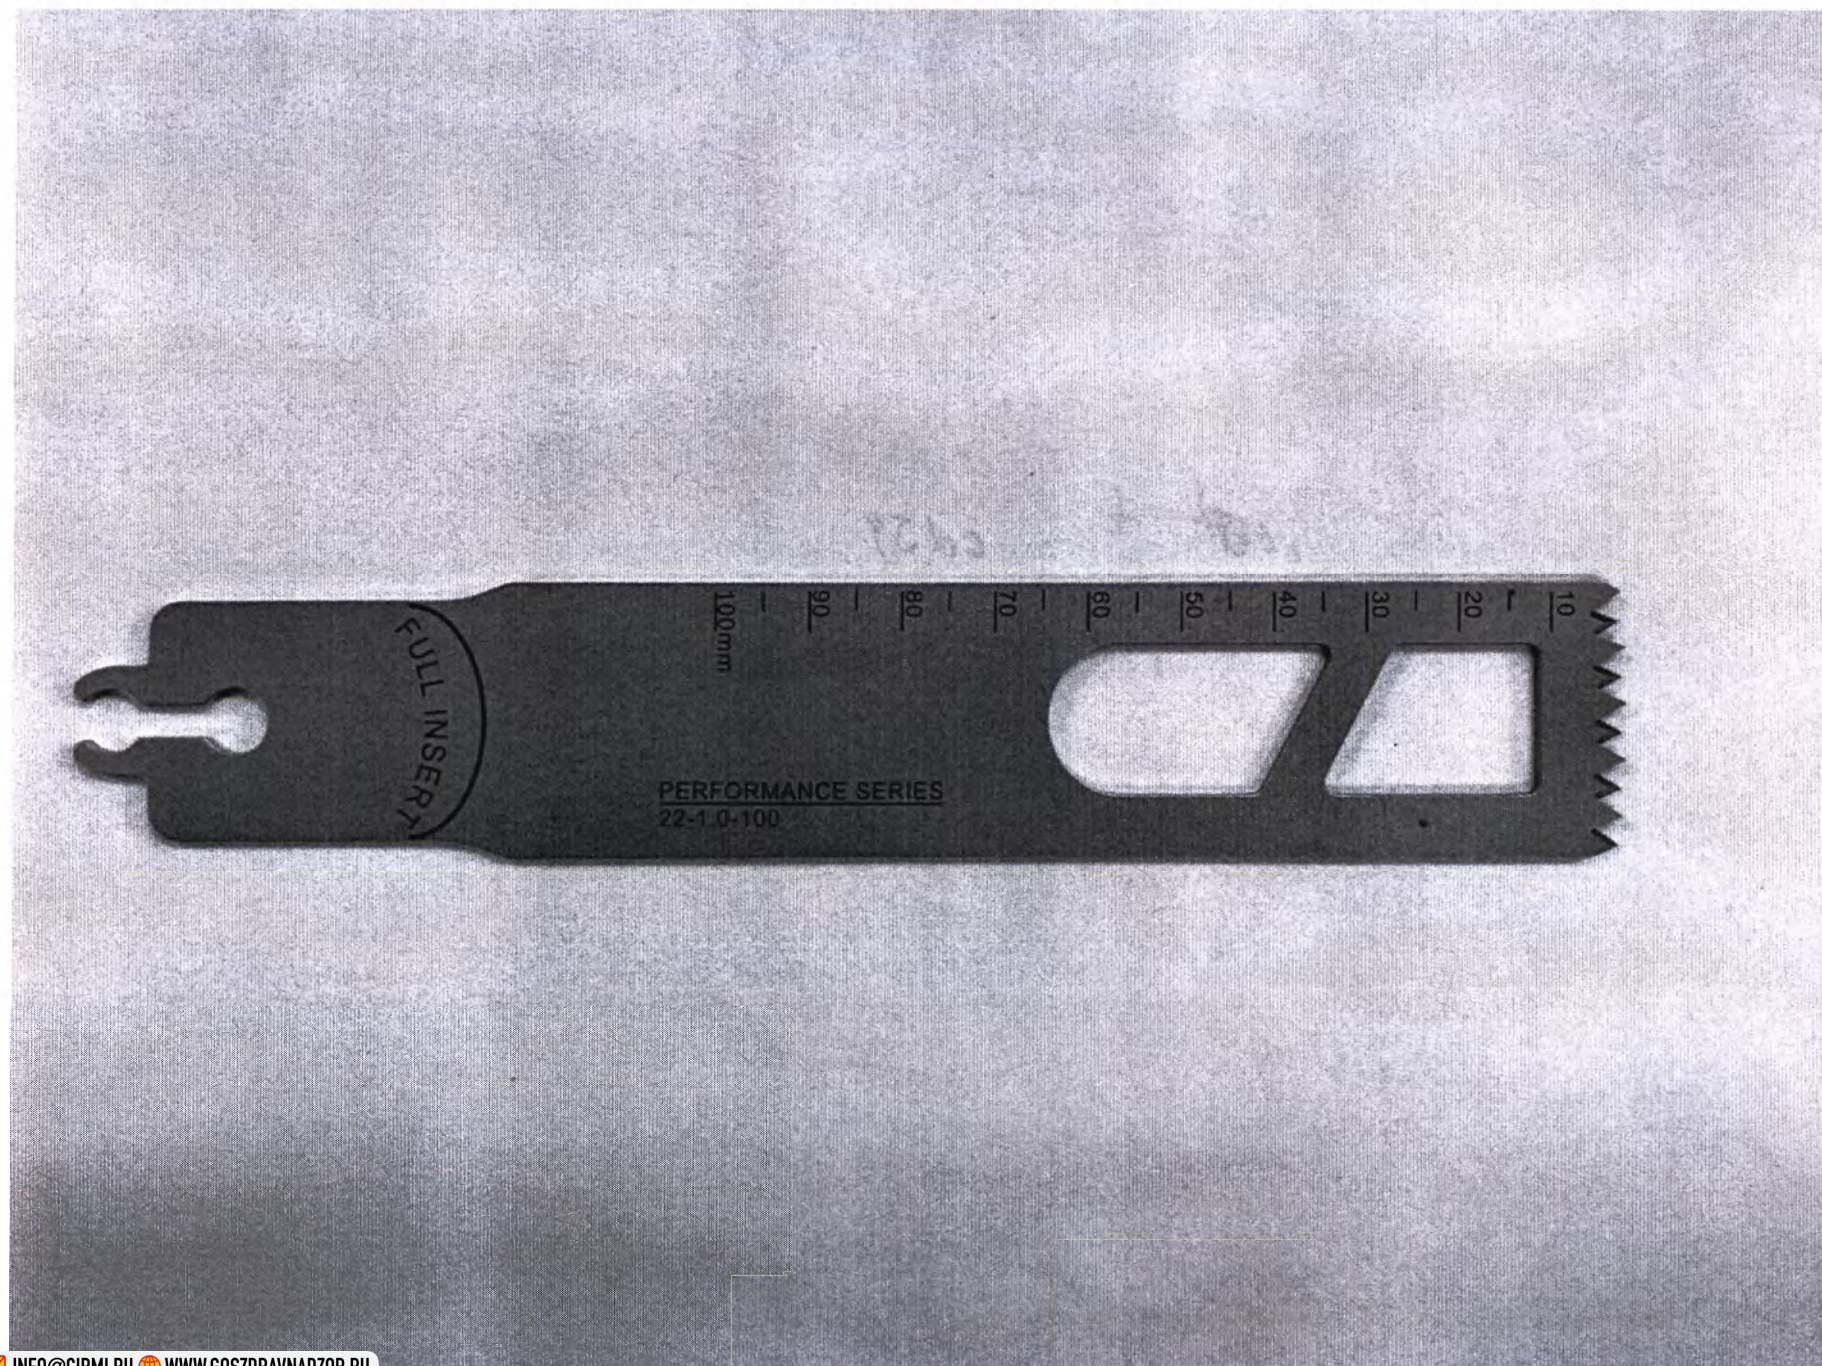

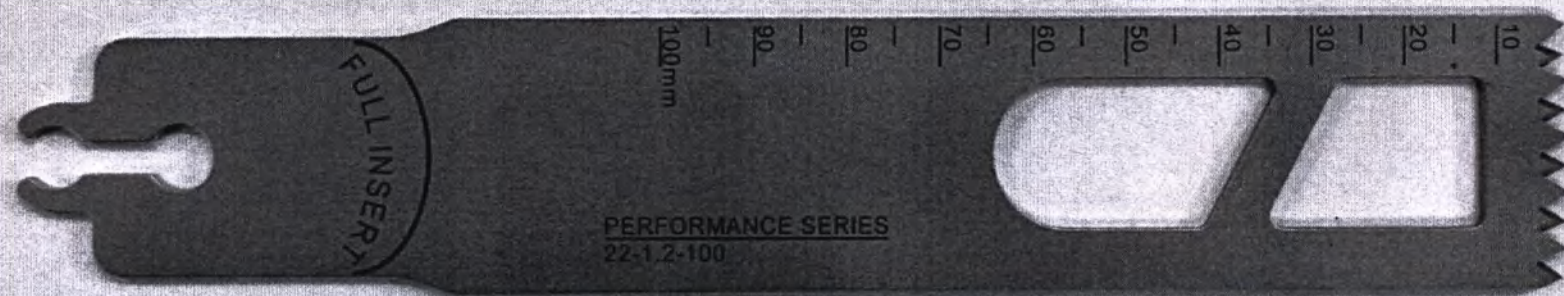

24

23. Металлическое одноразовое для пилы с интальной хирургической аккумуляторной СИ, II, размером: 22 x 1,3 x 100 мм

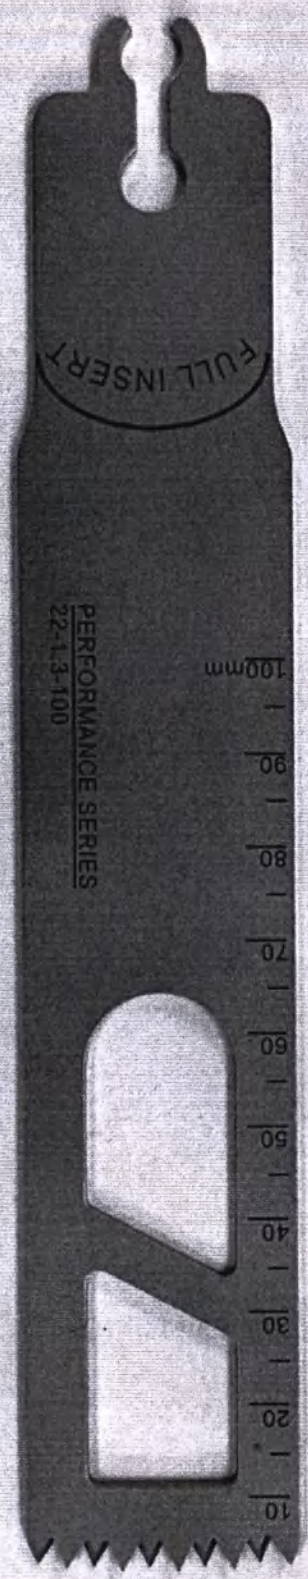

24

24. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDS-1, размером: 25 x 1,0 x 90 мм







26. Лезвие стерильное одноразовое для пилы скальпельной хирургической аккумуляторной GL-1, размером: 25 x 1,3 x 90 мм



27. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GILBERT, размером: 25 x 1,0 x 100 мм

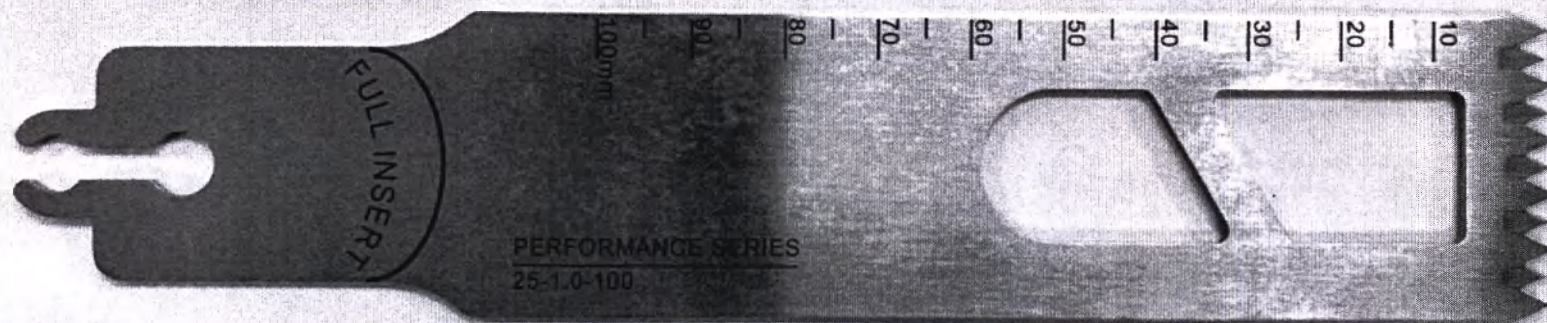

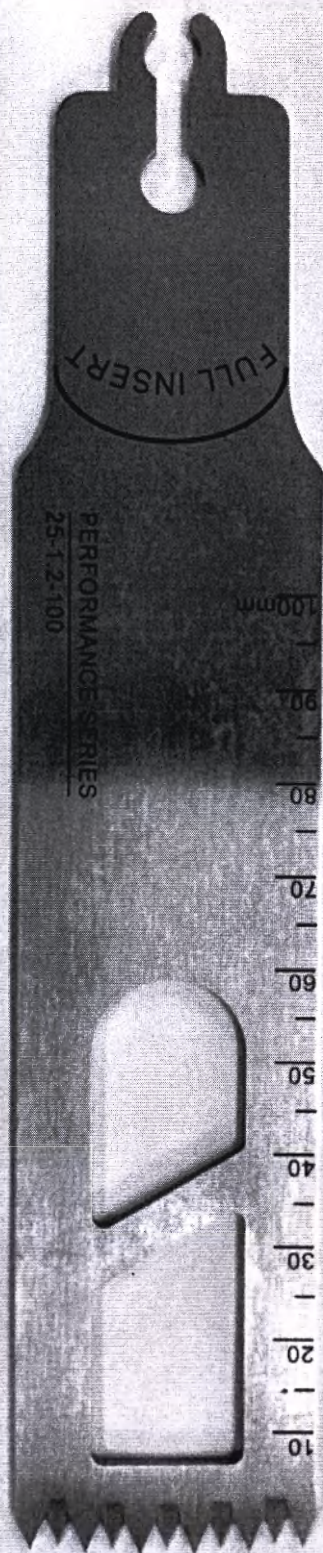

29. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GD-11, размером: 18 x 1,2 x 110 мм



30. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDS-II, размером: 18 x 1,0 x 110 мм




31. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной G15-П, размером: 15 x 0,9 x 70 мм



32. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GS II, размером: 20 x 1,2 x 90 мм



33. Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GS II, размером: 25 x 1,3 x 100 мм

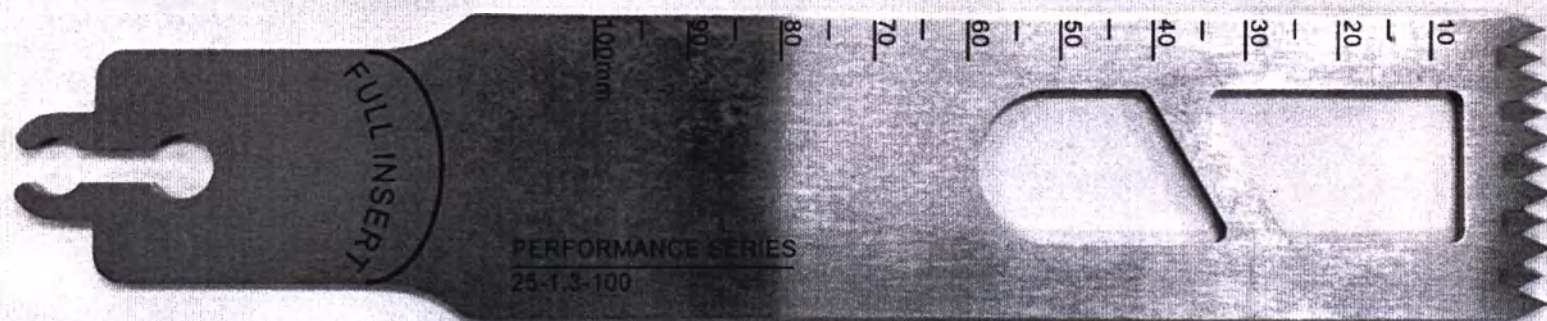

Наименование

Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDP II

Наименование медицинского изделия: Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: ____ x ____ x ____ мм, в составе:

- Лезвие стерильное одноразовое для пилы сагиттальной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: ____ x ____ x ____ мм;
- Эксплуатационная документация.

Код продукта: см. упаковку

Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.)

Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай)

Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Условия хранения: от -40 °C до +50 °C

Код партии (серии): см. упаковку

Год выпуска: см. упаковку

Срок годности: см. упаковку

Стерильно!

Апирогенно!

Нетоксично!

Изготовлено из нержавеющей стали «Н»

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



