

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РЕГИКОМ»

Козлов И.

г.



Фотографические изображения

«Лезвия для пилы реципрокной хирургической аккумуляторной GDP II»

Производитель: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.


(СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.),

No. 2 Ansheng Road, Jinfeng Town, 215625 Zhangjiagang City, Jiangsu Province, P.R.China (Китай)


1. Лезвие для пилы реципрокной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: 11 x 0,8 x 80 мм




2. Лезвие для пилы реципрокной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: 13 x 0,6 x 70 мм

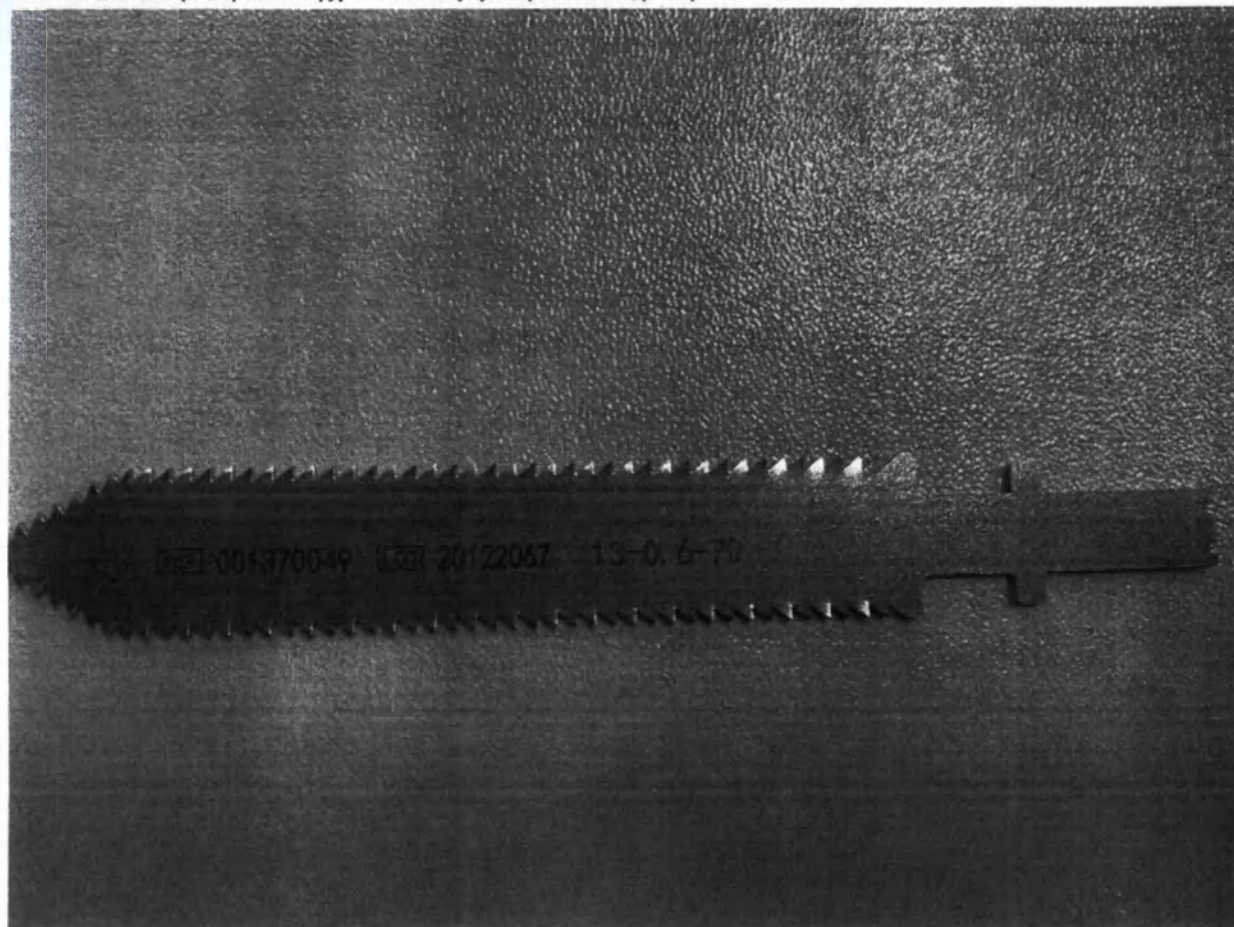

3. Лезвие для пилы реципрокной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: 11 x 0,5 x 100 мм

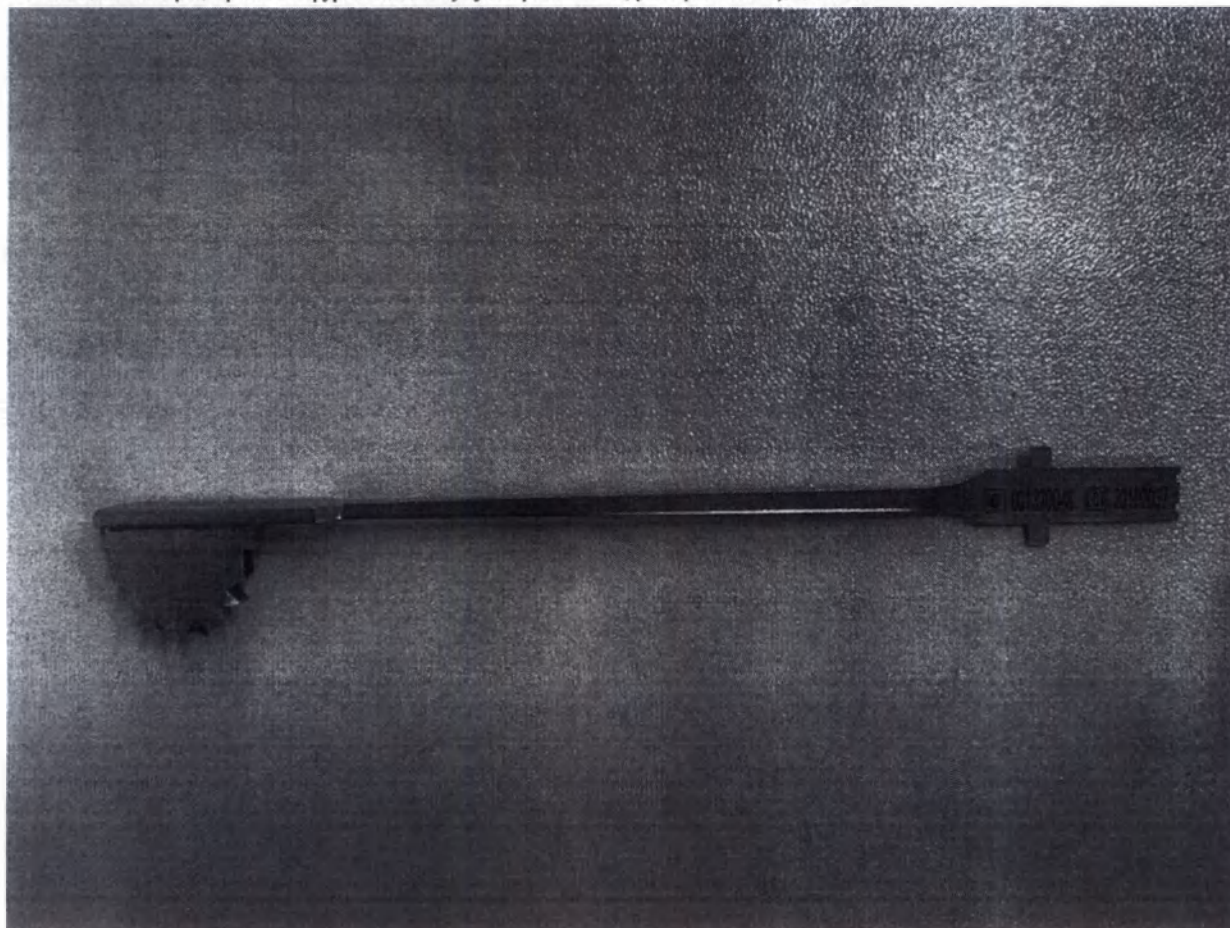

4. Лезвие для пилы реципрокной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: 6 x 0,6 x 40 мм

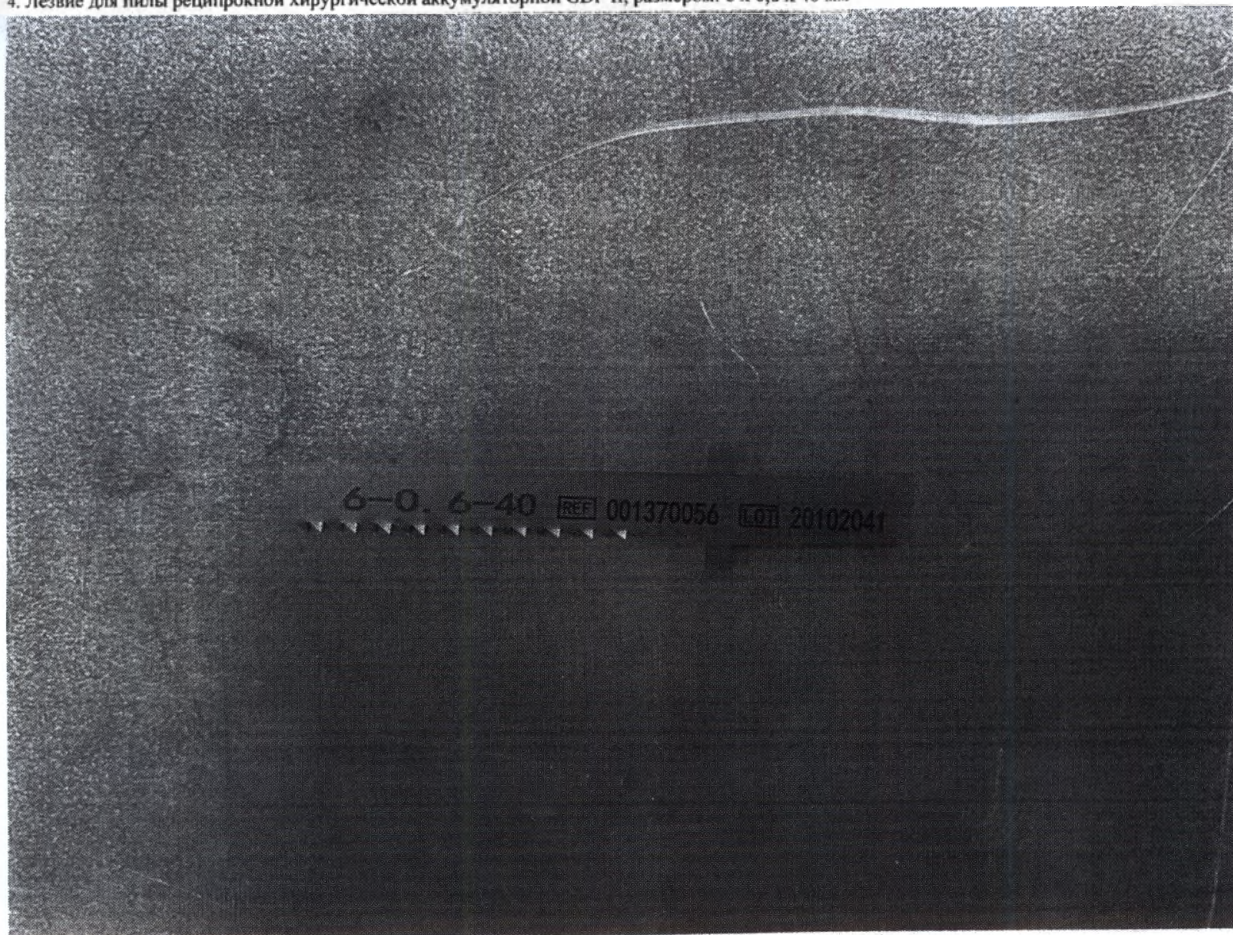

Проект текста маркировки для обращения на территории Российской Федерации

Наименование
Лезвие для пилы реципрокной хирургической аккумуляторной GDP II
Наименование медицинского изделия: Лезвие для пилы реципрокной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: ___ x ___ x ___ мм, в составе: - Лезвие для пилы реципрокной хирургической аккумуляторной GDP II, размером: ___ x ___ x ___ мм; - Эксплуатационная документация – 1 шт. Код продукта: см. упаковку Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения: от -40 °C до +50 °C Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Изготовлено из нержавеющей стали «Н» Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

