

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «СТЕРН»

Алексеев А.П.


«01» апреля 2024 г.





Фотографические изображения медицинского изделия

Аудиометр диагностический «Stern Otoscan Pro 202» по ТУ

26.60.12-005-52746973-2022

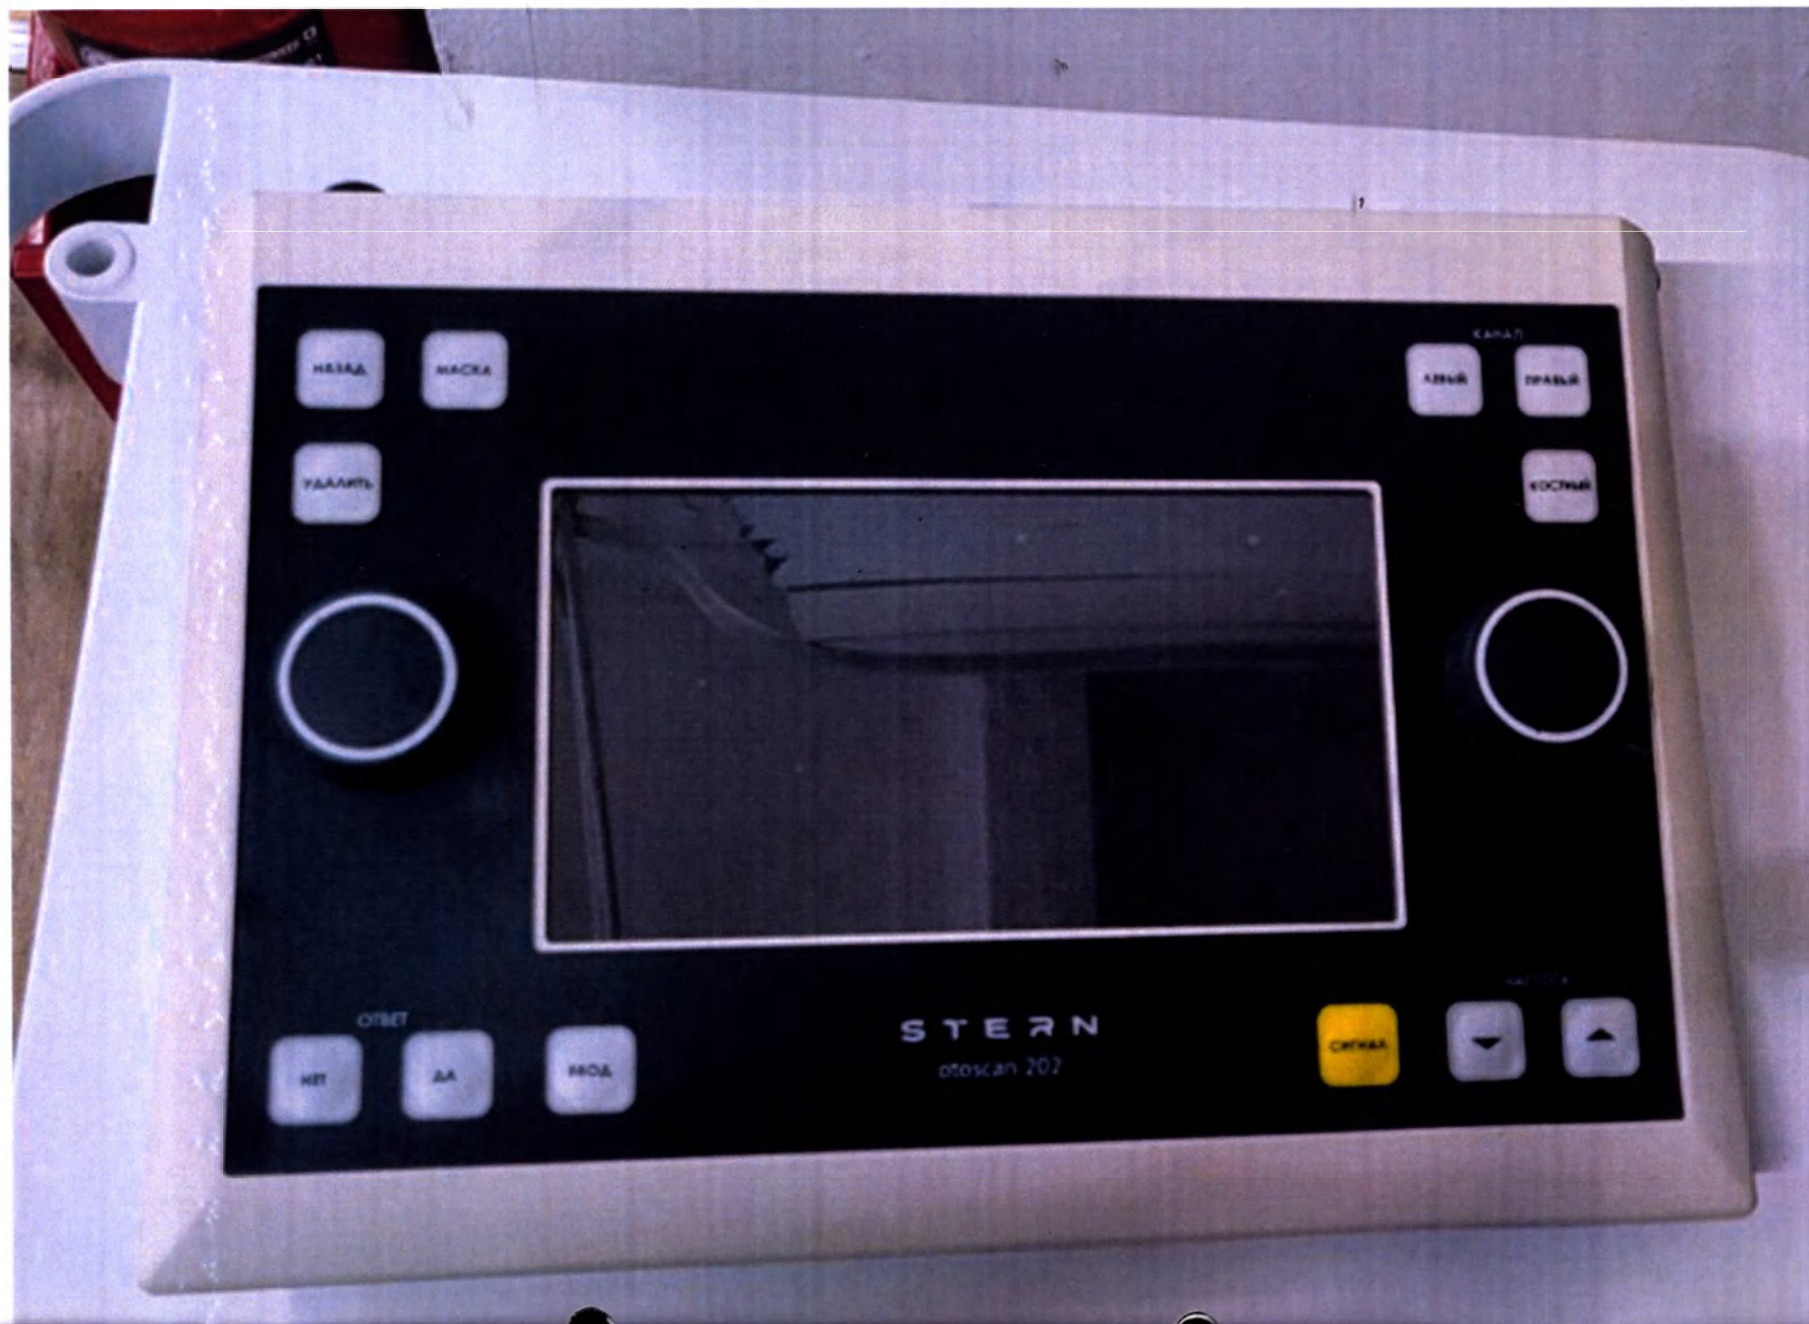

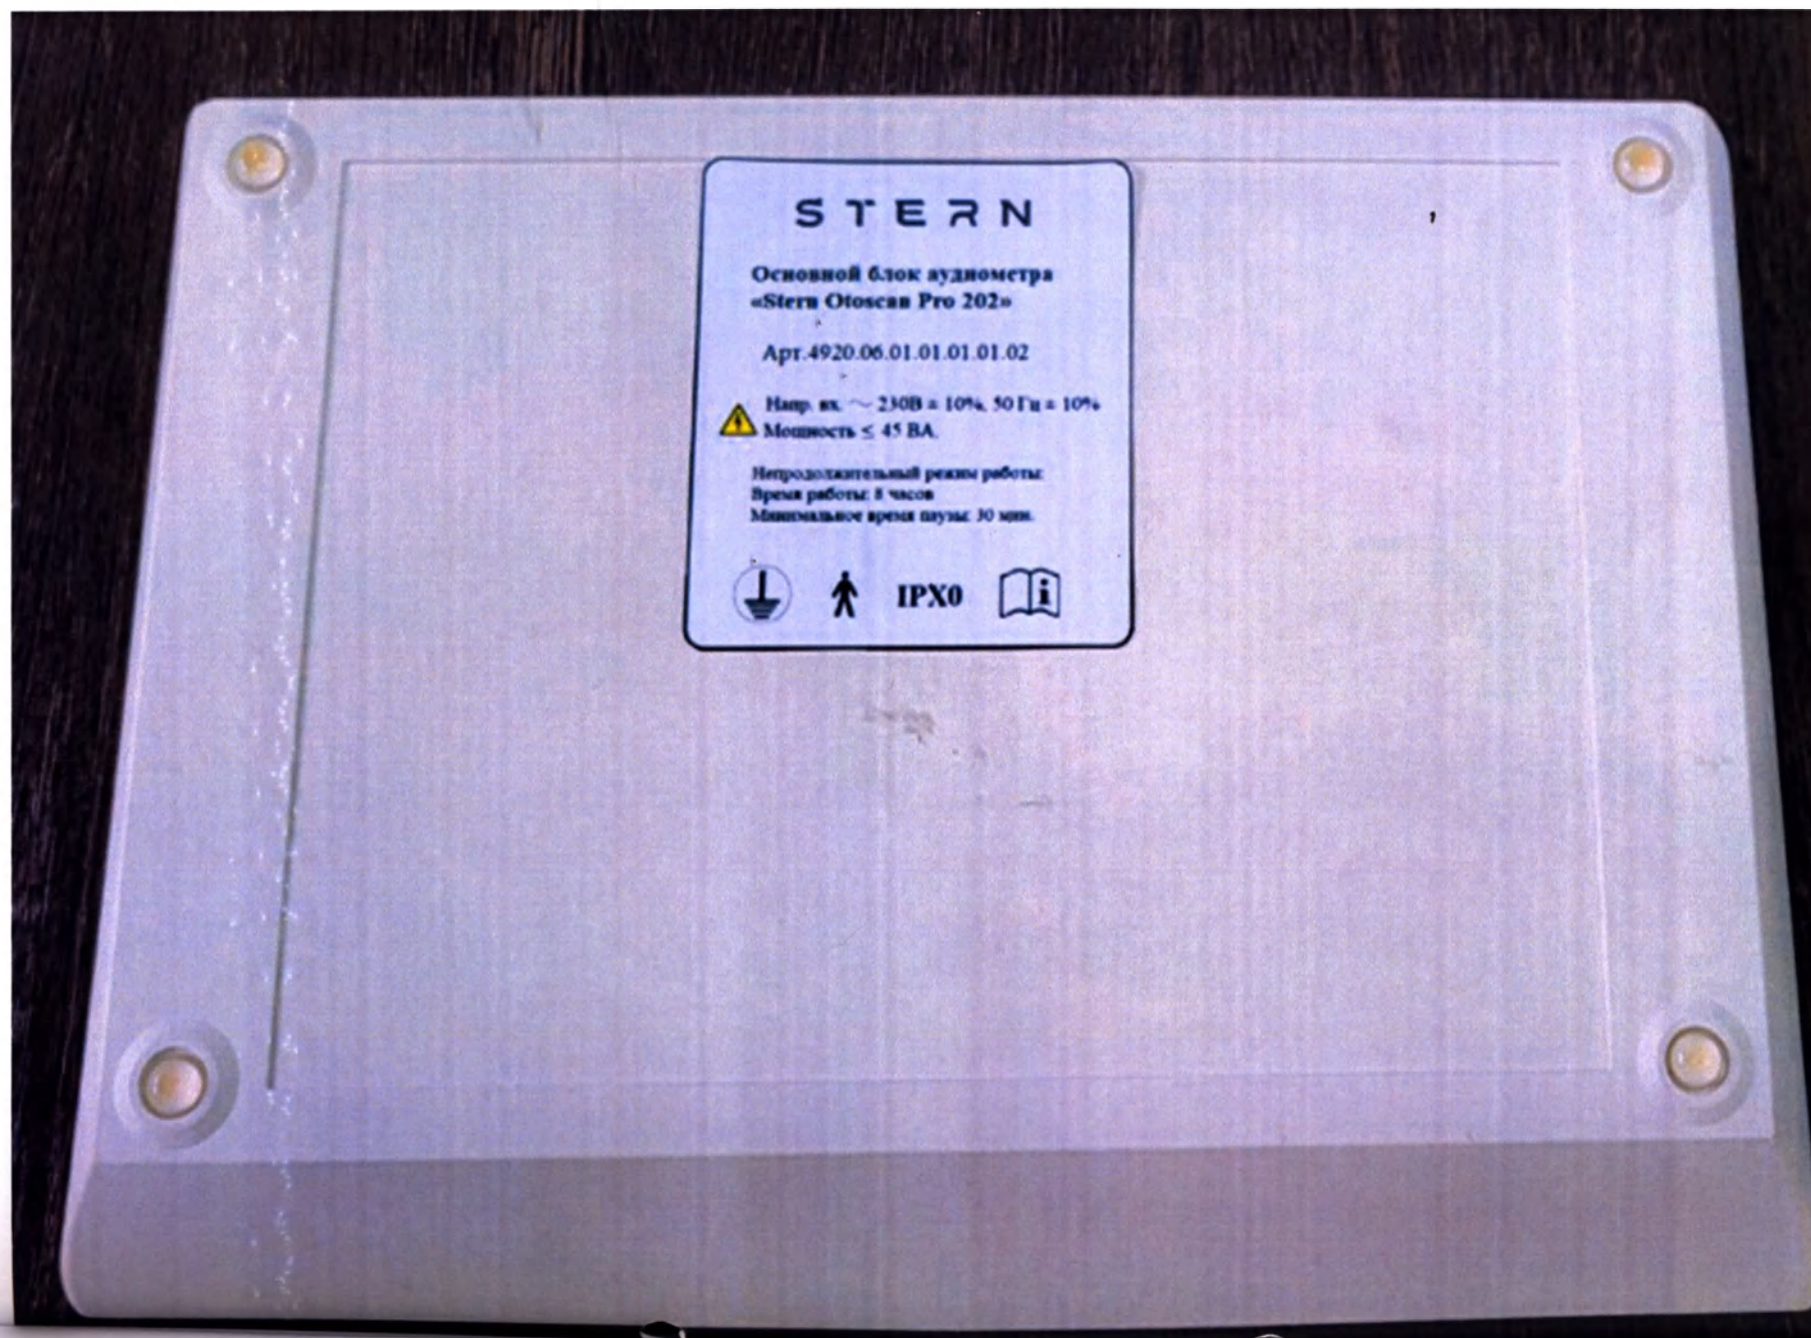


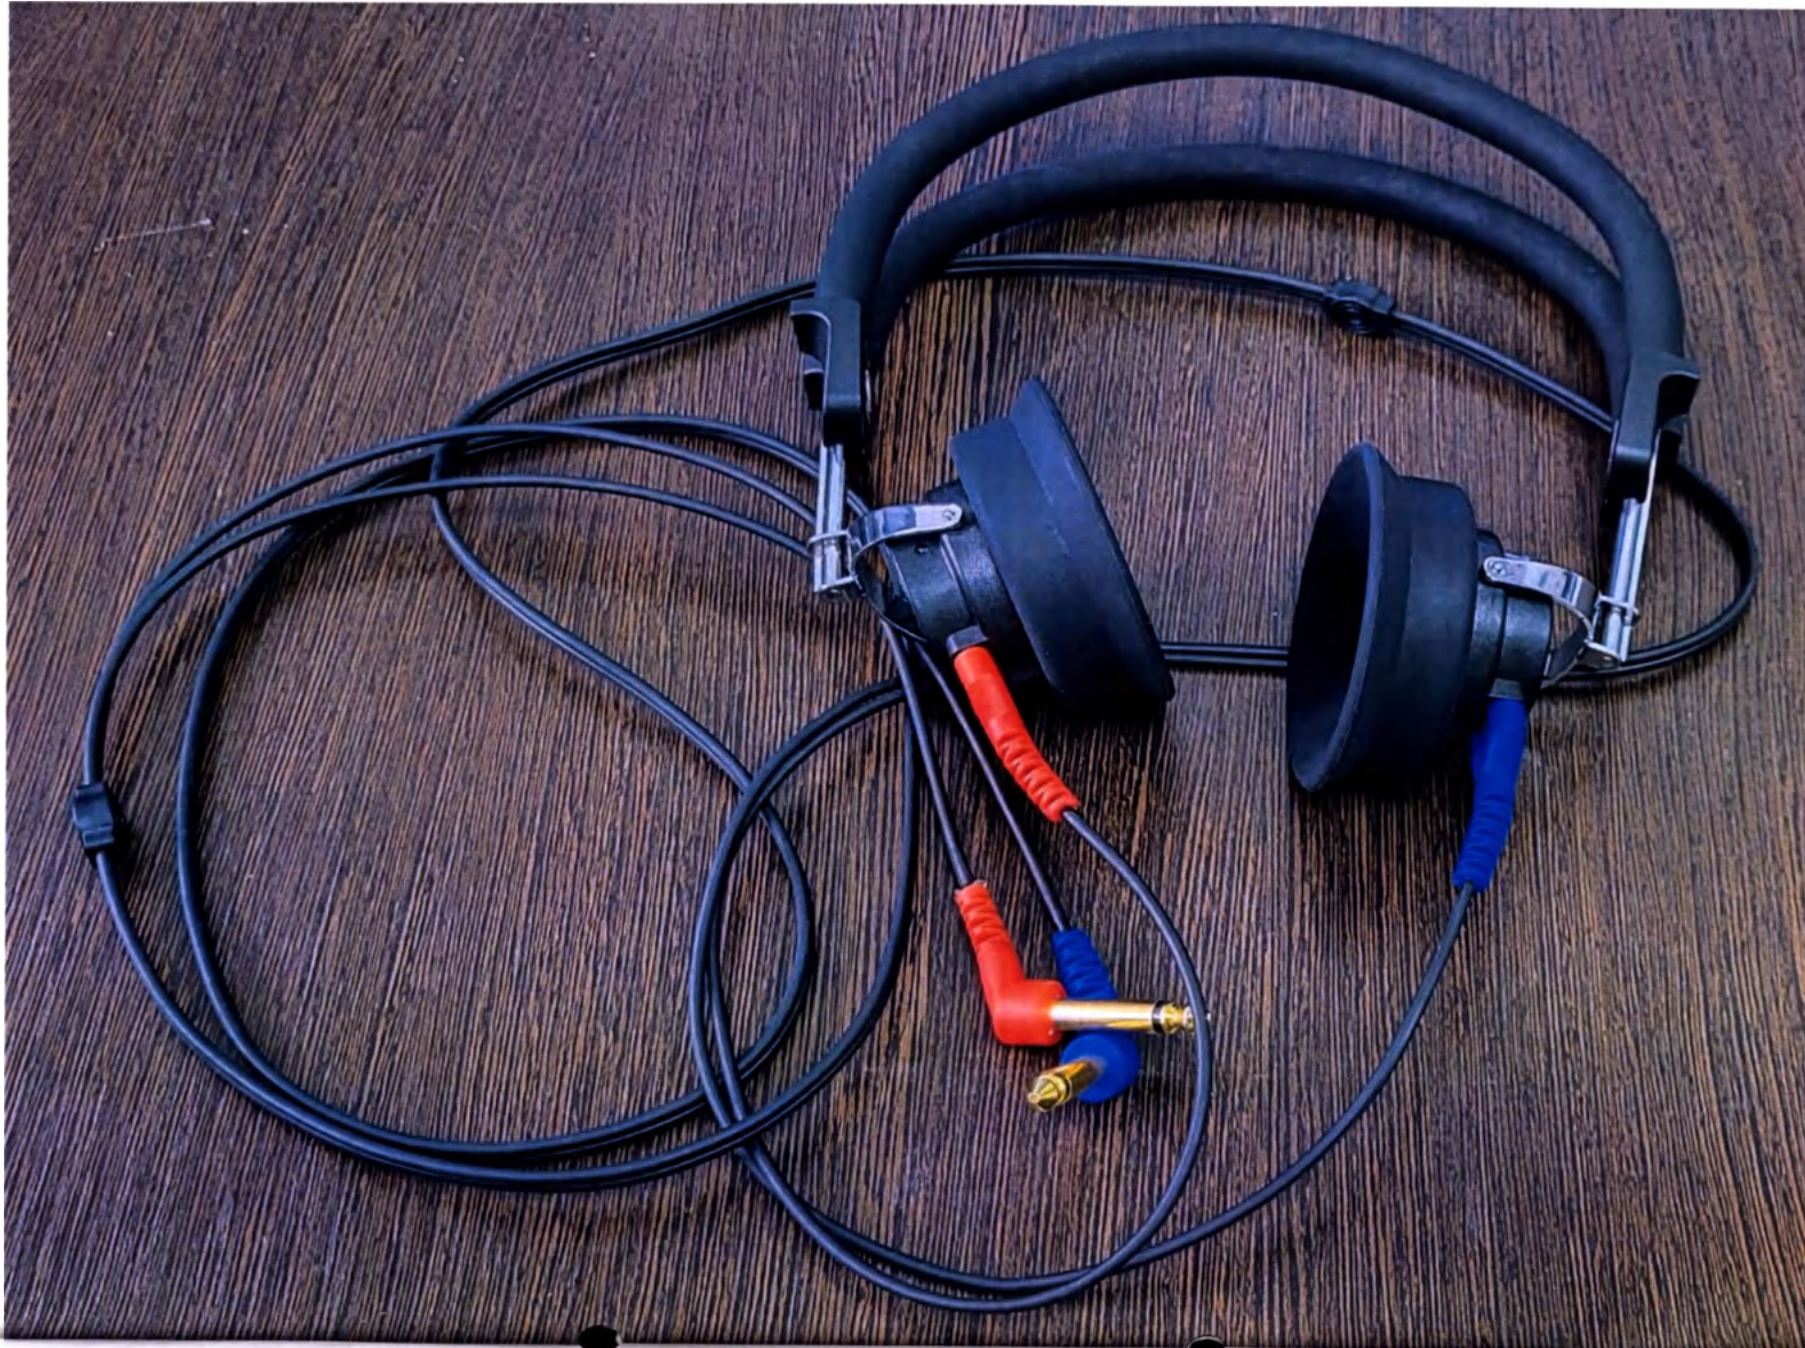



Маркировка головных телефонов


Костный вибратор с соединительным кабелем Radioear B71W, арт. 4920.06.01.01.01.03.00

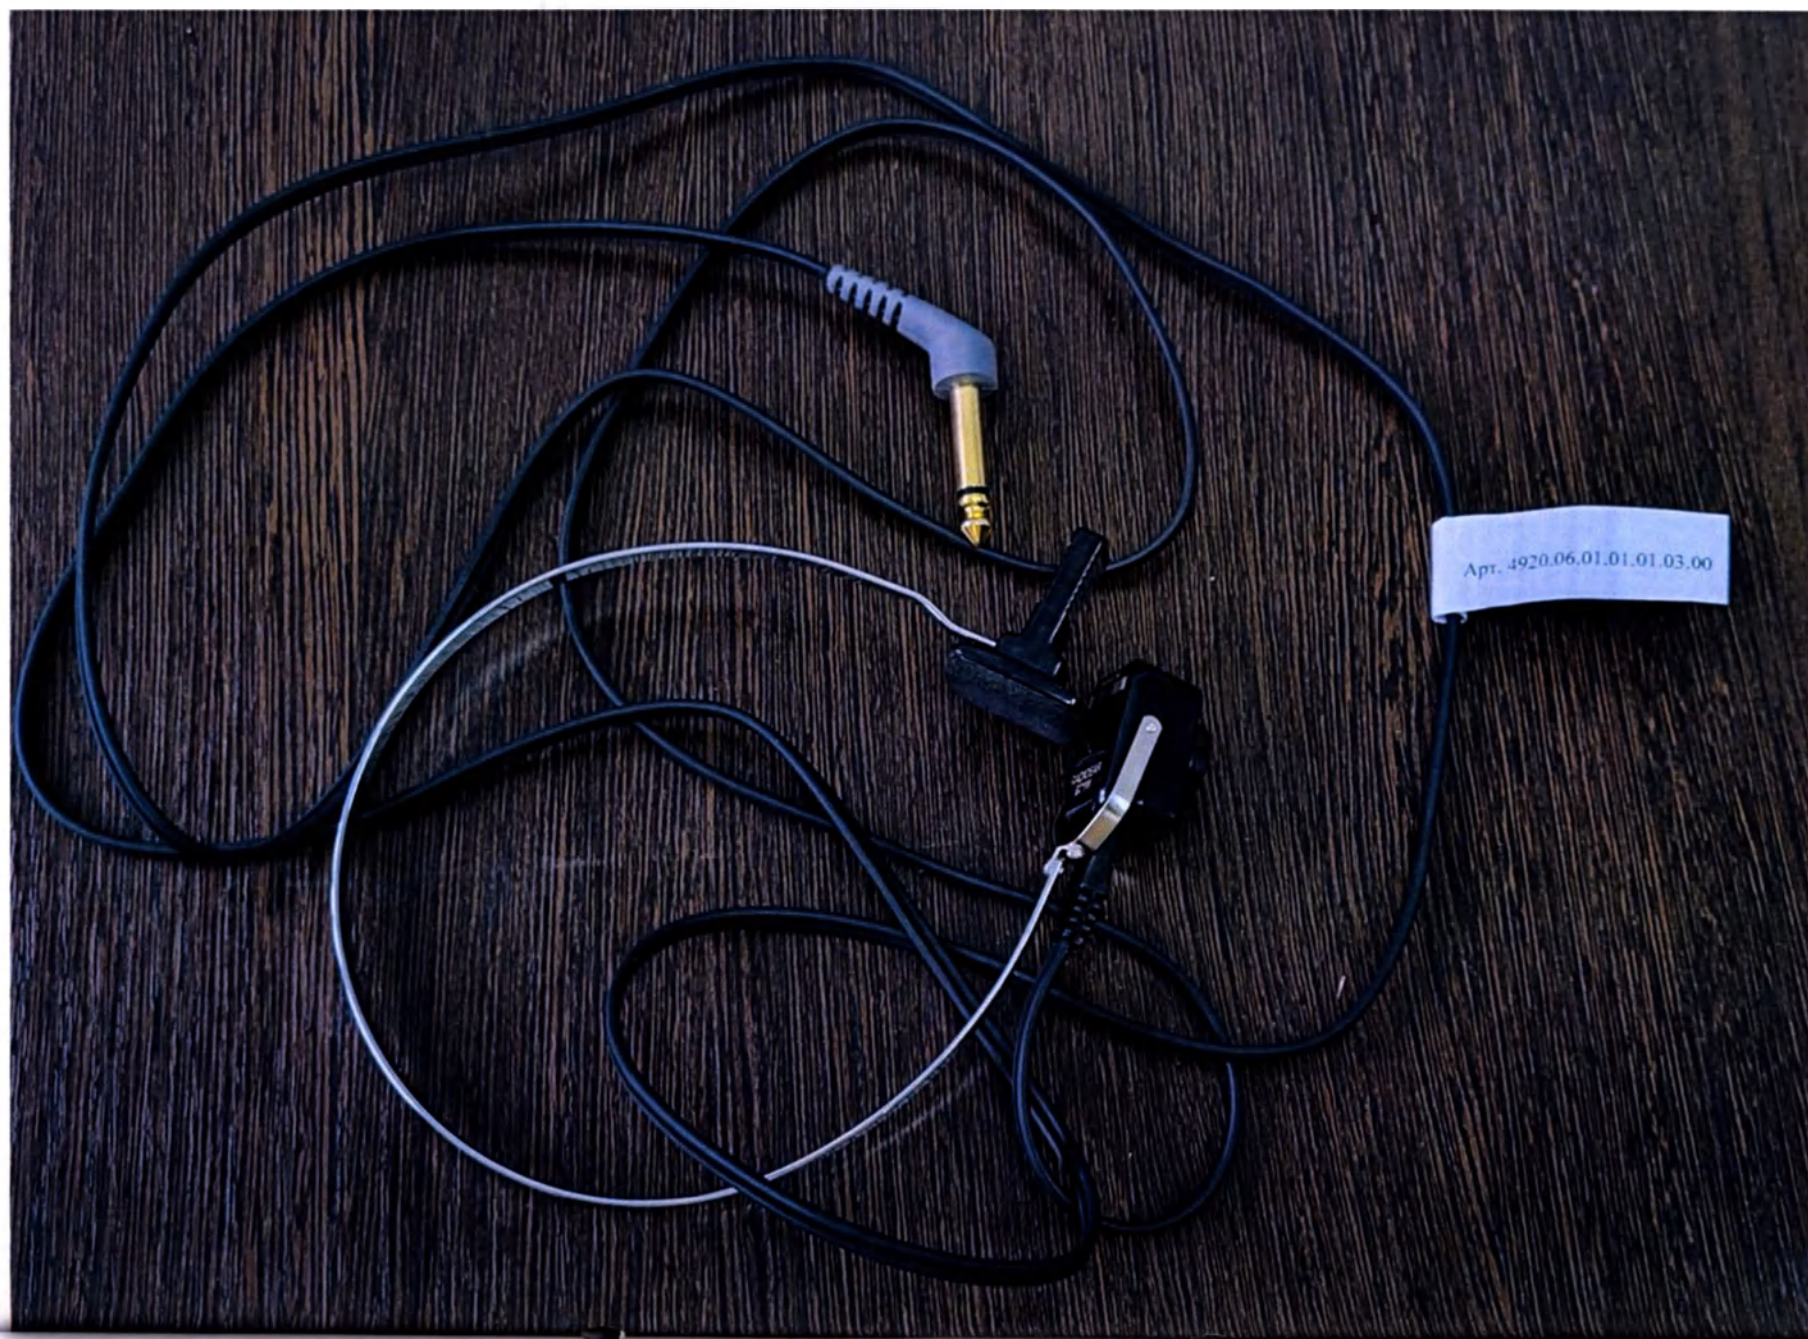


Маркировка костного вибратора с соединительным кабелем Radioear B71W



Кнопка ответа с соединительным кабелем, арт.4920.06.01.01.01.04.00

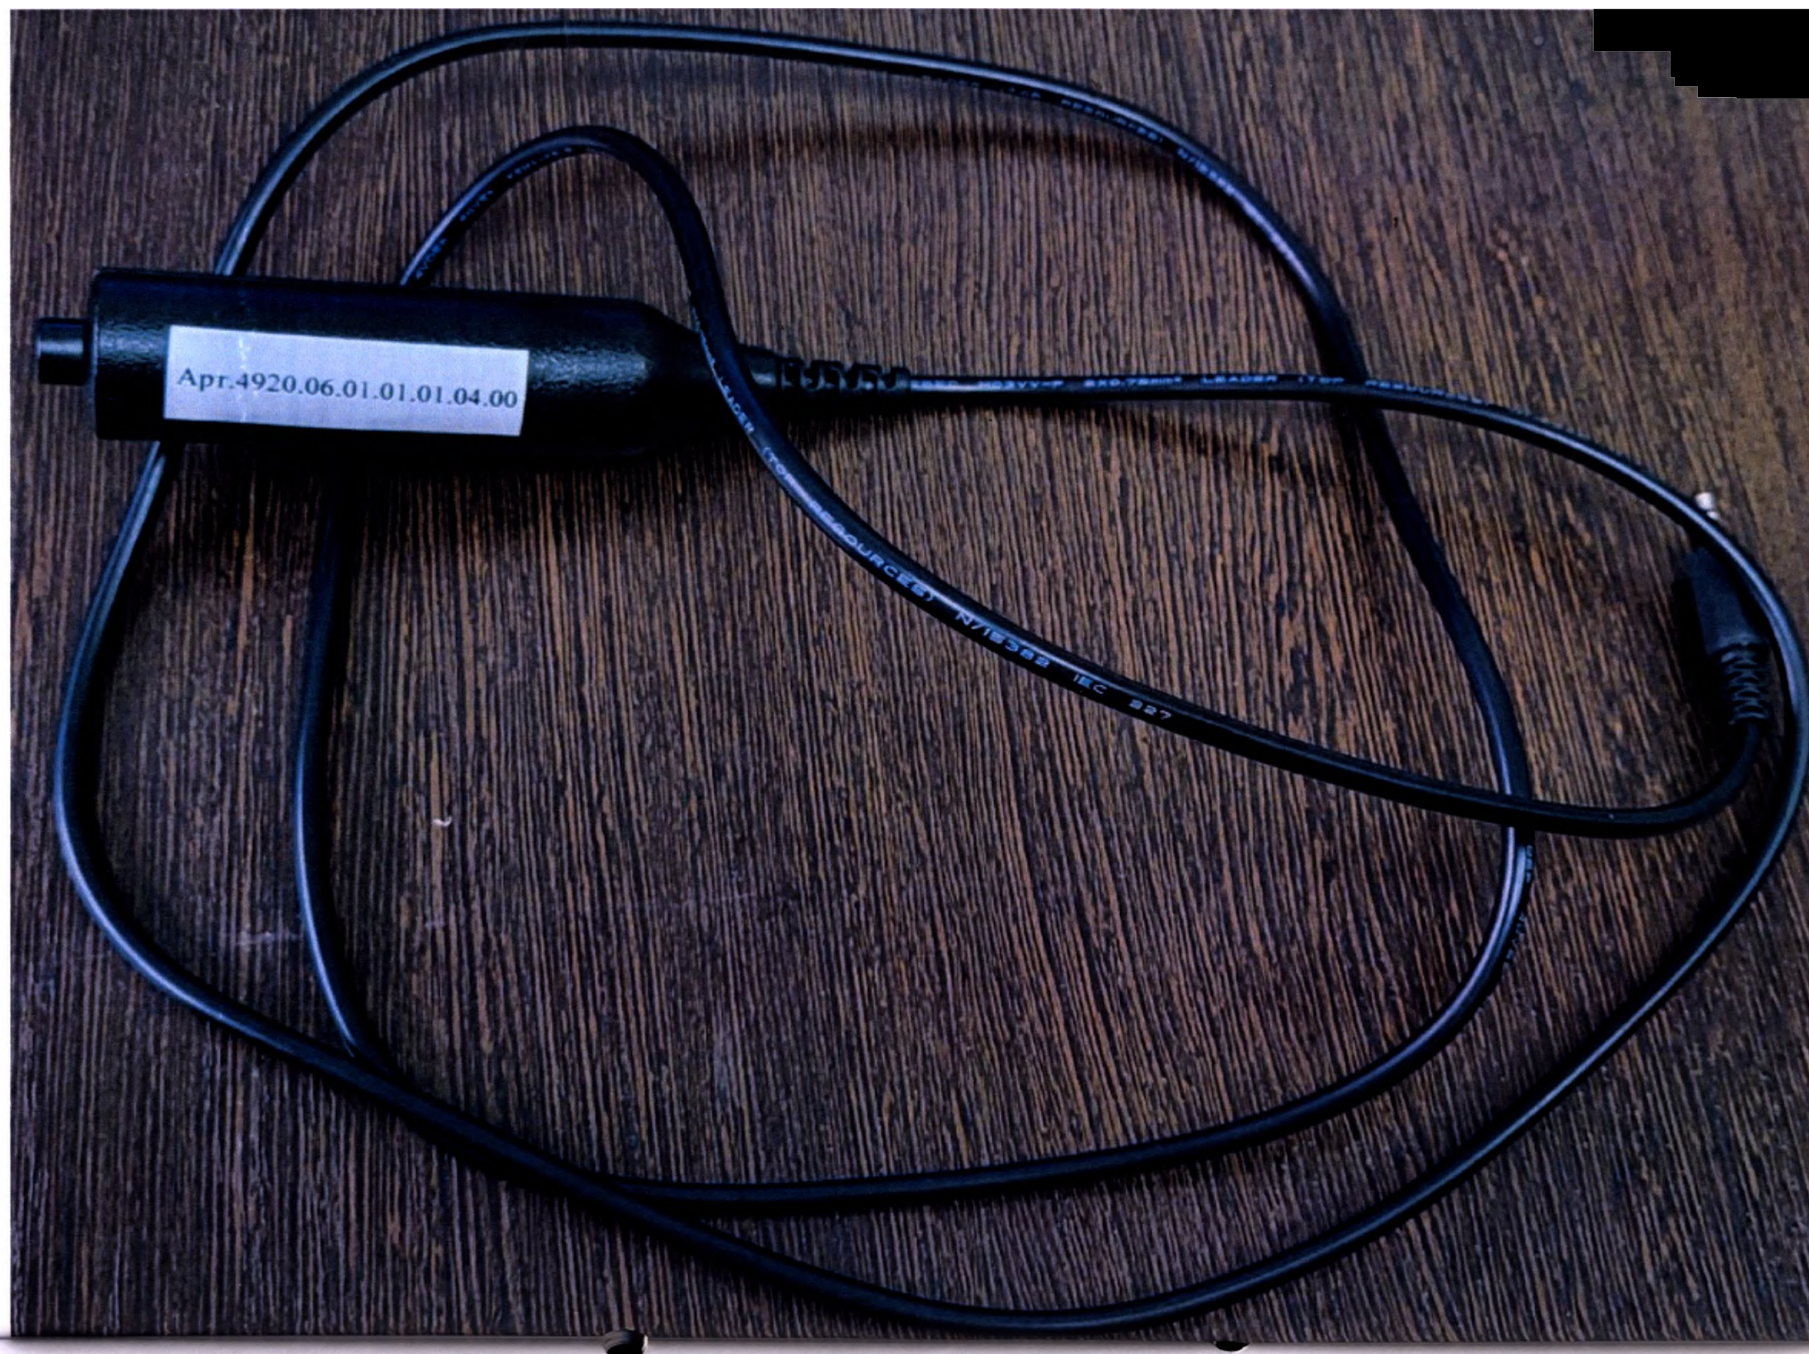

Кабель питания, арт. 4920.06.01.01.05.00

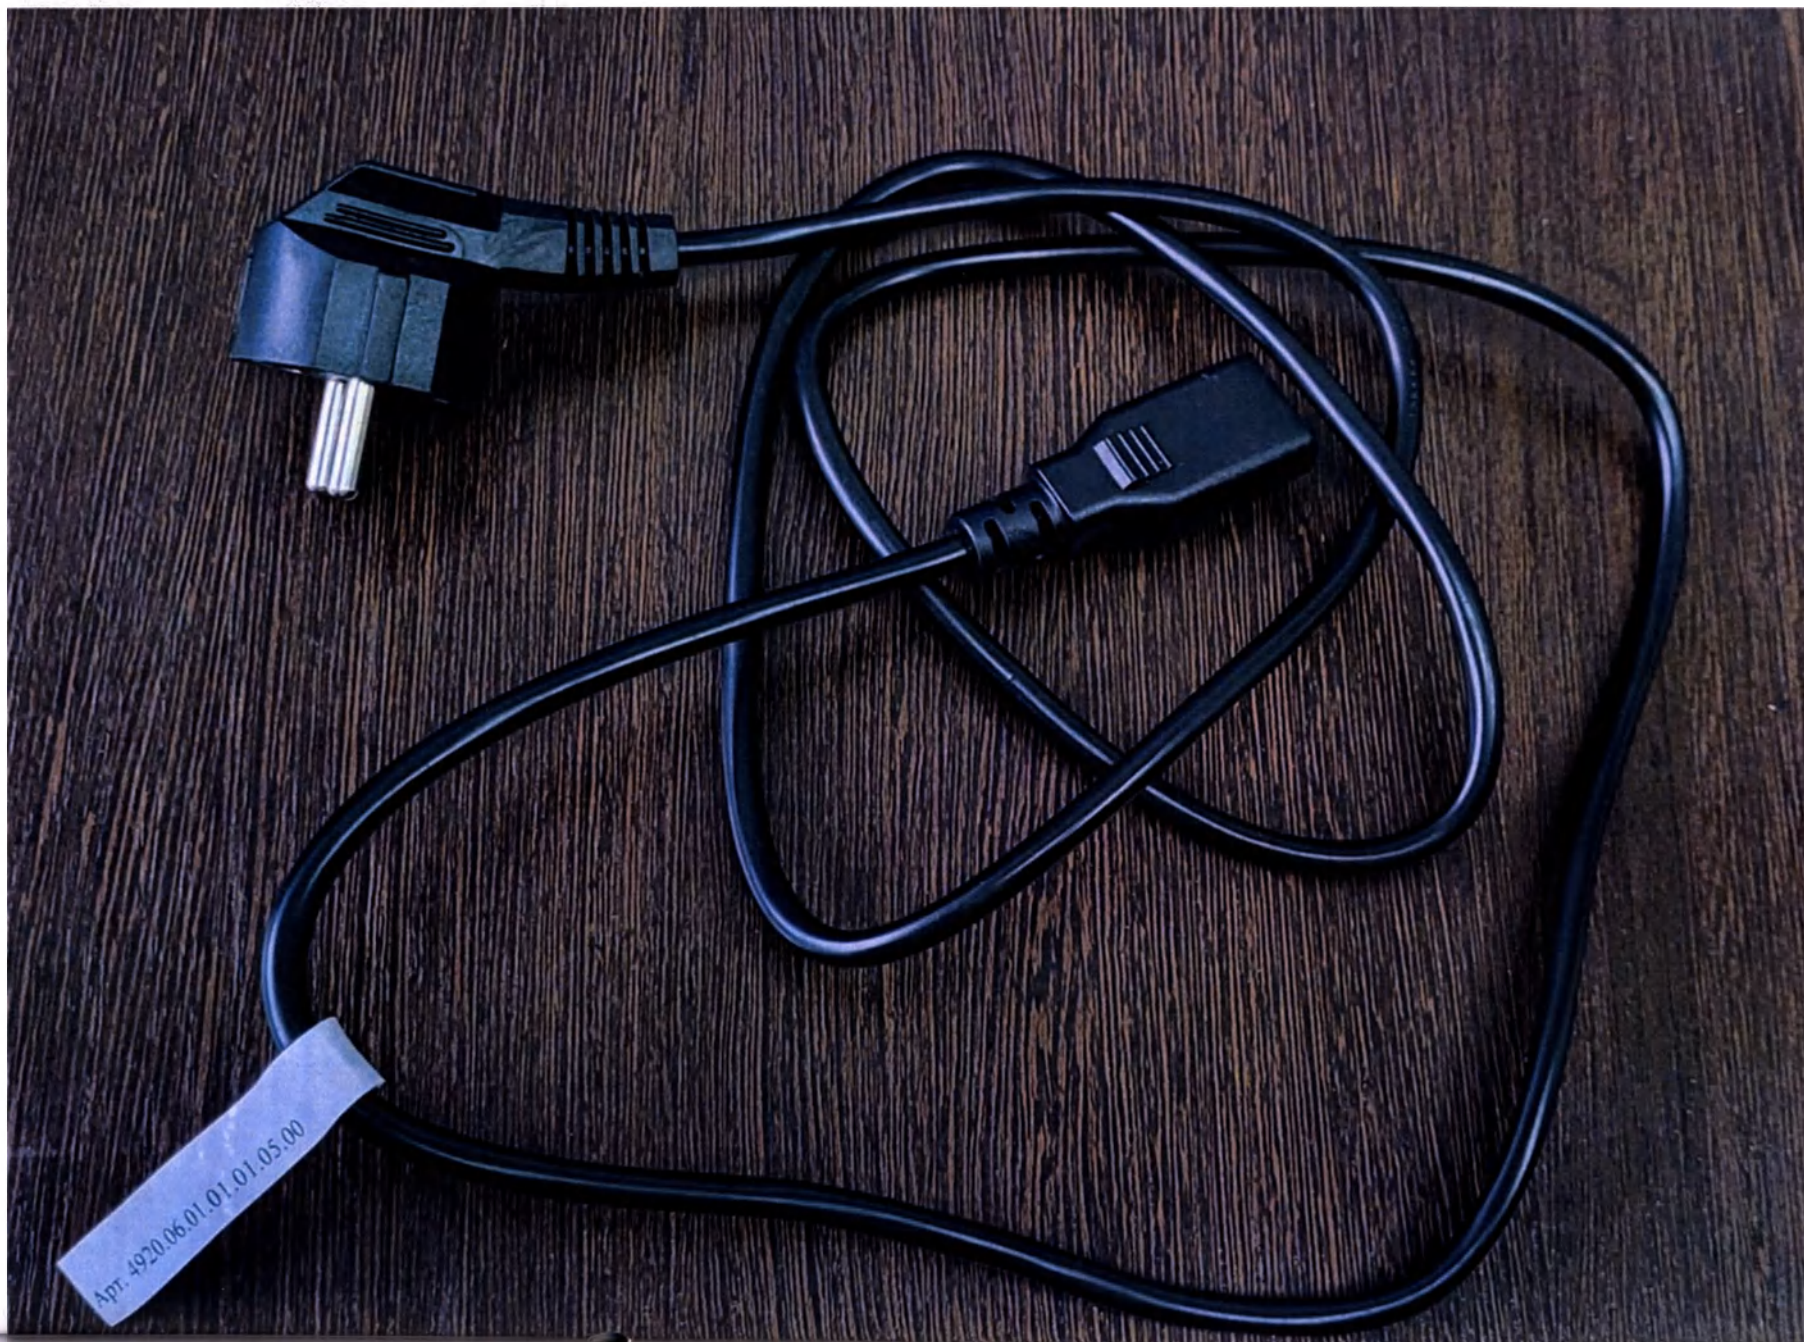

Кейс для хранения и транспортировки

S T E R N

Аудиометр диагностический «Stern Otoscan Pro 202»
по ТУ 26.60.12-005-52746973-2022

РУ № _____ от _____

Арт. 4920.06.01.01.01.00.02

 10.02.2022

 Напр. вх. $\sim 230\text{В} \pm 10\%$, $50\text{Гц} \pm 10\%$
Мощность $\leq 45\text{ВА}$.

Непродолжительный режим работы:
Время работы: 8 часов
Минимальное время паузы: 30 мин.



IPX0



ООО "СТЕРН"


Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, пом. IV, корп. 16, оф. 67.
Тел: +7(499)110-92-25, E-mail: info@medstern.ru
Сайт: www.medstern.ru

STERN

Аудиометр диагностический «Stern Otoscan Pro 202»
по ТУ 26.60.12-005-52746973-2022

РУ № ____ / ____ от ____

Арт. 4920.06.01.01.01.00.02

 10.02.2022



Напр. вх. $\sim 230\text{В} \pm 10\%$, $50\text{Гц} \pm 10\%$
Мощность $\leq 45\text{ВА}$.

Непродолжительный режим работы:
Время работы: 8 часов
Минимальное время паузы: 30 мин.



IPX0



ООО "СТЕРН"

Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, пом. IV, корп. 16, оф. 67.

Тел: +7(499)110-92-25, E-mail: info@medstern.ru

Сайт: www.medstern.ru

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью 11
листа (ов)
Генеральный директор
Алексеев А.П.

