


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


Реагент для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах и модулях биохимических cobas c (ECO-D), в вариантах исполнения производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany

2023


Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c 311 system), вариант исполнения 60 мл

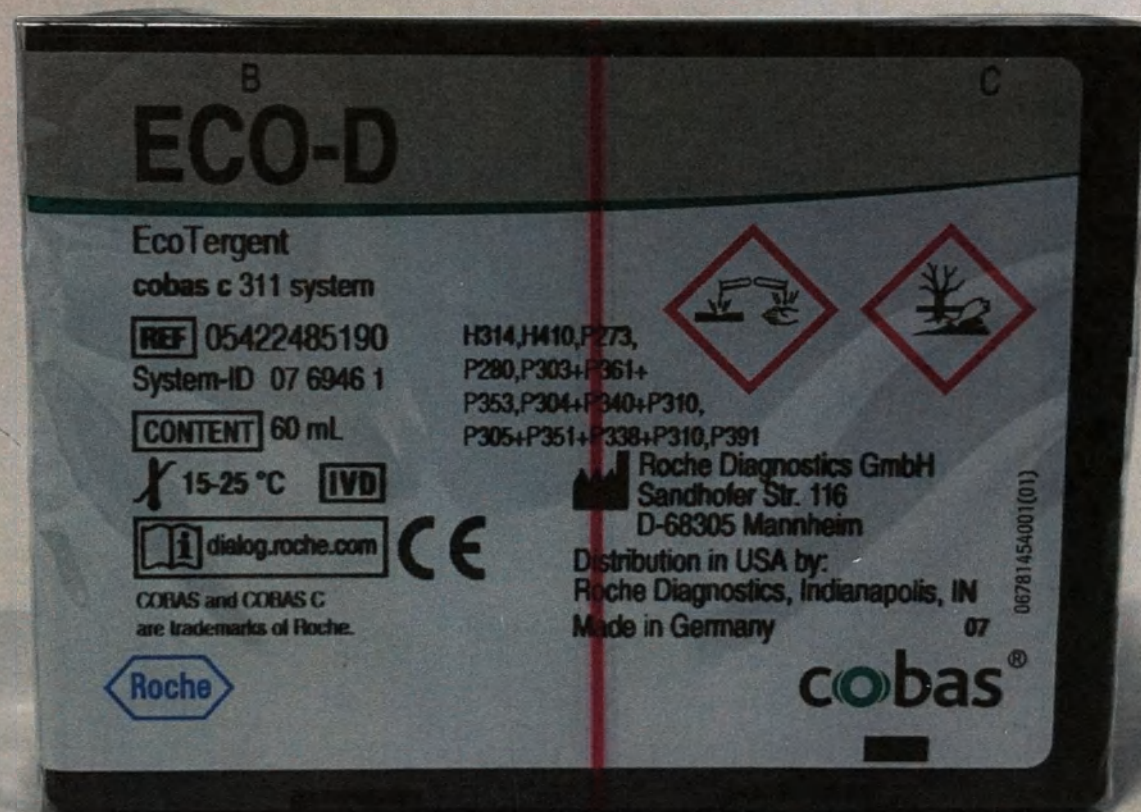


Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c 311 system), вариант исполнения 60 мл

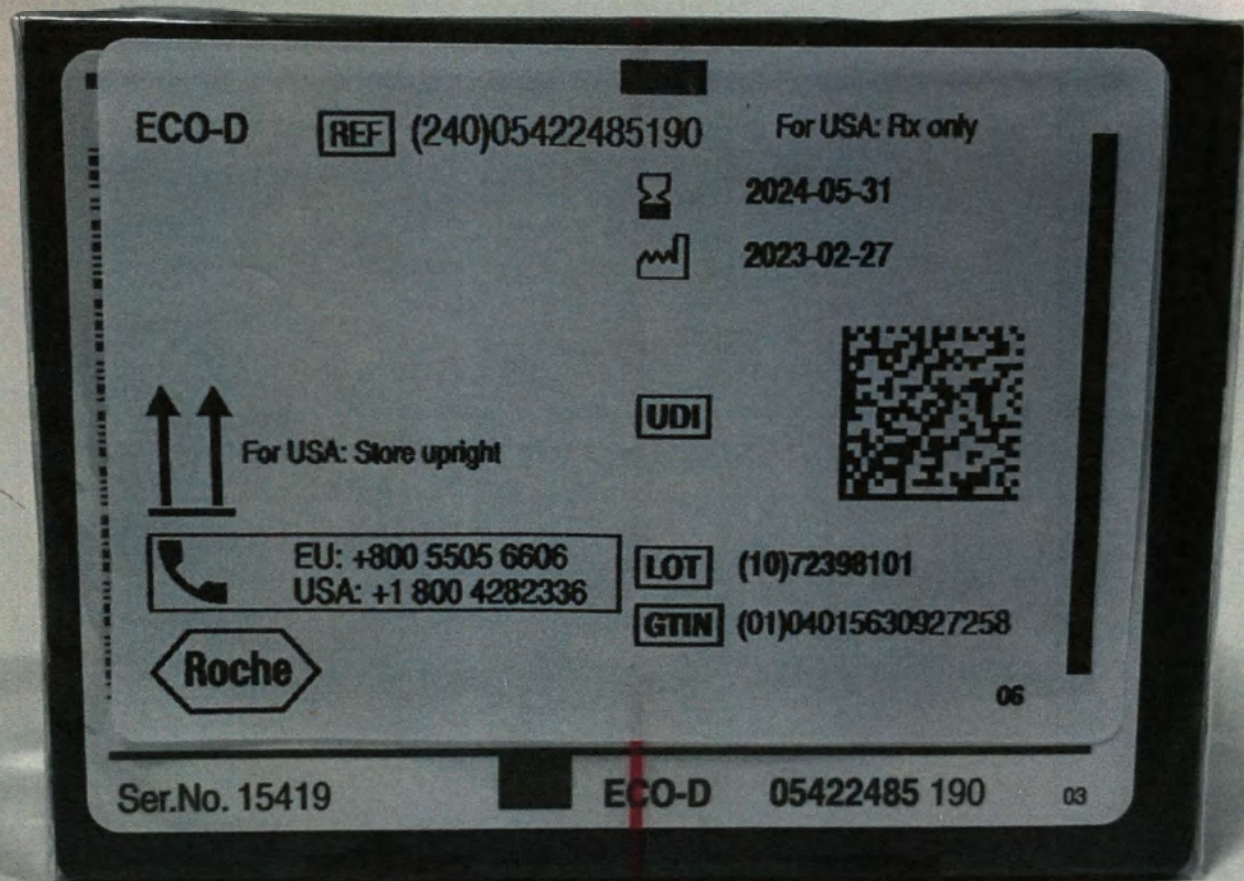

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c 311 system), вариант исполнения 60 мл

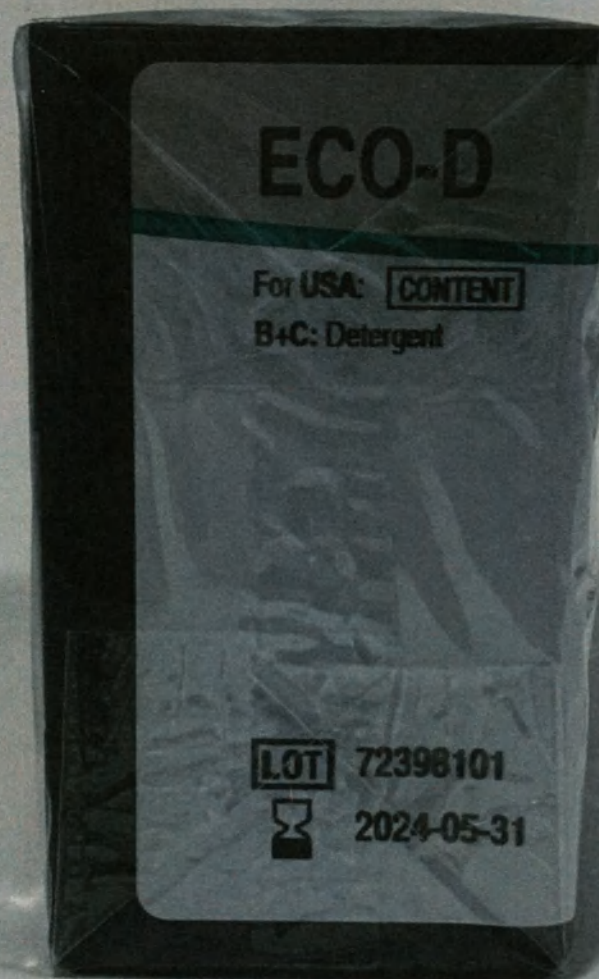


Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c 311 system), вариант исполнения 60 мл

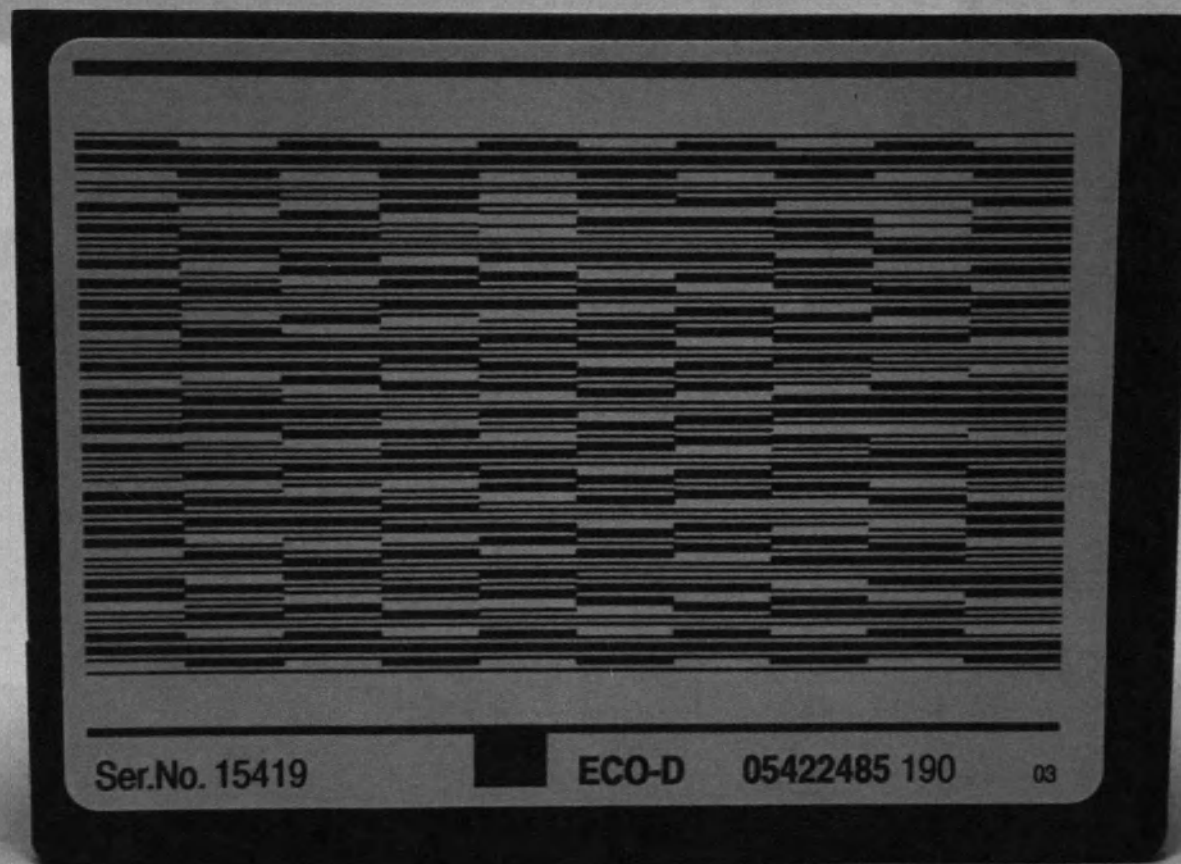

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c 311 system), вариант исполнения 60 мл (маркировка на русском языке)

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на анализаторах cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c 311 system), вариант исполнения 60 мл
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15562 от _____
Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия
Изделие предназначено только для диагностики *In vitro*
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com
Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).
Кат. номер 05422485190

Реагент во флаконах для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas с (ECO-D/Roche/Hitachi cobas с 501/502/Self-Contained ISE Support Box), вариант исполнения 12 x 59 мл

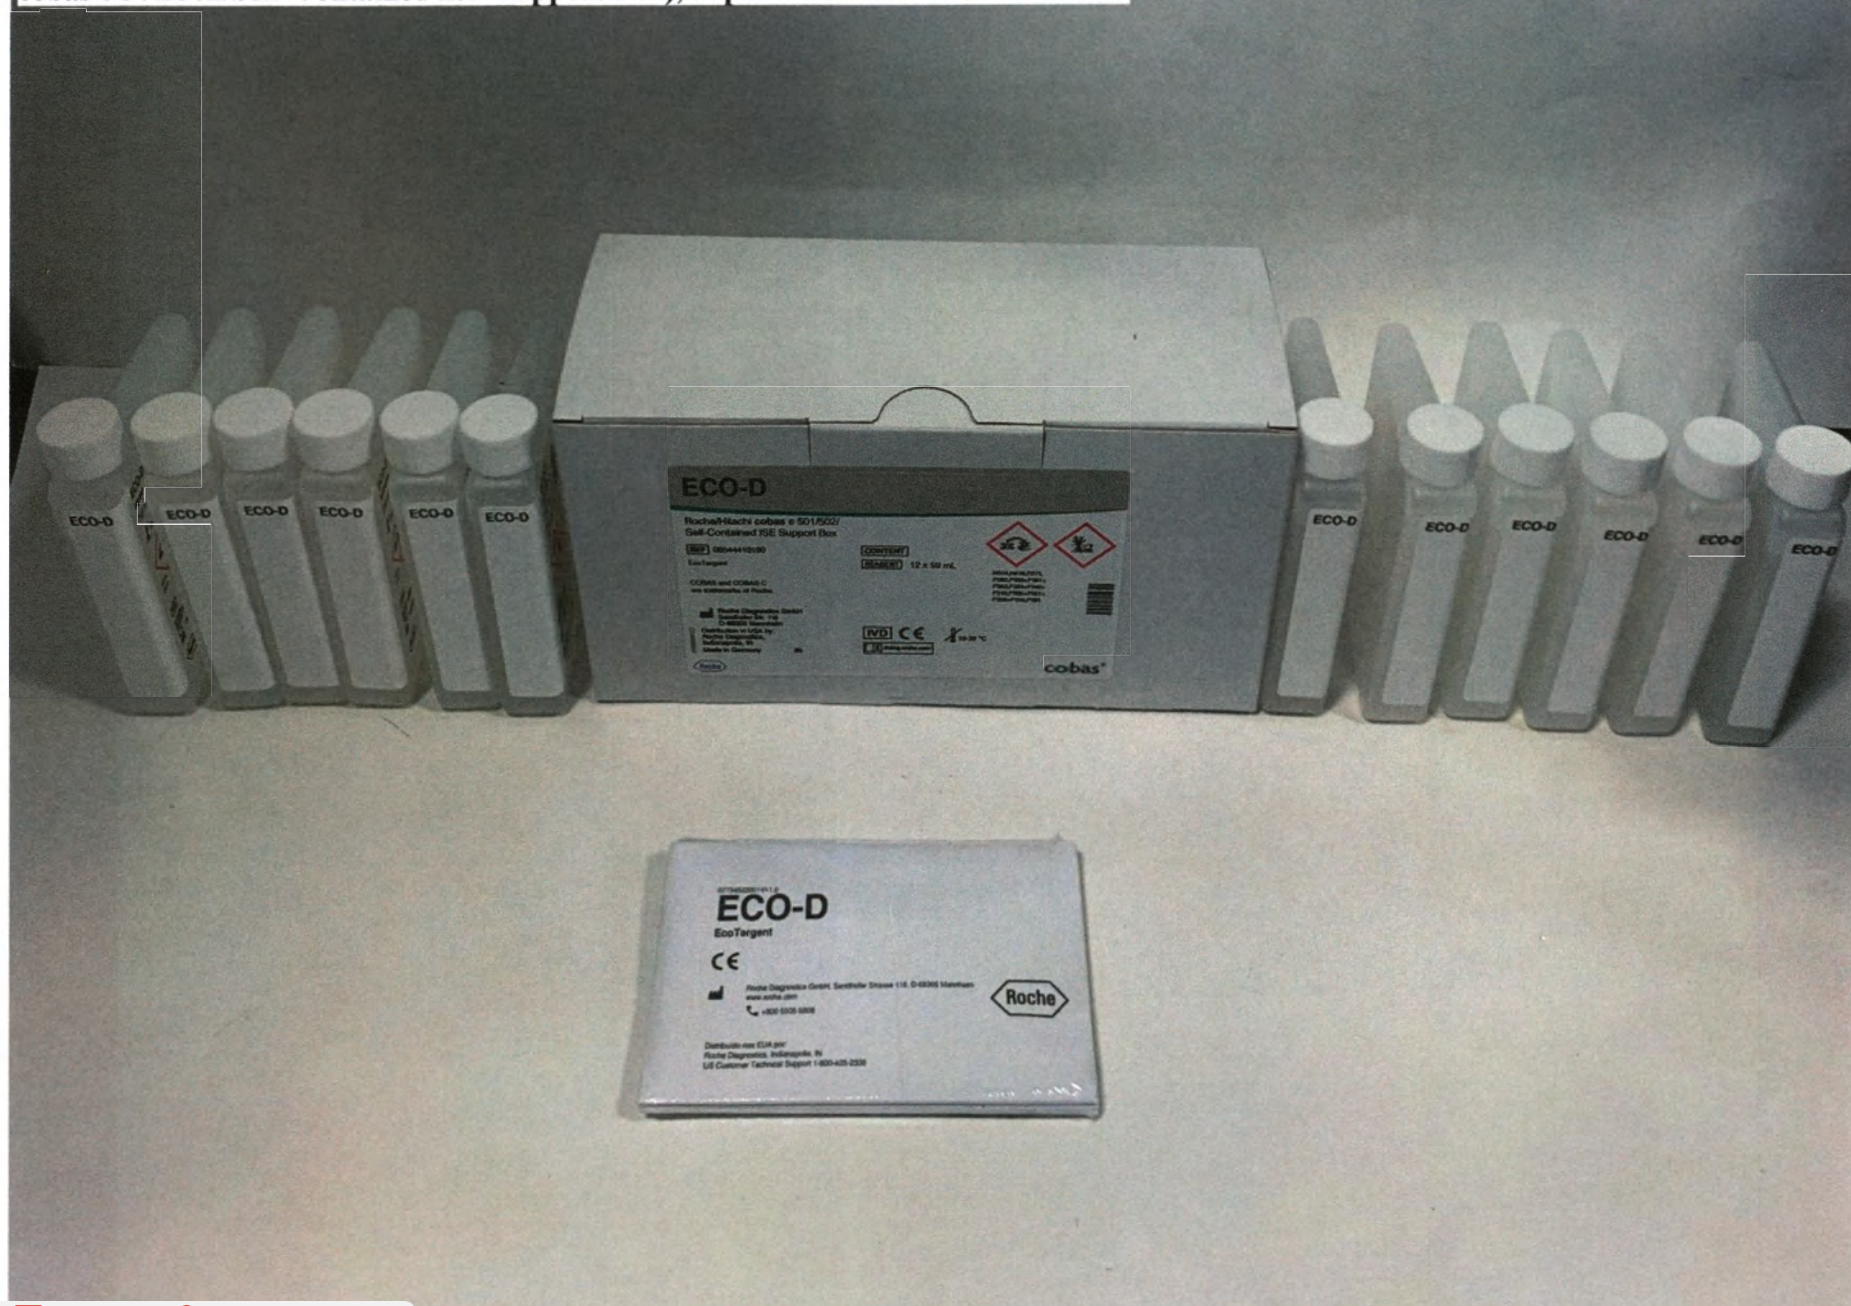

Реагент во флаконах для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/Roche/Hitachi cobas c 501/502/Self-Contained ISE Support Box), вариант исполнения 12 x 59 мл

ECO-D

Roche/Hitachi cobas c 501/502/
Self-Contained ISE Support Box

REF 06544410190

EcoTergent

COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

072026567 (1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

05

CONTENT

REAGENT 12 x 59 mL



H314, H410, P273,
P280, P303+P361+
P353, P304+P340+
P310, P305+P351+
P338+P310, P381



IVD

CE

15-25 °C

 diagnostics.roche.com



cobas[®]

Реагент во флаконах для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/Roche/Hitachi cobas c 501/502/Self-Contained ISE Support Box), вариант исполнения 12 x 59 мл

ECO-D

REF (240)06544410190

UDI



LOT (10)72890901



2024-05-31



2023-03-29

GTIN (01)04015630932306

05



Реагент во флаконах для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/Roche/Hitachi cobas c 501/502/Self-Contained ISE Support Box), вариант исполнения 12 x 59 мл

ECO-D

06544410

59 mL

15-25 °C



H314,
H410



1122

IVD

72880001



2024-05-31



Реагент во флаконах для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/Roche/Hitachi cobas c 501/502/Self-Contained ISE Support Box), вариант исполнения 12 x 59 мл



Реагент во флаконах для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/Roche/Hitachi cobas c 501/502/Self-Contained ISE Support Box), вариант исполнения 12 x 59 мл (маркировка на русском языке)

Реагент во флаконах для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/Roche/Hitachi cobas c 501/502/Self-Contained ISE Support Box), вариант исполнения 12 x 59 мл

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15562 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия


Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com


Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 06544410190

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c systems), вариант исполнения 96 мл

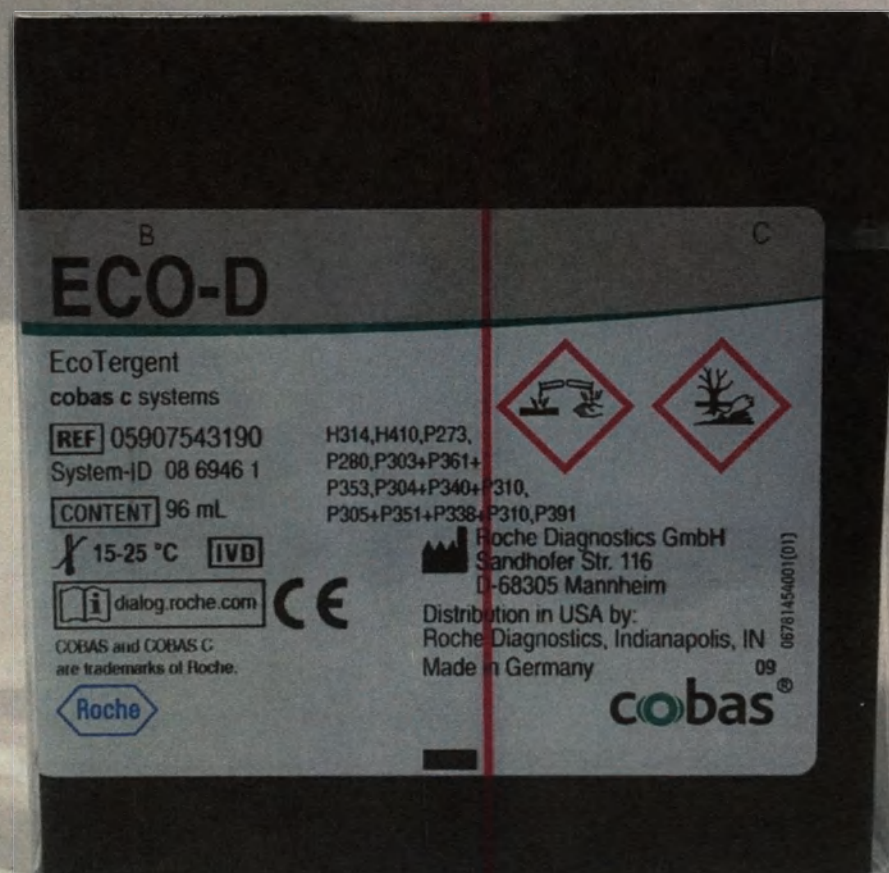

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c systems), вариант исполнения 96 мл

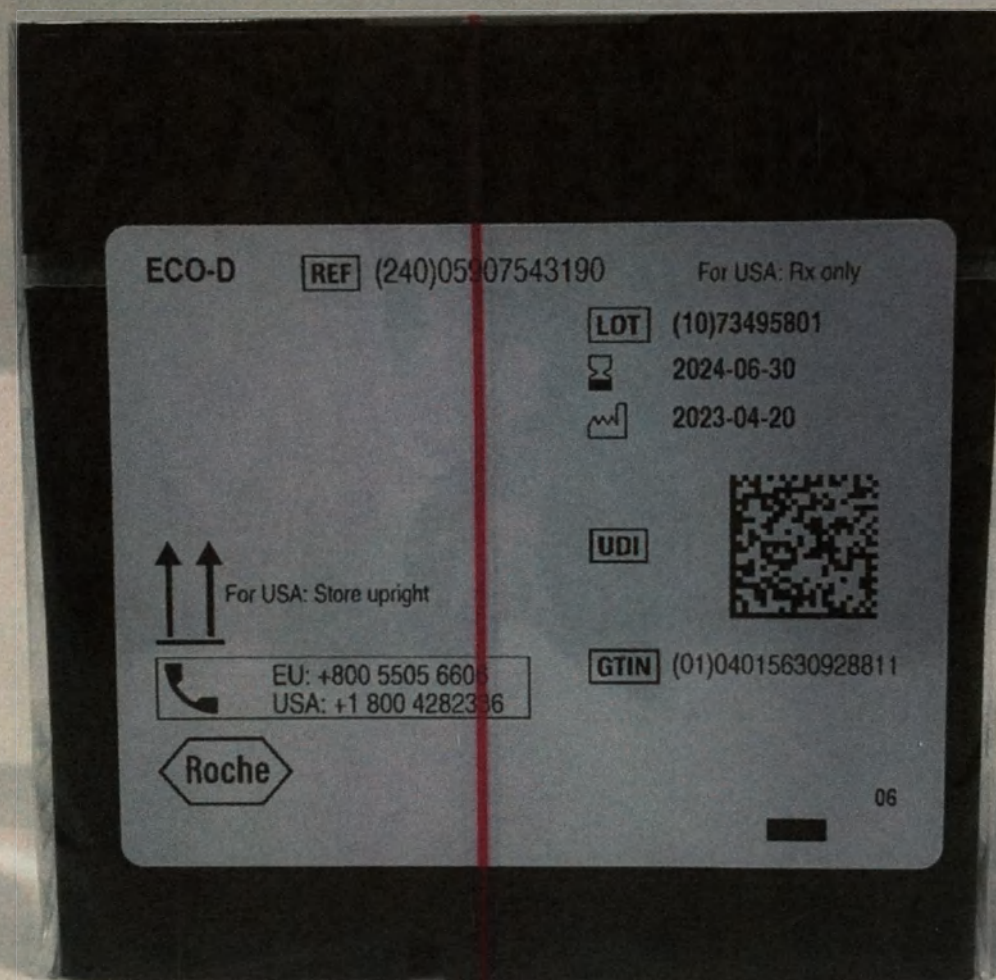

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas с (ECO-D/EcoTergent cobas c systems), вариант исполнения 96 мл



Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas с (ECO-D/EcoTergent cobas с systems), вариант исполнения 96 мл (маркировка на русском языке)

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas с (ECO-D/EcoTergent cobas с systems), вариант исполнения 96 мл
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15562 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com


Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 05907543190 (05907543214)

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c systems), вариант исполнения 40 мл



Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c systems), вариант исполнения 96 мл

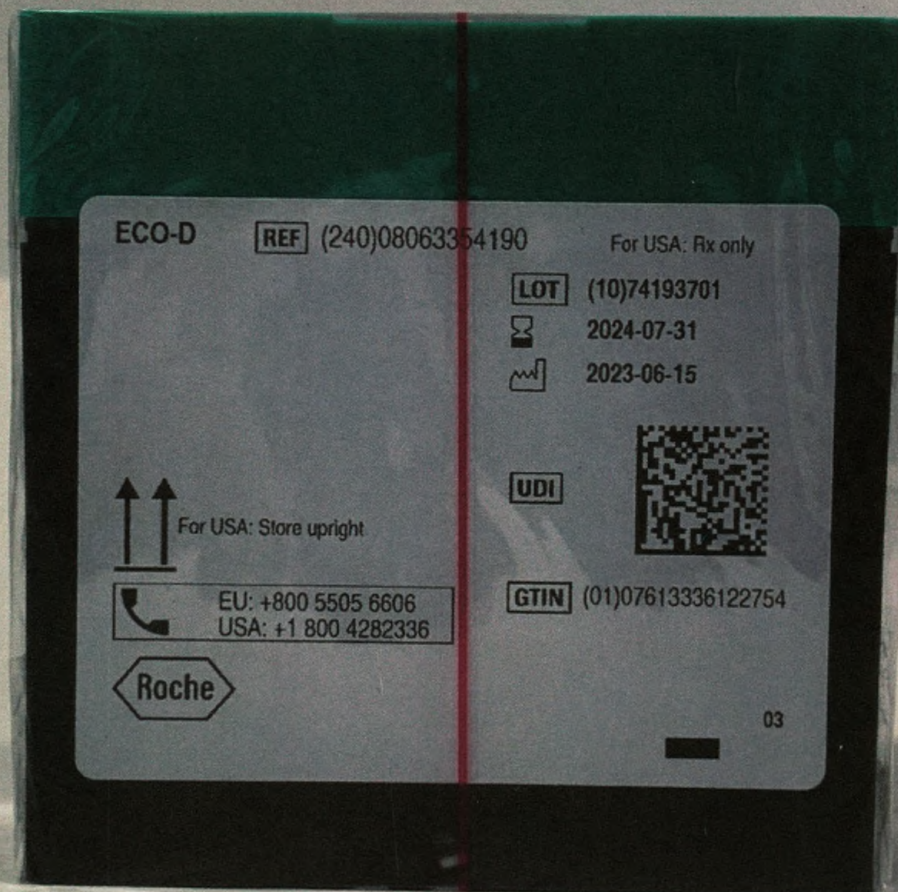

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c systems), вариант исполнения 96 мл



Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c systems), вариант исполнения 96 мл (маркировка на русском языке)

Реагент в кассете для снижения поверхностного натяжения в инкубационной бане на модулях cobas c (ECO-D/EcoTergent cobas c systems), вариант исполнения 40 мл
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/15562 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 08063354190 (08063354214)

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)

20



Свертываю № от 4.