

Фотографические изображения

Реагенты в кассете МРХ для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® МРХ), в вариантах исполнения на 96/480 тестов

2023




Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 96 тестов

cobas® MPX

REF

P/N: 06997708190

*Multiplex HIV, HCV & HBV nucleic acid test
for use on the cobas® 6800/8800 Systems*




IVD

cobas®

Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 96 тестов, (общий вид)



Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 96 тестов (макет маркировки картонной упаковки)

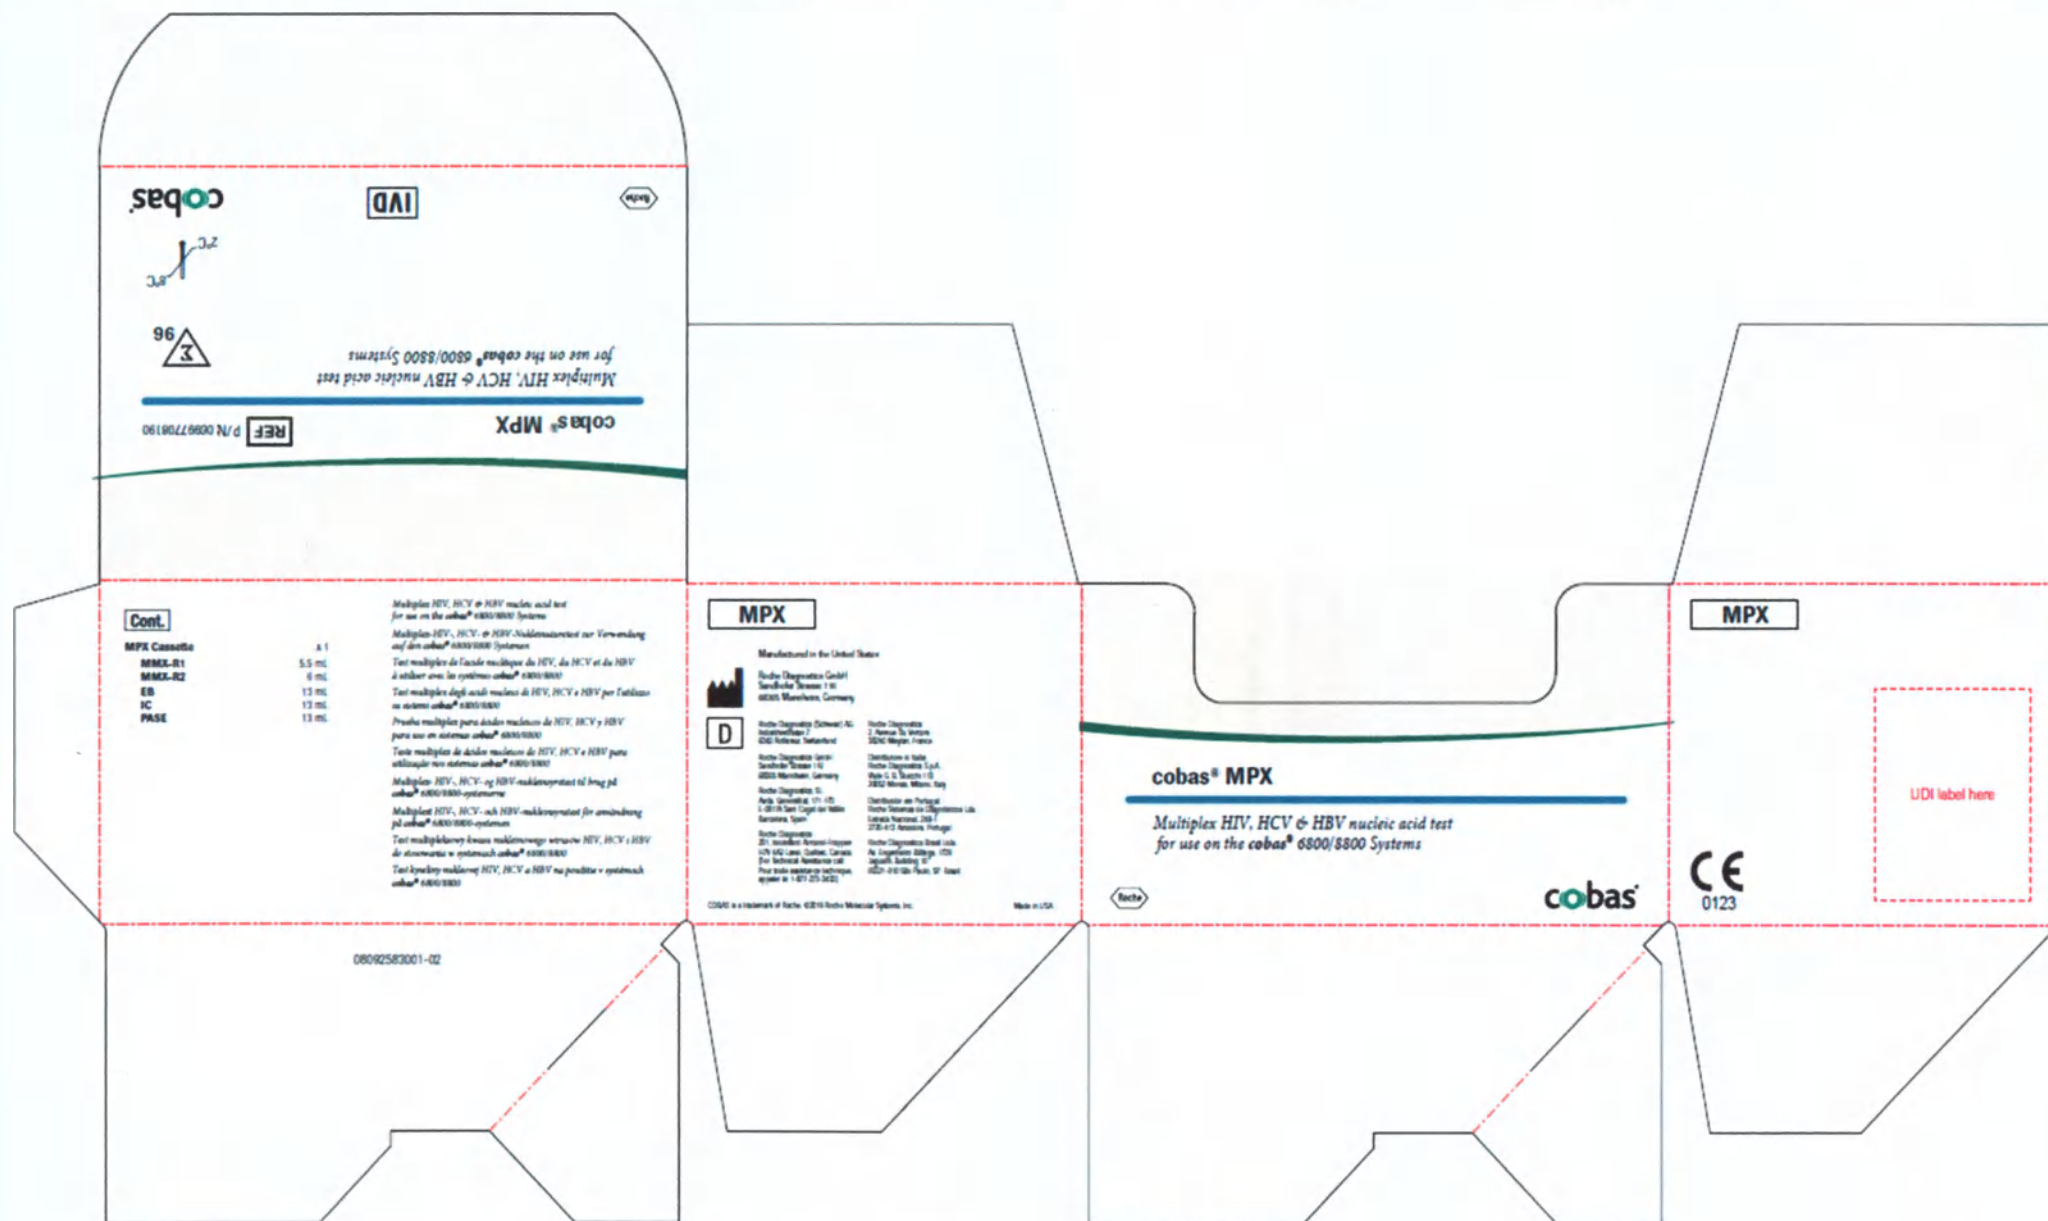


Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 96 тестов (маркировка картонной упаковки)

REF (240) 06997708190
GTIN (01) 00875197004618
UDI
05
LOT (10) Z12345
2038-01-31
2030-01-31



Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 96 тестов (макет маркировки кассеты с реагентами)

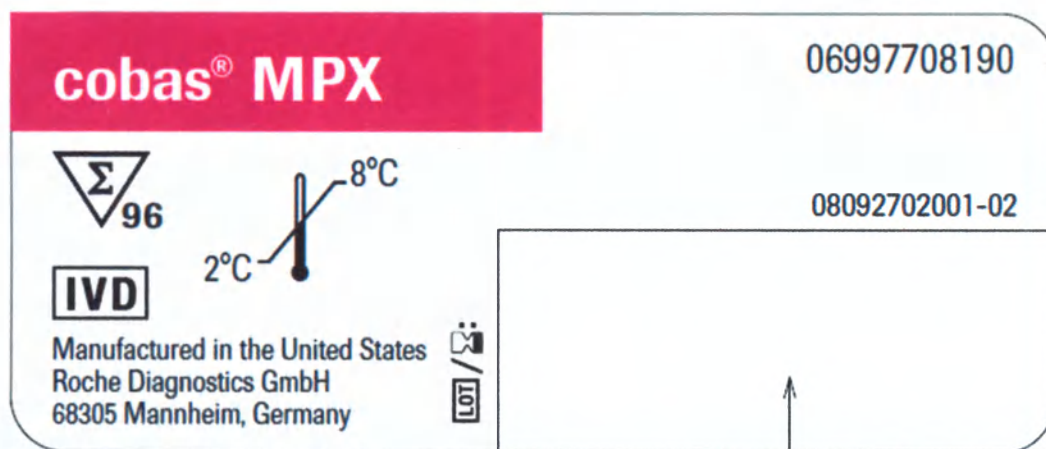



Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 96 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8926 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Molecular Systems, Inc» («Рош Молекуляр Системс, Инк.»), 1080 US Highway 202 South, Branchburg, New Jersey 08876, USA


Изделие предназначено только для диагностики in vitro.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер: 06997708190


Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 480 тестов

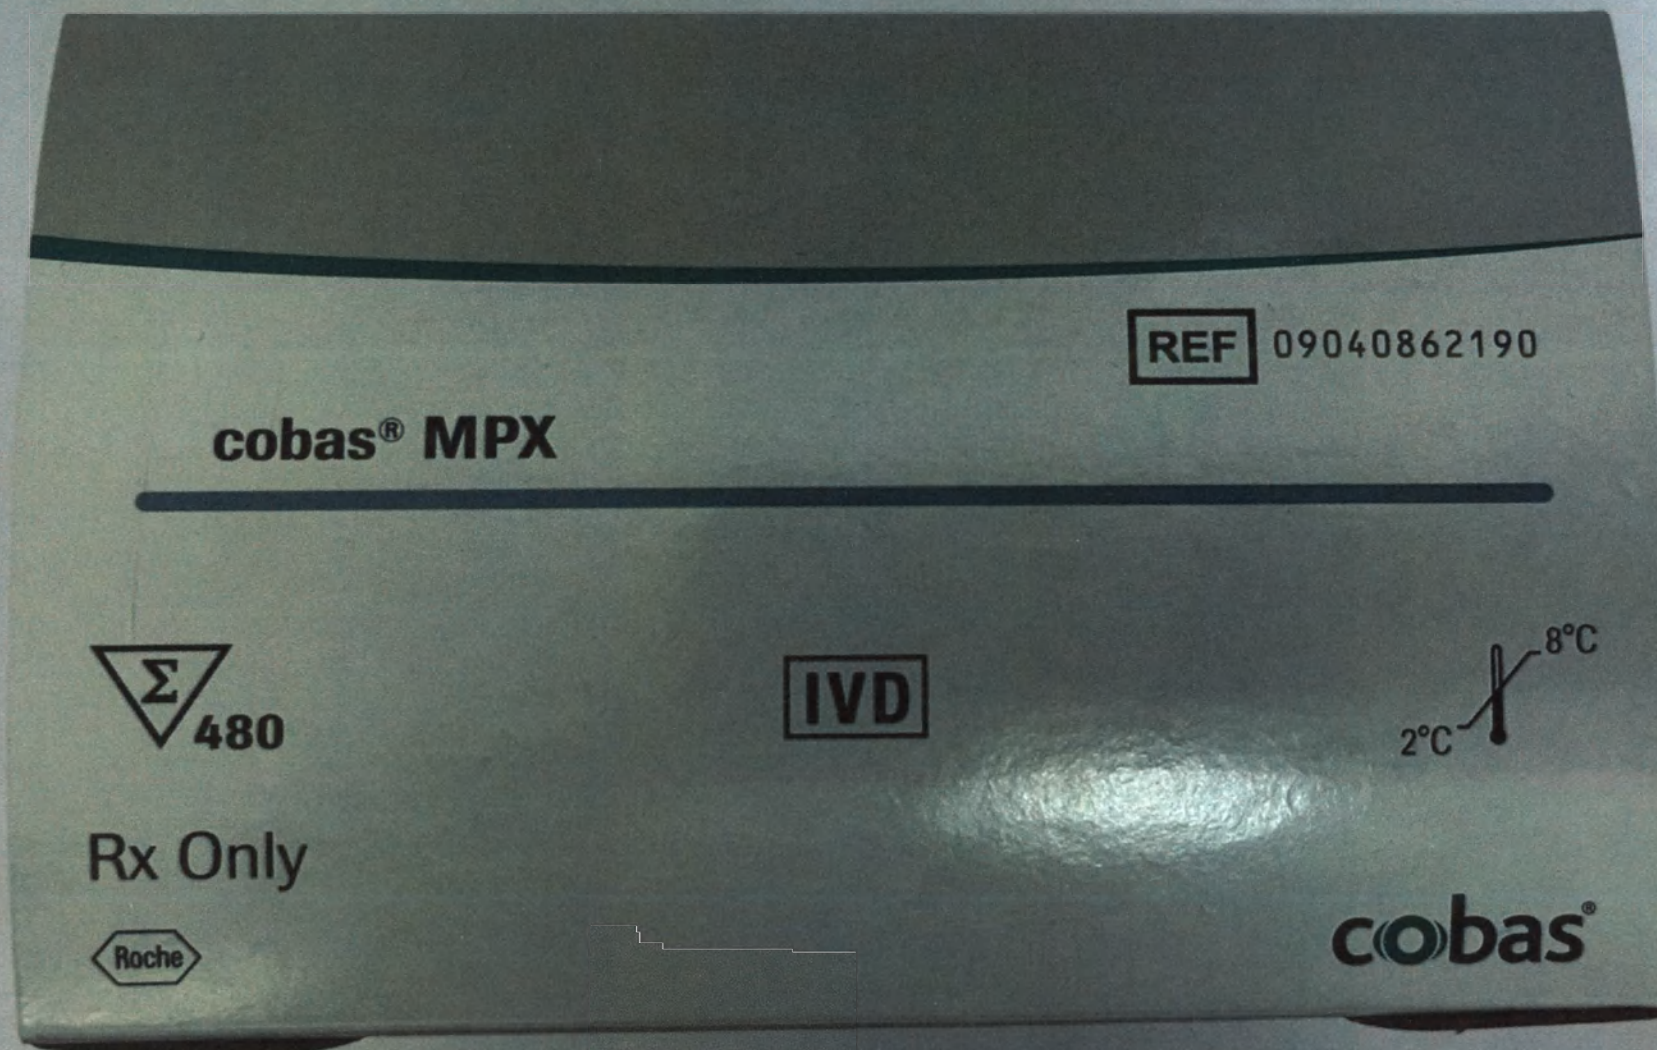

Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 480 тестов, (общий вид)

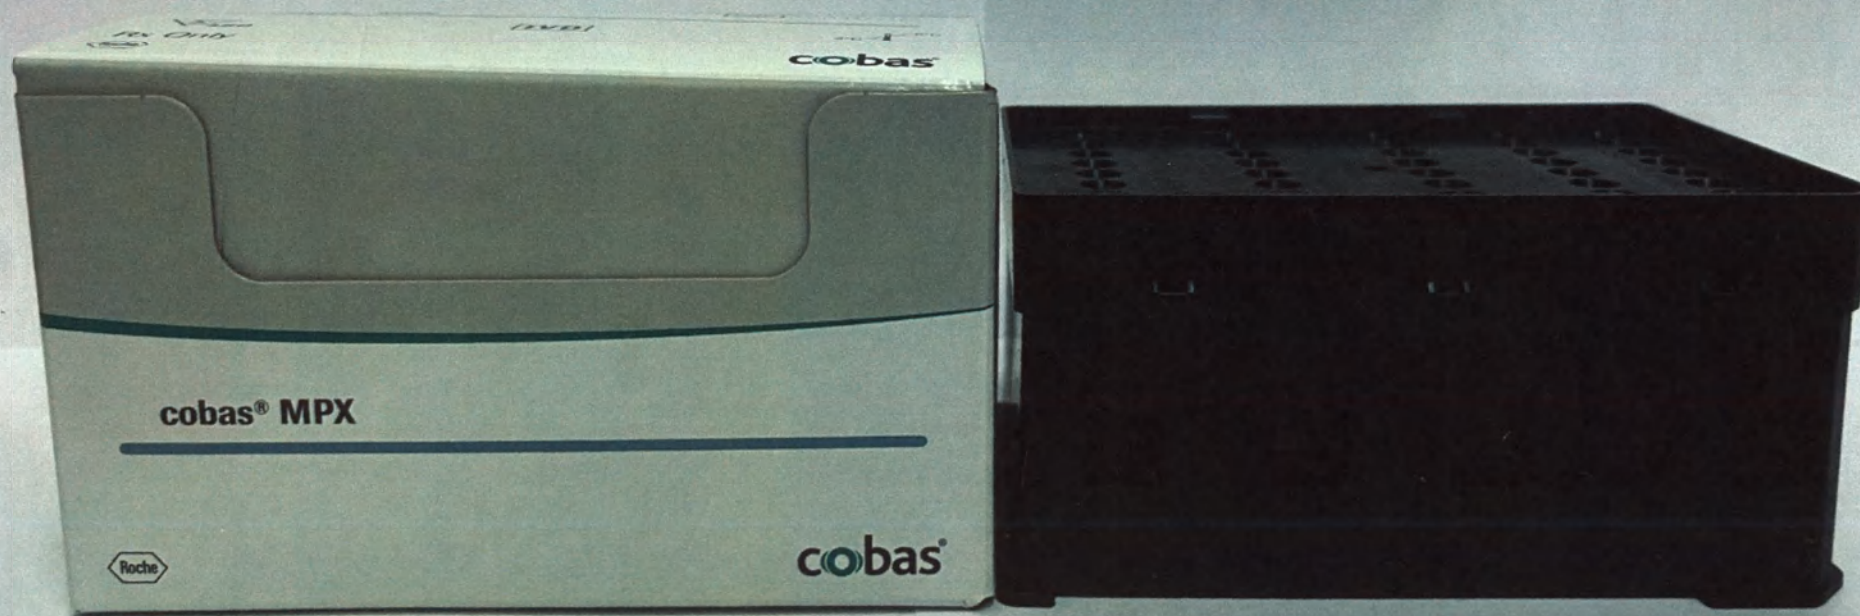

Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 480 тестов, (макет маркировки картонной упаковки)

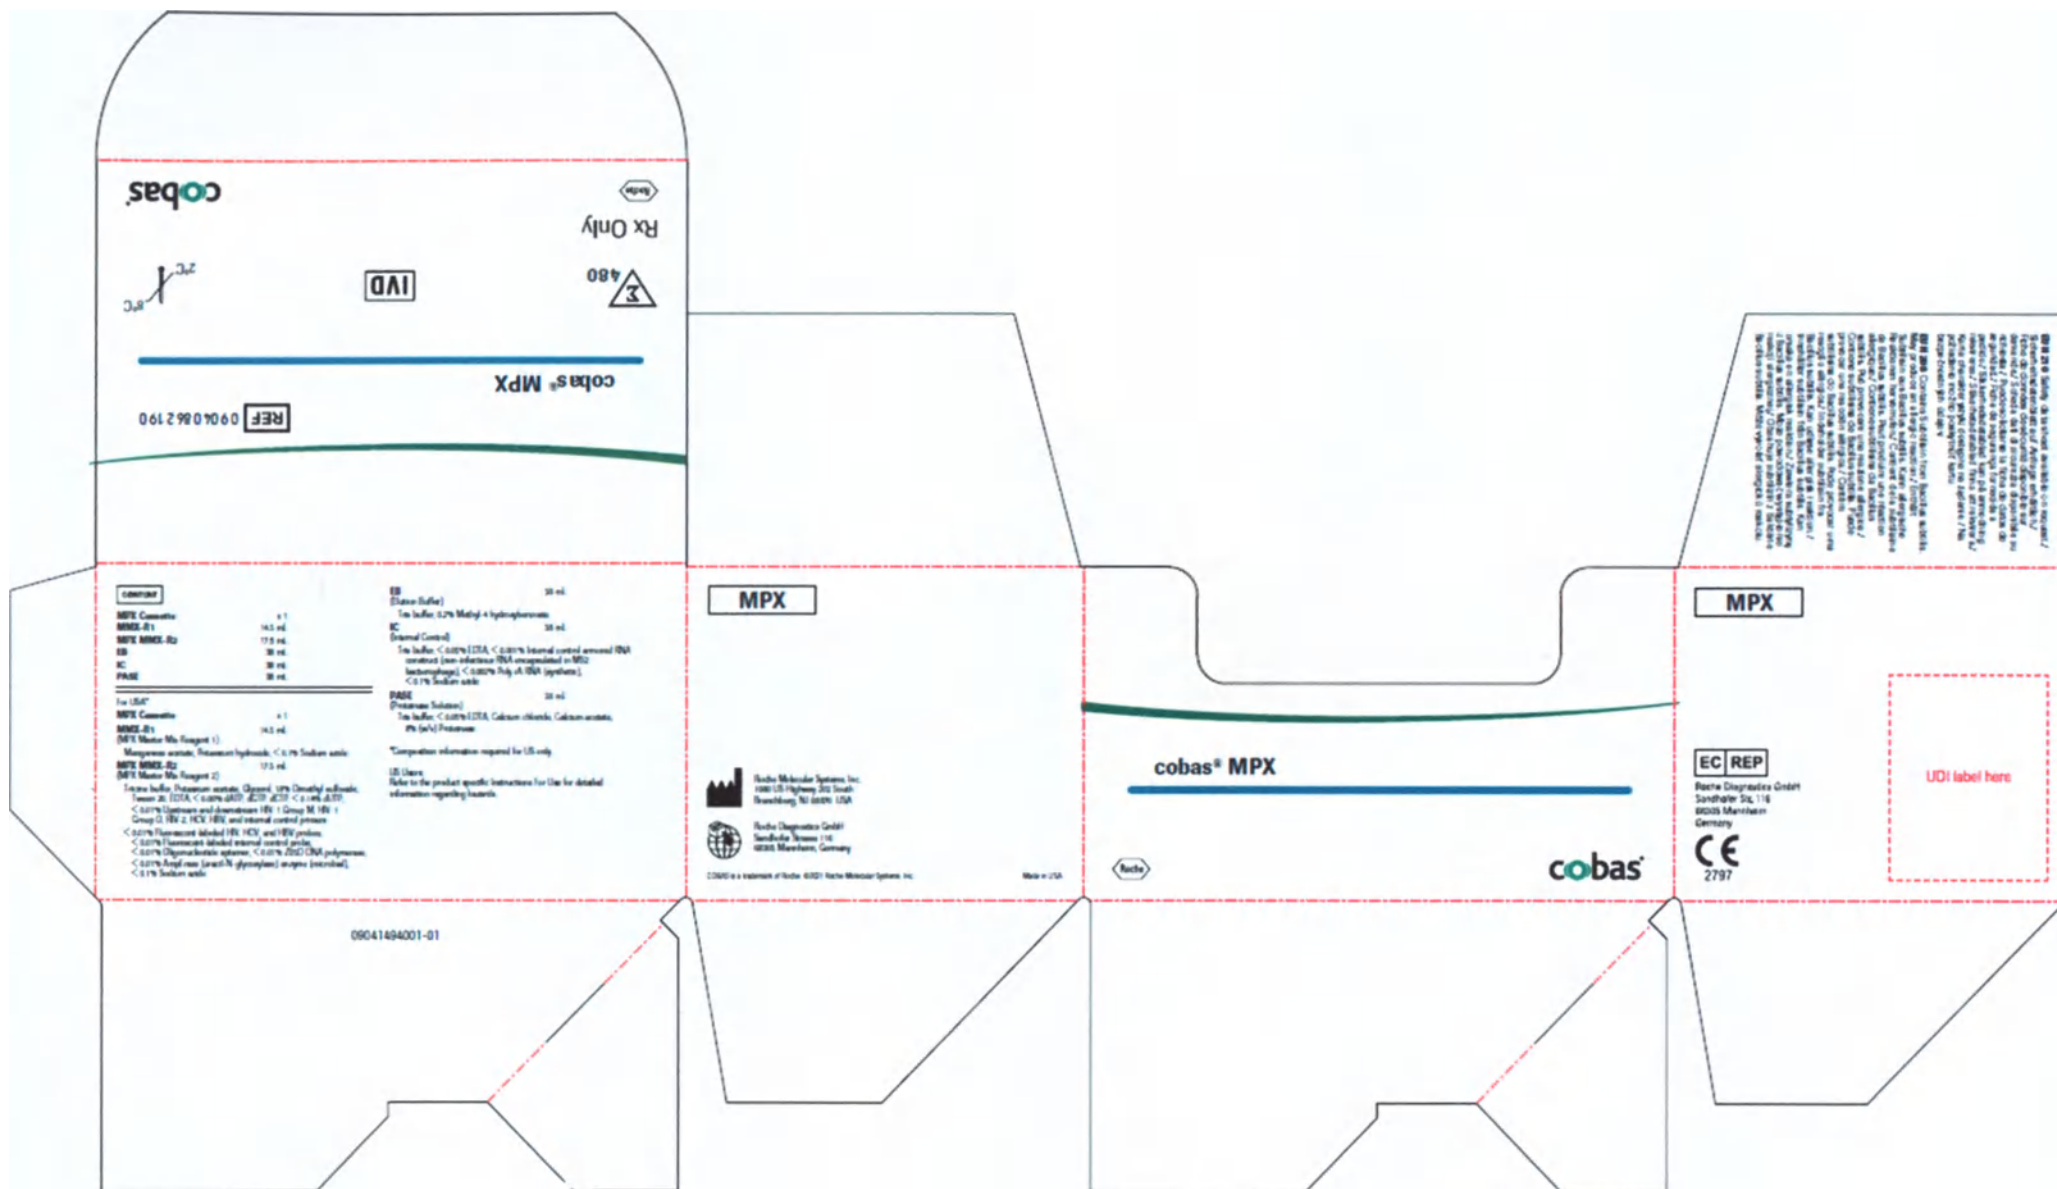

Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 96 тестов (маркировка картонной упаковки)

REF (240)09040862190

GTIN (01)00875197006452

UDI




LOT (10) Z1234567

2038-01-31

2030-01-31 01

Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 96 тестов (макет маркировки кассеты с реагентами)

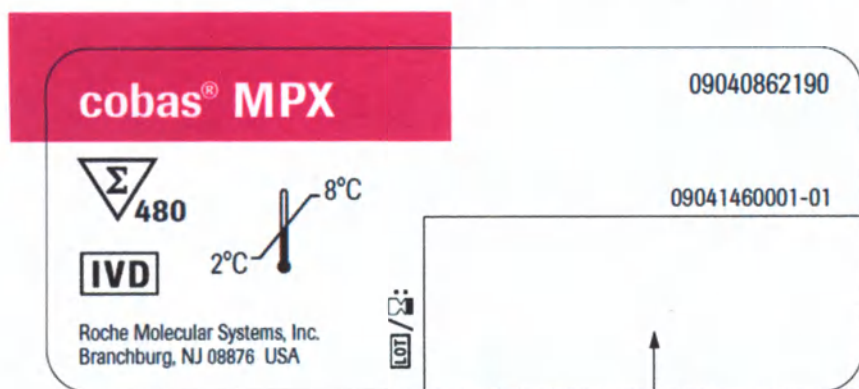

Макет маркировки на русском языке реагентов cobas® MPX, 480 тестов



Реагенты в кассете MPX для обнаружения нуклеиновых кислот ВИЧ, вируса гепатита В и вируса гепатита С в плазме и сыворотке крови человека на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® MPX), 480 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8926 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

**Производитель: «Roche Molecular Systems, Inc» («Рош Молекуляр Системс, Инк.»),
1080 US Highway 202 South, Branchburg, New Jersey 08876, USA**

Изделие предназначено только для диагностики in vitro.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер: 09040862190



Генеральный директор *Гаширова А.В.*

по доверенности
от 30.01.2023 г.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
11 листа (ов)