

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» февраля 2024 г.


М.П.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, fPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022»


Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)

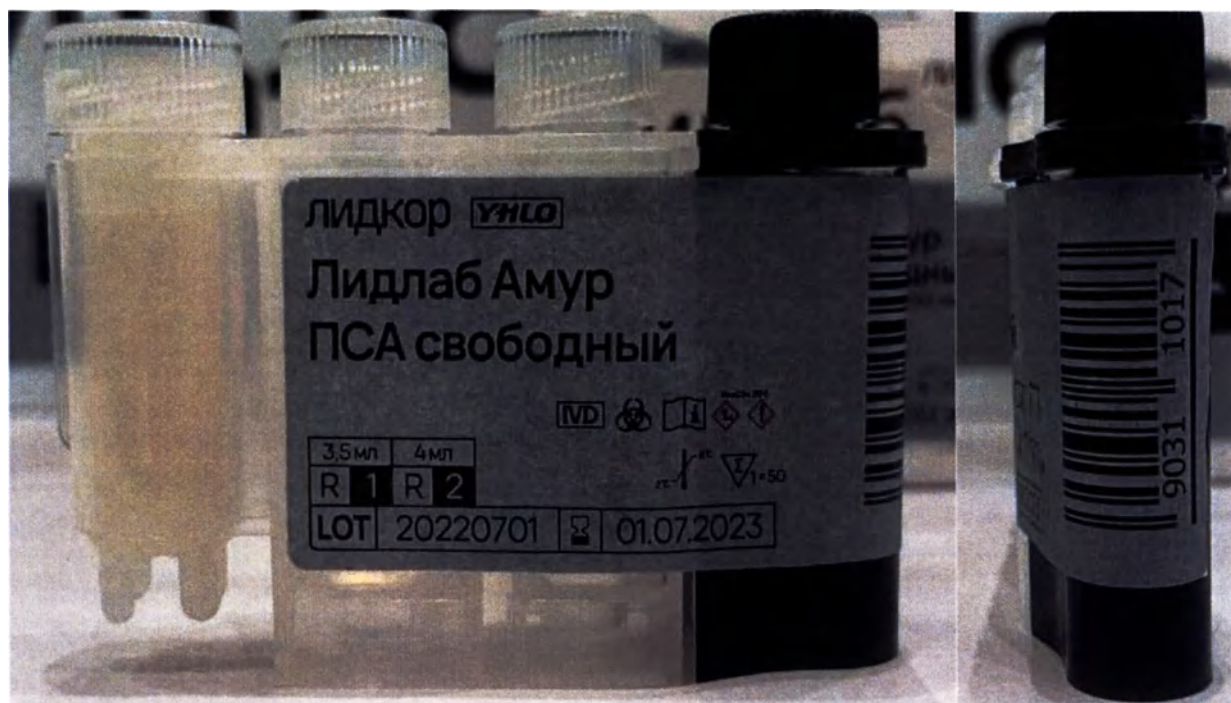

Пароизоляционные крышки




Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

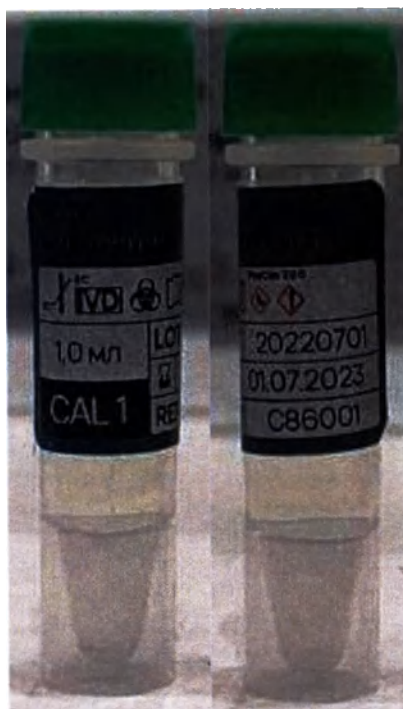

Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон



Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

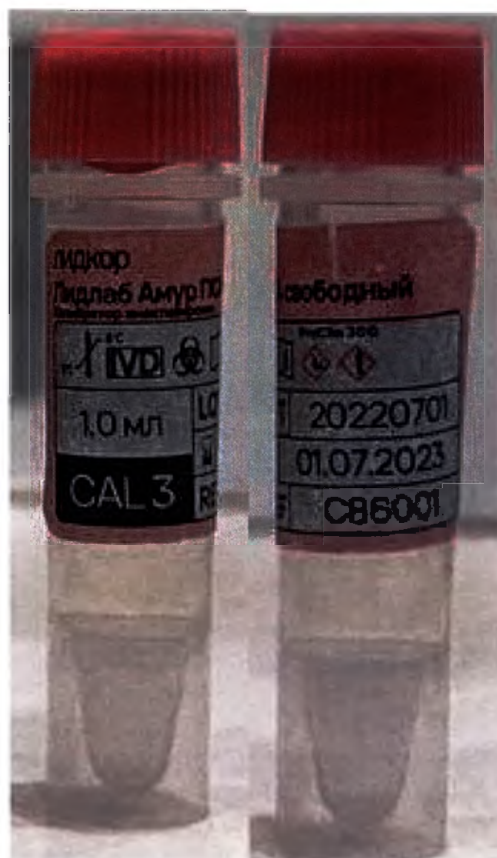

Потребительская упаковка



Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. б. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, fPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614683-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

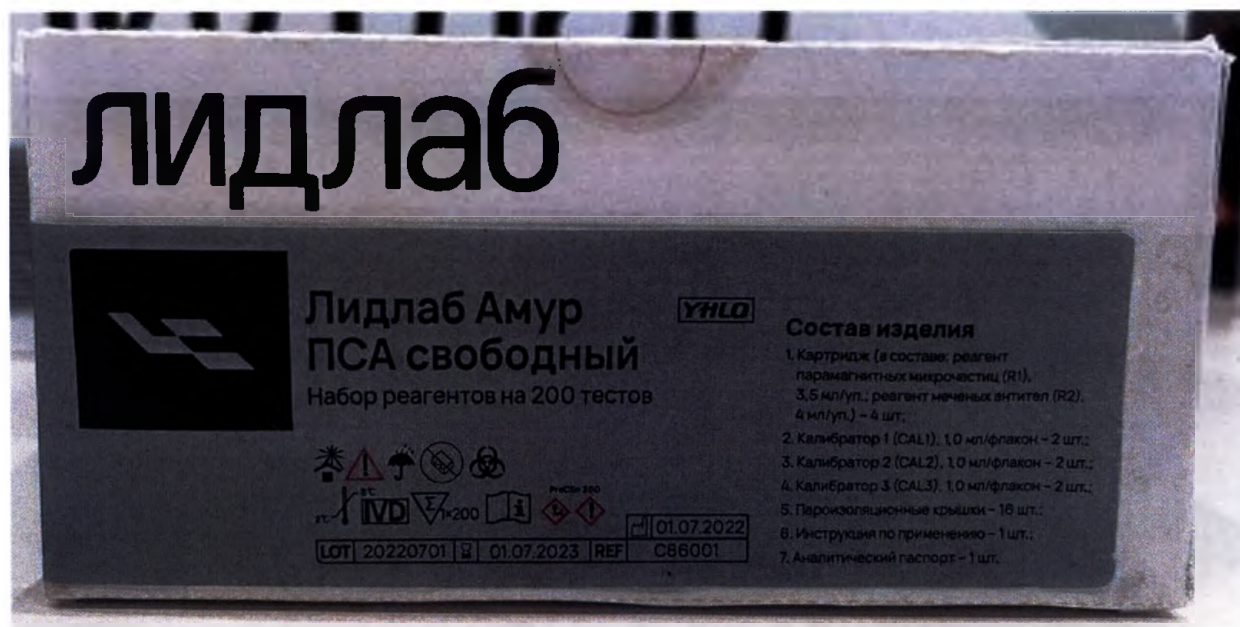


Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

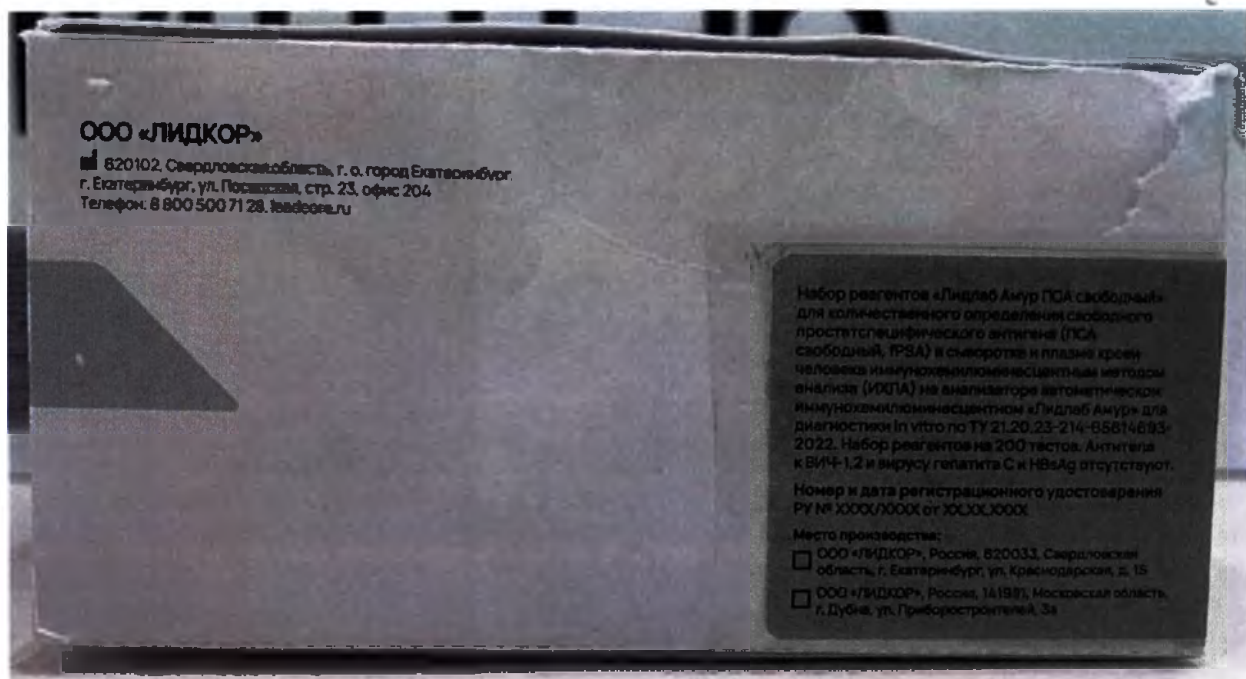


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)

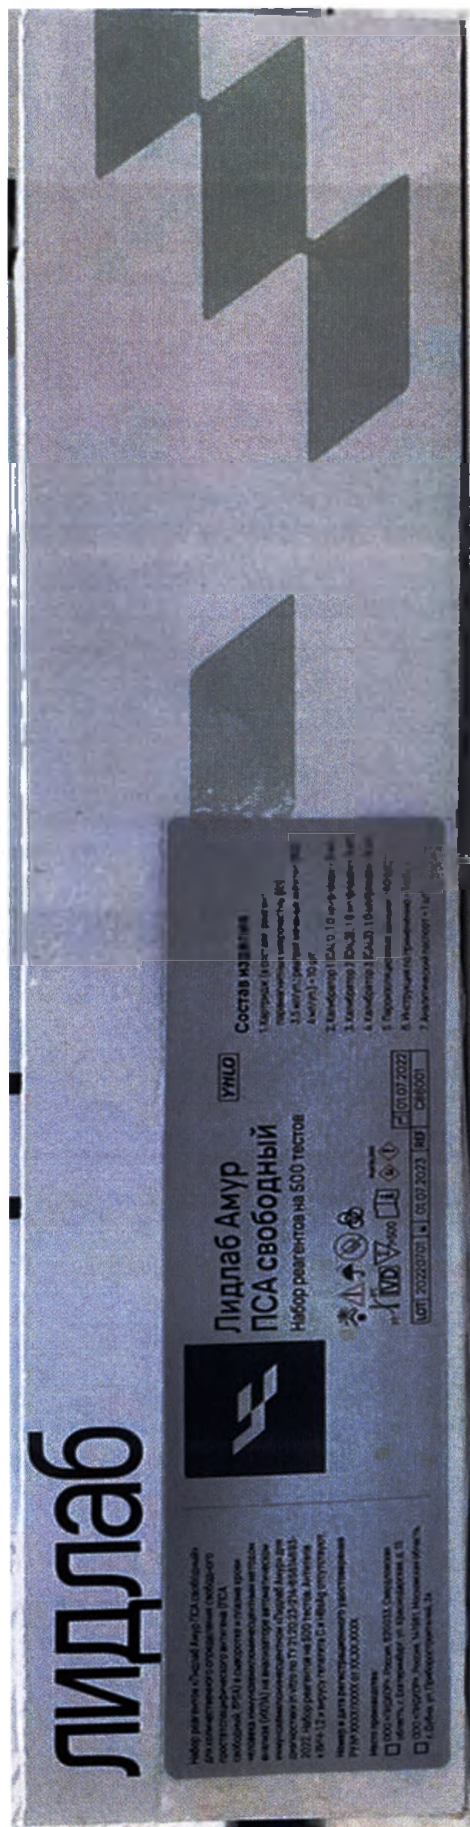

Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

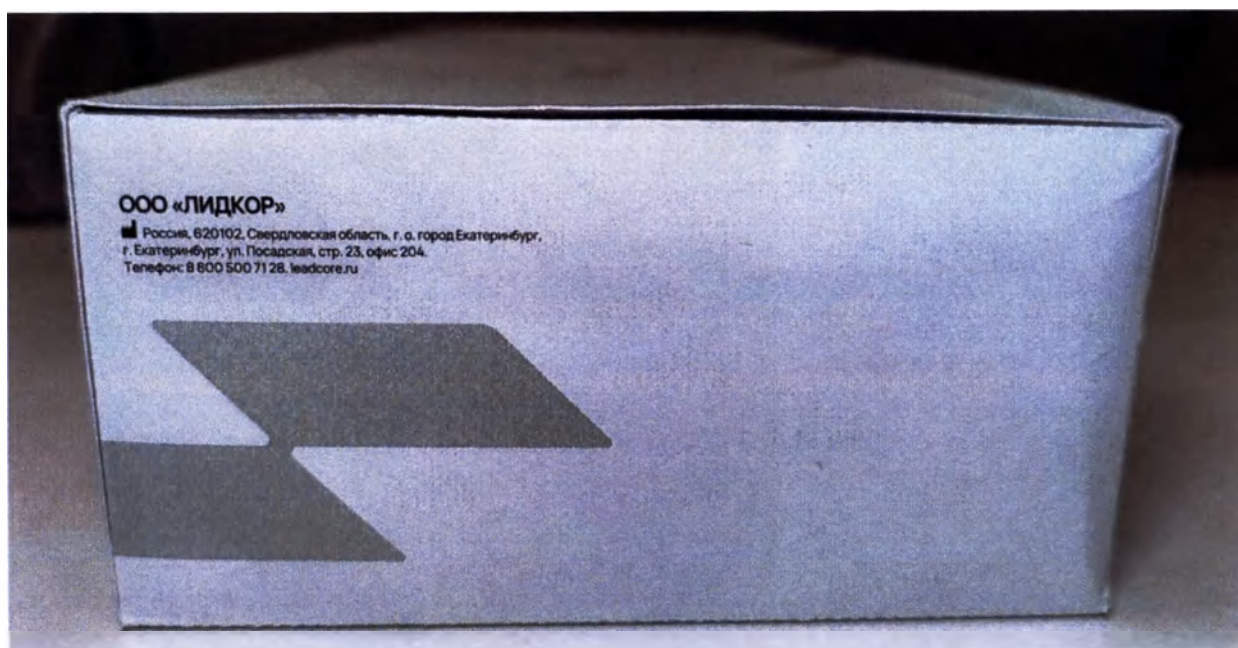

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)

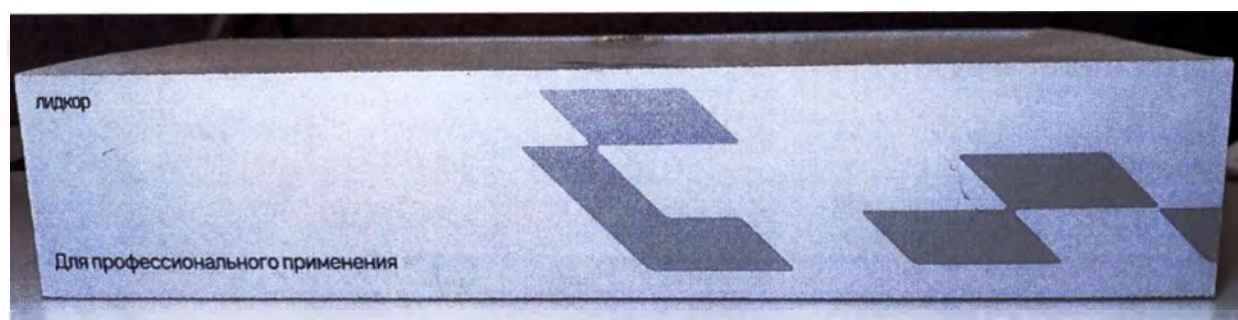

Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)






Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)

Групповое фото.



Транспортная упаковка

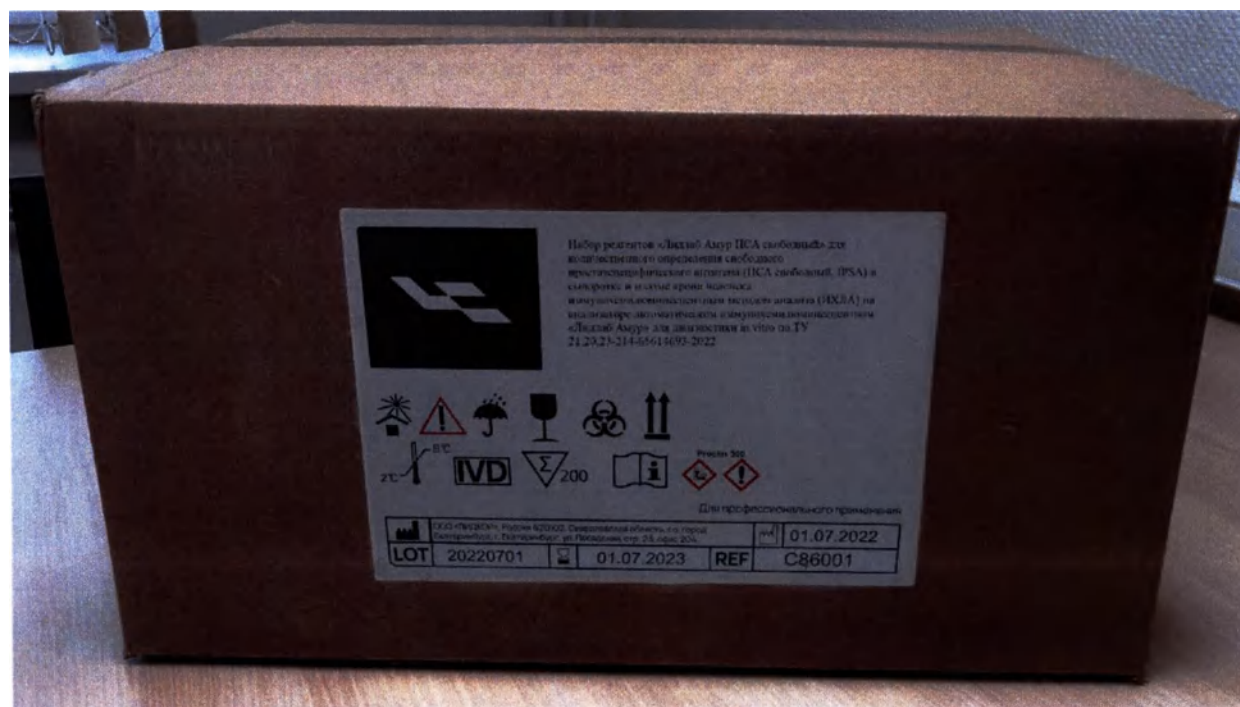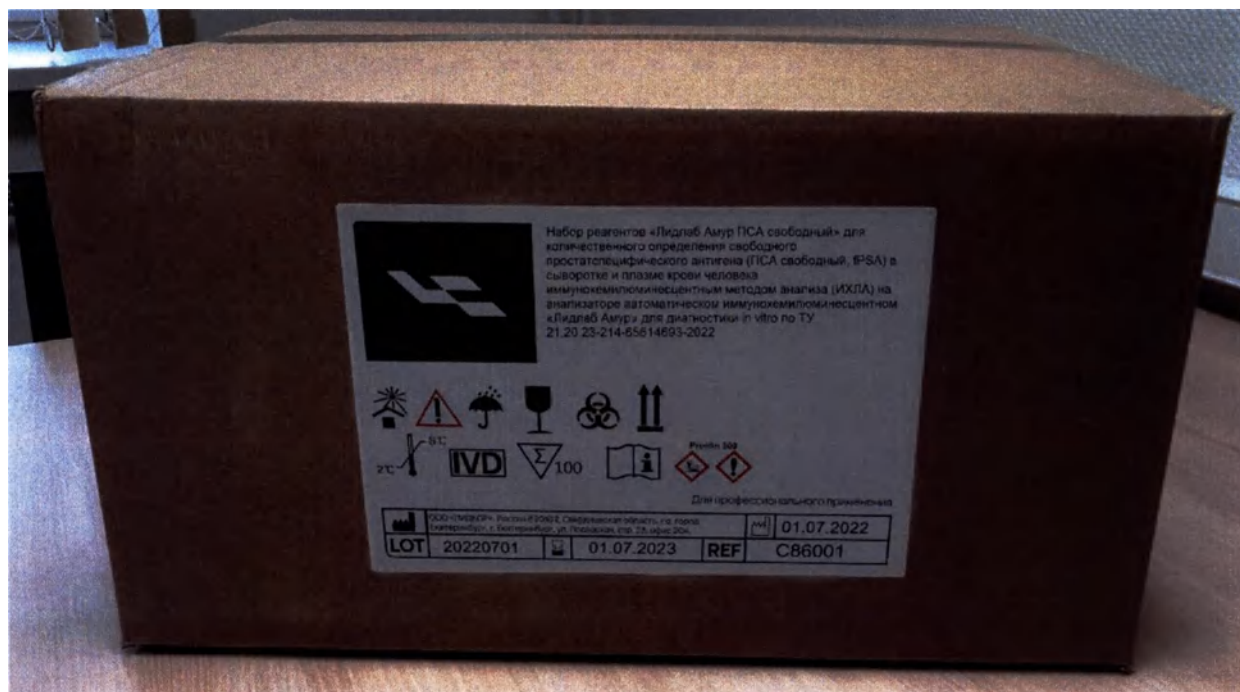

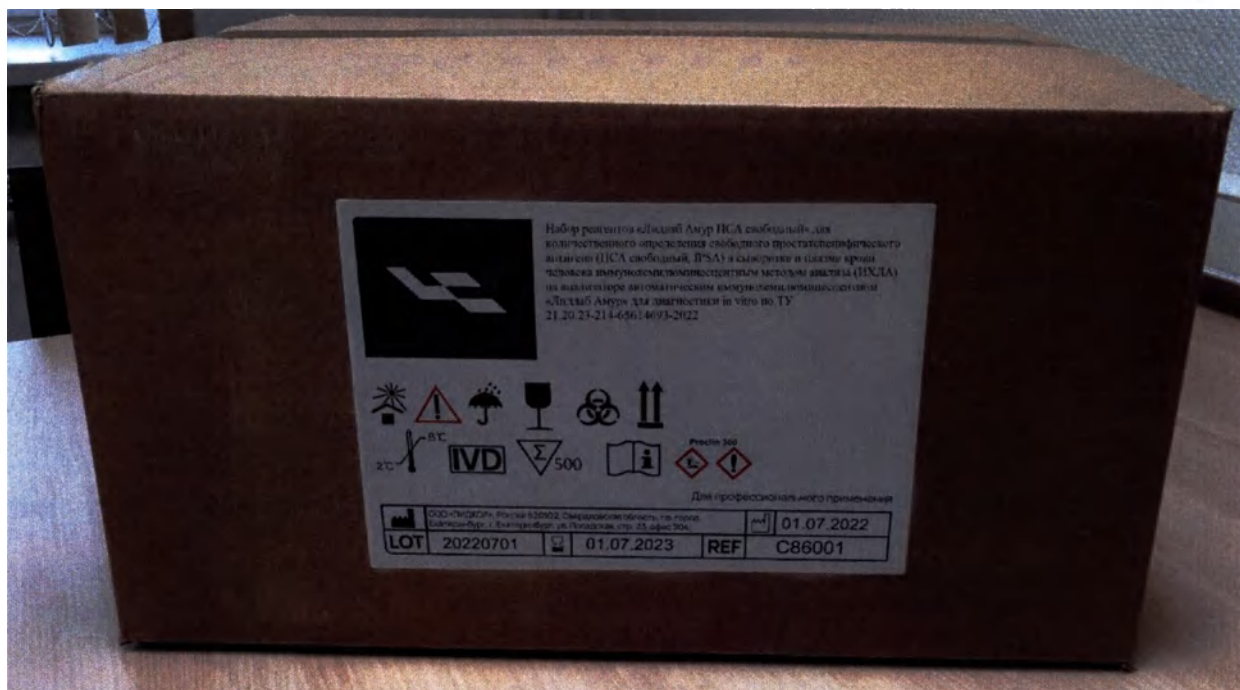

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

(подпись)

Директор

ООО «ЛИДКОР»

(подпись) /Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


«31» мая 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, fPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022»

Картридж (в составе: реагент парамагнитных частиц (R1), 3,5 мл/уп; реагент меченных антител (R2), 4,0 мл/уп.)

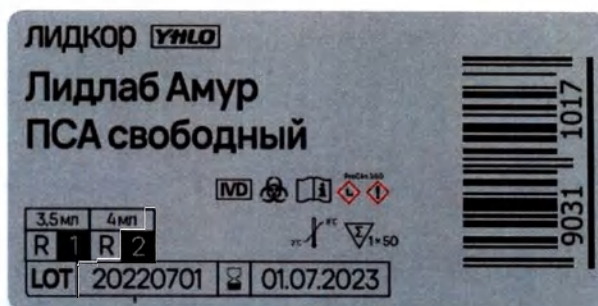

Калибратор 1 (CAL1)




Калибратор 2 (CAL2)



Калибратор 3 (CAL3)



Пароизоляционные крышки

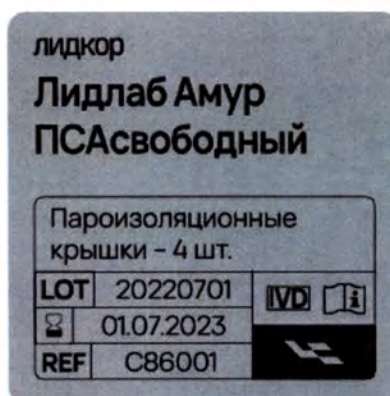

QR-code



Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, fPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВРЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ПСА свободный

Набор реагентов на 100 тестов



LOT 20220701 EXP 01.07.2023 REF C86001

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамagnetных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) - 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 1 шт.
5. Паронепроницаемые крышки - 8 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, fPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВРЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15

☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ПСА свободный

Набор реагентов на 200 тестов



LOT 20220701 EXP 01.07.2023 REF C86001

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамagnetных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) - 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон - 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон - 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон - 2 шт.
5. Паронепроницаемые крышки - 16 шт.
6. Инструкция по применению - 1 шт.
7. Аналитический паспорт - 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, (PSA)) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВМЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ПСА свободный

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



LOT 20220701 01.07.2023 REF C86001



01.07.2022

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамэгнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 10 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
5. Паронепроницаемые крышки – 40 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, (PSA)) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВМЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «Лидкор», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ПСА свободный

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT 20220701 01.07.2023 REF C86001




01.07.2022


Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамэгнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
5. Паронепроницаемые крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Потребительская коробка

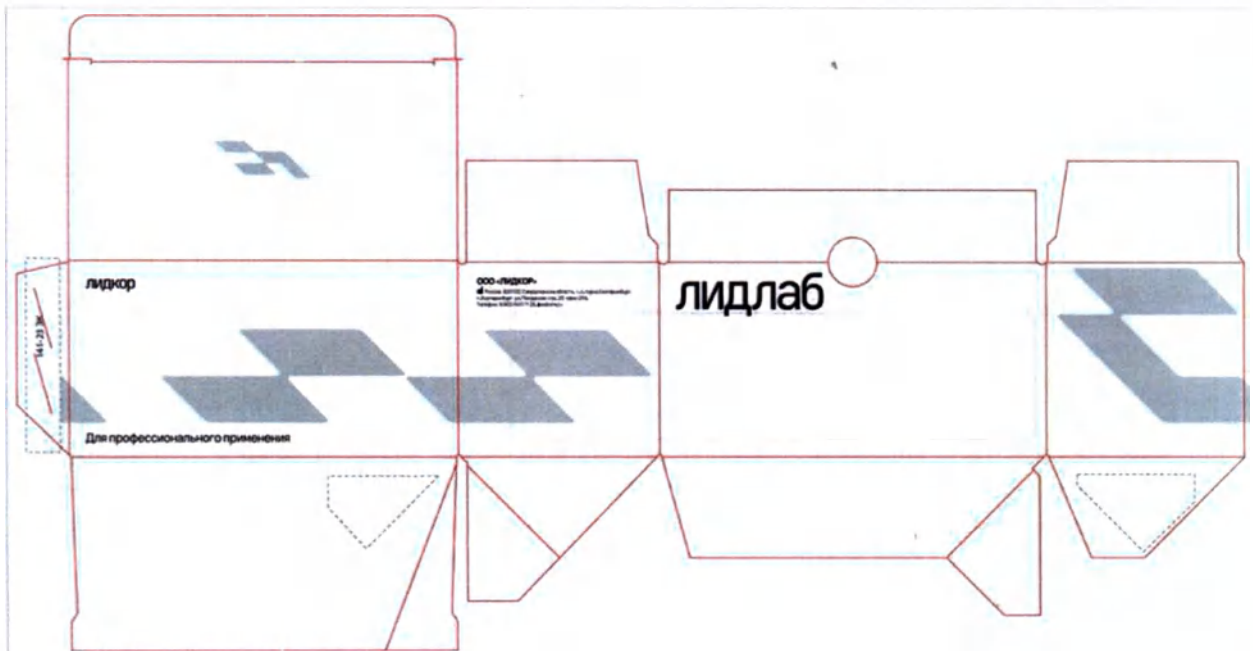

Транспортная упаковка

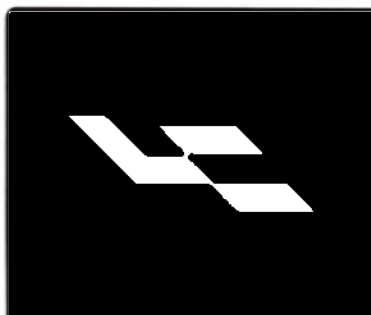

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86001	




Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022

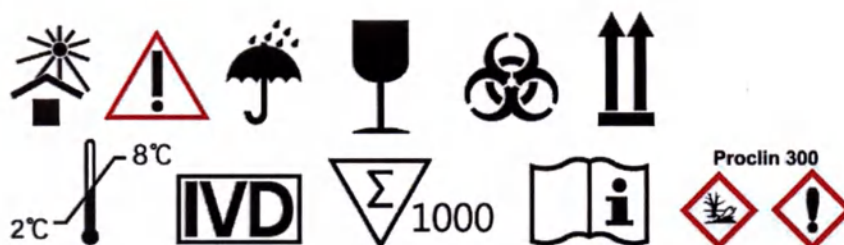


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.					XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86001	

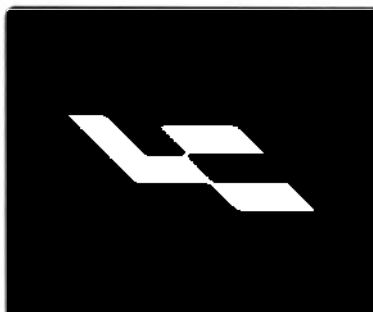

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022

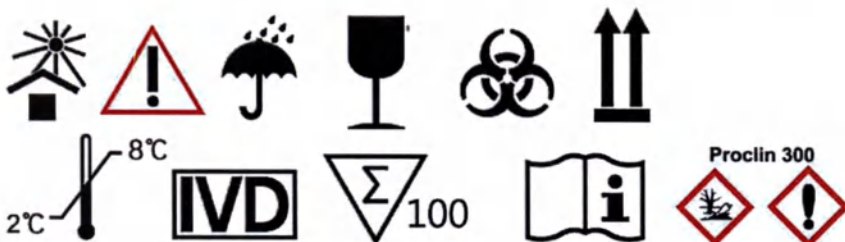

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86001



Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА свободный» для количественного определения свободного простатспецифического антигена (ПСА свободный, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-214-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86001

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) л.

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

