

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Фрезениус СП»



А.В. Мягков

12/12/2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор FX CorDiax

2022

1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор FX CorDiax, модели:

1. Диализатор FX CorDiax 40 в составе с инструкцией по эксплуатации
2. Диализатор FX CorDiax 50 в составе с инструкцией по эксплуатации
3. Диализатор FX CorDiax 60 в составе с инструкцией по эксплуатации
4. Диализатор FX CorDiax 80 в составе с инструкцией по эксплуатации
5. Диализатор FX CorDiax 100 в составе с инструкцией по эксплуатации
6. Диализатор FX CorDiax 120 в составе с инструкцией по эксплуатации
7. Диализатор FX CorDiax 600 в составе с инструкцией по эксплуатации
8. Диализатор FX CorDiax 800 в составе с инструкцией по эксплуатации
9. Диализатор FX CorDiax 1000 в составе с инструкцией по эксплуатации

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

2.1 Производитель

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg, Germany (Германия)

Телефон: +49 6172-609-0

Факс: +49 6172-609-2422

Эл. почта: <https://www.freseniusmedicalcare.com/en/contact/>

2.2 Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации

Акционерное общество «Фрезениус СП» (АО «Фрезениус СП»)

Юридический адрес: Угрешская улица, 2, стр. 6, комн. 09

115088, г. Москва, Российская Федерация

Телефон/факс: 8 (495) 789-64-54

Фактический адрес: Валовая улица, 35

115054, г. Москва, Российская Федерация

Телефон/факс: 8 (495) 789-64-54

Эл. почта: msk.office@fmc-ag.com

2.3 Производственные площадки

1. Fresenius Medical Care (Jiangsu) Co., Ltd.

Guli Industrial Park, Guli Zhen

Changshu City, Jiangsu Province, China

2. Fresenius Medical Care – SMAD,
Z.I. de la Pontchonnierre
Route de la Chanade, Savigny, 69591 L'Arbresle Cedex, France


3. ООО «ФРЕПУС», Россия, 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Академика Кадышевского, д. 11/6

4. Fresenius Medical Care Japan K.K.,
Buzen Plant
92-7 Ohaza Kaimo
Buzen City, Fukuoka Pref. 828-0045, Japan

5. Fresenius Medical Care Deutschland GmbH,
St. Wendel Plant,
Frankfurter Straße 6 - 8
66606 St. Wendel, Germany

3. ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Диализатор FX CorDiax 40



Диализатор FX CorDiax 40 в упаковке




Диализатор FX CorDiax 40 в транспортной упаковке






Диализатор FX CorDiax 50



Диализатор FX CorDiax 50 в упаковке



Диализатор FX CorDiax 50 в транспортной упаковке

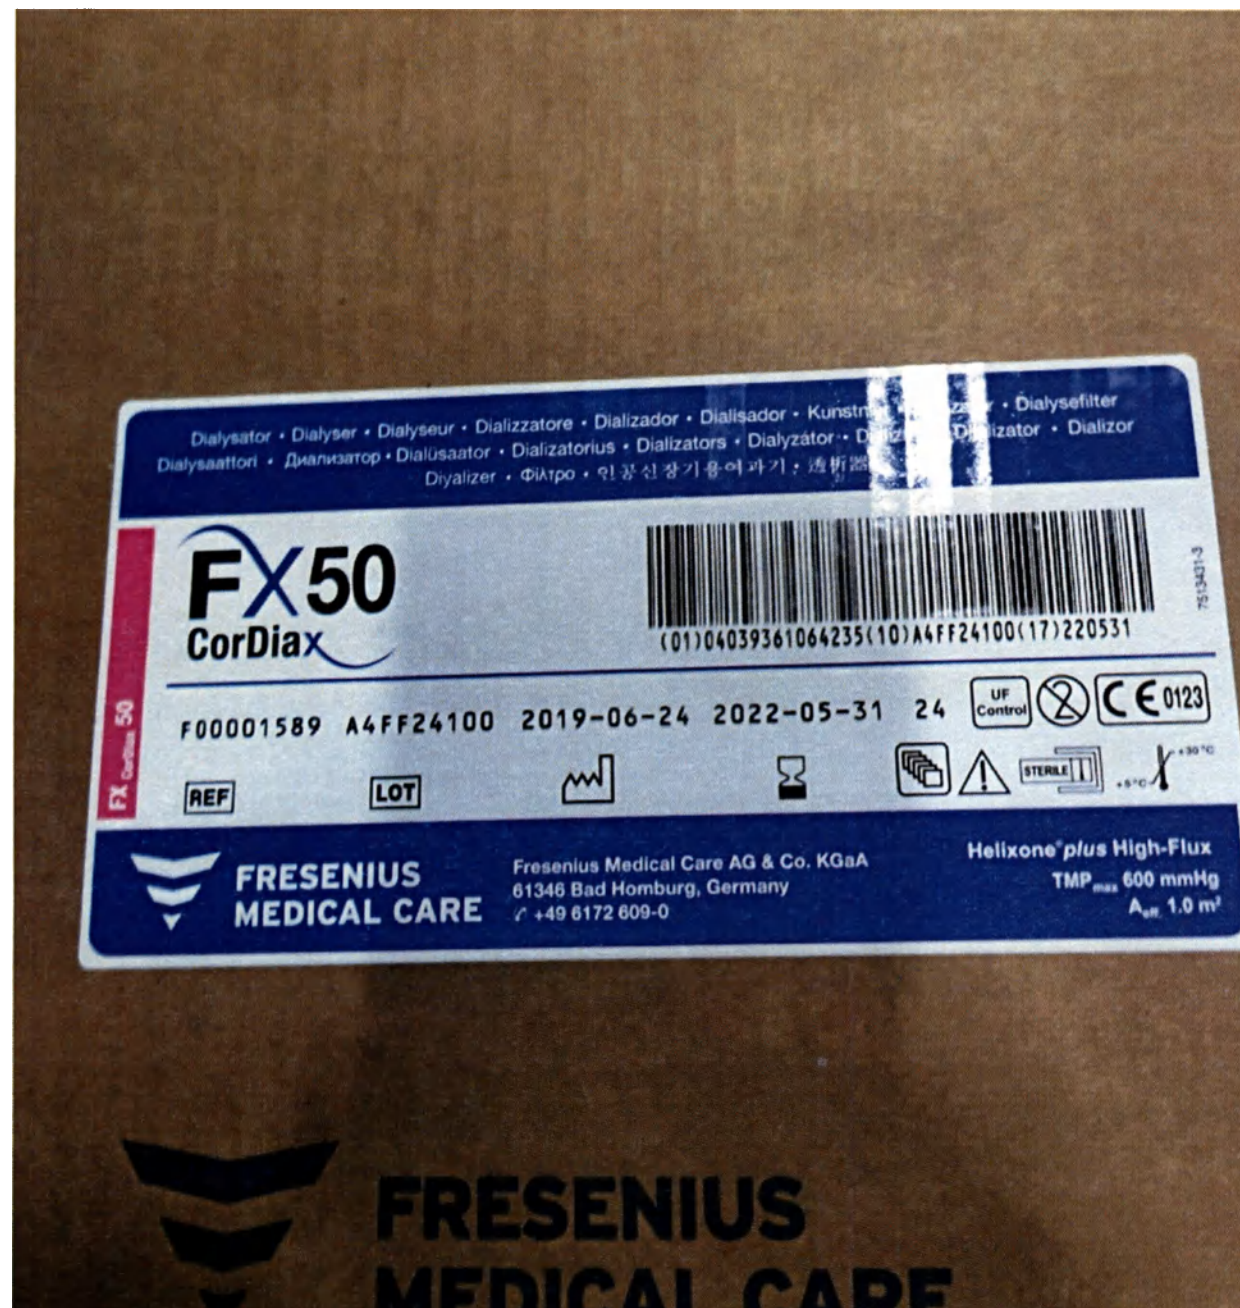




**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

FXclass

FXclass

Диализатор FX CorDiax 60



Диализатор FX CorDiax 60 в упаковке



Диализатор FX CorDiax 60 в транспортной упаковке






**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

FXclass

FXclass

Диализатор FX CorDiax 80



Диализатор FX CorDiax 80 в упаковке



Not for
clinical use!

Dialysator • Dialyser • Dialyseur • Dializzatore • Dializador • Dialisador • Kunstnier • Dializator • Dial
Dialysaattori • Диализатор • Dialysaator • Dializatorius • Dializators • Dialyzátor • Dializátor • Dijalizator
Diyalizer • Φίλτρο • 인공신장기용여과기 • 透析器

FX80
CorDiax



(01)04039361064396(10)C4FF30100(17)240531

7513451-3

FX CorDiax 80

F00001591 C4FF30100 2021-06-30 2024-05-31 24

UF
Control



CE 0123

REF

LOT



+30°C
+5°C



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
61346 Bad Homburg, Germany
☎ +49 6172 609-0

Helixone[®] plus High-Flux
TMP_{max} 600 mmHg
A_{eff} 1.8 m²



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**




**FRESENIUS
MEDICAL CARE**


FXclass

FXclass


Made in Germany


[illegible]





Диализатор FX CorDiax 120






Fresenius



**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

Диализатор FX CorDiax 600





Диализатор FX CorDiax 600 в транспортной упаковке






**FRESENIUS
MEDICAL CARE**

FXclass

FXclass

Диализатор FX CorDiax 800



Диализатор FX CorDiax 800 в упаковке




Диализатор FX CorDiax 800 в транспортной упаковке







Диализатор FX CorDiax 1000






Диализатор FX CorDiax 1000 в транспортной упаковке





Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 40

Этикетка медицинского изделия



Этикетка транспортной упаковки





Диализатор FX CorDiax 40

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Страна происхождения товара:

Германия/Япония/Франция/Китай

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь PVP)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.



Диализатор FX CorDiax 40

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Производственная площадка:

ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская
область, город Дубна, улица Академика
Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь PVP)


Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.

Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 50

Этикетка медицинского изделия



Этикетка транспортной упаковки





Диализатор FX CorDiax 50

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Страна происхождения товара:

Германия/Япония/Франция/Китай

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь PVP)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.



Диализатор FX CorDiax 50

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Производственная площадка:

ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская
область, город Дубна, улица Академика
Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь PVP)


Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.

Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 60

Этикетка медицинского изделия



Этикетка транспортной упаковки





Диализатор FX CorDiax 60

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Страна происхождения товара:

Германия/Япония/Франция/Китай

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone®plus

(Полисульфон – смесь PVP)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.



Диализатор FX CorDiax 60

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Производственная площадка:

ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская
область, город Дубна, улица Академика
Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone®plus

(Полисульфон – смесь PVP)


Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.


Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.

Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 80

Этикетка медицинского изделия



Этикетка транспортной упаковки



Стикеры потребительской и транспортной упаковки



Диализатор FX CorDiax 80

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Страна происхождения товара:

Германия/Япония/Франция/Китай

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь PVP)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.



Диализатор FX CorDiax 80

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Производственная площадка:

ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская
область, город Дубна, улица Академика
Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь PVP)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.

Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 100

Этикетка медицинского изделия

FX100

CorDiax

Helixone^{plus} High-Flux
 Dialysator • Dialyser • Dialyseur • Dializzatore • Dializador • Dialisador • Kunstnier • Dializator • Dialysefilter
 Dialysaattori • Диализатор • Dialüsaator • Dializatorius • Dializators • Dialyzátor • Dializátor • Dijalizator • Dializor
 Dializer • Φίλτρο • 인공신장기용여과기 • 透析器

CE 0123 UF Control STERILE

A_{eff} 2.2 m² TMP_{max} 600 mmHg

REF LOT

FX CorDiax 100

7513341-3

FRESENIUS MEDICAL CARE

Этикетка транспортной упаковки

FX100

CorDiax

Dialysator • Dialyser • Dialyseur • Dializzatore • Dializador • Dialisador • Kunstnier • Dializator • Dialysefilter
 Dialysaattori • Диализатор • Dialüsaator • Dializatorius • Dializators • Dialyzátor • Dializátor • Dijalizator • Dializor
 Dializer • Φίλτρο • 인공신장기용여과기 • 透析器

CE 0123 UF Control

REF LOT


FRESENIUS MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
 61346 Bad Homburg, Germany
 ☎ +49 6172 609-0

Helixone^{plus} High-Flux
 TMP_{max} 600 mmHg
 A_{eff} 2.2 m²


7513461-3

 **FRESENIUS
MEDICAL CARE** 



Диализатор FX CorDiax 100
Стерильно, апирогенно, нетоксично
Производитель:
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0
Уполномоченный представитель в РФ:
АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54
Страна происхождения товара:
Германия/Япония/Франция/Китай
Регистрационное удостоверение №:
ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.
**Инструкция по подготовке диализатора к
использованию:**
«Перед применением прочтите инструкцию»
Мембрана: Helixone[®]plus
(Полисульфон – смесь PVP)
Особые указания:
Не хранить при температуре ниже +5 °C или
выше +30 °C.
Используйте, в случае если нет
повреждений наружной упаковки,
уплотняющие колпачки на месте и
диализатор не поврежден.

 **FRESENIUS
MEDICAL CARE** 



Диализатор FX CorDiax 100
Стерильно, апирогенно, нетоксично
Производитель:
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0
Уполномоченный представитель в РФ:
АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54
Производственная площадка:
ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская
область, город Дубна, улица Академика
Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России
Регистрационное удостоверение №:
ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.
**Инструкция по подготовке диализатора к
использованию:**
«Перед применением прочтите инструкцию»
Мембрана: Helixone[®]plus
(Полисульфон – смесь PVP)
Особые указания:
Не хранить при температуре ниже +5 °C или
выше +30 °C.
Используйте, в случае если нет
повреждений наружной упаковки,
уплотняющие колпачки на месте и
диализатор не поврежден.

Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 120

Этикетка медицинского изделия

FX120
CorDiax

Helixone®plus High-Flux
 Dialysator • Dialyser • Dialyseur • Dializzatore • Dializador • Dialisador • Kunstnier • Dializator • Dialysefilter
 Dialysaattori • Диализатор • Dialüsaator • Dializatorius • Dializators • Dialyzátor • Dializátor • Dijalizator • Dializor
 Dialysator • Dializatorius • Dializators
 Dialyzitor • Dializitor • Dializator
 Dializor • Dializor • Dializor
 Dializor • Dializor • Dializor
 인공신장기용여과기
 透析器

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA · 61346 Bad Homburg, Germany · ☎ +49 6172 609-0

CE 0123 UF Control STERILE

A_{eff} 2.5 m² TMP_{max} 600 mmHg

REF LOT LOT

FX CorDiax 120

FRESENIUS MEDICAL CARE

7513591-3

Этикетка транспортной упаковки

Dialysator • Dialyser • Dialyseur • Dializzatore • Dializador • Dialisador • Kunstnier • Dializator • Dialysefilter
 Dialysaattori • Диализатор • Dialüsaator • Dializatorius • Dializators • Dialyzátor • Dializátor • Dijalizator • Dializor
 Dializer • Φίλτρο • 인공신장기용여과기 • 透析器

FX120
CorDiax

FX CorDiax 120

REF LOT

UF Control CE 0123

STERILE +5 °C / +30 °C

FRESENIUS MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
 61346 Bad Homburg, Germany
 ☎ +49 6172 609-0

Helixone®plus High-Flux
 TMP_{max} 600 mmHg
 A_{eff} 2.5 m²

7513601-3

Стикер потребительской и транспортной упаковки




Диализатор FX CorDiax 120
Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Производитель:
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0
Уполномоченный представитель в РФ:
АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54
Страна происхождения товара:
Германия/Япония/Франция/Китай
Регистрационное удостоверение №:
ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.
Инструкция по подготовке диализатора к использованию:
«Перед применением прочтите инструкцию»
Мембрана: Helixone®plus
(Полисульфон – смесь PVP)
Особые указания:
Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.
Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.



Диализатор FX CorDiax 120
Стерильно, апиrogenно, нетоксично
Производитель:
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0
Уполномоченный представитель в РФ:
АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54
Производственная площадка:
ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская область, город Дубна, улица Академика Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России
Регистрационное удостоверение №:
ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.
Инструкция по подготовке диализатора к использованию:
«Перед применением прочтите инструкцию»
Мембрана: Helixone®plus
(Полисульфон – смесь PVP)
Особые указания:
Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.
Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.

Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 600

Этикетка медицинского изделия



Этикетка транспортной упаковки





Диализатор FX CorDiax 600

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Страна происхождения товара:

Германия/Япония/Франция/Китай

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь ПВП)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.



Диализатор FX CorDiax 600

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Производственная площадка:

ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская
область, город Дубна, улица Академика
Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь ПВП)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.


Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 800

Этикетка медицинского изделия



Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA · 61346 Bad Homburg, Germany · ☎ +49 6172 609-0

Helixone®plus High-Flux
 Hämodiafilter · Haemodiafilter · Hémodiafiltre · Emodiafiltro · Hemodiafiltro · Hemodiafilter
 Hemodiafiltr · Hæmodiafilter · Hemodiafilteri · Гемодиалитр · Hemodiafiltras
 Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr
 Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr
 Хемодиалитр · Φίλτρο αιμοδιαθήσεως · 인공신장기용 여과기 · 費森尤斯血液過濾透析器





A 2.0 m² TMP 600 mmHg

FX CorDiax 800

REF LOT LOT

FX CorDiax 800



FRESENIUS MEDICAL CARE

Этикетка транспортной упаковки



FX CorDiax 800

Helixone®plus High-Flux
 Hämodiafilter · Haemodiafilter · Hémodiafiltre · Emodiafiltro · Hemodiafiltro · Hemodiafilter
 Hemodiafiltr · Hæmodiafilter · Hemodiafilteri · Гемодиалитр · Hemodiafiltras
 Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr · Hemodiafiltr
 Хемодиалитр · Φίλτρο αιμοδιαθήσεως · 인공신장기용 여과기 · 費森尤斯血液過濾透析器










FRESENIUS MEDICAL CARE

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
 61346 Bad Homburg, Germany
 ☎ +49 6172 609-0

Helixone®plus High-Flux
 TMP_{max} 600 mmHg
 A_{eff} 2.0 m²

Стикеры потребительской и транспортной упаковки



Диализатор FX CorDiax 800

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Страна происхождения товара:

Германия/Япония/Франция/Китай

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь ПВП)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.



Диализатор FX CorDiax 800

Стерильно, апирогенно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Производственная площадка:

ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская
область, город Дубна, улица Академика
Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь ПВП)


Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет повреждений наружной упаковки, уплотняющие колпачки на месте и диализатор не поврежден.

Макеты маркировки Диализатор FX CorDiax 1000

Этикетка медицинского изделия



Этикетка транспортной упаковки



Стикеры потребительской и транспортной упаковки



Диализатор FX CorDiax 1000

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Страна происхождения товара:

Германия/Япония/Франция/Китай

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к
использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь ПВП)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или
выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет
повреждений наружной упаковки,
уплотняющие колпачки на месте и
диализатор не поврежден.



Диализатор FX CorDiax 1000

Стерильно, апиrogenно, нетоксично

Производитель:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA,
Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg,
Germany, +49 6172 609-0

Уполномоченный представитель в РФ:

АО «Фрезениус СП», 115088, г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 6, комн. 09,
8 (495) 789-64-54

Производственная площадка:

ООО «ФРЕРУС», 141980, Московская
область, город Дубна, улица Академика
Кадышевского, дом 11/6, Сделано в России

Регистрационное удостоверение №:

ФСЗ 2012/13172 от 24 августа 2016г.

Инструкция по подготовке диализатора к
использованию:

«Перед применением прочтите инструкцию»

Мембрана: Helixone[®]plus

(Полисульфон – смесь ПВП)

Особые указания:

Не хранить при температуре ниже +5 °C или
выше +30 °C.

Используйте, в случае если нет
повреждений наружной упаковки,
уплотняющие колпачки на месте и
диализатор не поврежден.

ПРОШНО. ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ

(56) ЛИС.

Генеральный директор
А.В. Мельков

