

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«31» мая 2023 г.

М.П.




Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-213-65614693-2022»

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.)




Пароизоляционные крышки

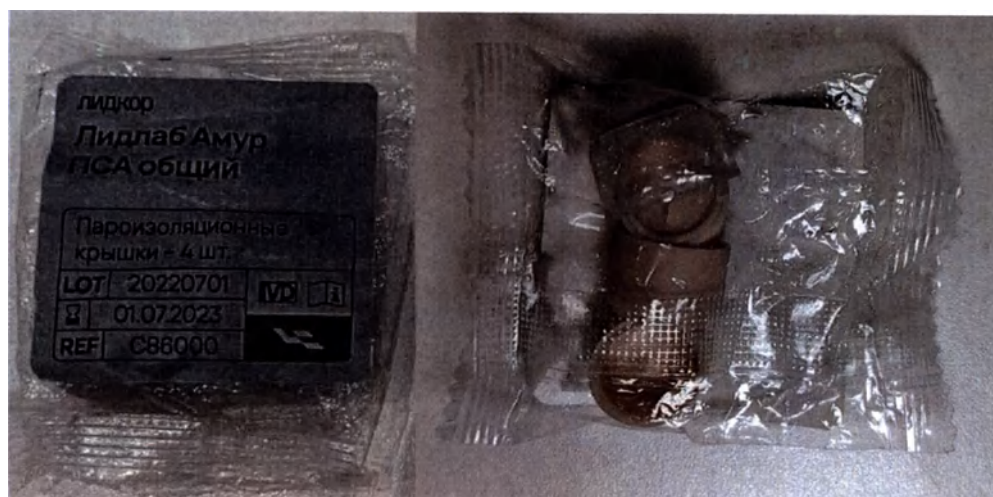


Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон



Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон

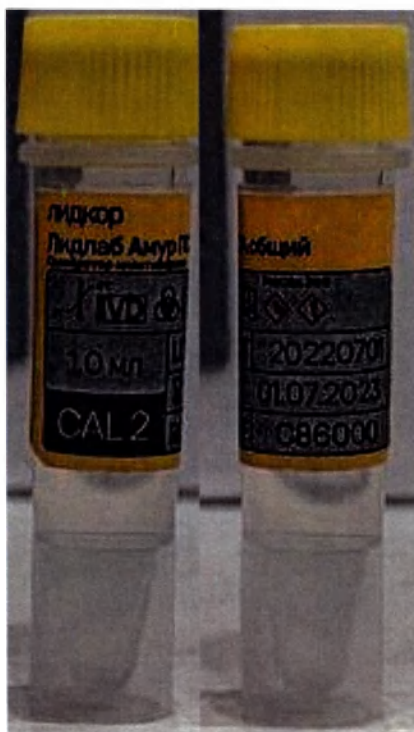


Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон

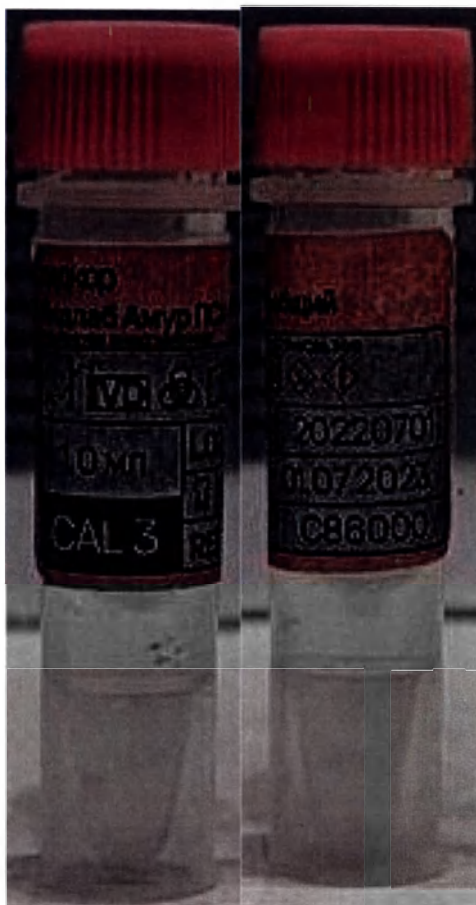


Потребительская упаковка




Потребительская упаковка 100 тестов (вид спереди)

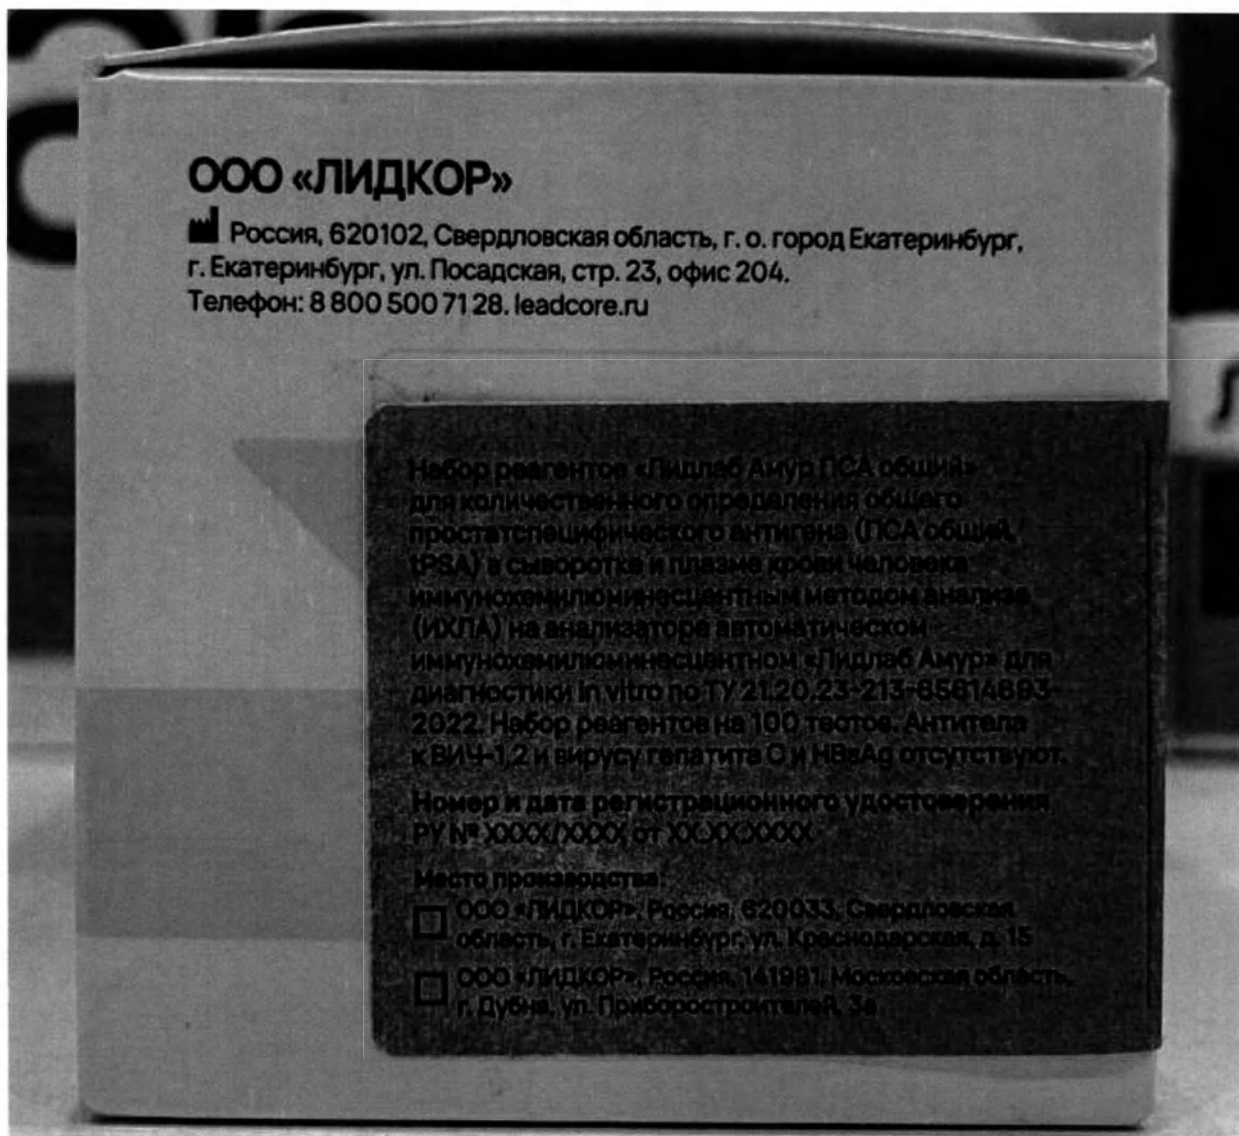


Потребительская упаковка 100 тестов (вид слева)

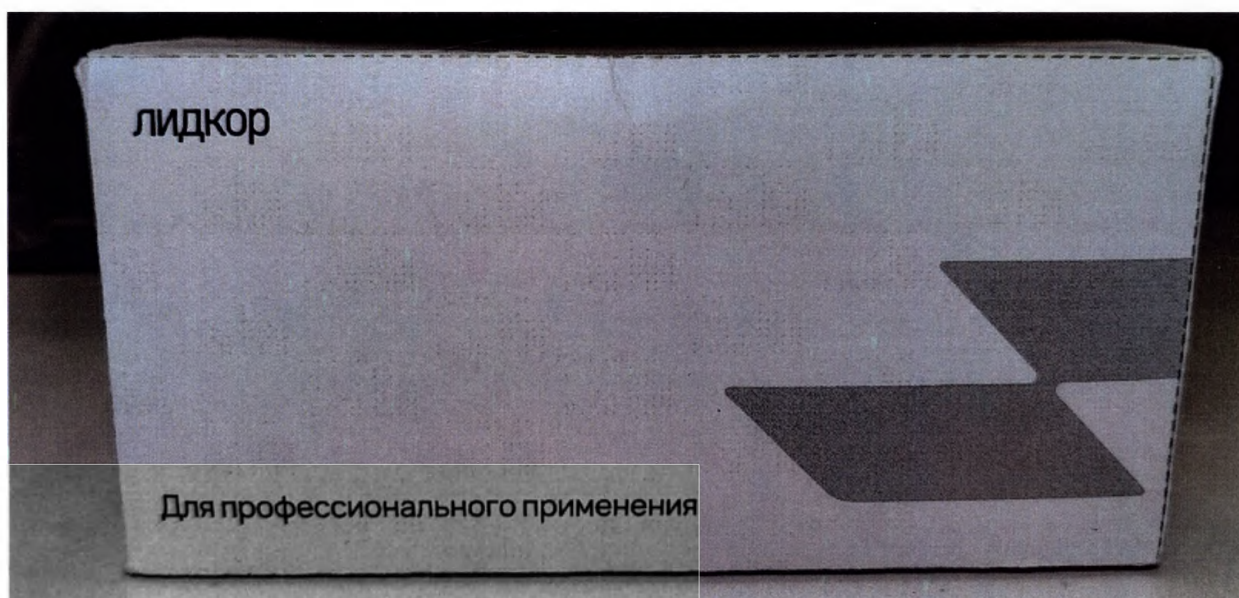

Потребительская упаковка 100 тестов (вид сзади)

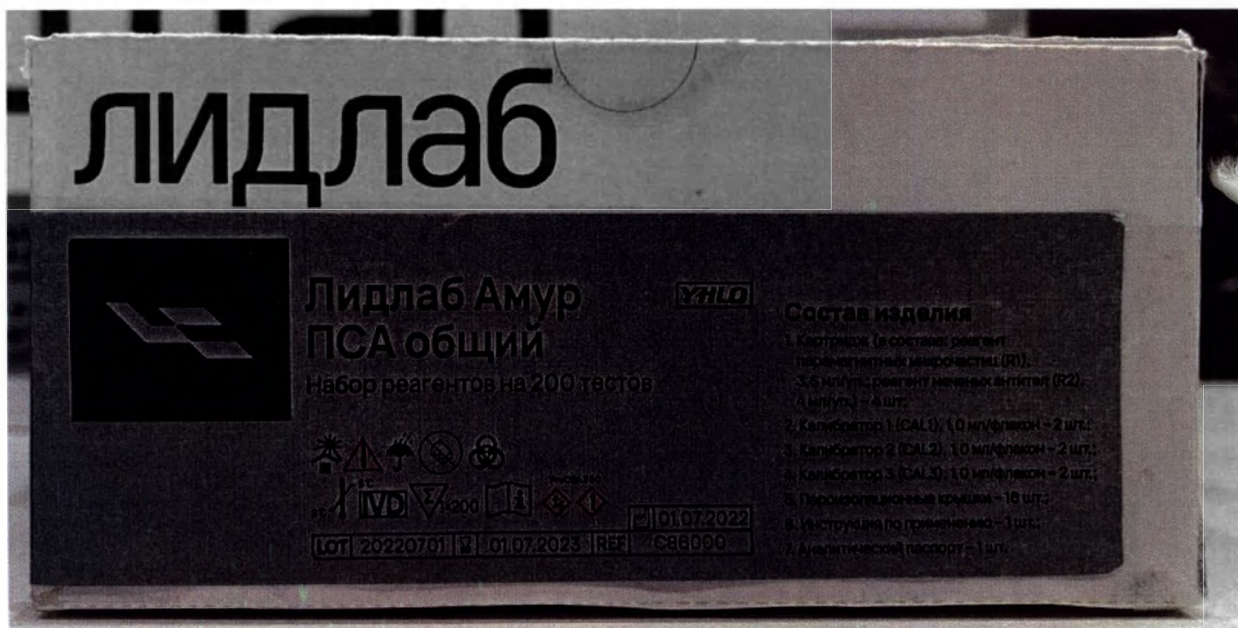

Потребительская упаковка 200 тестов (вид спереди)

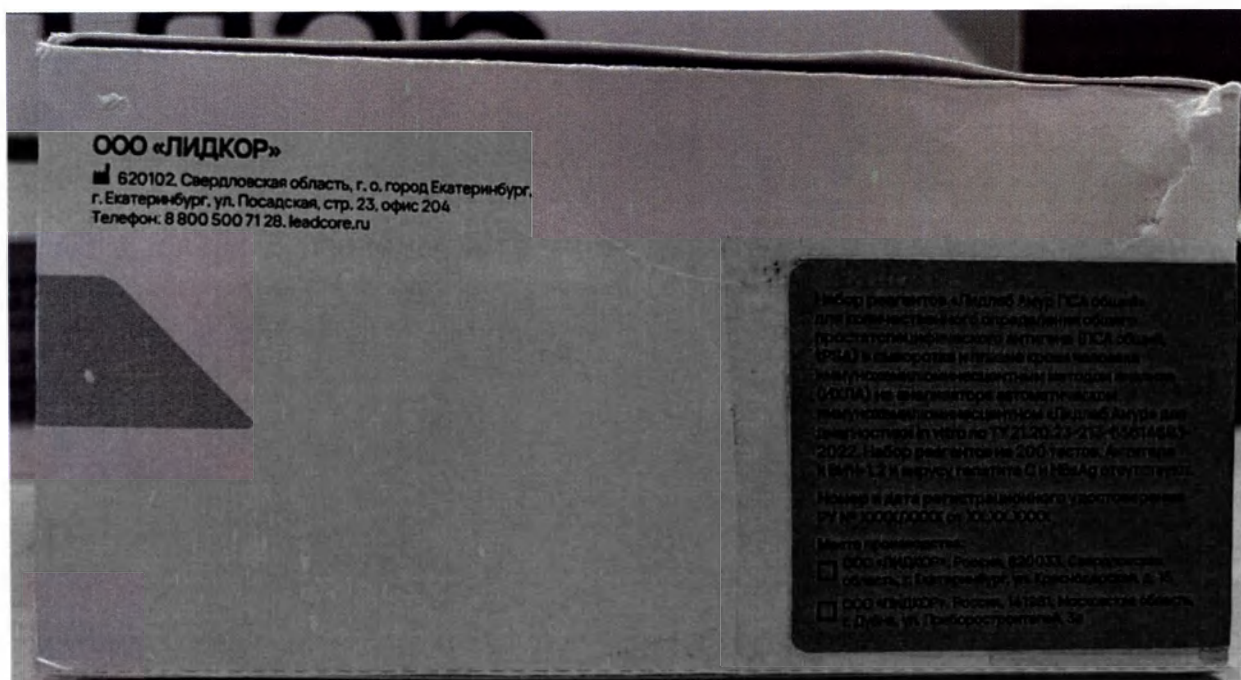


Потребительская упаковка 200 тестов (вид слева)



Потребительская упаковка 200 тестов (вид сзади)




Потребительская упаковка 500 тестов (вид спереди)

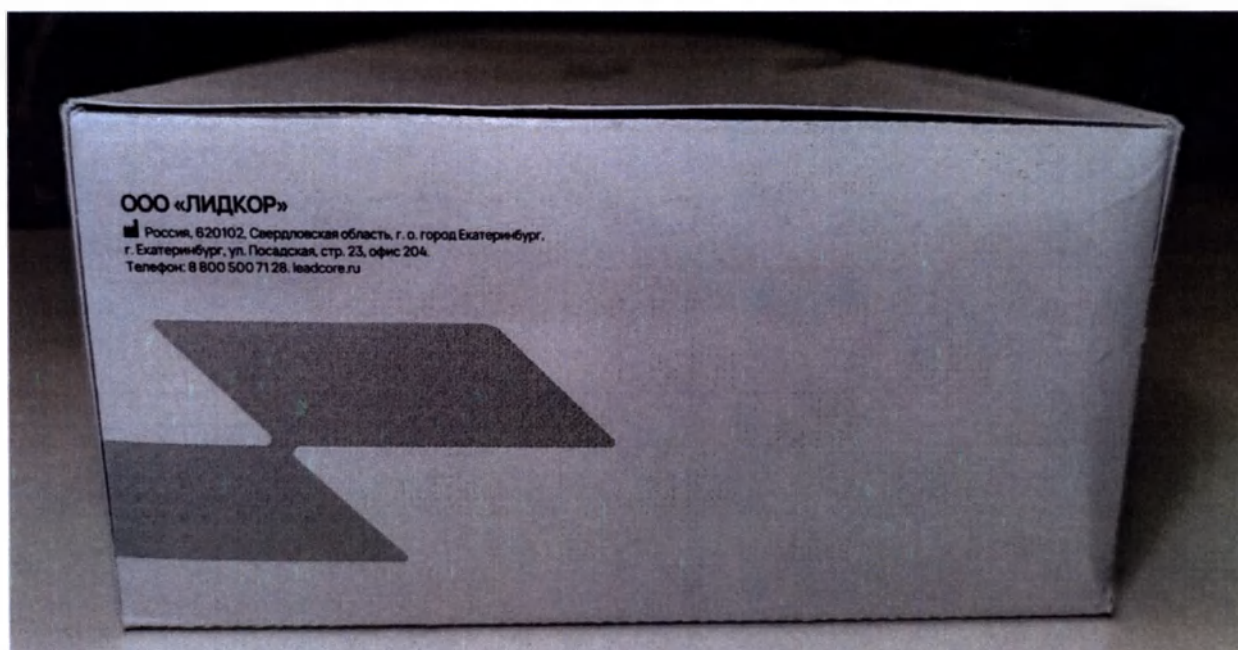

Потребительская упаковка 500 тестов (вид слева)




Потребительская упаковка 500 тестов (вид сзади)

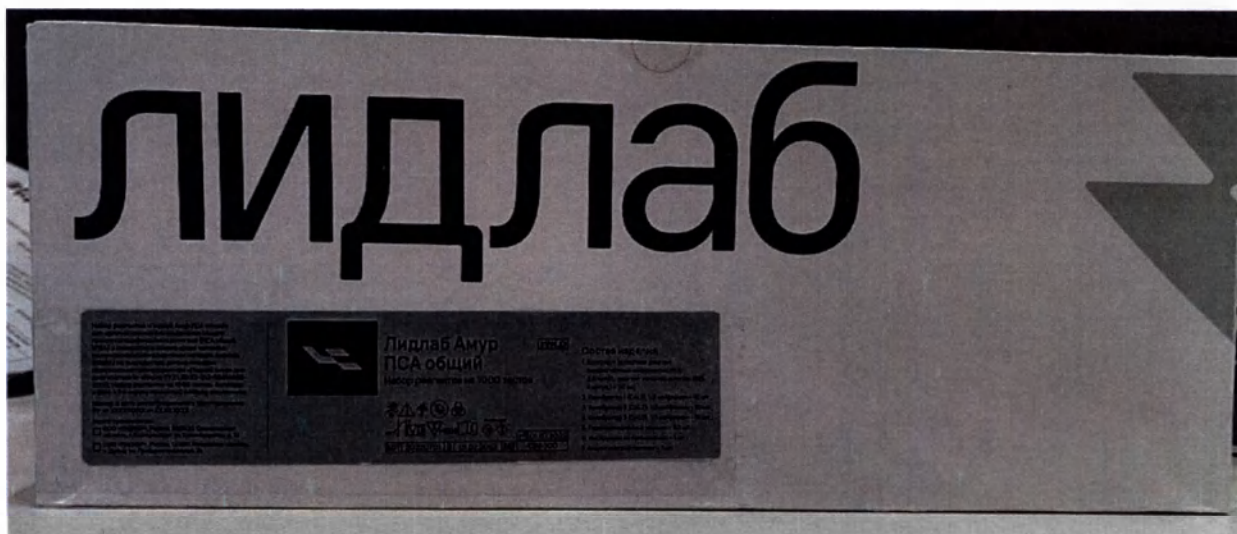


Потребительская упаковка 1000 тестов (вид спереди)



Потребительская упаковка 1000 тестов (вид слева)

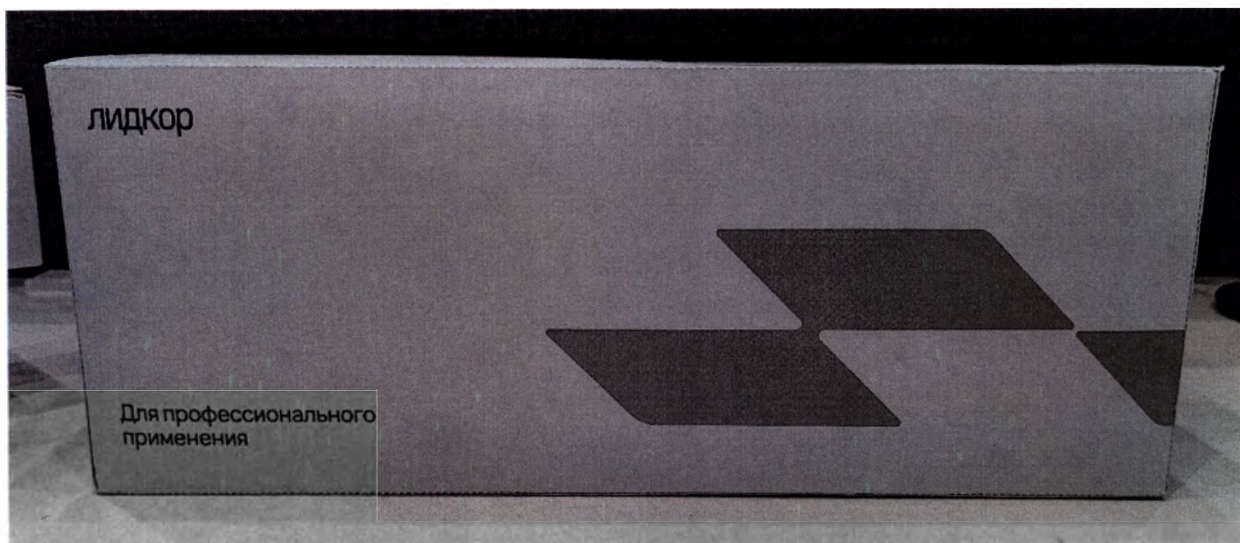

Потребительская упаковка 1000 тестов (вид сзади)


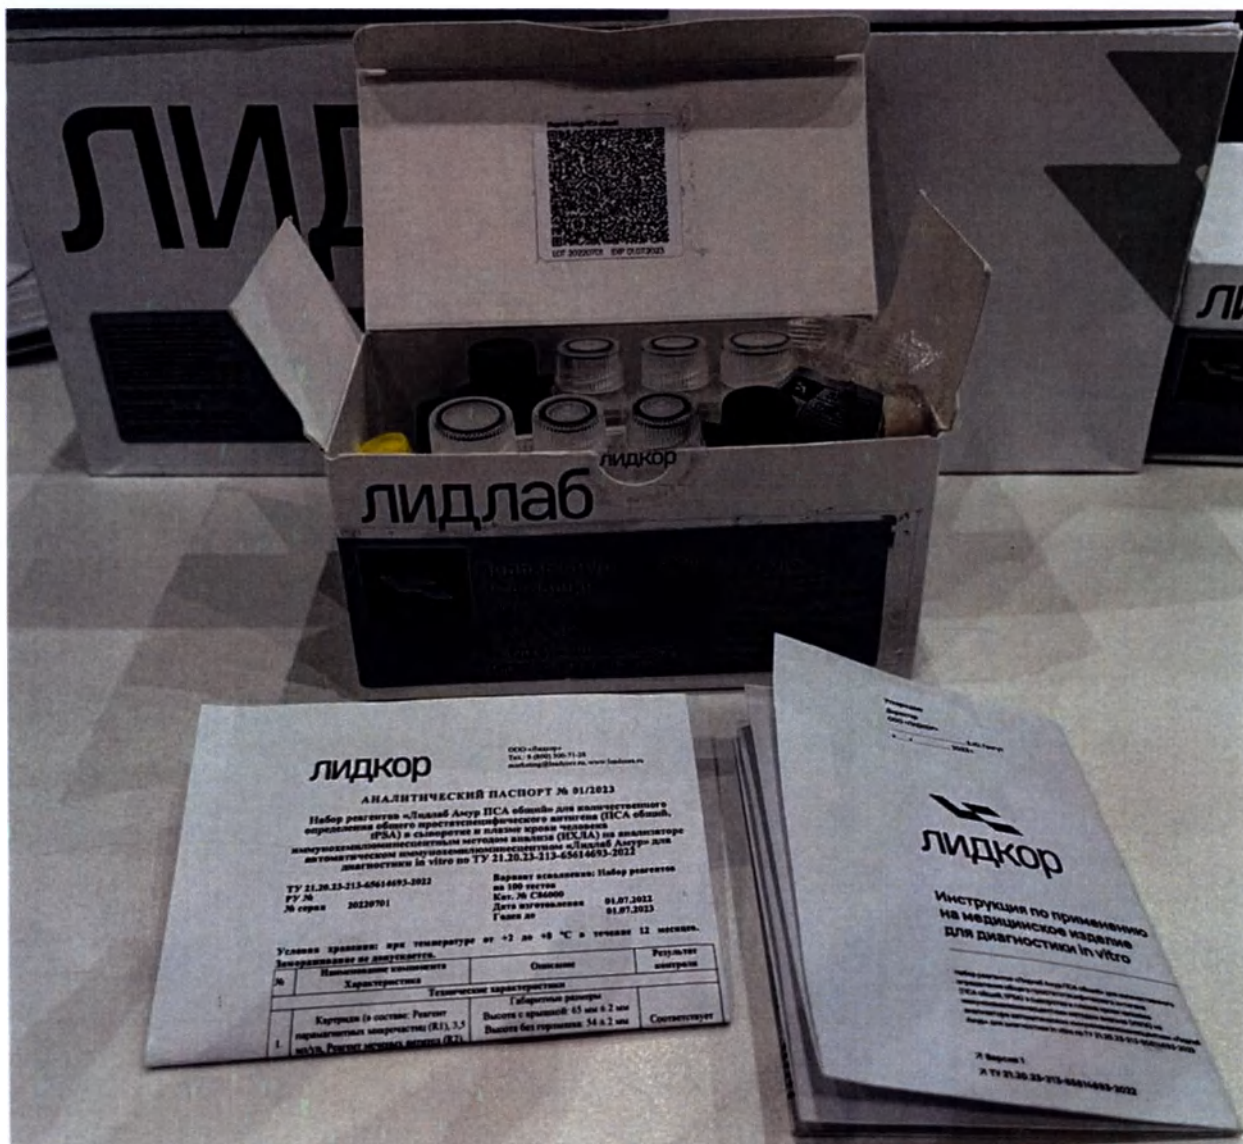




Фотография общего вида набора реагентов на 100 тестов.



Групповое фото.

Транспортная упаковка

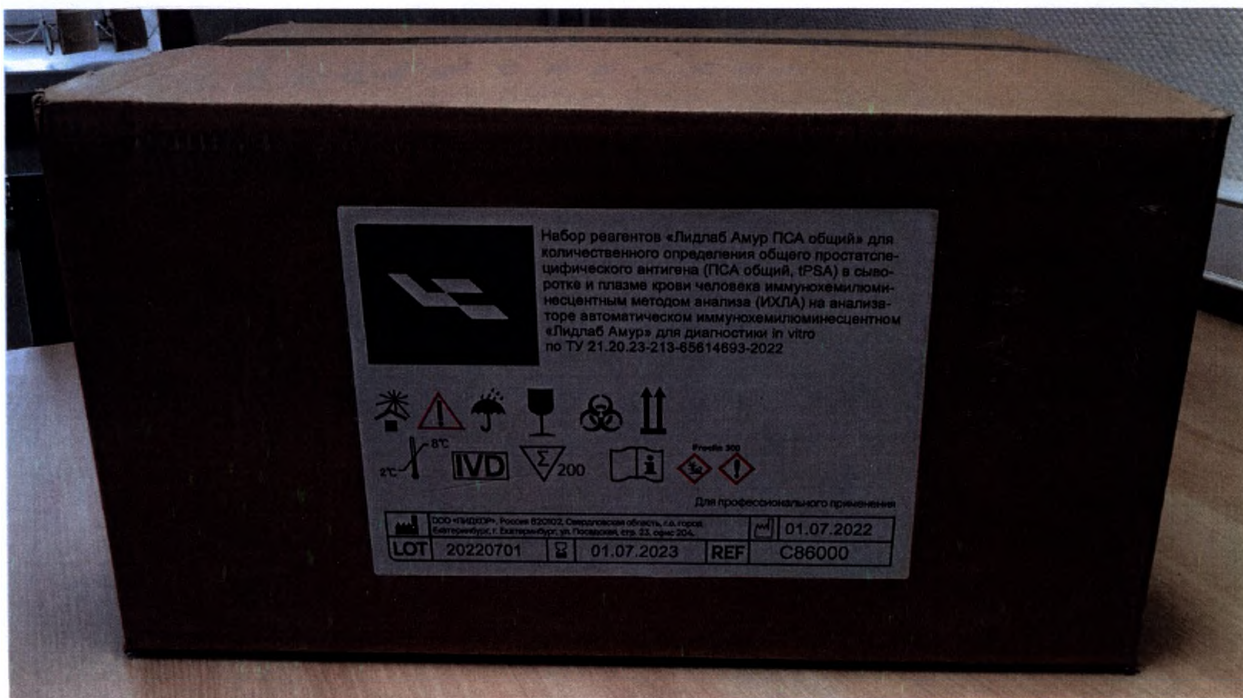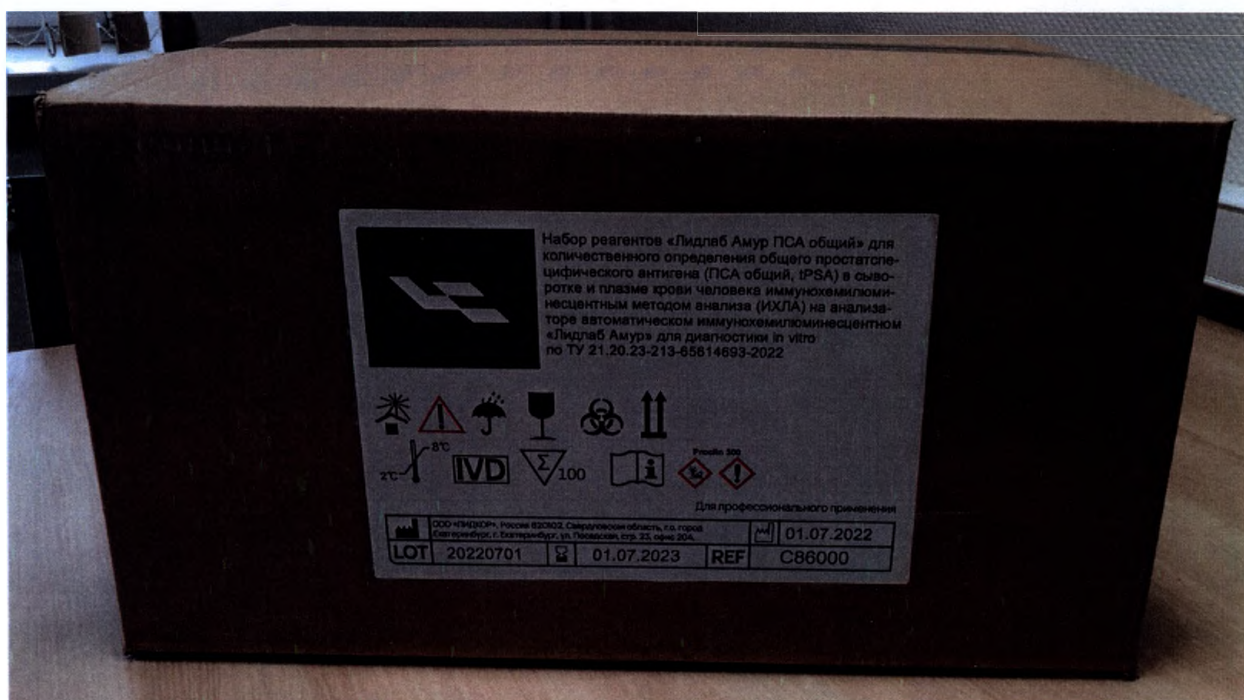

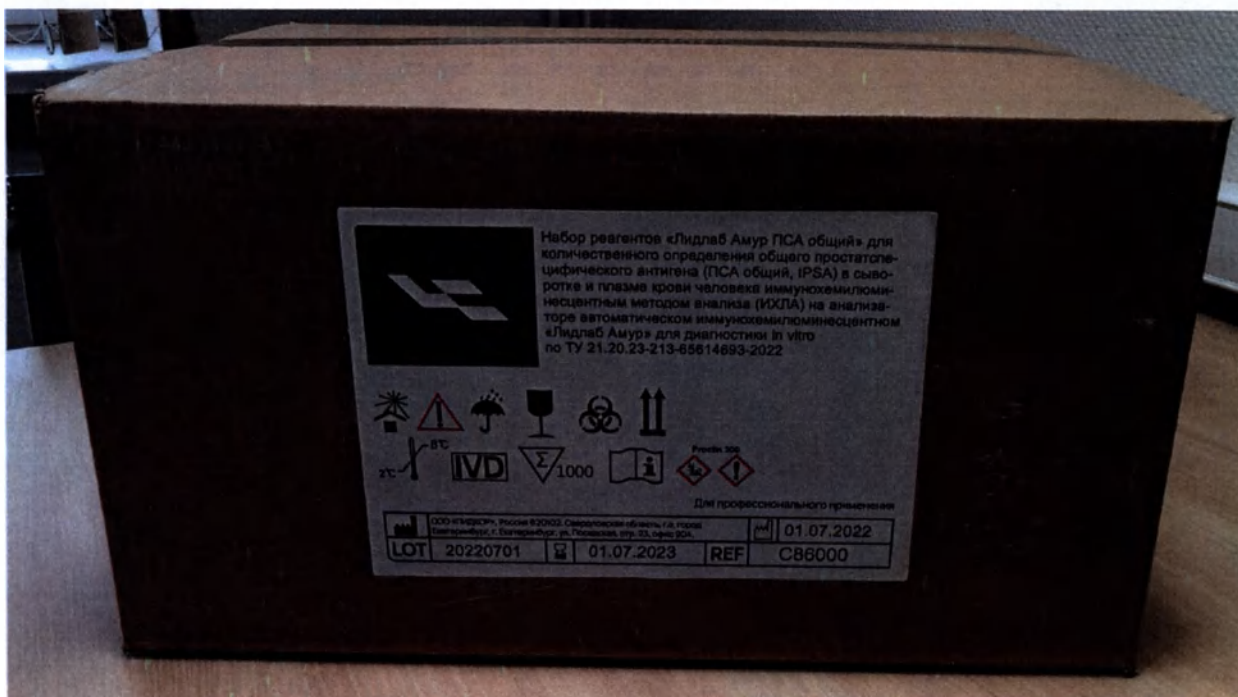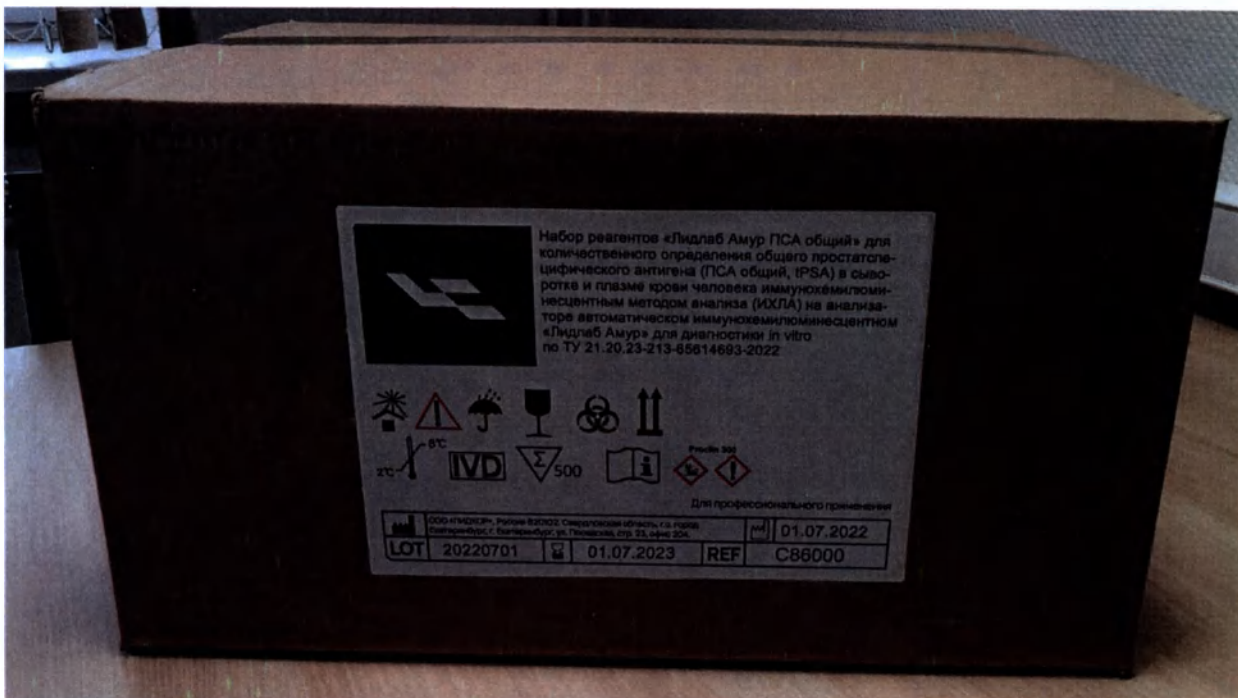

и скреплено печатью
13 (тринадцать) л.

ООО «ЛИДКОР» _____ /Е. Ю. Гохгут/



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ЛИДКОР"

Е.Ю. Гохгут


«31» мая 2023 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

«Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-213-65614693-2022»

Картридж (в составе: реагент парамагнитных частиц (R1), 3,5 мл/уп; реагент меченных антител (R2), 4,0 мл/уп.)

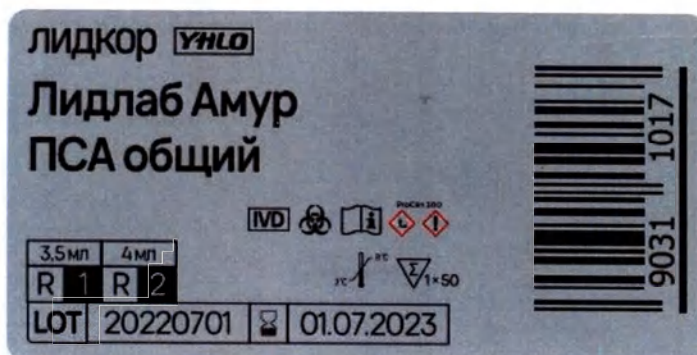

Калибратор 1 (CAL1)



Калибратор 2 (CAL2)




Калибратор 3 (CAL3)



Пароизоляционные крышки



QR-code

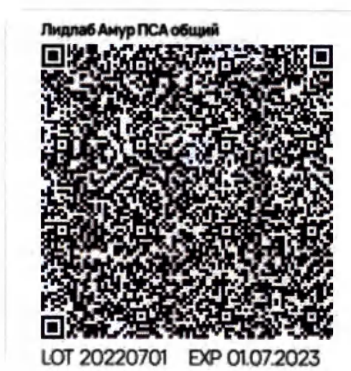

Наклейка



Потребительская упаковка

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по TY 21.20.23-213-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антигена к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ПСА общий

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT 20220701 01.07.2023 REF C86000

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 2 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 1 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 1 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 1 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 8 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по TY 21.20.23-213-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антигена к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ПСА общий

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT 20220701 01.07.2023 REF C86000

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 2 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по TY 21.20.23-213-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антигена к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ПСА общий

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



LOT 20220701 01.07.2023 REF C86000

Состав изделия


1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 10 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 5 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 40 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по TY 21.20.23-213-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антигена к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения RU № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур ПСА общий

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO




LOT 20220701 01.07.2023 REF C86000

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3.5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4 мл/уп.) – 20 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1.0 мл/флакон – 10 шт.
5. Пароизоляционные крышки – 80 шт.
6. Инструкция по применению – 1 шт.
7. Аналитический паспорт – 1 шт.

Потребительская коробка

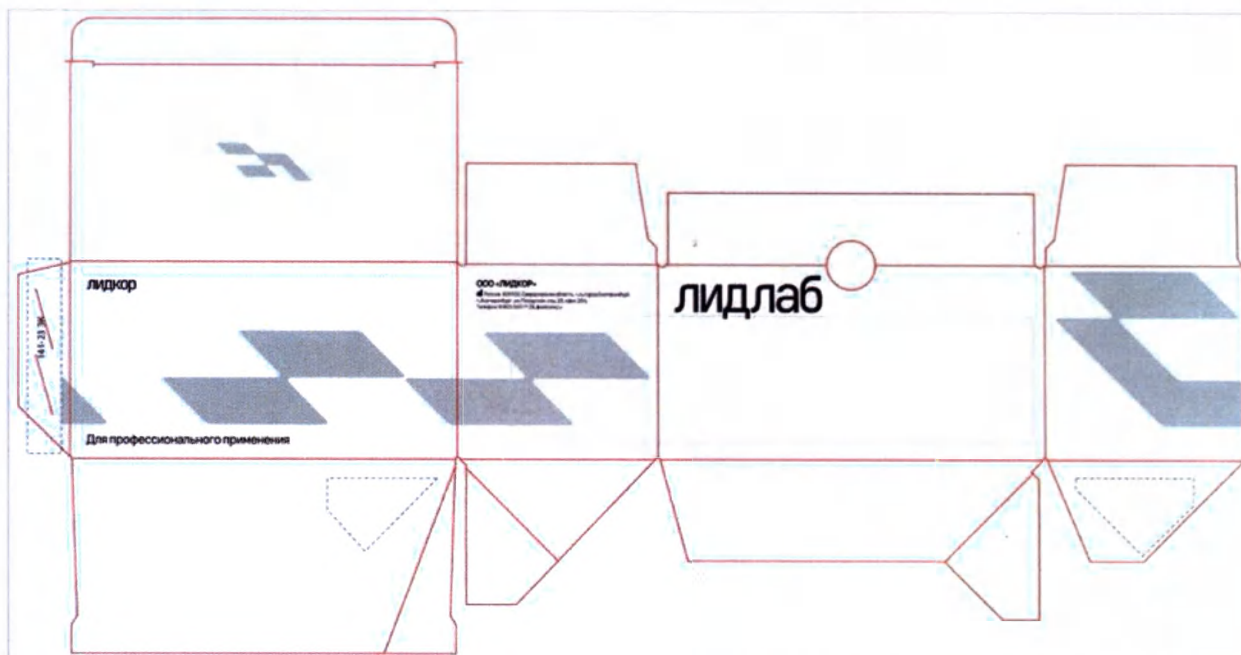

Транспортная упаковка



Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-213-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86000



Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro*
по ТУ 21.20.23-213-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXX		XX.XX.XXXX	REF	C86000



Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-213-65614693-2022

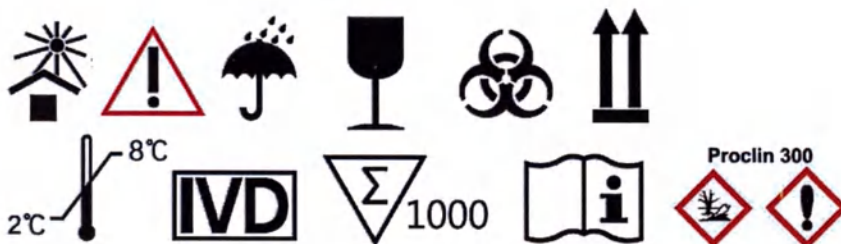

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX REF C86000



Набор реагентов «Лидлаб Амур ПСА общий» для количественного определения общего простатспецифического антигена (ПСА общий, tPSA) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-213-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.		XX.XX.XXXX
LOT	XXXXXXXXXX		XX.XX.XXXX REF C86000

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
7 (*Сид*) л.



/Е. Ю. Гохгут/