

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «СКИНВЕЛ»




Ко Бум Сук
2024 г.


ФОТОМАТЕРИАЛЫ
медицинского изделия

«Аппарат радиочастотный терапевтический VOLNEWMER,
модель VM1-M100»


производства Classys Inc. (Клэссис Инк.), Республика Корея



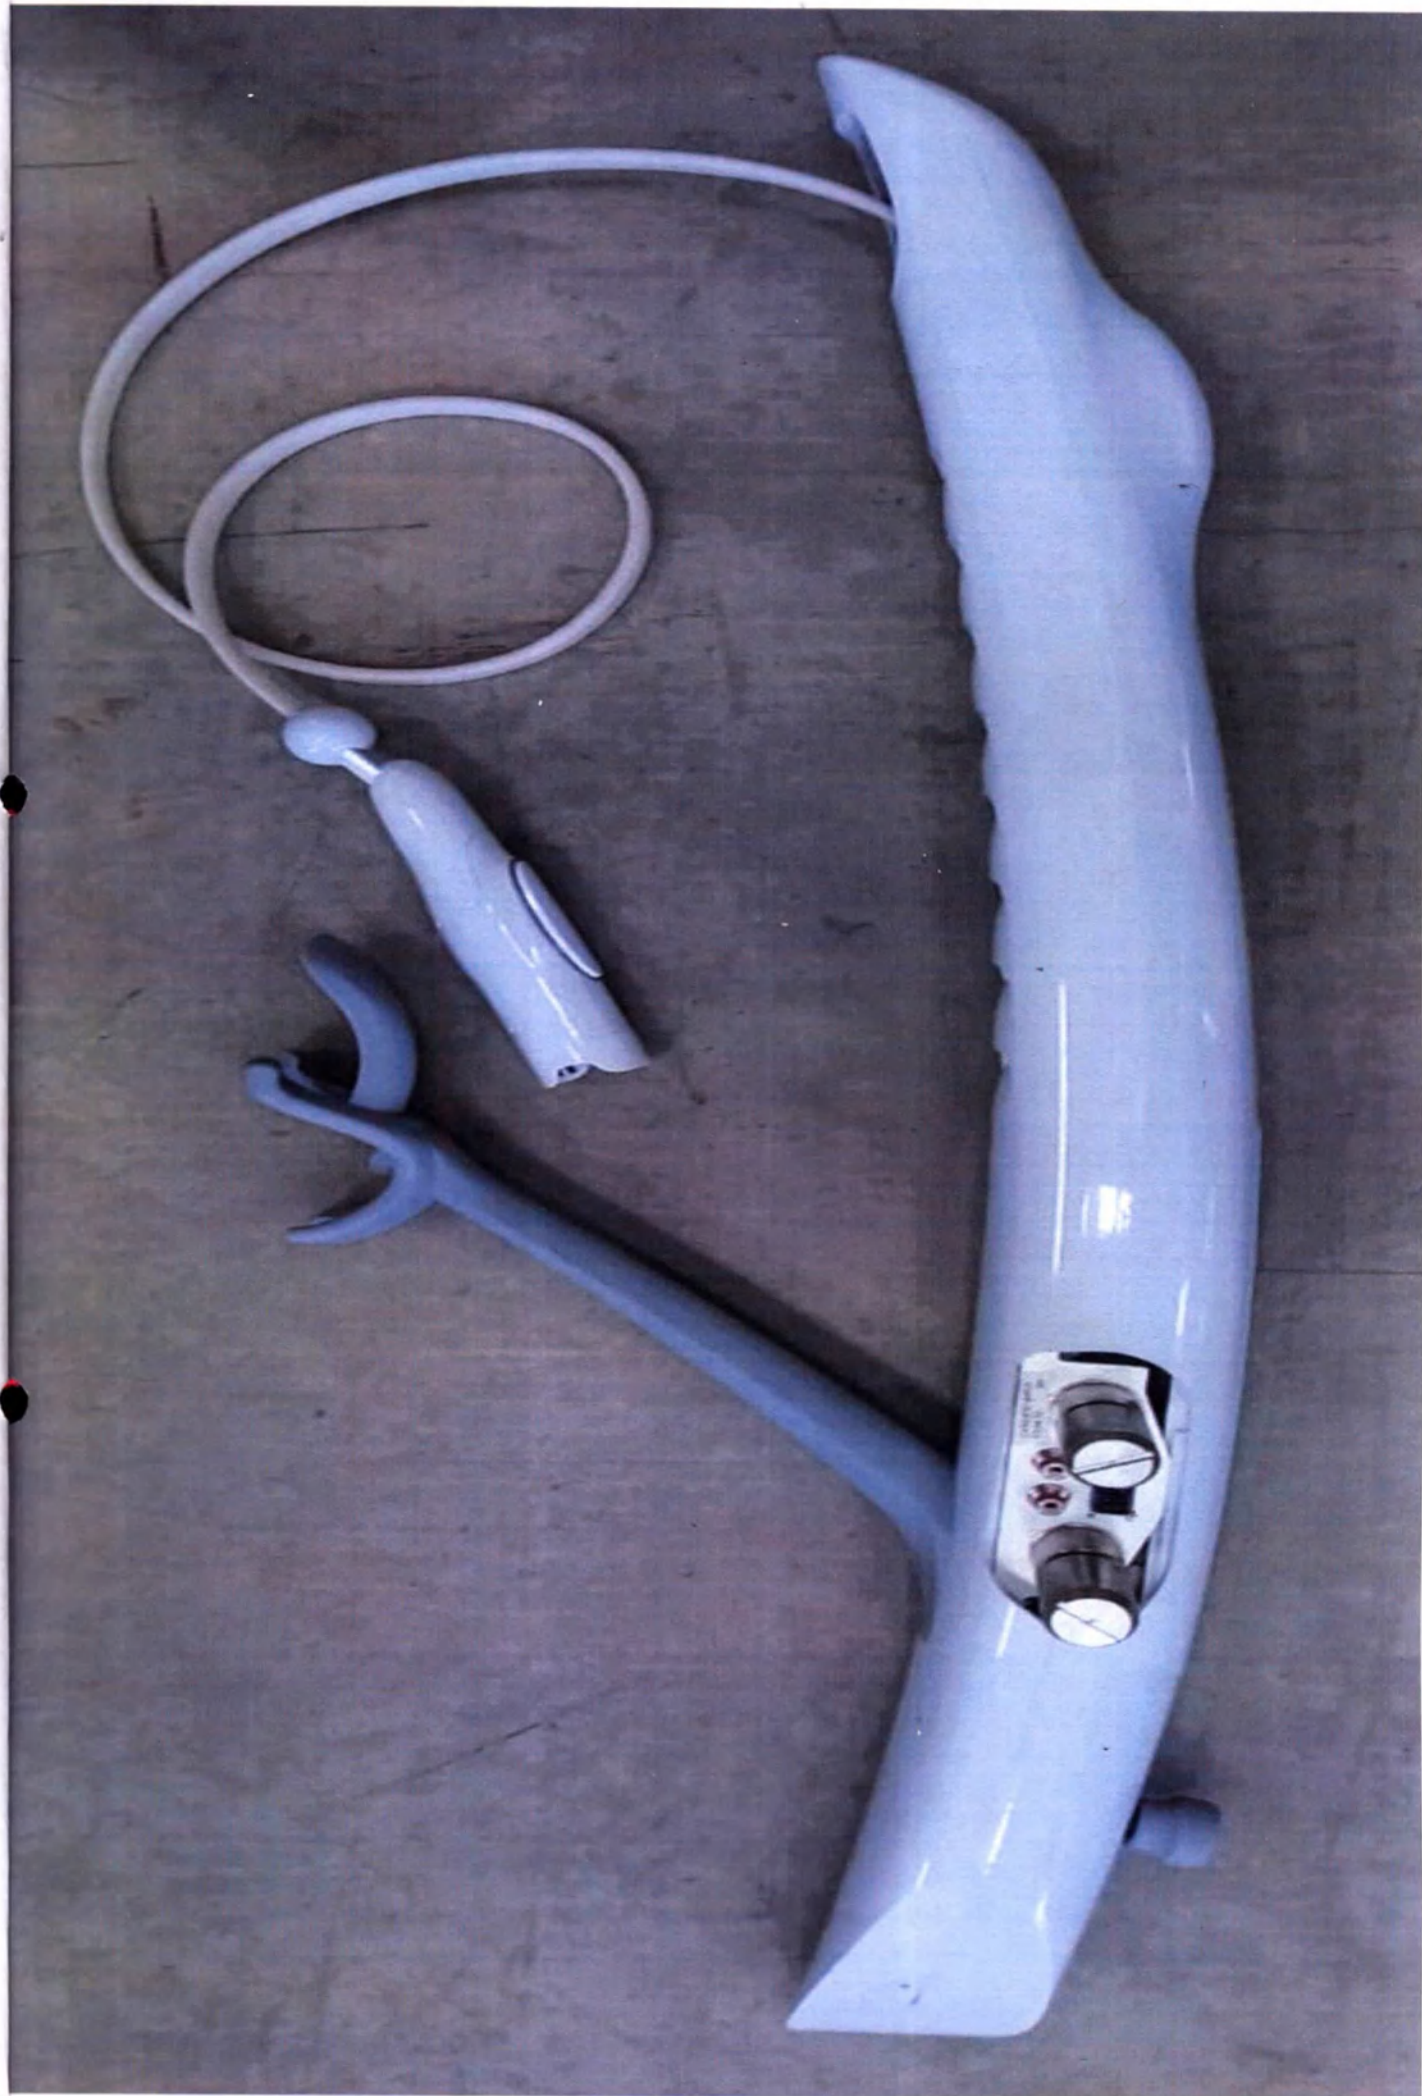

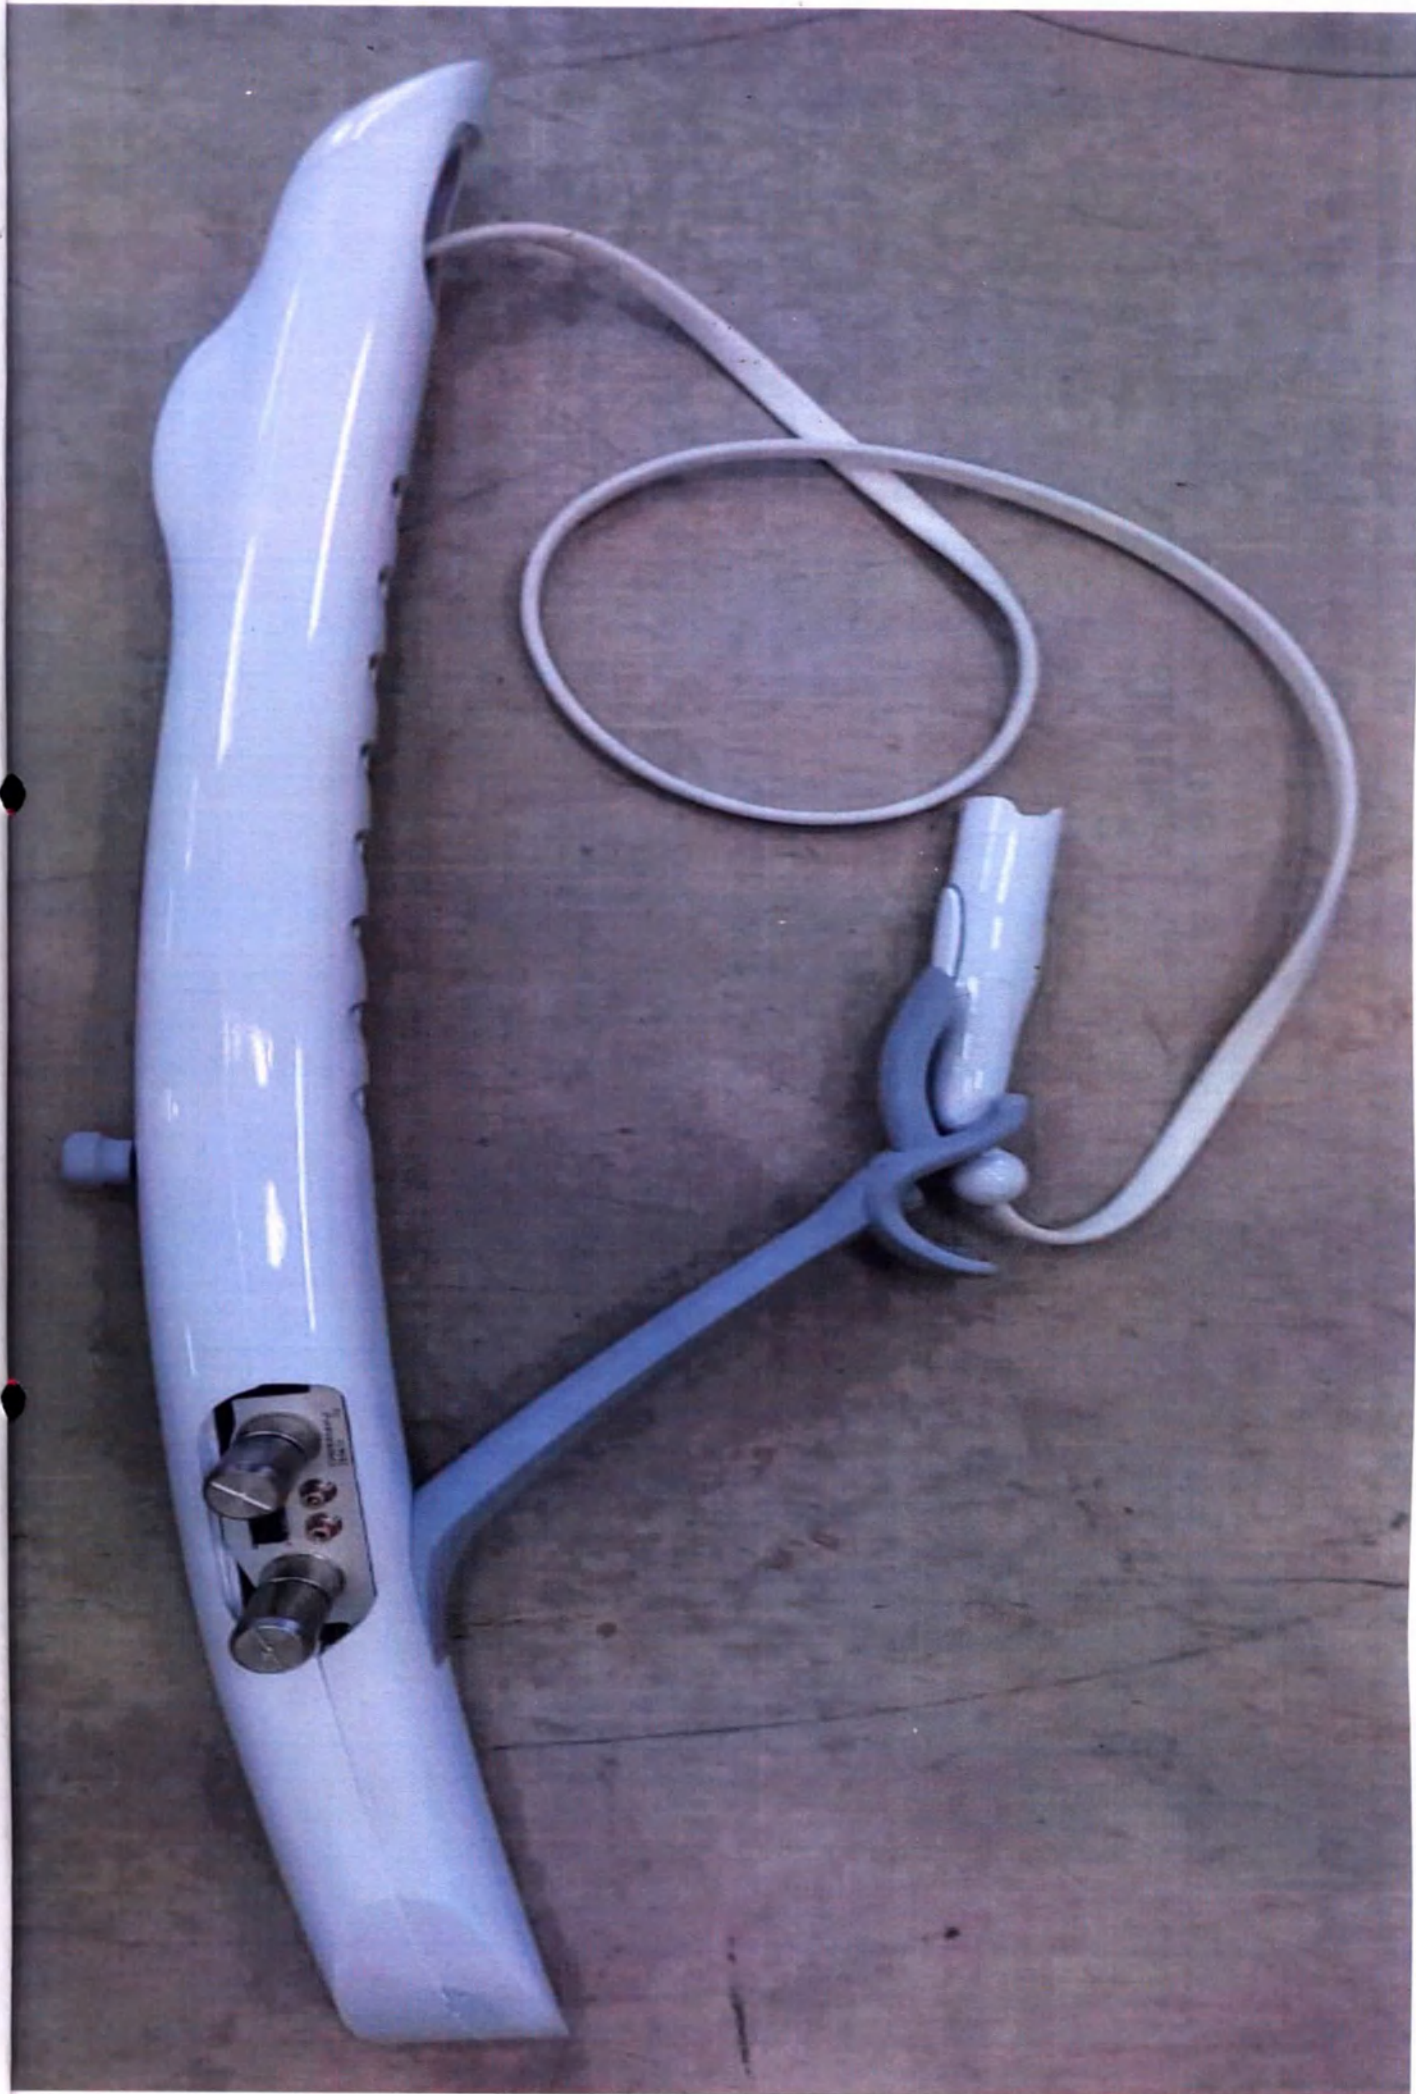




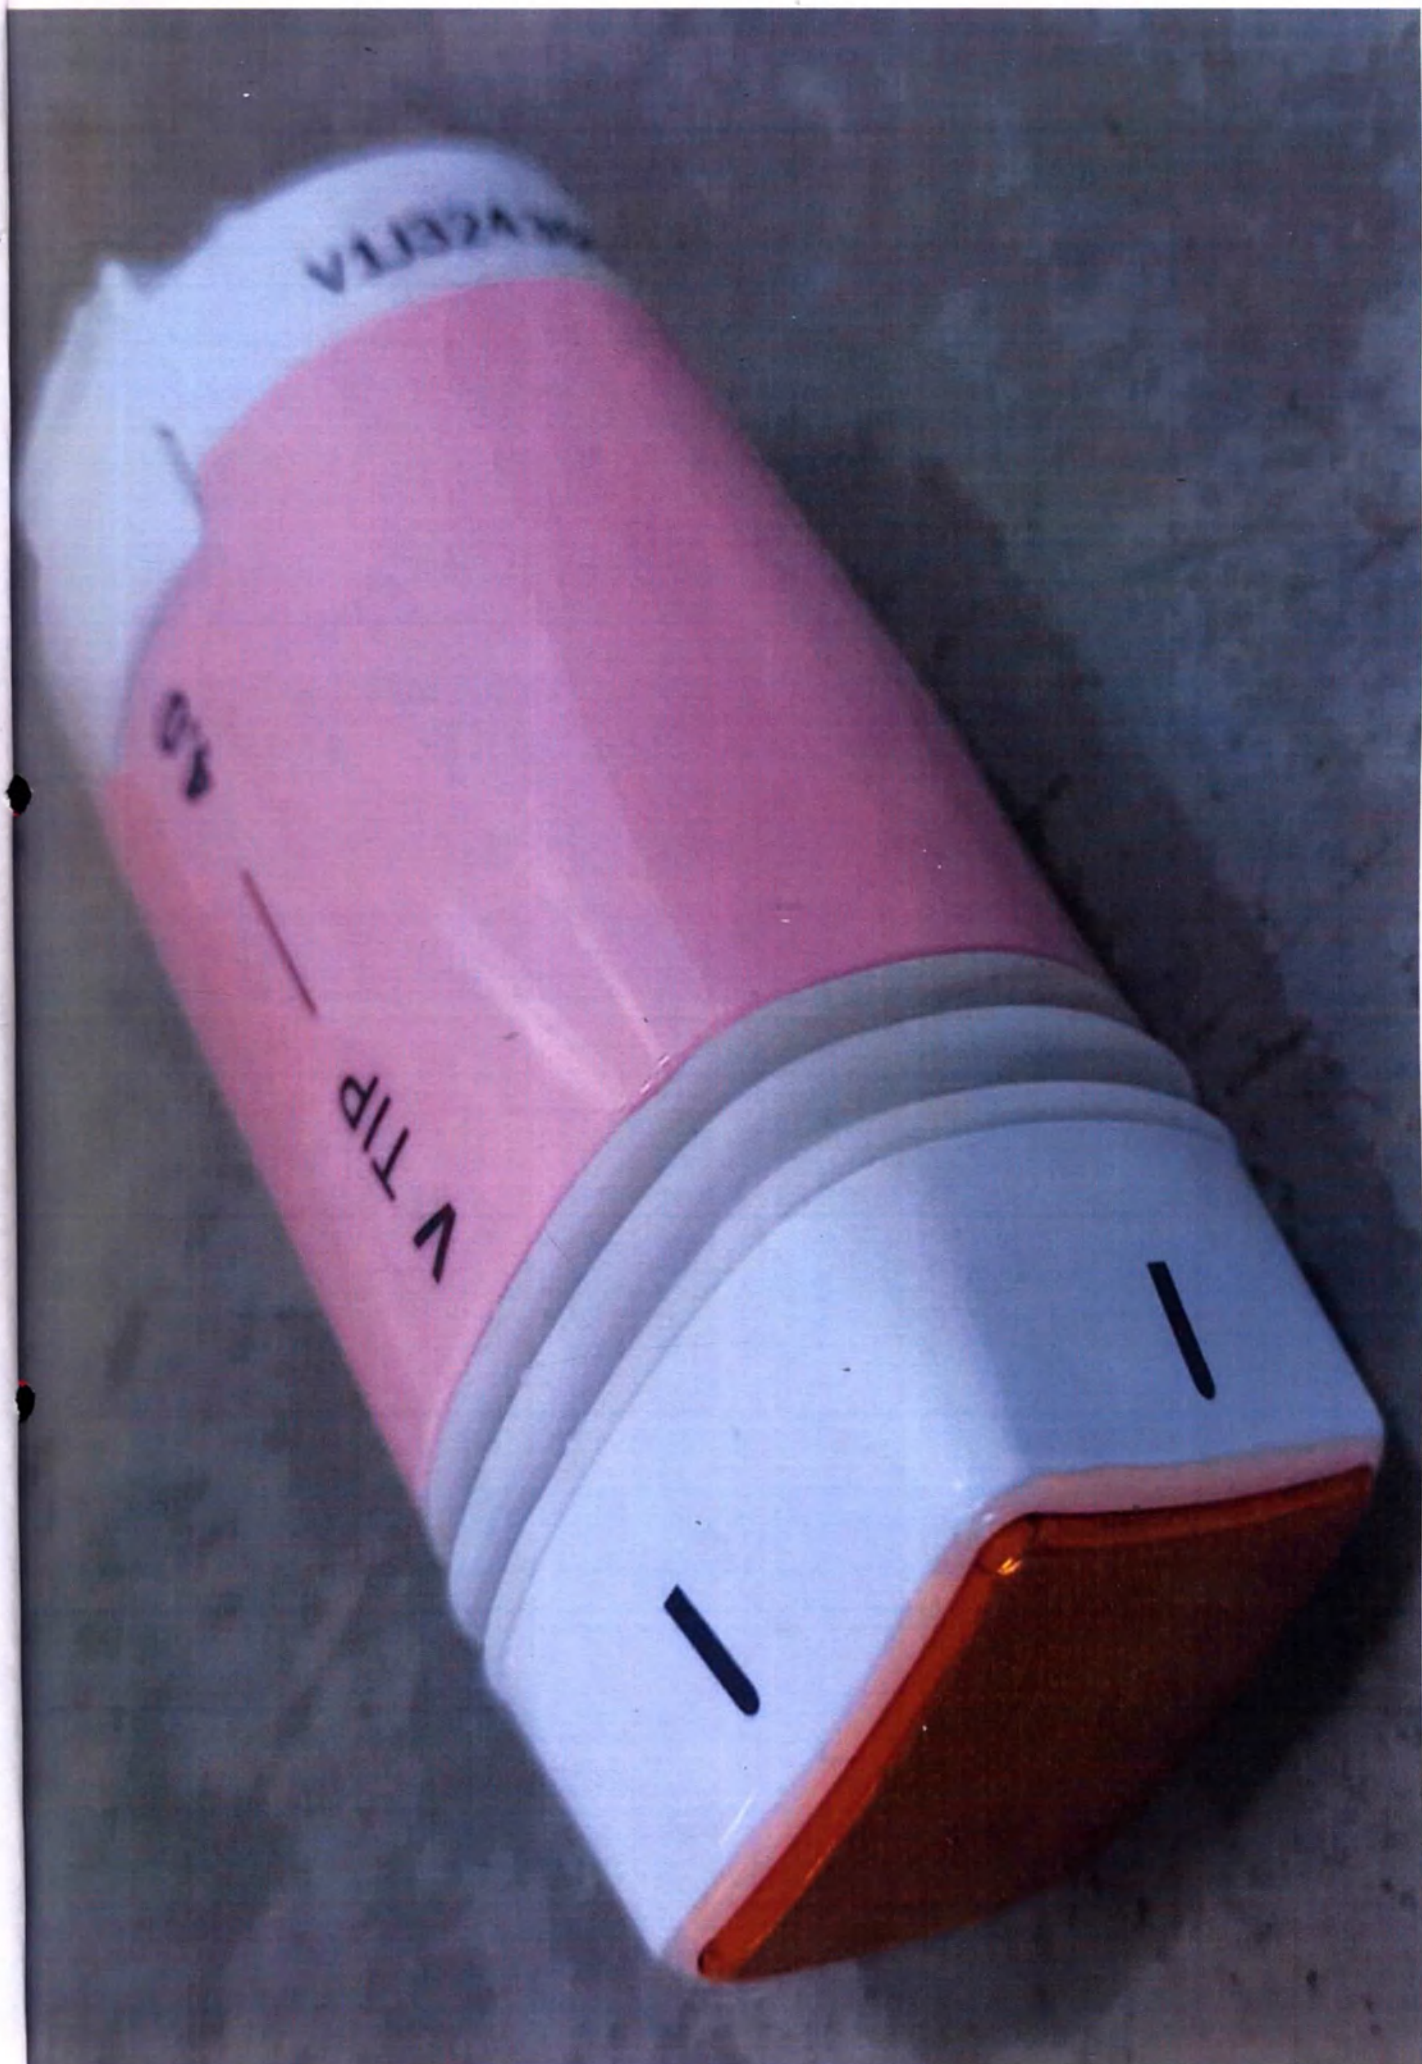







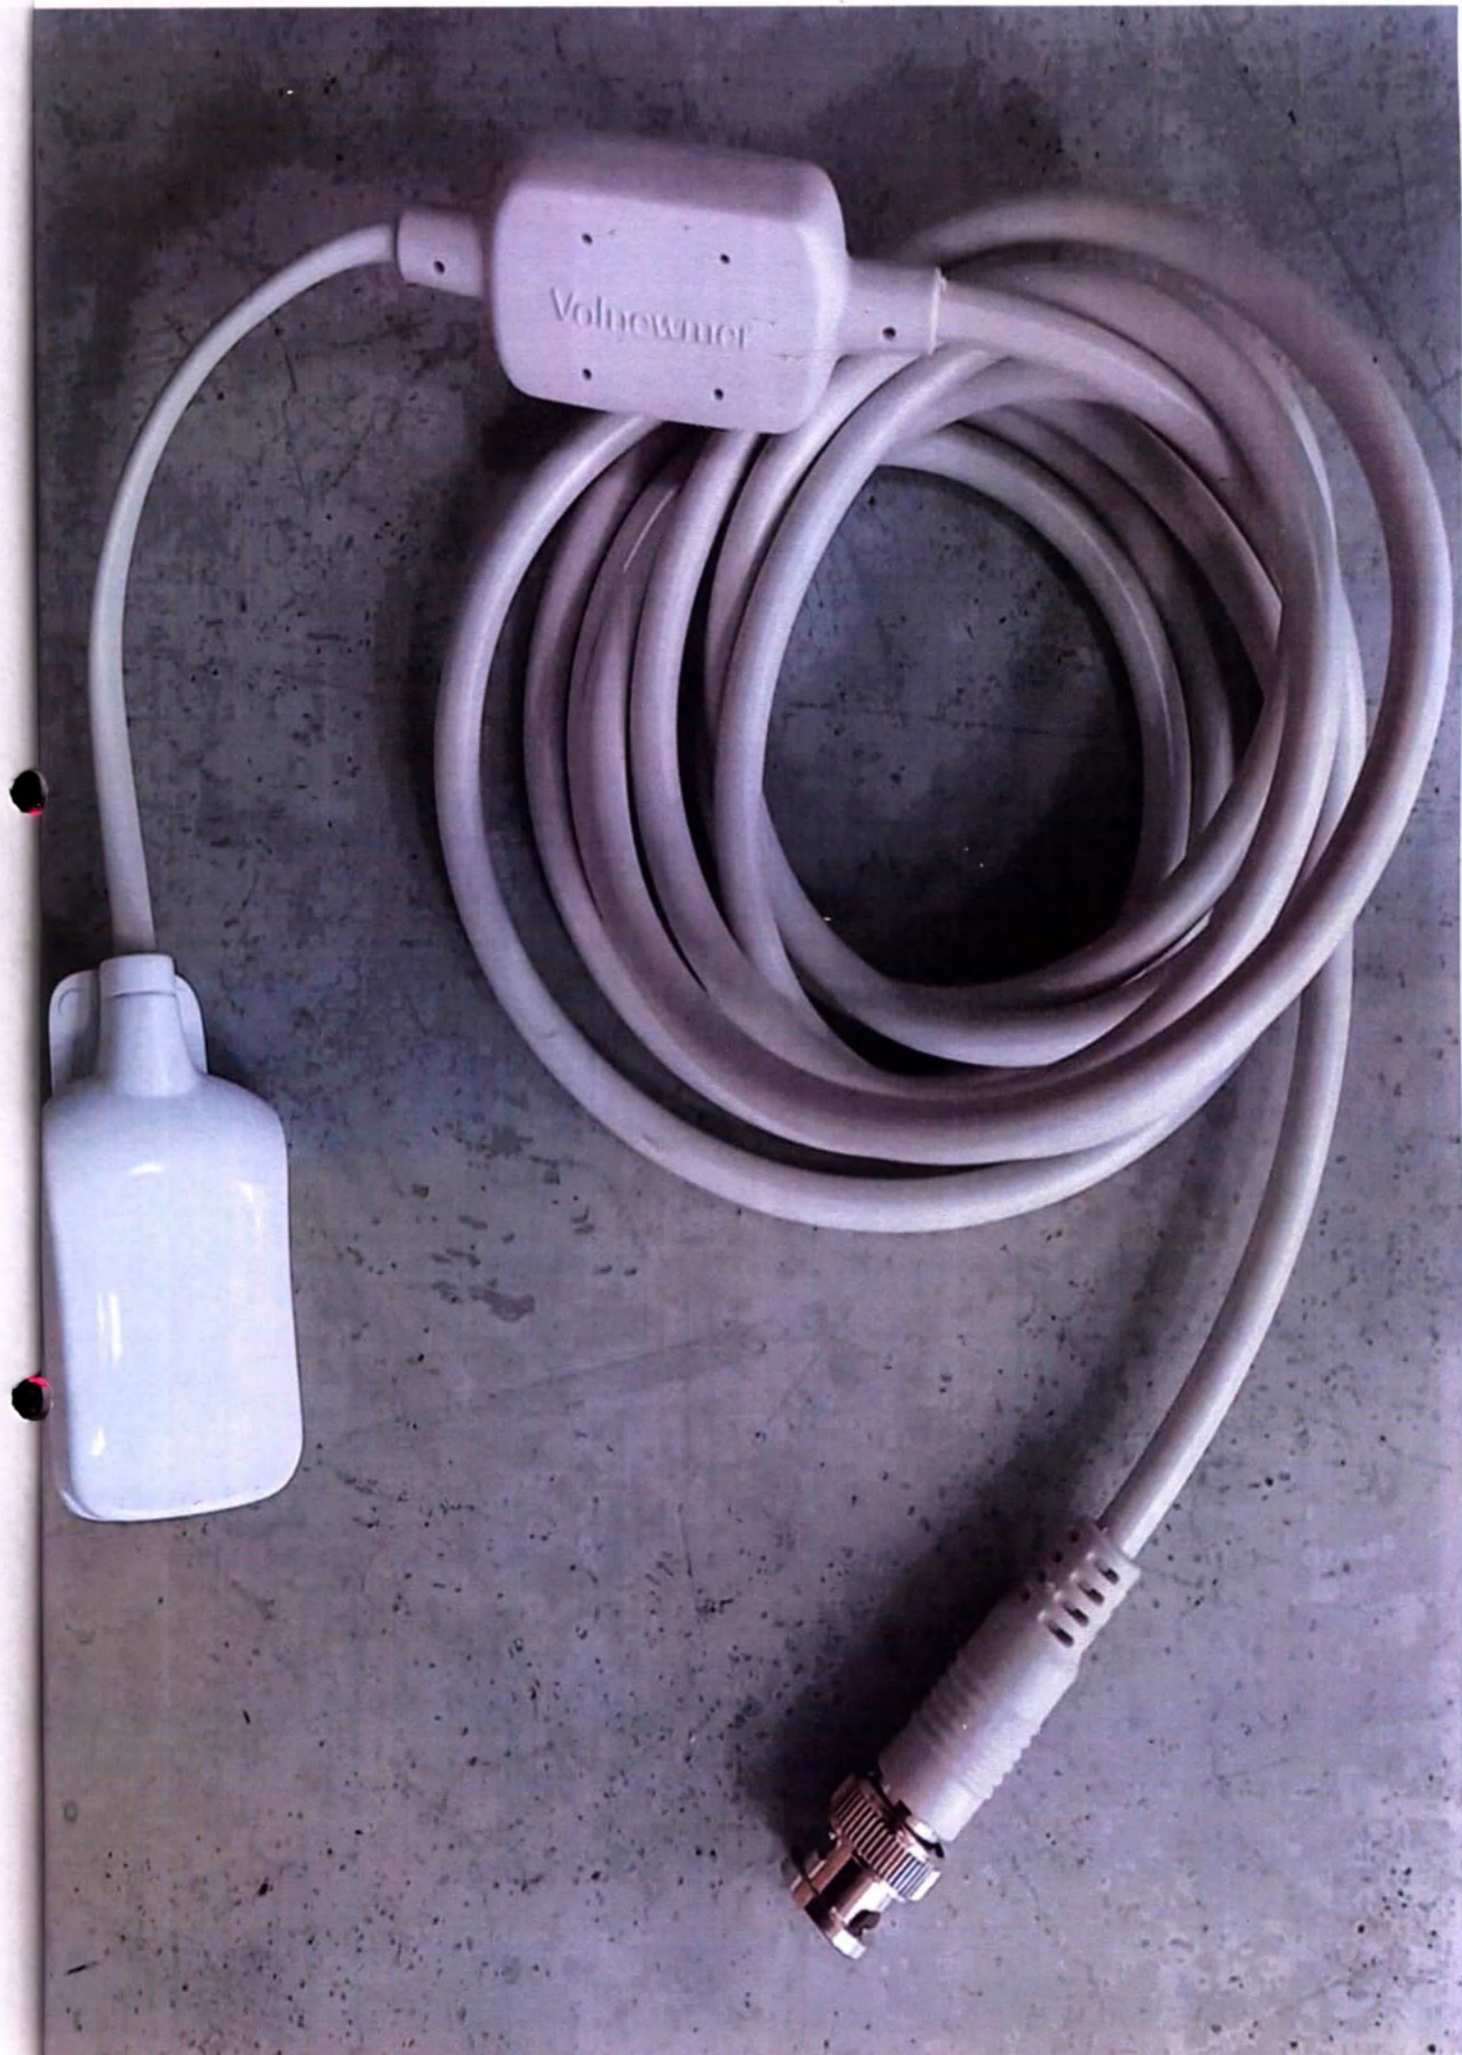




現代製薬

VOLNEWMER®

COUPLING GEL
30 ml

 **CLASSSYS**

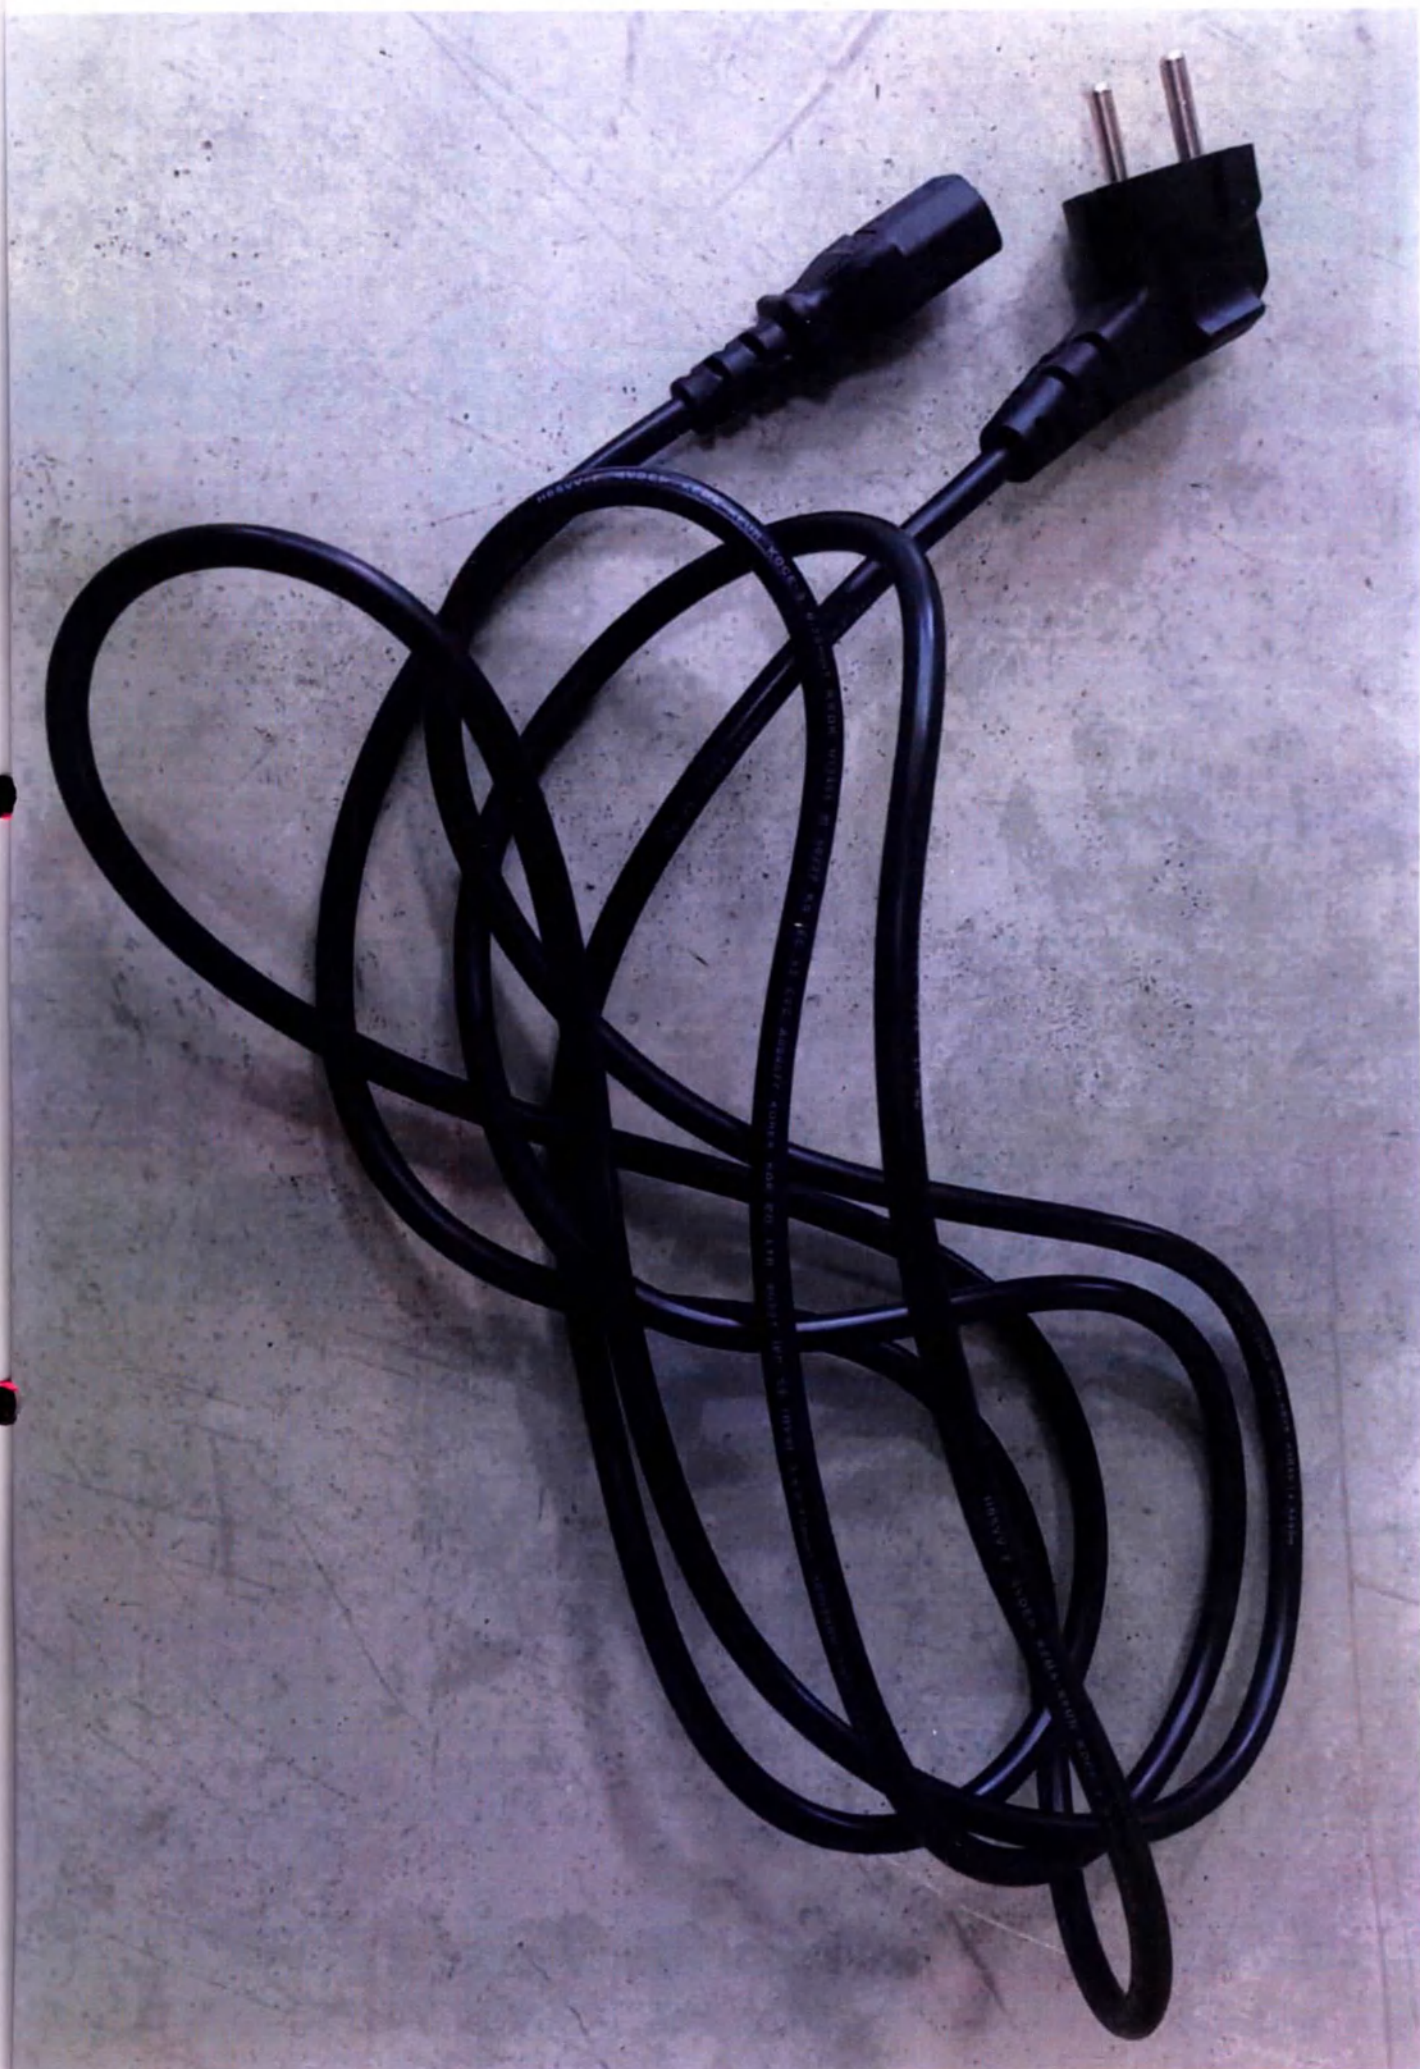


12. Кабель питания







AQUILINE® CAT. NO. 971-SWNO210
NEMA & UL ENCLOSURE TYPE 1, 4X, 6 & 6P
UL US 3A 25VAC ~ 50/60 HZ
μ ++ 1E5 IP68 **CE**
LINEMASTER SWITCH CORP.
WOODSTOCK, CT USA



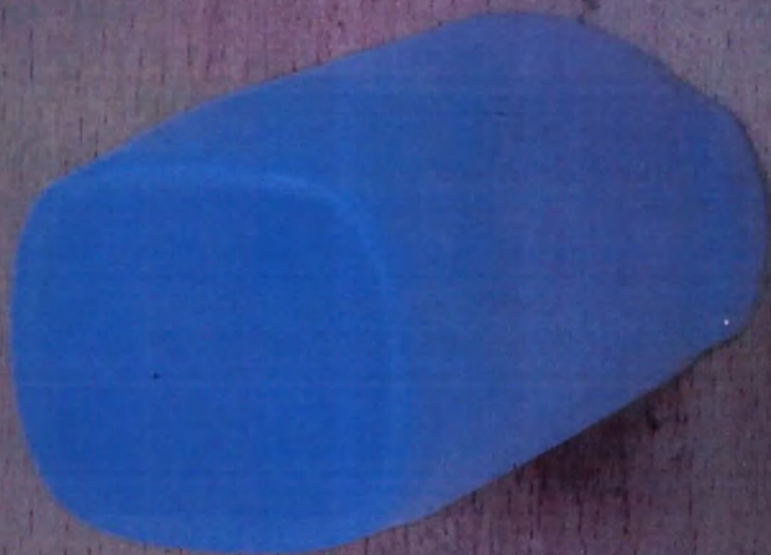

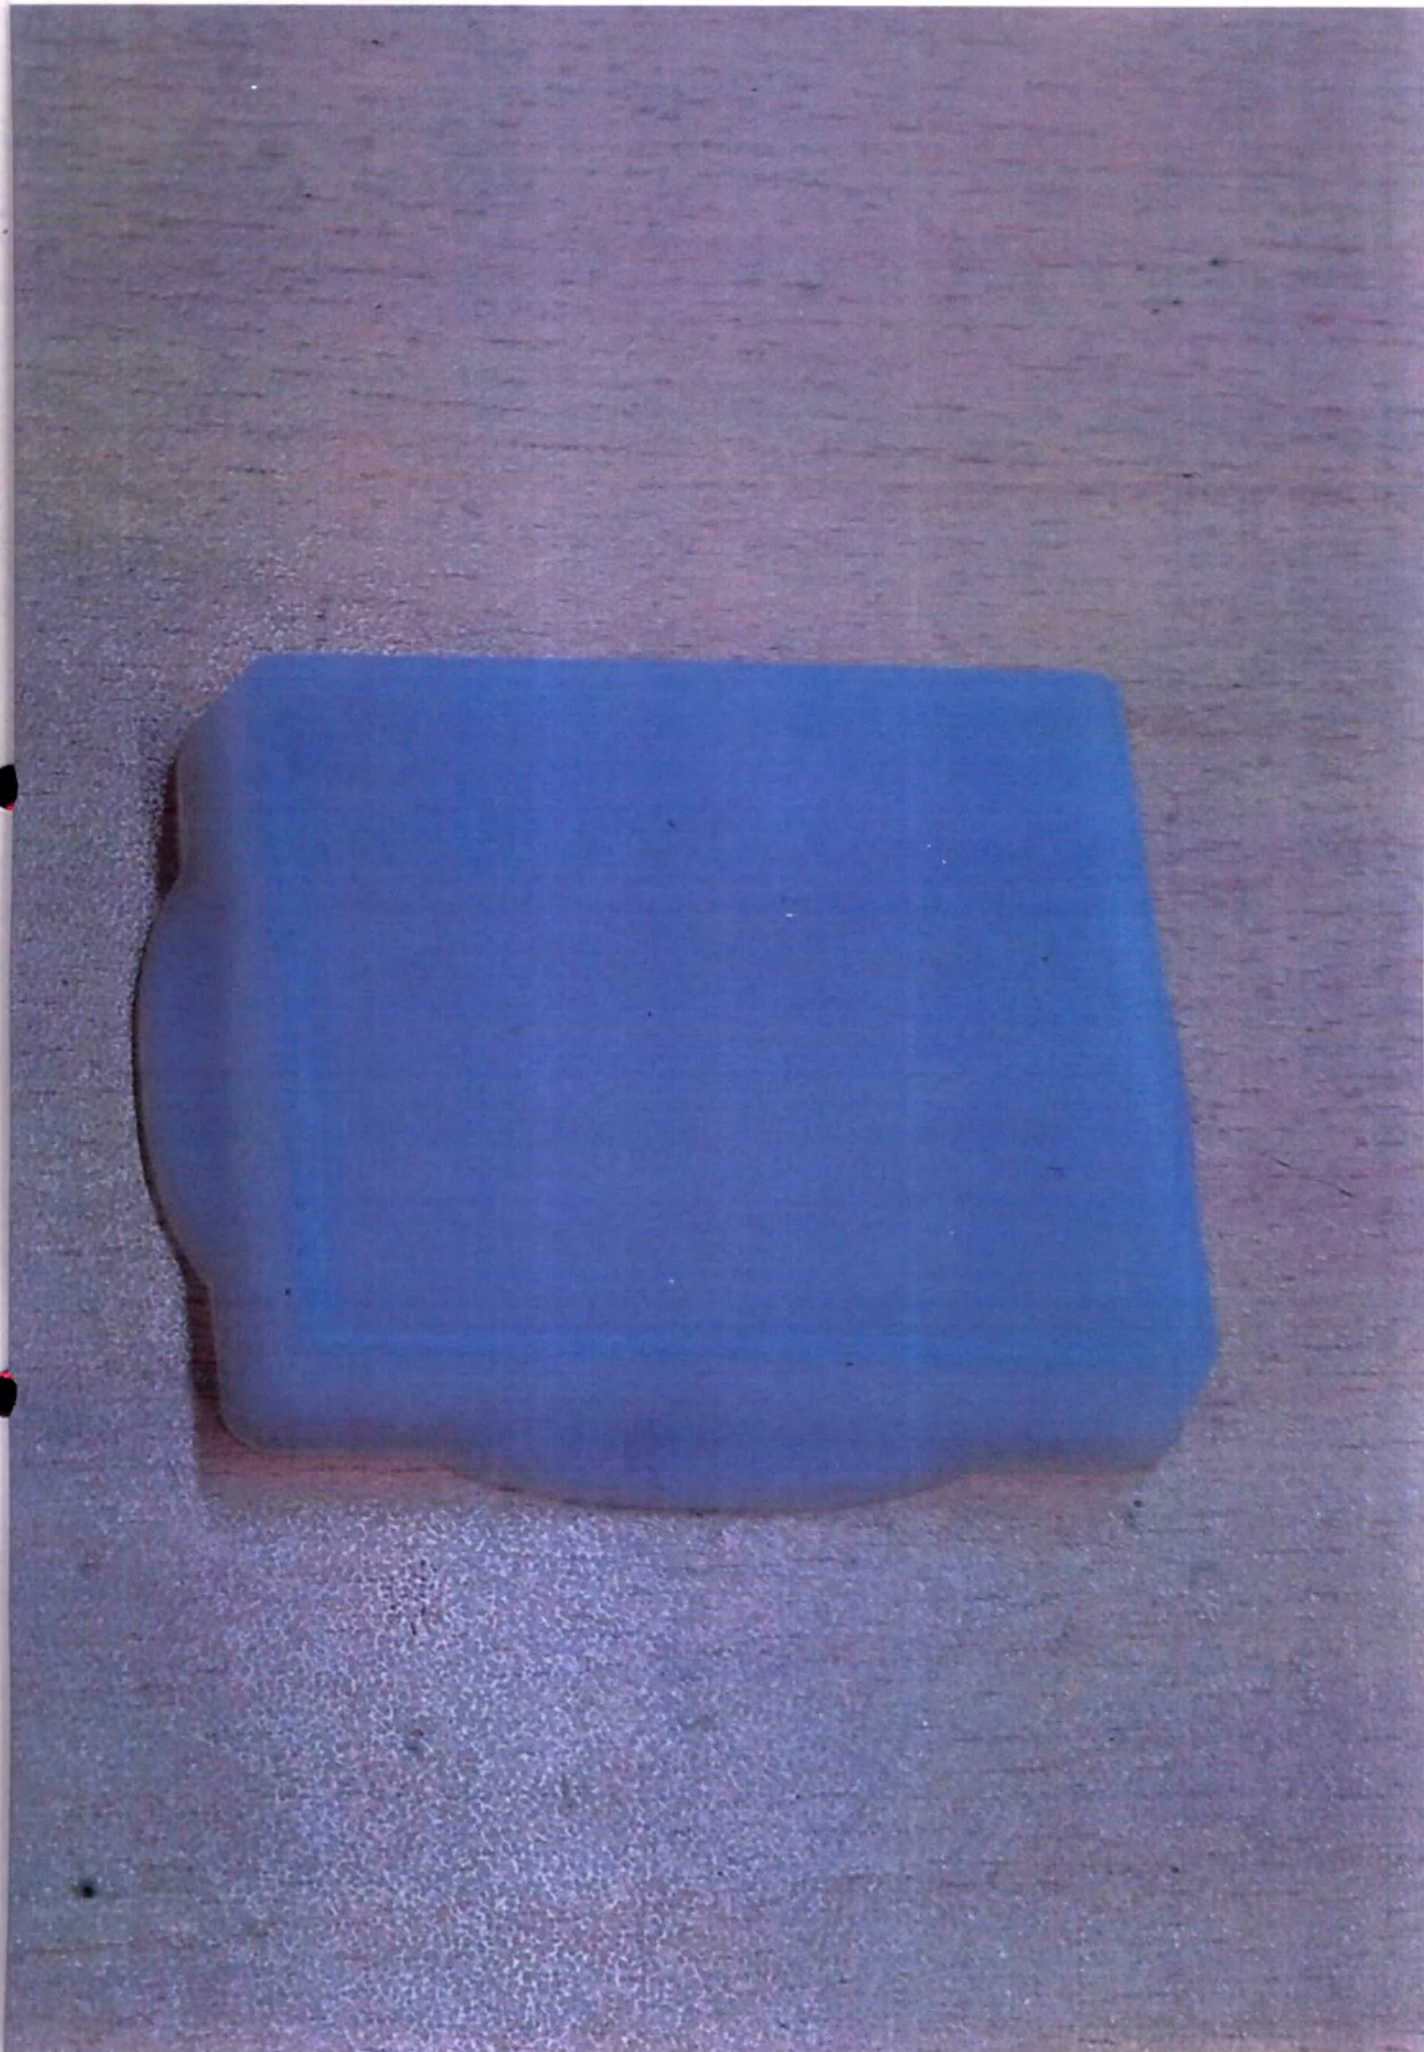



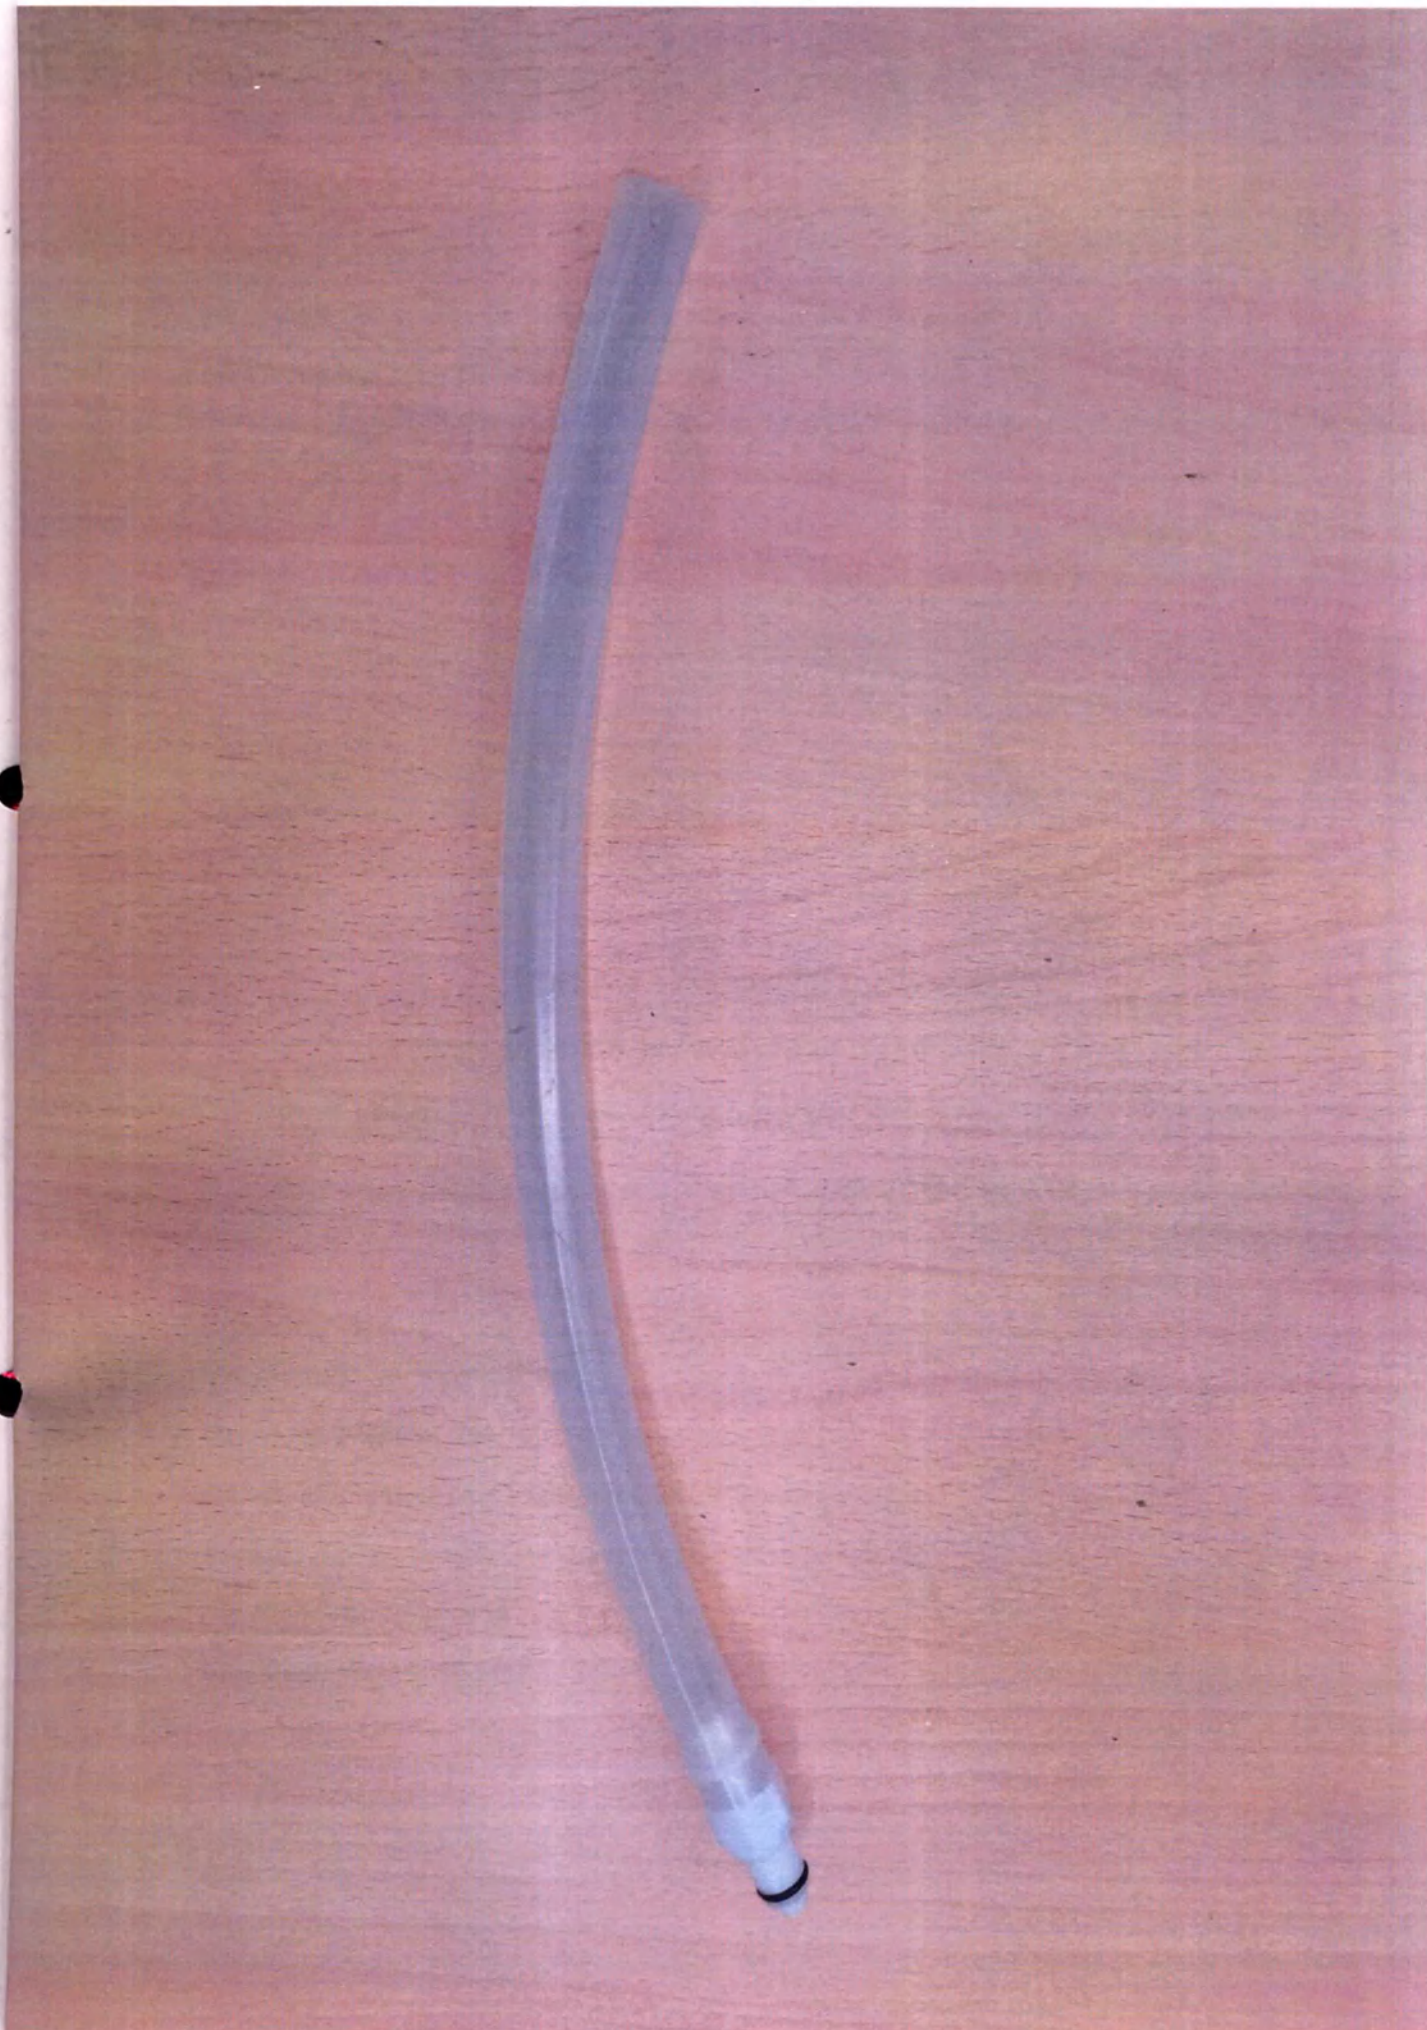


19. Приспособление для слива охлаждающего состава VOLNEWMER, производства Classys Inc.

Date: 2024.06.03

APPROVE / УТВЕРЖДАЮ


President & CEO Classys Inc. / Президент и исполнительный директор Клэссис Инк.

Baek Seung Han / Пак Сын Хан



Signature / Подпись

Stamp / Печать



Operator's manual for medical device /

Руководство по эксплуатации медицинского изделия

Radiofrequency therapeutic device VOLNEWMER, model VM1-M100 /

Аппарат радиочастотный терапевтический VOLNEWMER, модель VM1-M100

Manufacturer / Производитель

Classys Inc. / Клэссис Инк.

Classys, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea /

Клэссис, 208 Тегеран-ро, Гангнам-гу, Сеул, Республика Корея

Tel. / Тел.: +82-2-517-2114

Fax / Факс: +82-2-6008-3457

Radio-Frequency Therapeutic Equipment

VOLNEWMER

Model : VM1- M100

Rating : 220-240V~, 50/60Hz, 1200VA


Operating Frequency : 6.78MHz

Weight : 56kg



SN

CVN23D014



23.04.12



Please read operation manual carefully before use.



Classsys Inc.

Made in Korea

Head office: CLASSYS, 208, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
Factory: A-1501-1515, 15F/A-801-815, 8F/B-701-715, 7F, H Businesspark, 25,
Beobwon-ro 11-gil, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
TEL: +82-2-517-2114 **FAX:** +82-2-6008-3457

V01.1

ООО «СКИНВЕЛ»

Итого в настоящем документе

23 (двадцать три) листа(-ов)

Генеральный директор:

Ко Бум Сук _____

МП

