

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Здоровье»



В.А. Курбатов

«26» апреля 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОЗИТНЫЙ
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ BISICO ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ ЗУБОВ**

**производства компании Бисико Билефельдер Денталсиликон
ГмбХ&Ко.КГ (Bisico Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co.KG), Германия**

2024

Bisico Bulk Fill

Farbe: Universal Dentin

Bulk Fill Composite

Inhalt:
2 Spritzen à 2 g
10 Purple Tips



- 1 - Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Bulk Fill в шприце 2 г (1,02 мл).
- 2 - Канюля интраоральная черного цвета.
- 3 - Инструкция краткая по применению материала стоматологического жидкотекучего реставрационного Bisico Bulk Fill.
- 4 - Потребительская упаковка.

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Bulk Fill в шприце. Общий вид.



Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Bulk Fill в капсуле. Общий вид.

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический нанокompозитный реставрационный универсальный Bisico Nanofill n. Общий вид.

1 - Материал стоматологический нанокompозитный реставрационный универсальный Bisico Nanofill n оттенок A1 в шприце 4 г (1,92 мл).

2 - Шкала цветовая.

3 - Инструкция краткая по применению материала стоматологического нанокompозитного реставрационного универсального Bisico Nanofill n.

4 - Потребительская упаковка (пластиковый тубус).




Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico Nanofill unique в шприце. Общий вид.

1 - Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico Nanofill unique в шприце 4 г (1,92 мл).

2 - Инструкция краткая по применению Материала стоматологического композитного светоотверждаемого Bisico Nanofill unique.

3 - Потребительская упаковка (пластиковый тубус).

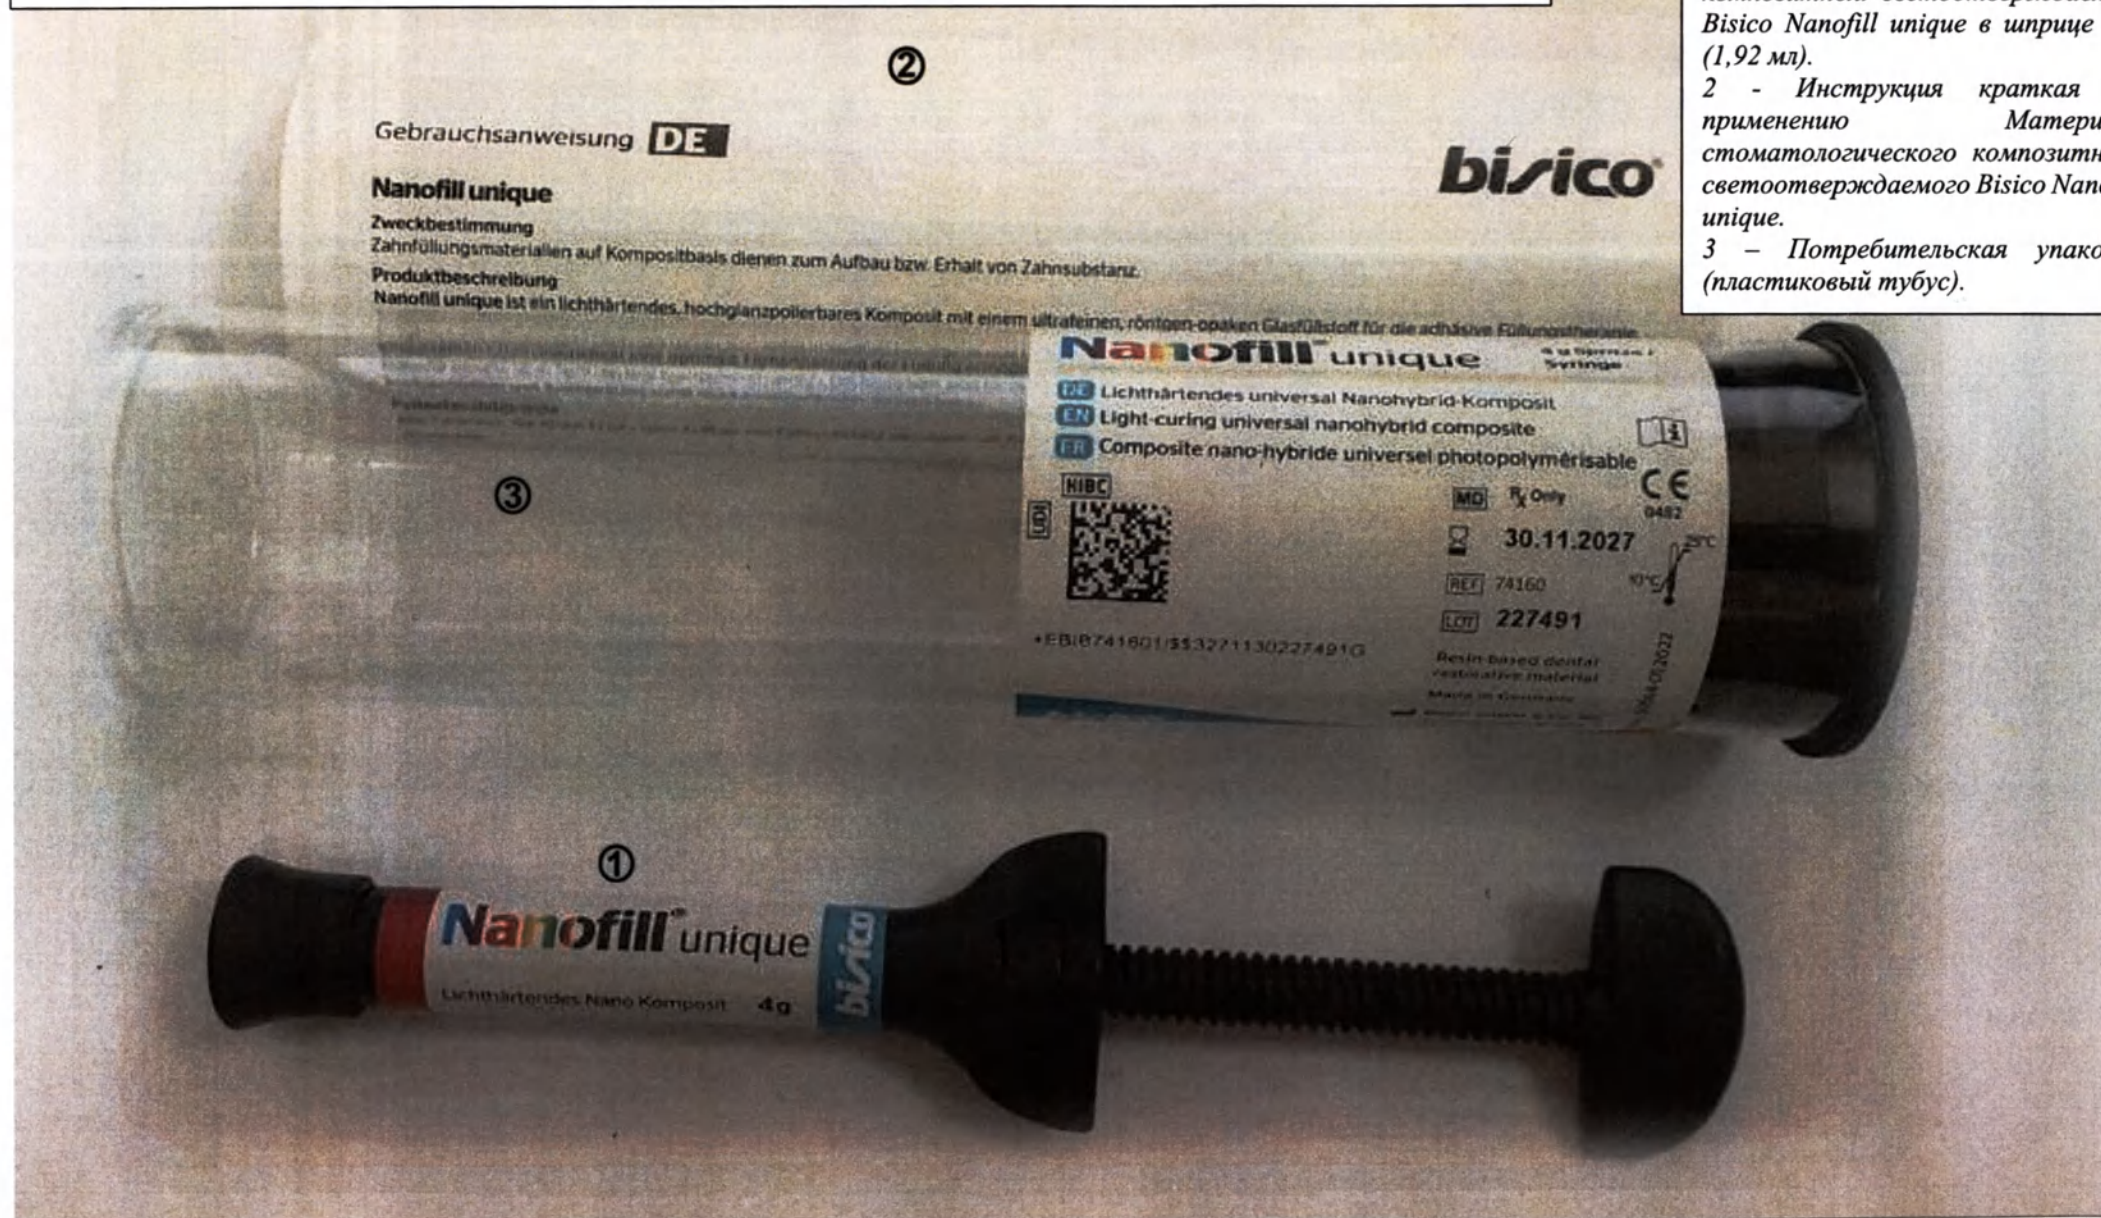

Nanofill[®] unique

20 x 0,3 g
Capsules

DE Lichthärtendes universal Nanohybrid-Komposit
EN Light-curing universal nanohybrid composite
FR Composite nano-hybride universel photopolymérisable

R_xonly MD

CE
0482

UDI

REF 74161



01.2030

25°C
10°C

LOT 231024



Resin-based dental
restorative material

Made in Germany

Bisico GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße 3
D-33611 Bielefeld

53580-02-2022



HIBC

+EBIB741611/\$\$0130231024Y

bisico

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico Nanofill unique в капсуле. Общий вид.

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Nanofill flow в шприце. Общий вид.



- 1 - Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Nanofill flow оттенок A2 в шприце 2 г (1,19 мл).
- 2 - Канюля интраоральная черного цвета.
- 3 - Инструкция краткая по применению материала стоматологического жидкотекучего реставрационного Bisico Nanofill flow.
4. Потребительская упаковка.

2 - Инструкция краткая по применению
материала стоматологического
композитного микрогибридного
реставрационного Bisico Micro Esthetic

3 - Потребительская упаковка
(пластиковый тубус)

1 - Материал стоматологический композитный микрогибридный
реставрационный Bisico Micro Esthetic оттенок: A2
в шприце 5 г (2,63 мл)

Материал стоматологический композитный
светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов,
вариант исполнения: Материал стоматологический
композитный микрогибридный реставрационный Bisico
Micro Esthetic в шприце. Общий вид.

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический композитный микрогибридный реставрационный Bisico Micro Esthetic в капсуле. Общий вид.

①



②




③




- 1 Материал стоматологический композитный микрогибридный реставрационный Bisico Micro Esthetic оттенок A1, в капсуле 0,3 г (0,15 мл).
- 2 - Инструкция краткая по применению материала стоматологического композитного микрогибридного реставрационного Bisico Micro Esthetic.
- 3 – Потребительская упаковка (пластиковая коробка).

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetic flow-viscous. Общий вид.

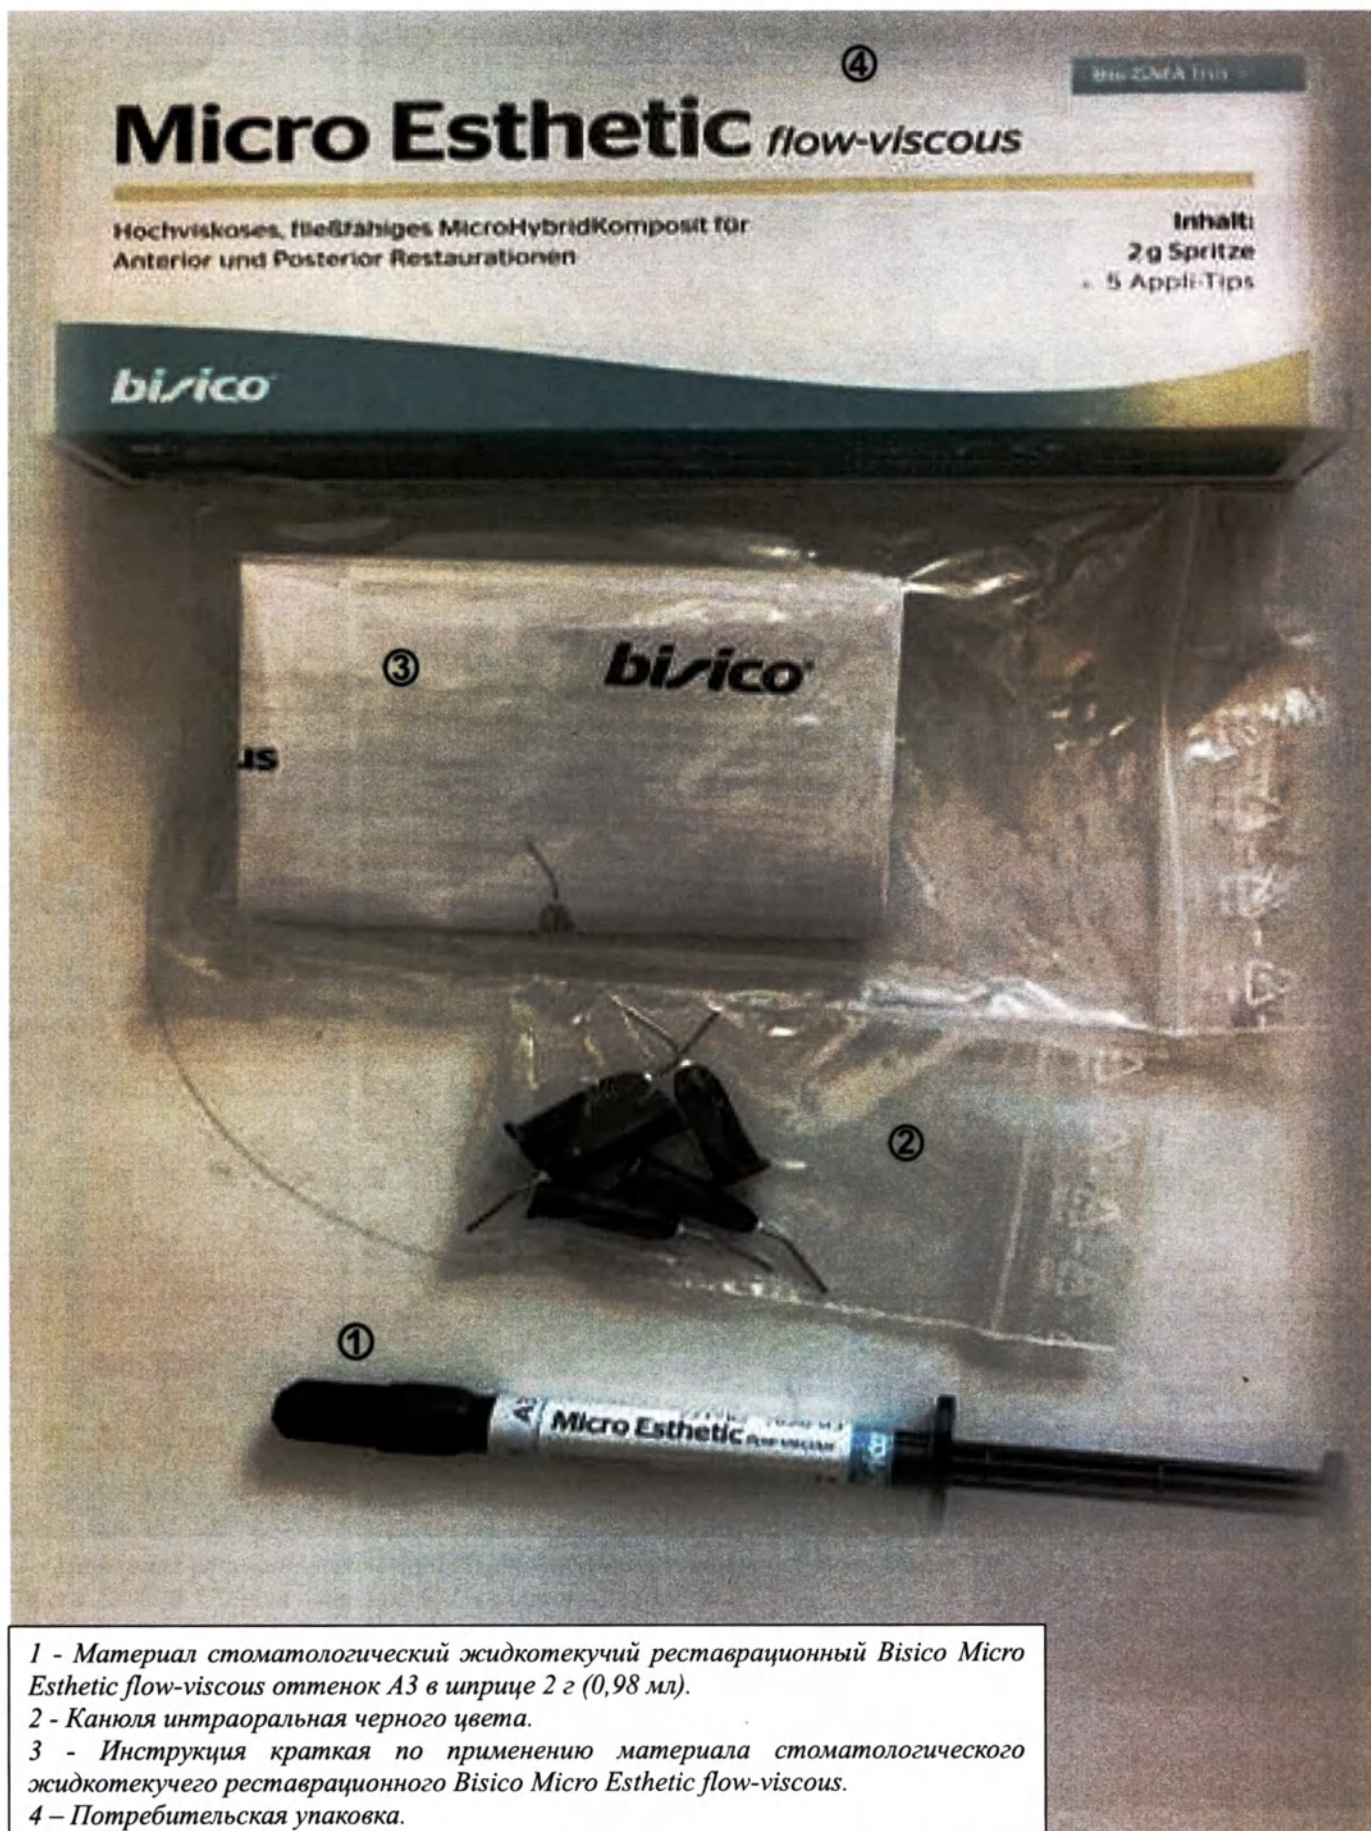


- 1 - Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetic flow-viscous оттенок A3 в шприце 2 г (0,98 мл).
- 2 - Канюля интраоральная черного цвета.
- 3 - Инструкция краткая по применению материала стоматологического жидкотекучего реставрационного Bisico Micro Esthetic flow-viscous.
- 4 - Потребительская упаковка.

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов, вариант исполнения: Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetik Gingiva. Общий вид.

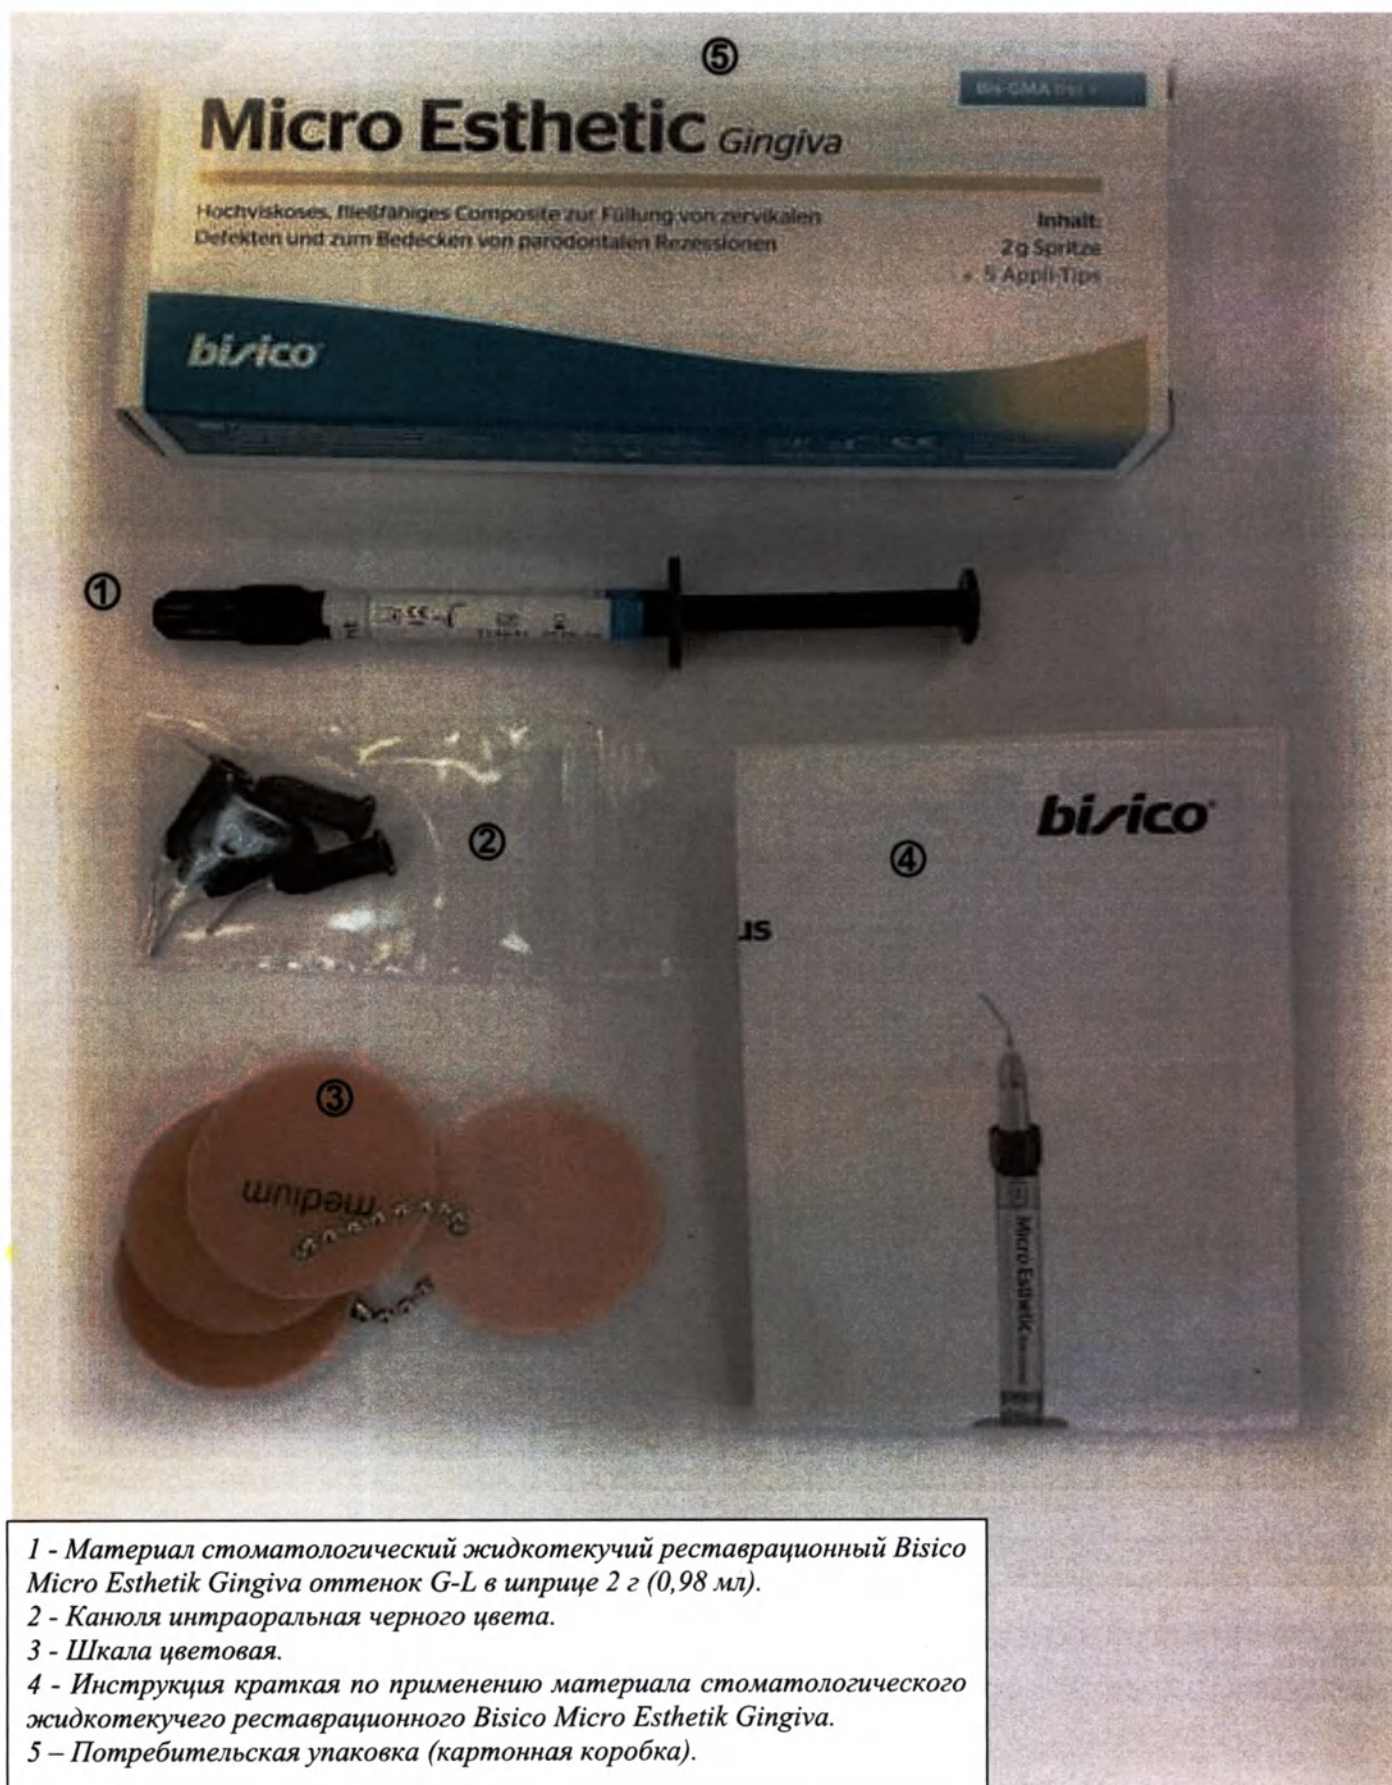




- 1 - Адгезив стоматологический Bisico Bond LC во флаконе 5 мл.
- 2 - Кисточка аппликационная однократного применения (soft, белая).
- 3 - Кисточка аппликационная однократного применения (красная).
- 4 - Ручка-держатель кисточек аппликационных однократного применения.
- 5 - Палетка для смешивания 6-ти секционная.
- 6 - Инструкция краткая по применению адгезива стоматологического Bisico Bond LC.
- 7 - Потребительская упаковка.

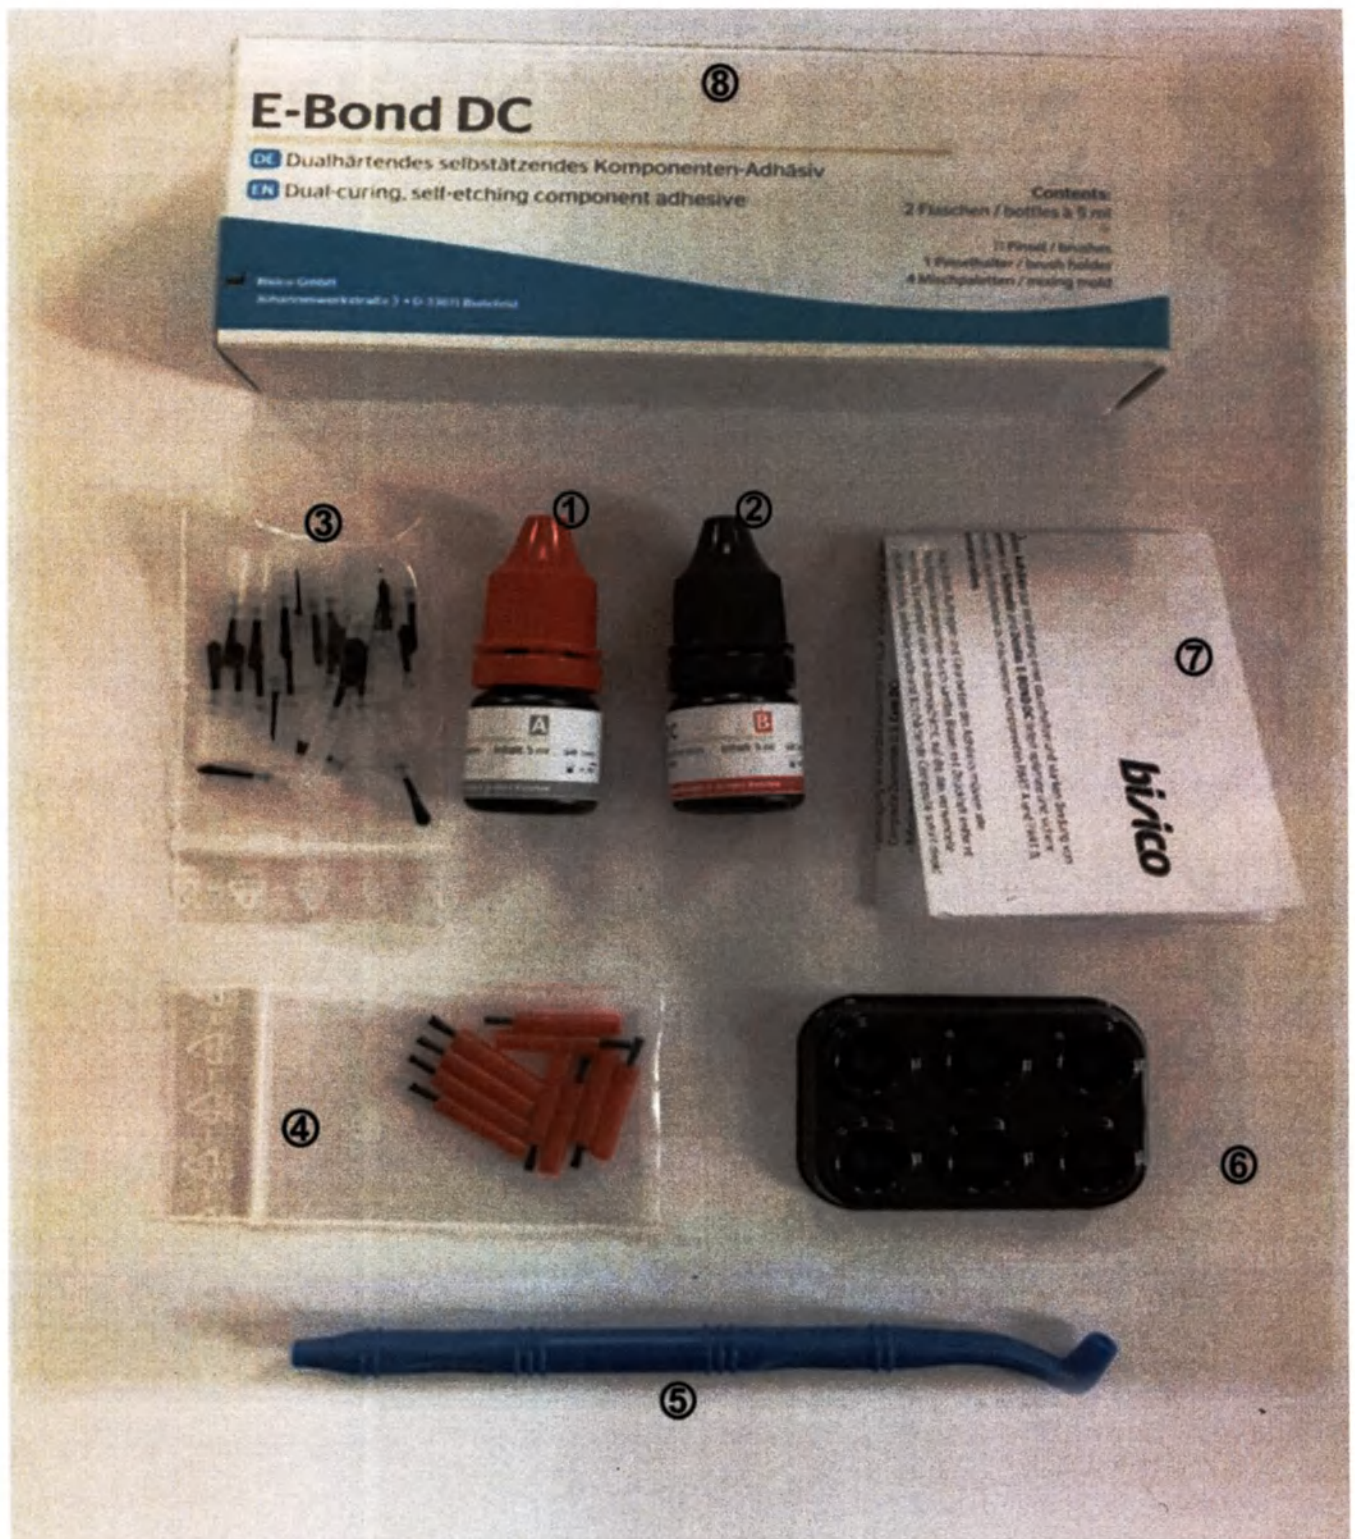

- 1 - Компонент А во флаконе 5 мл.
- 2 - Компонент В во флаконе 5 мл.
- 3 - Кисточка аппликационная однократного применения (soft, белая).
- 4 - Кисточка аппликационная однократного применения (красная).
- 5 - Ручка-держатель кисточек аппликационных однократного применения.
- 6 - Палетка для смешивания 6-ти секционная.
- 7 - Инструкция краткая по применению адгезива стоматологического Bisico E-Bond DC.
- 8 - Потребительская упаковка.

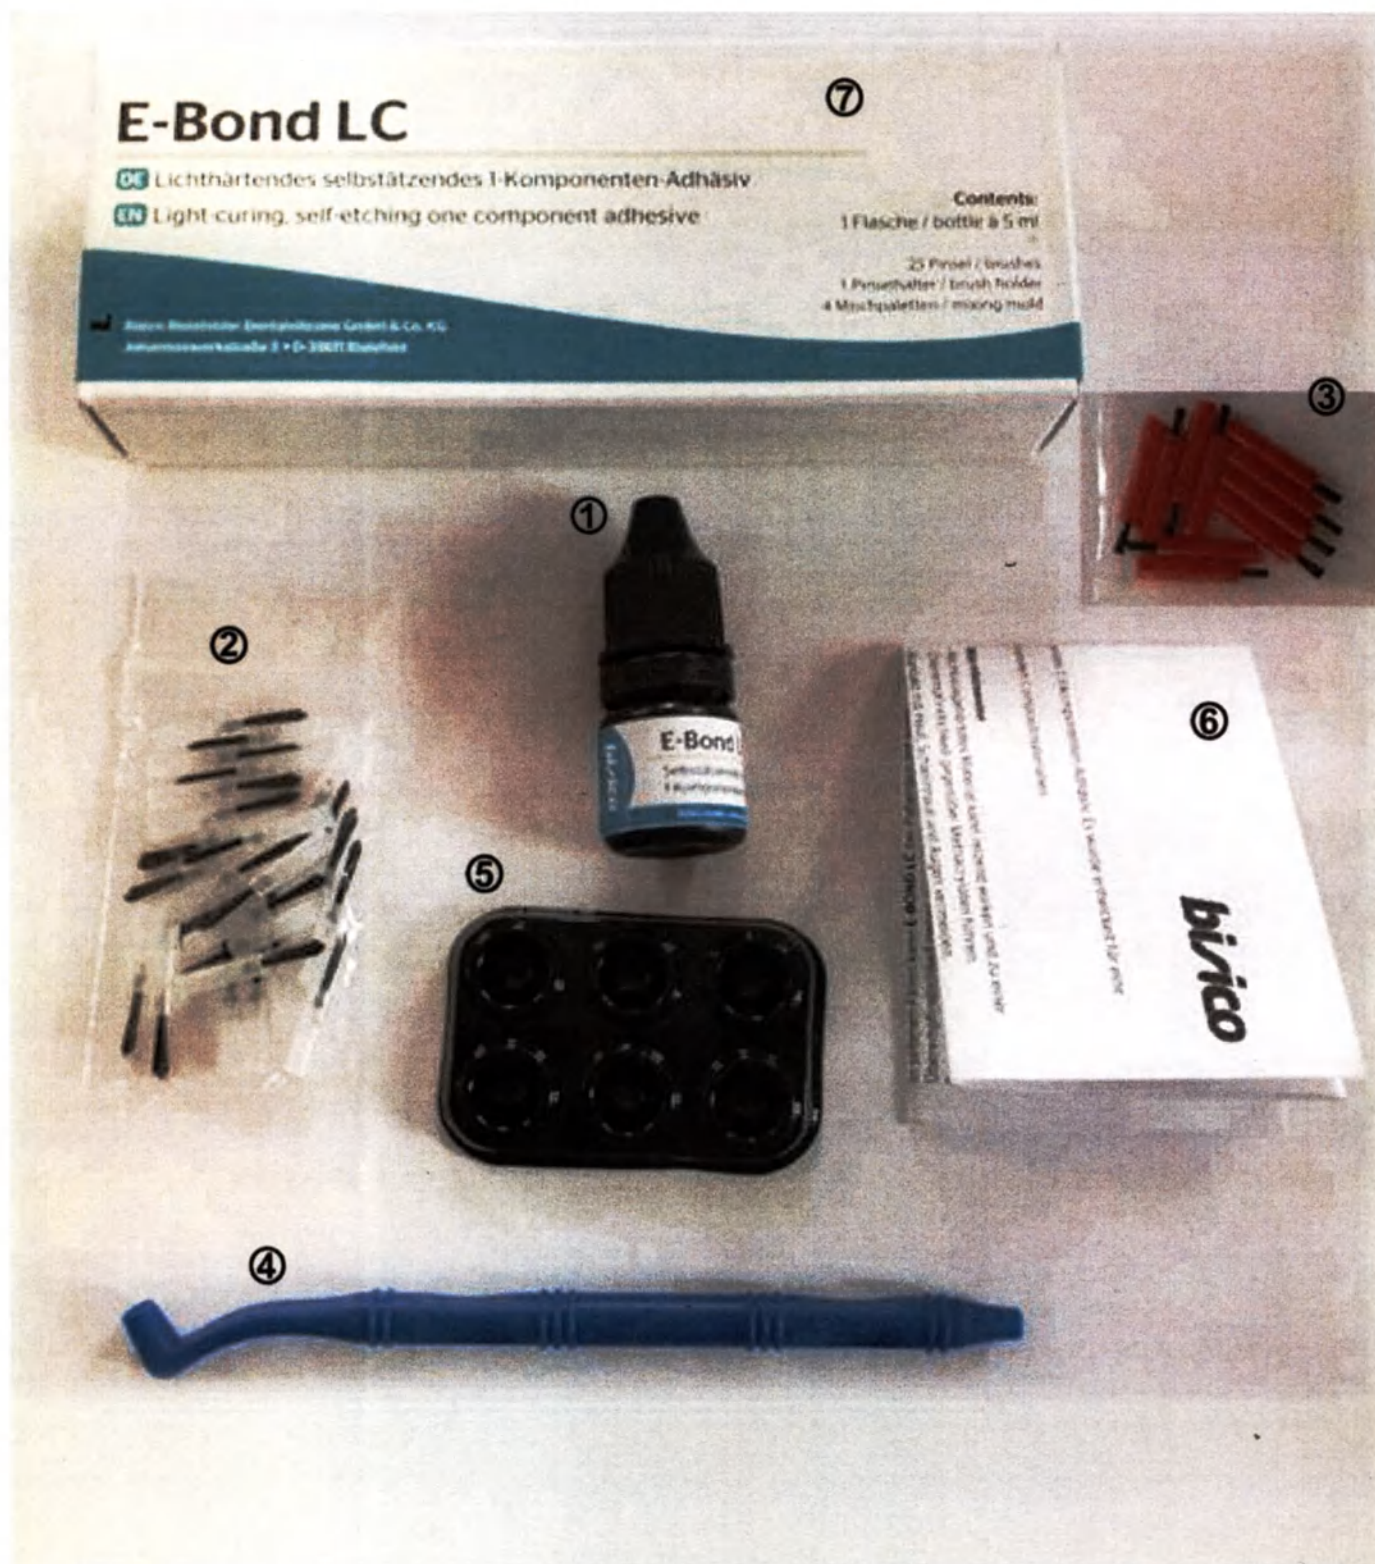

- 1 - Адгезив стоматологический Bisico E-Bond LC во флаконе 5 мл.
- 2 - Кисточка аппликационная однократного применения (soft, белая).
- 3 - Кисточка аппликационная однократного применения (красная).
- 4 - Ручка-держатель кисточек аппликационных однократного применения.
- 5 - Палетка для смешивания 6-ти секционная.
- 6 - Инструкция краткая по применению адгезива стоматологического Bisico E-Bond LC.
- 7 - Потребительская упаковка.

Гель протравочный Bisico Best Etch. Общий вид.



- 1 - Гель протравочный Bisico Best Etch в шприце 2 мл.
- 2 - Канюля интраоральная светло-голубого цвета.
- 3 - Инструкция краткая по применению геля протравочного Bisico Best Etch.
- 4 - Потребительская упаковка.



Вид 1.




Вид 2.

Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Bulk Fill. Потребительская упаковка шприца.



Вид 1.

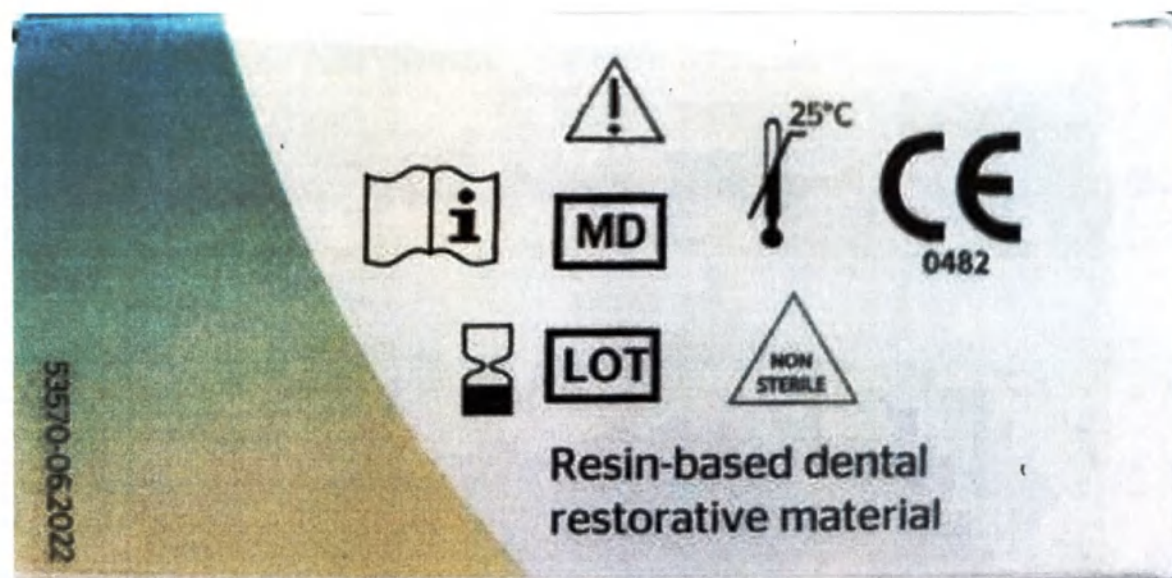


Вид 2.


Материал стоматологический жидкотекучий реставрационного Bisico Nanofill flow. Потребительская упаковка шприца.



Вид 1.

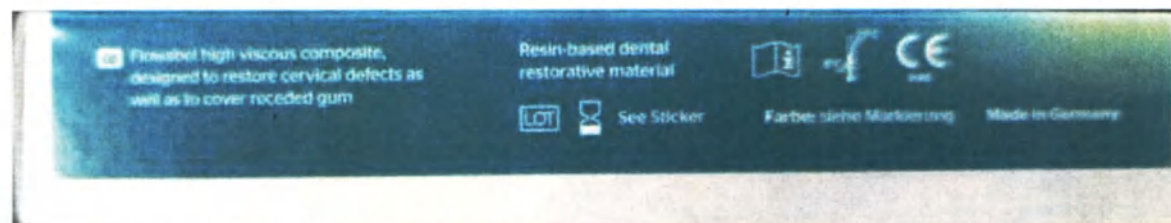

Вид 2.

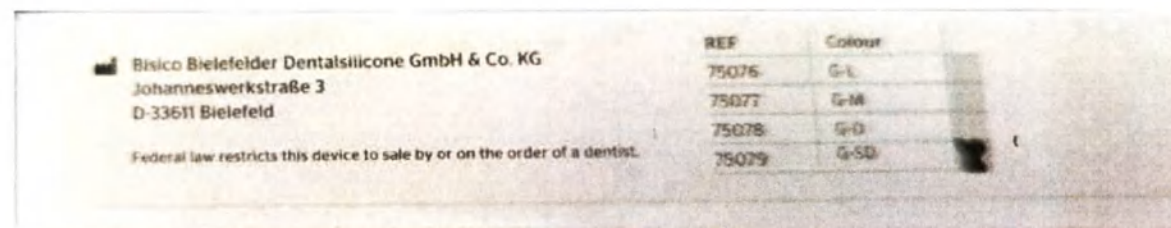


Вид 3.


Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetik Gingiva. Потребительская упаковка шприца.

Пример маркировочного стикера на потребительской упаковке, варианты исполнения:
Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Bulk Fill, Материал
стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Nanofill flow, Материал стоматологический
жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetic flow-viscous,
Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetik Gingiva, а также на
потребительских упаковках следующих компонентов: Адгезив стоматологический Bisico Bond LC,
Адгезив стоматологический Bisico E-Bond DC, Адгезив стоматологический Bisico E-Bond LC



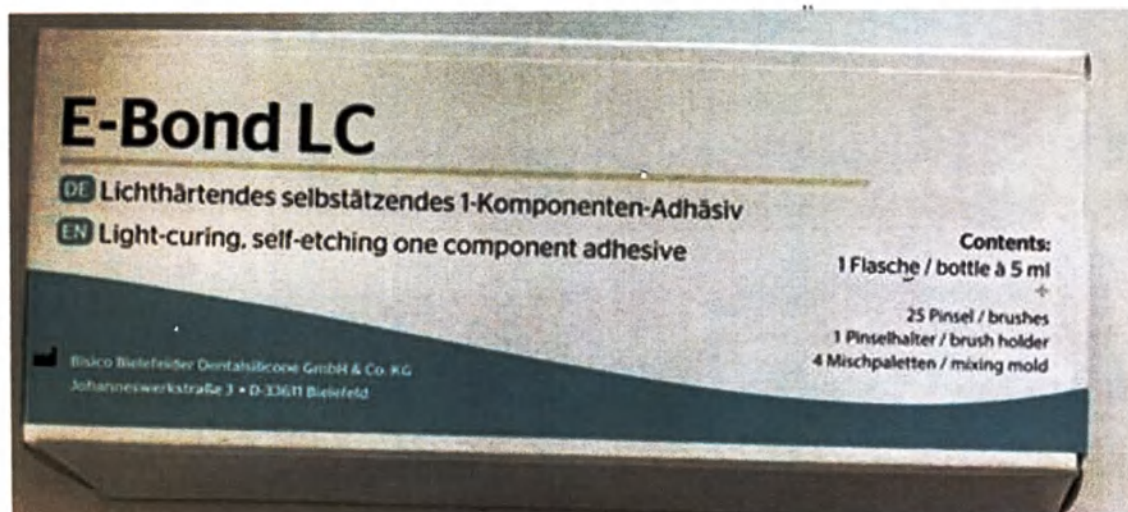

Вид 1.

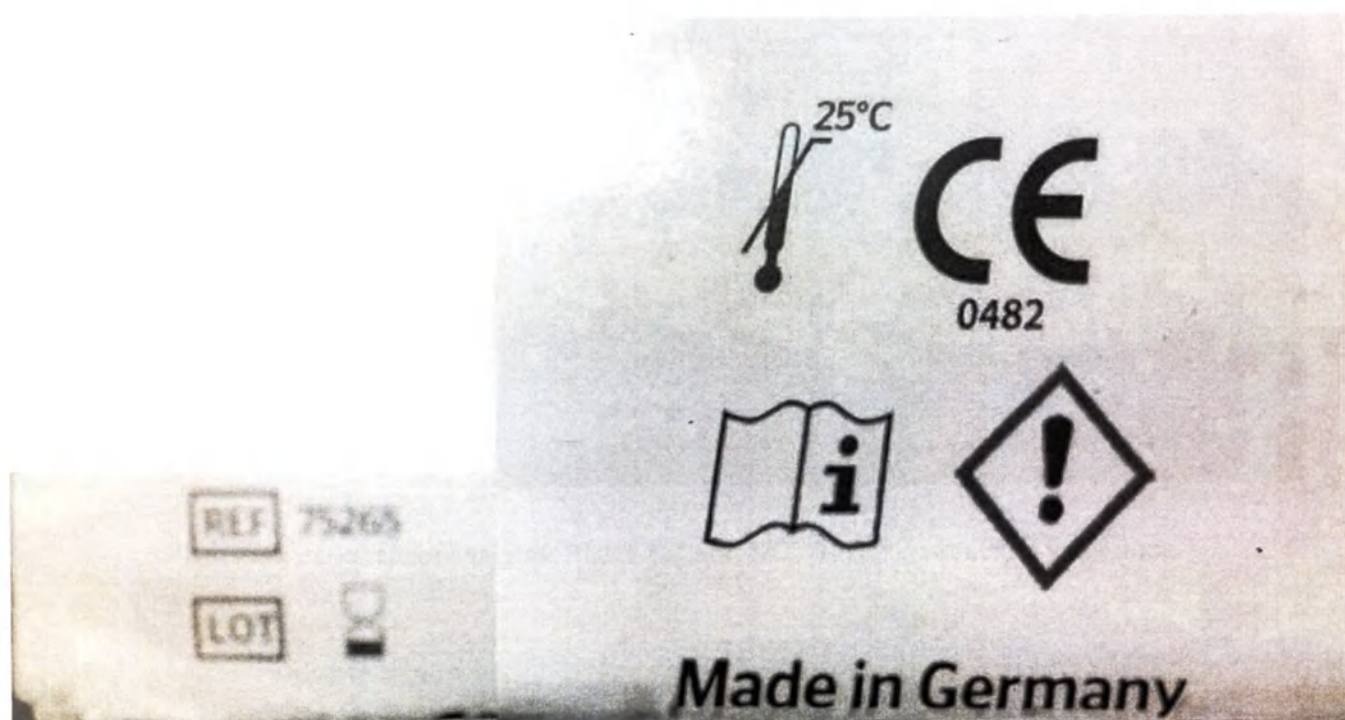

Вид 2.

Вид 3.

Адгезив стоматологический Bisico Bond LC. Потребительская упаковка.

E-Bond DC

DE Dualhärtendes selbstätzendes Komponenten-Adhäsiv

EN Dual-curing, self-etching component adhesive

Contents:

2 Flaschen / bottles à 5 ml



25 Pinsel / brushes

1 Pinselhalter / brush holder

4 Mischpaletten / mixing mold

Bisico GmbH

Johannessenwerkstraße 3 • D-33611 Bielefeld



Адгезив стоматологический Bisico E-Bond DC. Потребительская упаковка.

Адгезив стоматологический Bisico E-Bond LC. Потребительская упаковка.



Гель протравочный Bisico Best Etch. Потребительская упаковка.



Дозатора Compro-Ject. Общий вид.





Маркировка на корпусе Дозатора Compo-Ject

bisico®

Chargenstempel

Product Name

REF

Inhalt:

Bruttogewicht:

CE Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co.KG
Johanneswerkstr. 3, D- 33611 Bielefeld

Макет маркировочной этикетки на групповой (транспортной) упаковке на английском языке

Пакетная марка	
bisico®	
Наименование медицинского изделия	
REF	
Состав:	
Масса брутто:	
CE Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG Johanneswerkstr. 3, 33611, Bielefeld, Germany, Германия	

Макет маркировочной этикетки на групповой (транспортной) упаковке на русском языке

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Bulk Fill

Артикул: XXXXXX¹

Комплектность: См. Эксплуатационную документацию –
«Инструкция краткая по применению материала
стоматологического жидкотекучего
реставрационного Bisico Bulk Fill»

РУ № _____ **от «** _____ **»** _____ **г.**

Срок годности 4 года

Рекомендуемые условия хранения Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс 25°С

Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ

(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

1. В данной строке будет указан один из следующих артикулов: 75052, 75054

Макет дополнительной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Bulk Fill.

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Материал стоматологический нанокомпозитный реставрационный универсальный Bisico Nanofill n

Артикул: XXXXXX¹

Цвет: XX²

Комплектность: См. Эксплуатационную документацию – «Инструкция краткая по применению материала стоматологического нанокомпозитного реставрационного универсального Bisico Nanofill n»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 3 года

Рекомендуемые Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс 25°С

условия хранения Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ

(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

1. В данной строке будет указан один из следующих артикулов: 74080, 74000, 74010, 74020, 74090, 74100, 74030, 74110, 74040, 74050, 74140, 74150, 74160.

2. В данной строке будет указано одно из следующих обозначений цветовых оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C (прозрачный), EW, OA (опаловый), Bleach (максимально белый).

Макет дополнительной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический нанокомпозитный реставрационный универсальный Bisico Nanofill n.

**Материал стоматологический композитный светоотверждаемый
Bisico для пломбирования зубов**

**Материал стоматологический композитный светоотверждаемый
Bisico Nanofill unique**

Артикул: XXXXXX¹

Комплектность: См. Эксплуатационную документацию –
«Инструкция краткая по применению Материала
стоматологического композитного
светоотверждаемого Bisico Nanofill unique»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 5 лет

Рекомендуемые условия хранения Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс
25°С

Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ

(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

1. В данной строке будет указан один из следующих артикулов: 74160, 74161

**Макет дополнительной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический
композитный светоотверждаемый Bisico Nanofill unique**

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Nanofill flow

Артикул: XXXXXX¹
Цвет: XX²
Комплектность* См. Эксплуатационную документацию – «Инструкция краткая по применению материала стоматологического жидкотекучего реставрационного Bisico Nanofill flow»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 4 года
Рекомендуемые Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс 25°С
условия хранения Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ
(Bisico Bielefelder Dentalsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

1. В данной строке будет указан один из следующих артикулов: 74062, 74061, 74060, 74070.

2. В данной строке будет указано одно из следующих обозначений цветовых оттенков: A1, A2, A3, A3.5.

Макет дополнительной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Nanofill flow

**Материал стоматологический композитный светоотверждаемый
Bisico для пломбирования зубов**

**Материал стоматологический композитный микрогибридный
реставрационный Bisico Micro Esthetic**

Артикул: XXXXXX¹
Цвет: XX²
Комплектность: См. Эксплуатационную документацию –
«Инструкция краткая по применению материала
стоматологического композитного
микрогибридного реставрационного Bisico Micro
Esthetic»

РУ № _____ от « ____ » _____ Г.

Срок годности 4 года
Рекомендуемые Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс
условия хранения 25°С
Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

**Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ
(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия**

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

1. В данной строке будет указан один из следующих артикулов: 75003, 75000, 75001, 75002, 75007, 75008, 75004, 75005, 75009, 75014, 75103, 75100, 75101, 75102, 75104, 75013.

2. В данной строке будет указано одно из следующих обозначений цветовых оттенков: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, серый, ОА (опиловый), С (прозрачный), Bleach (максимально белый)

Макет дополнительной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический композитный микрогибридный реставрационный Bisico Micro Esthetic

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetic flow-viscous

Артикул: XXXXXX¹

Цвет: XX²

Комплектность: См. Эксплуатационную документацию – «Инструкция краткая по применению материала стоматологического жидкотекучего реставрационного Bisico Micro Esthetic flow-viscous»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 4 года

Рекомендуемые Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс 25°С

условия хранения Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ

(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

1. В данной строке будет указан один из следующих артикулов: 75075, 75070, 75071, 75072.

2. В данной строке будет указано одно из следующих обозначений цветовых оттенков: A1, A2, A3, A3.5.

Макет дополнительной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetic flow-viscous

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetik Gingiva

Артикул: XXXXXX¹
Цвет: XX²
Комплектность: См. Эксплуатационную документацию – «Инструкция краткая по применению материала стоматологического жидкотекучего реставрационного Bisico Micro Esthetik Gingiva»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 4 года
Рекомендуемые условия хранения Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс 25°С
Относительная влажность воздуха не выше 50%.

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ
(Bisico Bielefelder Dental silicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

1. В данной строке будет указан один из следующих артикулов: 75076, 75077, 75078, 75079.

2. В данной строке будет указано одно из следующих обозначений цветовых оттенков: G-L, G-M, G-D, G-SD

Макет дополнительной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Micro Esthetik Gingiva

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Адгезив стоматологический Bisico Bond LC

Артикул: 75260

Комплектность: См. Эксплуатационную документацию – «Инструкция краткая по применению адгезива стоматологического Bisico Bond LC»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 2 года

Рекомендуемые Температурный диапазон: от плюс 10 °C до плюс 25°C

условия хранения Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ

(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

Макет дополнительной этикетки на русском языке Адгезива стоматологического Bisico Bond LC

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Адгезив стоматологический Bisico E-Bond DC

Артикул: 75250

Комплектность: См. Эксплуатационную документацию – «Инструкция краткая по применению адгезива стоматологического Bisico E-Bond DC»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 2 года

Рекомендуемые Температурный диапазон: от плюс 10 °C до плюс 25°C

условия хранения Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ

(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

Макет дополнительной этикетки на русском языке Адгезива стоматологического Bisico E-Bond DC

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Адгезив стоматологический Bisico E-Bond LC

Артикул: 75265

Комплектность: См. Эксплуатационную документацию – «Инструкция краткая по применению адгезива стоматологического Bisico E-Bond LC»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 2 года

Рекомендуемые Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс 25°С

условия хранения Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ

(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:

ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64

Макет дополнительной этикетки на русском языке Адгезива стоматологического Bisico E-Bond LC

Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico для пломбирования зубов

Гель протравочный Bisico Best Etch

Артикул: 75280

Комплектность: См. Эксплуатационную документацию – «Инструкция краткая по применению геля протравочного Bisico Best Etch»

РУ № _____ от « ____ » _____ г.

Срок годности 2 года

Рекомендуемые Температурный диапазон: от плюс 10 °С до плюс 25°С

условия хранения Относительная влажность воздуха не выше 50%

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией!

Только для профессионального применения!

Информацию на этикетке считать приоритетной!

Производитель:

Бисико Билефельдер Денталсиликон ГмбХ энд Ко. КГ

(Bisico Bielefelder Dentsilicone GmbH & Co. KG), Germany, Германия

Эксклюзивный дистрибьютор:


ООО «Здоровье» www.zd-m.ru

+7(495) 504-10-64



Макет дополнительной этикетки на русском языке Геля протравочного Bisico Best Etch



Пример упаковки с макетом маркировочной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический нанокомпозитный реставрационный универсальный Bisico Nanofill n

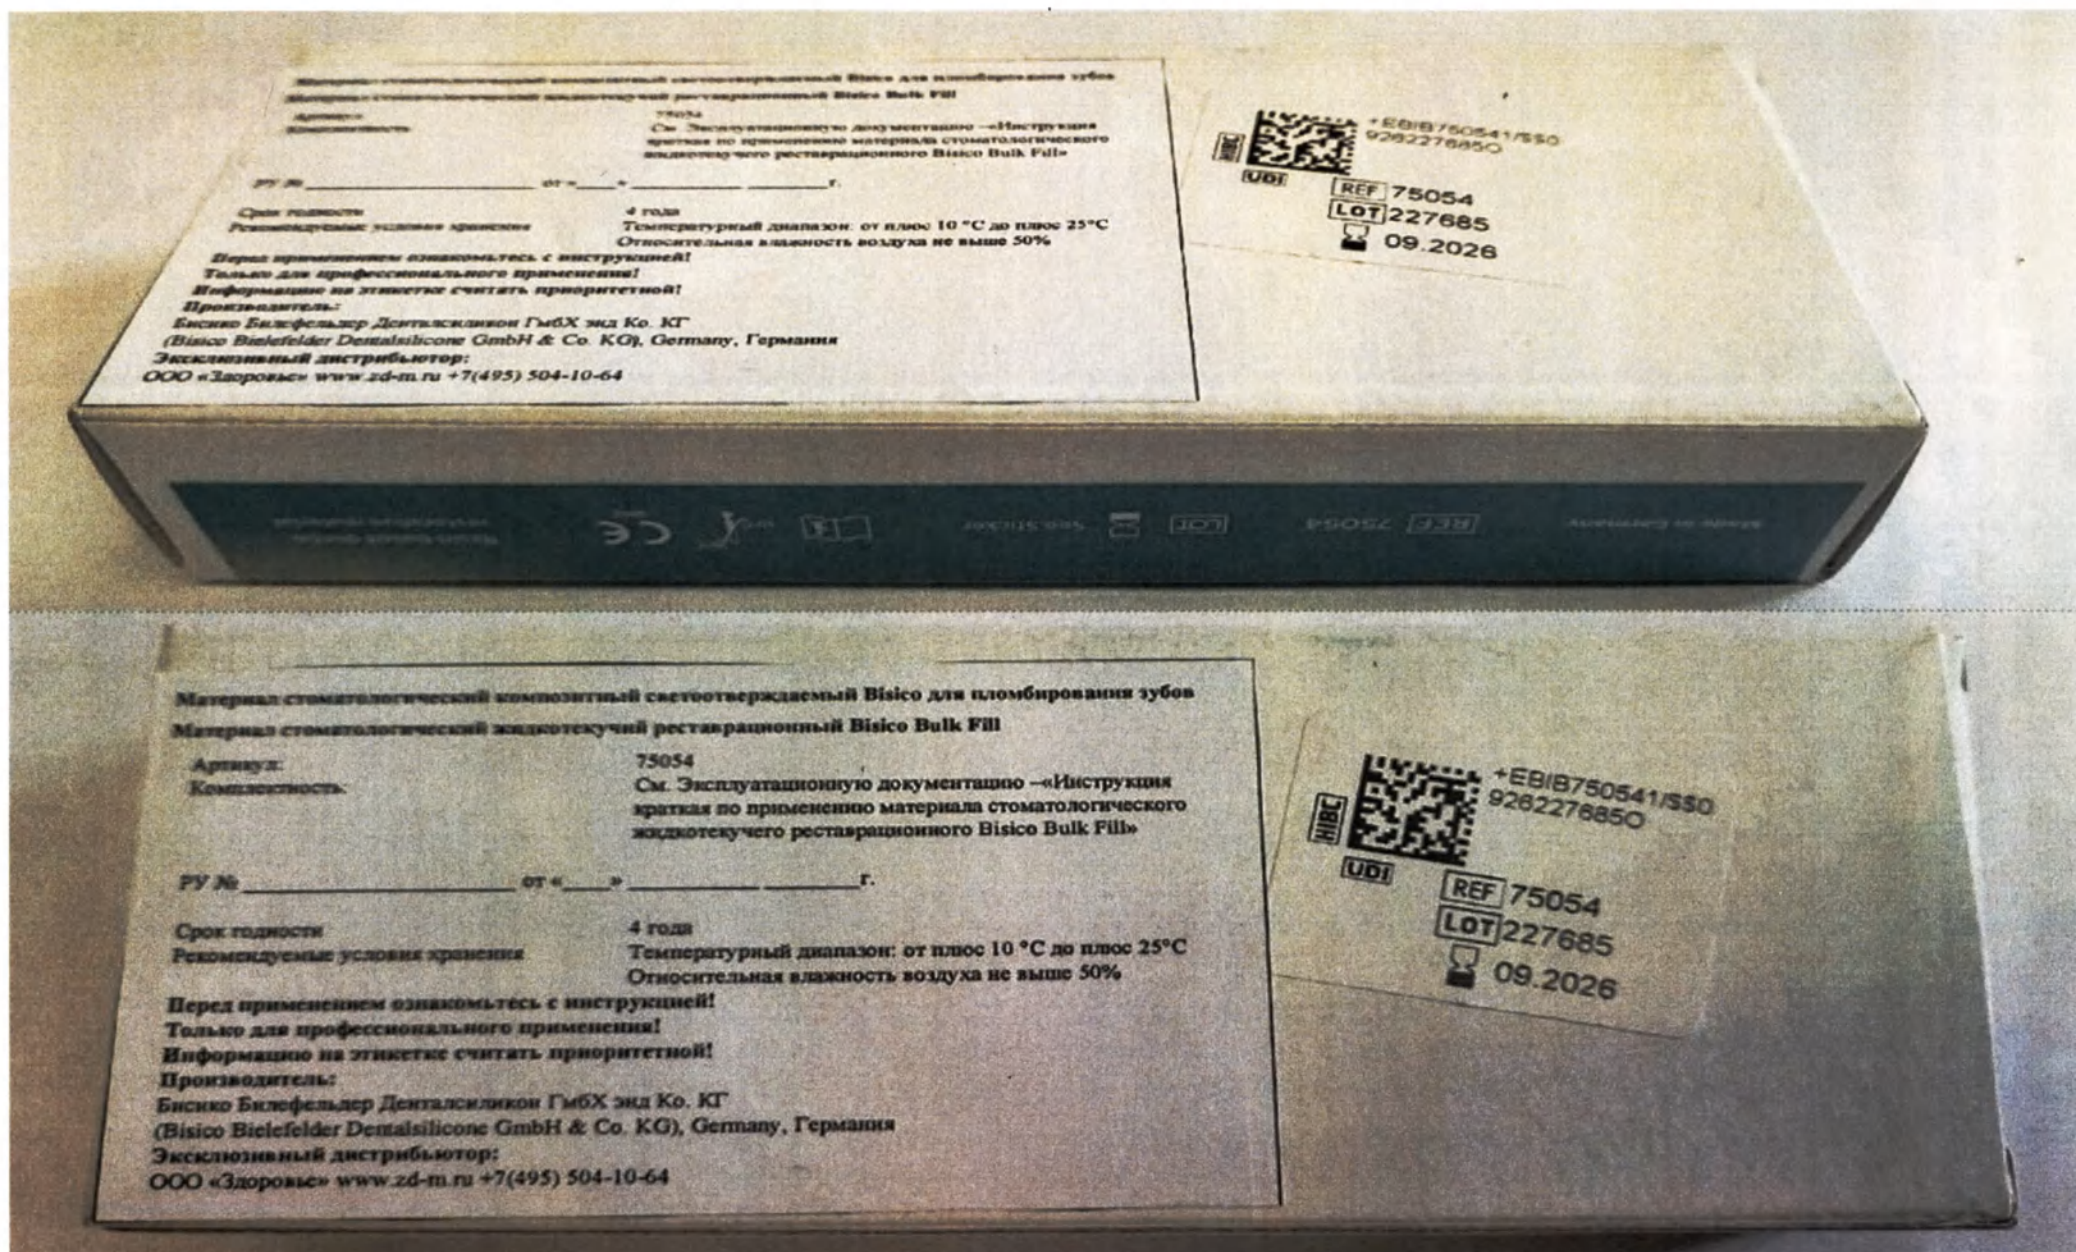

Пример упаковки с макетом маркировочной этикетки на русском языке варианта исполнения Материал стоматологический жидкотекучий реставрационный Bisico Bulk Fill в шприце

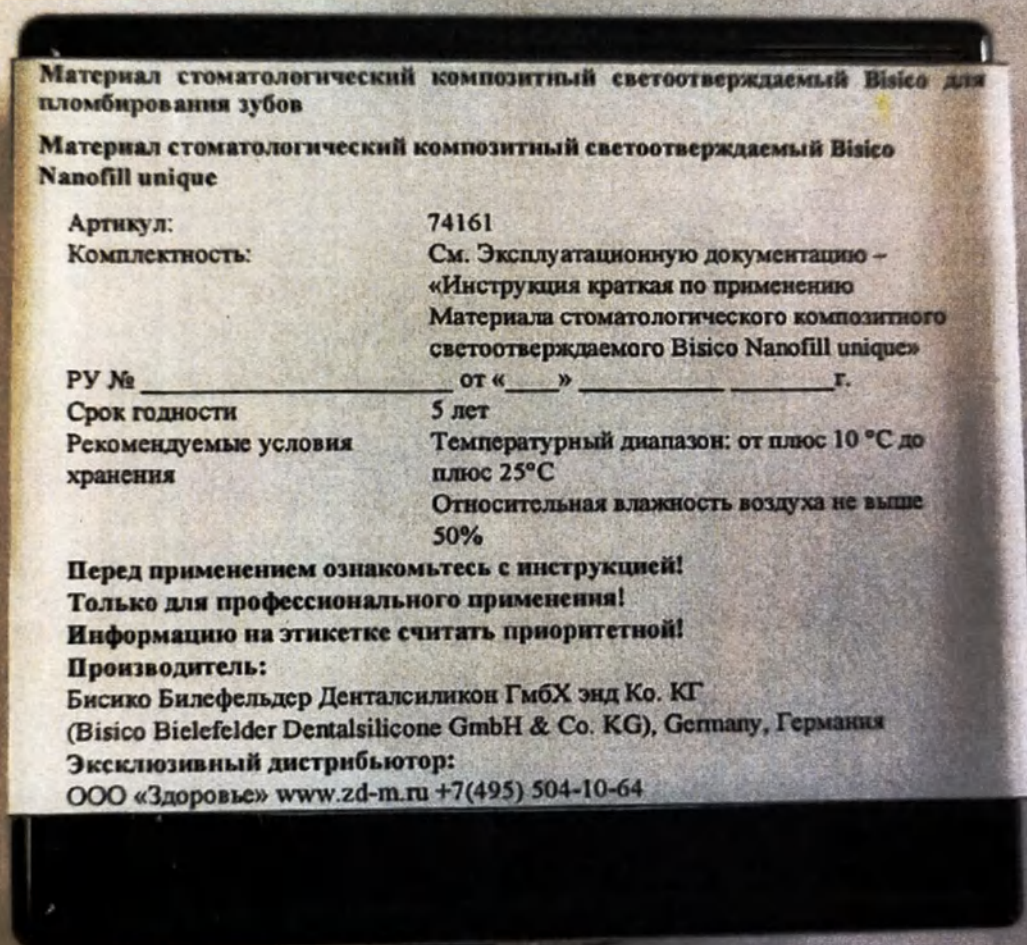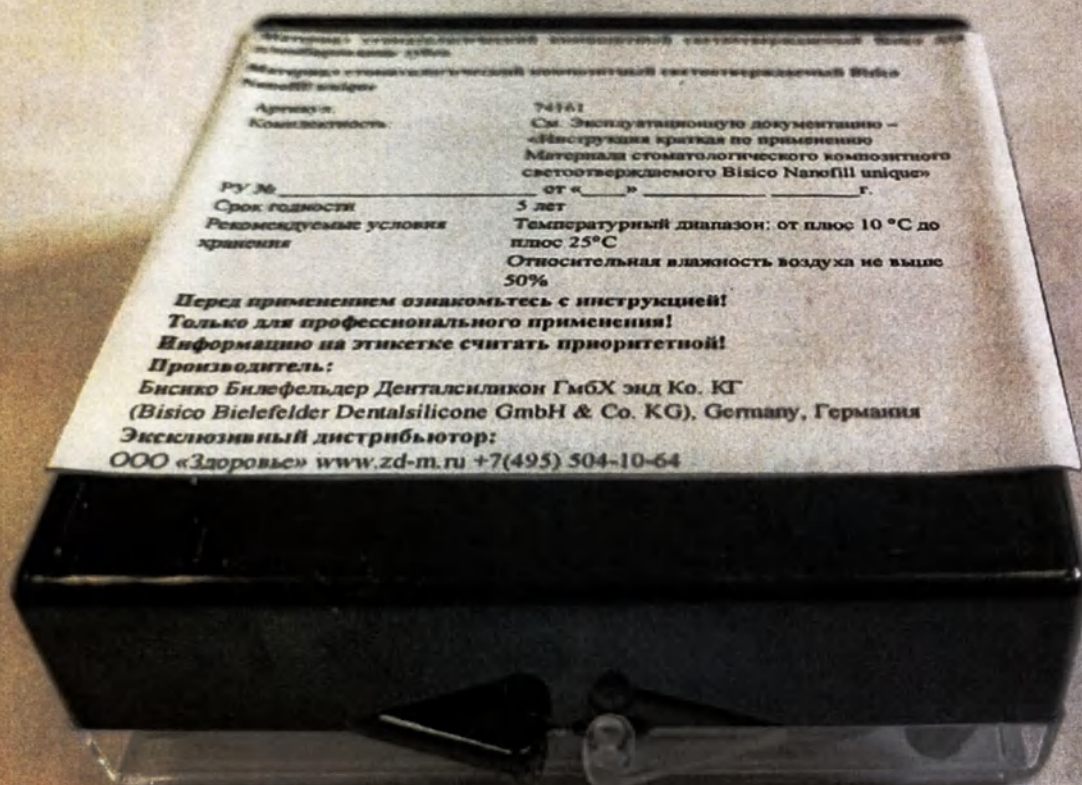

Пример упаковки с макетом маркировочной этикетки на русском языке варианта исполнения
Материал стоматологический композитный светоотверждаемый Bisico Nanofill unique в
капсуле



Транспортная упаковка. Вид спереди.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью:

38 страниц восемь листа(ов)

Генеральный директор
ООО «Здоровье» В.А. Курбатов

