

ACKNOWLEDGMENT

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

State of California
County of ORANGE

On November 24, 2023 before me, Justin Ryan Sur, Notary Public
(insert name and title of the officer)

personally appeared Dhiren Mehta - - - - -
who proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) whose name(s) is/are subscribed to the within instrument and acknowledged to me that he/she/they executed the same in his/her/their authorized capacity(ies), and that by his/her/their signature(s) on the instrument the person(s), or the entity upon behalf of which the person(s) acted, executed the instrument.

I certify under PENALTY OF PERJURY under the laws of the State of California that the foregoing paragraph is true and correct.

WITNESS my hand and official seal.

Signature



(Seal)





«Подтверждаю точность, правильность и
here by certify accuracy, correctness and
достоверность содержания текста перевода
reliability of this document translated
на русский язык»
into Russian

Макет этикеток на медицинское изделие: Носитель для витрификации, производства
Allwin Medical Devices Inc., USA (Олвин Медикал Девайсес Инк., США)


«УТВЕРЖДАЮ» /
«APPROVE»
Allwin Medical Devices Inc.,
USA (Олвин Медикал
Девайсес Инк., США)

Генеральный директор/ Chief
Executive Officer

Dhiren Mehta
(Дхирен Мехта)

(подпись/signature)

М.П./Stamp

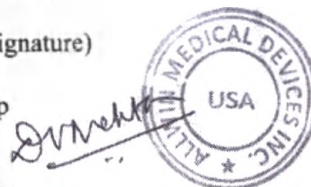

“13” 10 2023
«день» месяц (цифрами) /
«day» month (numerals)

Макет этикеток: Носитель для витрификации

Этикетка первичной упаковки	Этикетка вторичной упаковки
SureStrip - Blue 	
SureStrip - Red 	
SureStrip - Yellow 	
SureStrip - Ivory 	
SureStrip - White 	
SureStrip Weighted - Blue 	
SureStrip Weighted - Red 	

allwin® Носитель для витрификации SureStrip Weighted- Red

REF: SUS-R-WT LOT: PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

allwin® Носитель для витрификации SureStrip Weighted- Red

REF: SUS-R-WT LOT: PGTMMDD-# Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/У № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

SureStrip Weighted - Yellow

allwin® Носитель для витрификации SureStrip Weighted- Yellow

REF: SUS-Y-WT LOT: PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

allwin® Носитель для витрификации SureStrip Weighted- Yellow

REF: SUS-Y-WT LOT: PGTMMDD-# Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/У № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

SureStrip Weighted - Ivory

allwin® Носитель для витрификации SureStrip Weighted- Ivory

REF: SUS-I-WT LOT: PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

allwin® Носитель для витрификации SureStrip Weighted- Ivory

REF: SUS-I-WT LOT: PGTMMDD-# Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/У № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

SureStrip Weighted - White

allwin® Носитель для витрификации SureStrip Weighted- White

REF: SUS-W-WT LOT: PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

allwin® Носитель для витрификации SureStrip Weighted- White

REF: SUS-W-WT LOT: PGTMMDD-# Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/У № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

SureLock - Green

allwin® Носитель для витрификации SureLock - Green

REF: SUL-G LOT: PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

allwin® Носитель для витрификации SureLock - Green

REF: SUL-G LOT: PGTMMDD-# Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/У № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

SureLock - Blue

allwin® Носитель для витрификации SureLock - Blue

REF: SUL-B LOT: PGTMMDD-# PTTT-MM PTTT-MM

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

allwin® Носитель для витрификации SureLock - Blue

REF: SUL-B LOT: PGTMMDD-# Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80% Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/У № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Миралома Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

SureLock - Yellow



Носитель для витрификации SureLock - Yellow

REF: SUL-Y LOT: РГТММД-#

STERILE R Не токсично

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80%

Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Мираломе Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com



Носитель для витрификации SureLock - Yellow

REF: SUL-Y LOT: РГТММД-#

STERILE R Не токсично

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80%

Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/г № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Мираломе Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

SureLock-Pink



Носитель для витрификации SureLock - Pink

REF: SUL-P LOT: РГТММД-#

STERILE R Не токсично

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80%

Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Мираломе Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com



Носитель для витрификации SureLock - Pink

REF: SUL-P LOT: РГТММД-#

STERILE R Не токсично

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80%

Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/г № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Мираломе Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

SureLock - Violet



Носитель для витрификации SureLock - Violet

REF: SUL-V LOT: РГТММД-#

STERILE R Не токсично

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80%

Количество: 1 шт.

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Мираломе Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com



Носитель для витрификации SureLock - Violet

REF: SUL-V LOT: РГТММД-#

STERILE R Не токсично

• Эндотоксины (LAL) ≤ 2 ЕЗ/изделие
• MEA ≥ 80%

Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель в России: ООО "Гера", 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416 Р/г № _____ от _____

Олвин Медикал Девайсес, Инк. 3305 Ист-Мираломе Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США эл.почта: info@allwinmedical.com, сайт: www.allwinmedical.com

Этикетка транспортной упаковки




Олвин Медикал Девайсес, Инк.
3305 Ист-Мираломе-Авеню, оф. 176 Анахайм, Калифорния 92806 США
эл.почта: info@allwinmedical.com,
сайт: www.allwinmedical.com

Грузополучатель:
ООО "Гера", Россия, 620026, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 оф. 416

Вес брутто транспортной упаковки: XX кг

Условия транспортировки: до 24 часов от -18°C при неконтролируемой относительной влажности до +40°C и относительной влажности 15%



НОТАРИАЛЬНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Нотариус или иное должностное лицо, оформляющее настоящее свидетельство, удостоверяет только личность лица, подписавшего документ, к которому прилагается настоящее свидетельство, а не достоверность, точность или действительность этого документа.

Штат Калифорния
Округ ОРИНДЖ

24 ноября 2023 года, ко мне, нотариусу Джастину Райану Суру,
(укажите имя и должность должностного лица)

лично обратился Дхирен Мехта,
который, приведя убедительные доказательства, подтвердил, что он является лицом, чье имя указано в прилагаемом документе, а также то, что он составил его в рамках своих полномочий, и что его подписью на документе лицо или организация, от имени которой он действует, оформляет настоящий официальный документ.

Под страхом ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ в соответствии с законодательством штата Калифорния подтверждаю, что вышеприведенный абзац является подлинным и верным.

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНО моей подписью и официальной печатью.

ДЖАСТИН РАЙАН СУР
ЛИЦЕНЗИЯ № 2355368
НОТАРИУС - КАЛИФОРНИЯ
Округ Ориндж
Срок моих полномочий истекает 23.04.2025

Подпись

/подпись/

(Печать)

Я, *Ермакова Надежда Алексеевна*, квалифицированный переводчик английского и русского языков, подтверждаю, что вышеприведенное является верным и точным переводом оригинального документа.

Подпись переводчика

Ермакова Надежда Алексеевна

Российская Федерация
Город Екатеринбург Свердловской области
Четырнадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года
Я, Филиппова Ольга Владимировна, нотариус города Екатеринбурга,
свидетельствую подлинность подписи переводчика Ермаковой Надежды Алексеевны.
Подпись сделана в моем присутствии.
Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 66/201-н/66-2023-1-163.

Уплачено за совершение нотариального действия: 850 руб. 00 коп.

О.В. Филиппова



Проставлено, пронумеровано
и скреплено печатью
(лист)
Нотариус Филиппова О.В.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Носитель для витрификации»:

Варианты исполнения:

I. SureStrip

1. SureStrip - Blue
2. SureStrip - Red
3. SureStrip - Yellow
4. SureStrip - Ivory
5. SureStrip - White

II. SureStrip Weighted

1. SureStrip Weighted - Blue
2. SureStrip Weighted- Red
3. SureStrip Weighted- Yellow
4. SureStrip Weighted- Ivory
5. SureStrip Weighted- White

III. SureLock


1. SureLock -Green
2. SureLock -Blue
3. SureLock -Yellow
4. SureLock -Pink
5. SureLock -Violet.

Директор ООО «Гера»




В.В.Шестопалов


Общий вид носителя для витрификации SureStrip - Blue

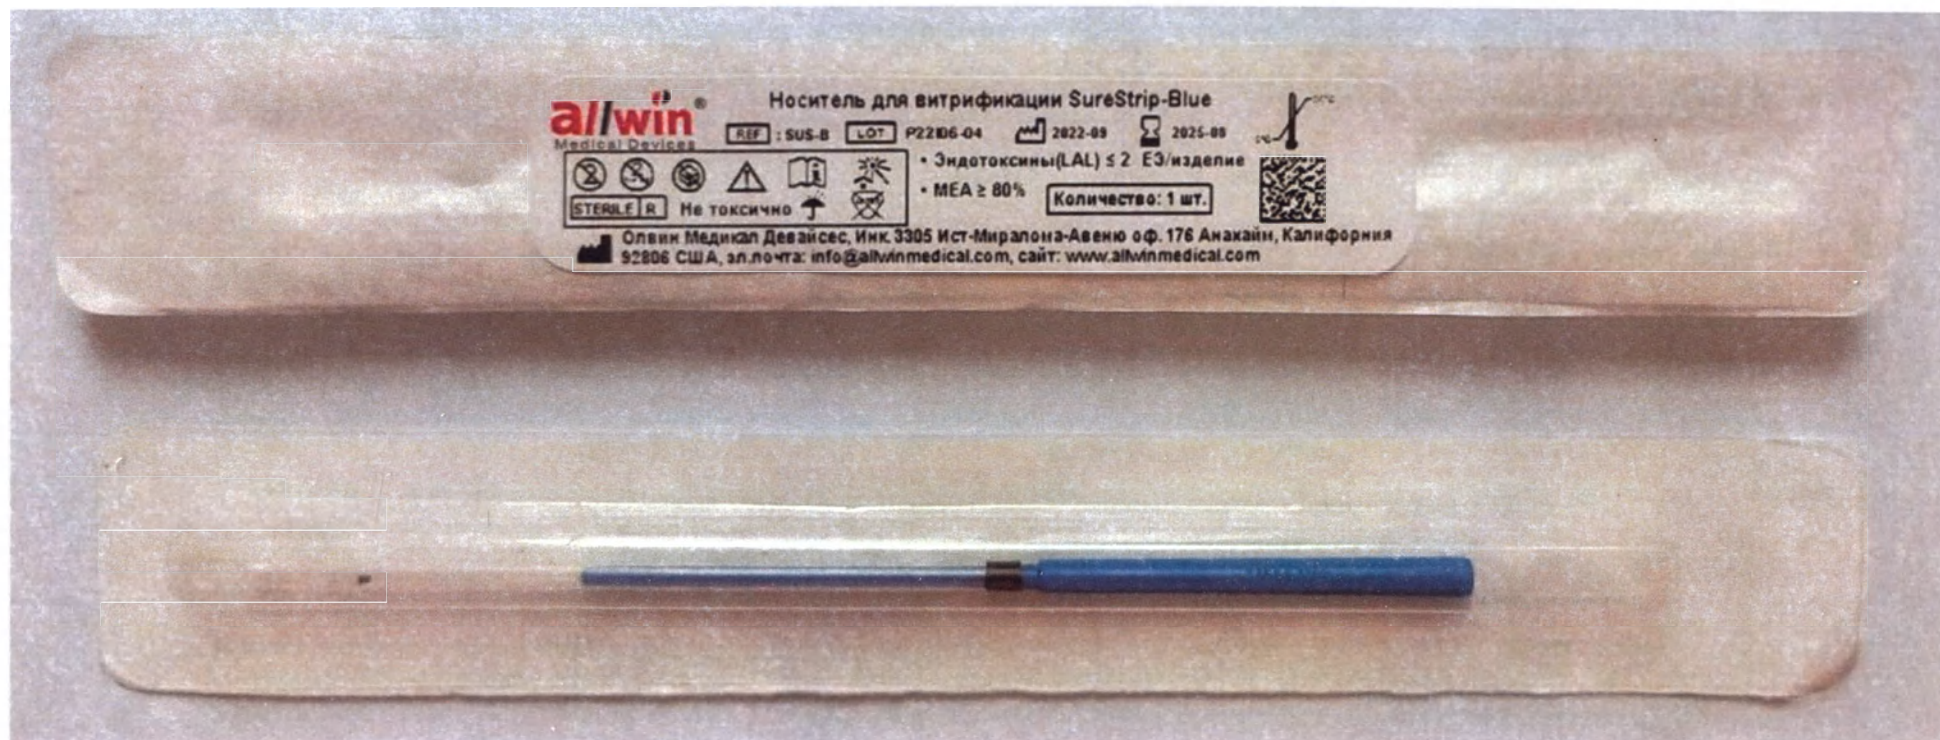

Общий вид носителя для витрификации SureStrip - Red

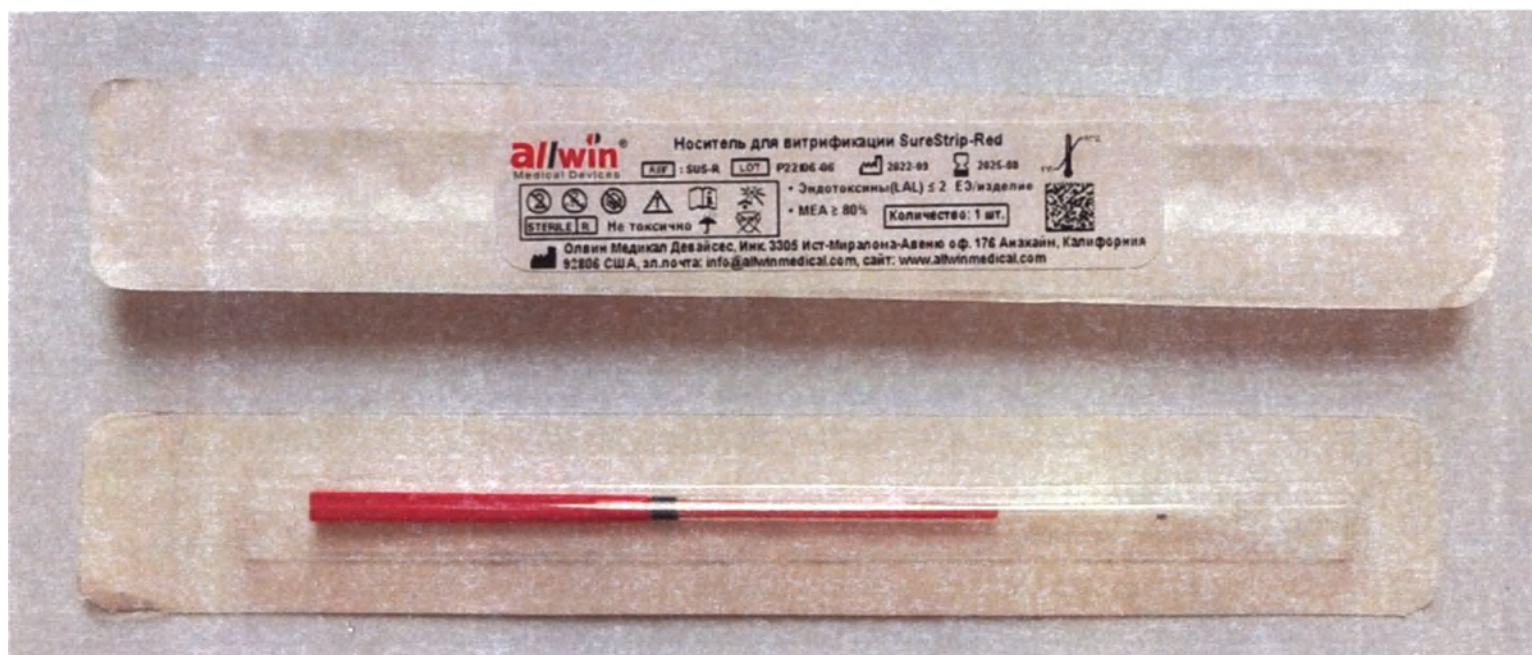


Общий вид носителя для витрификации SureStrip - Yellow

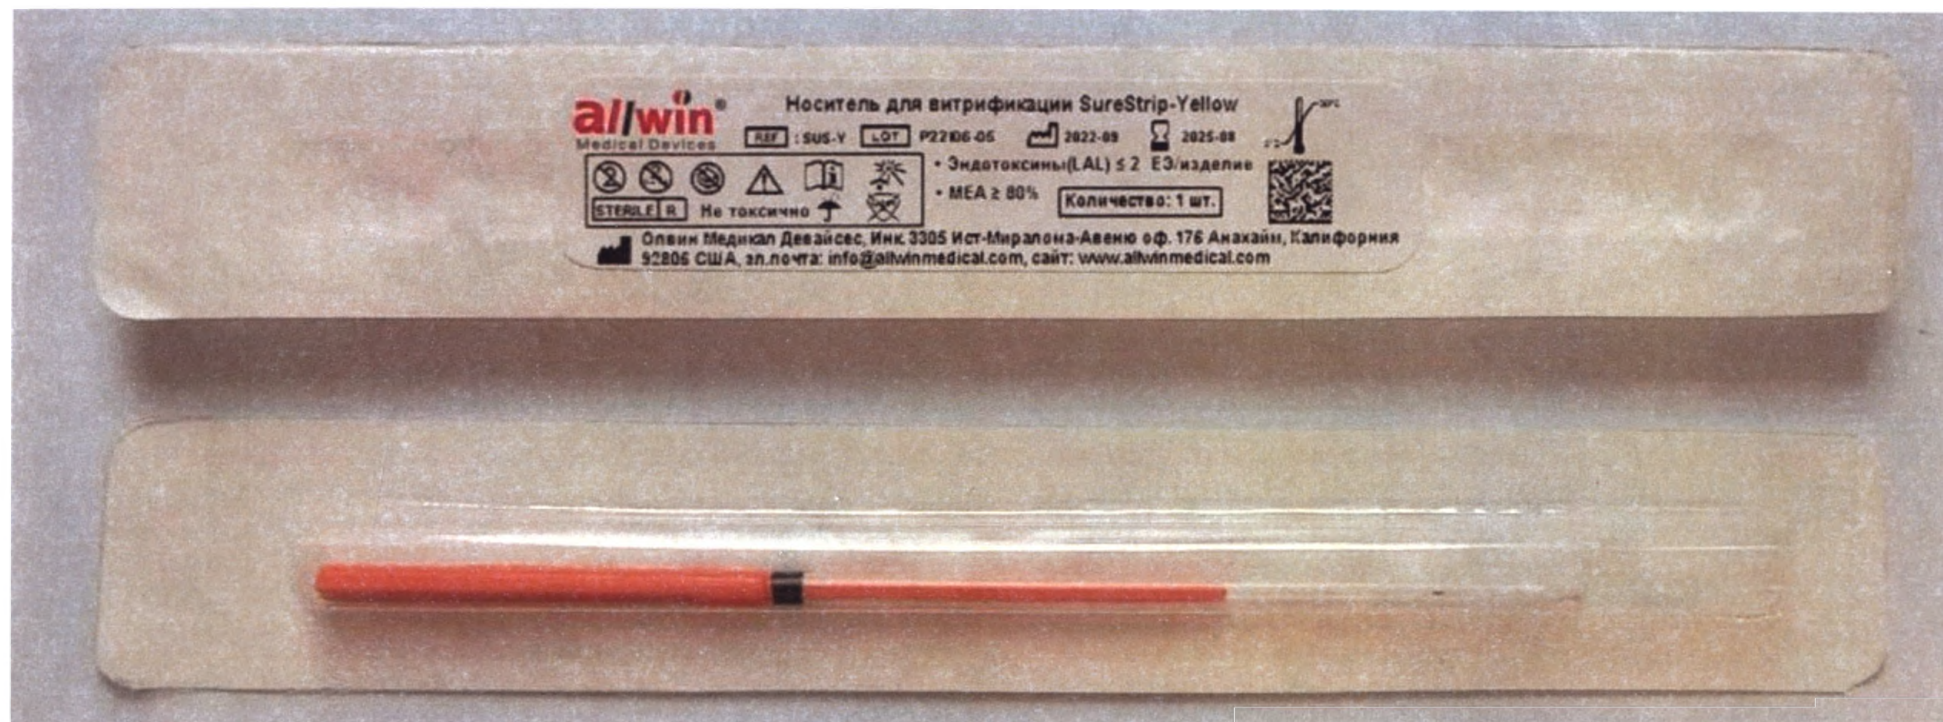

Общий вид носителя для витрификации SureStrip – Ivory




Общий вид носителя для витрификации SureStrip – White

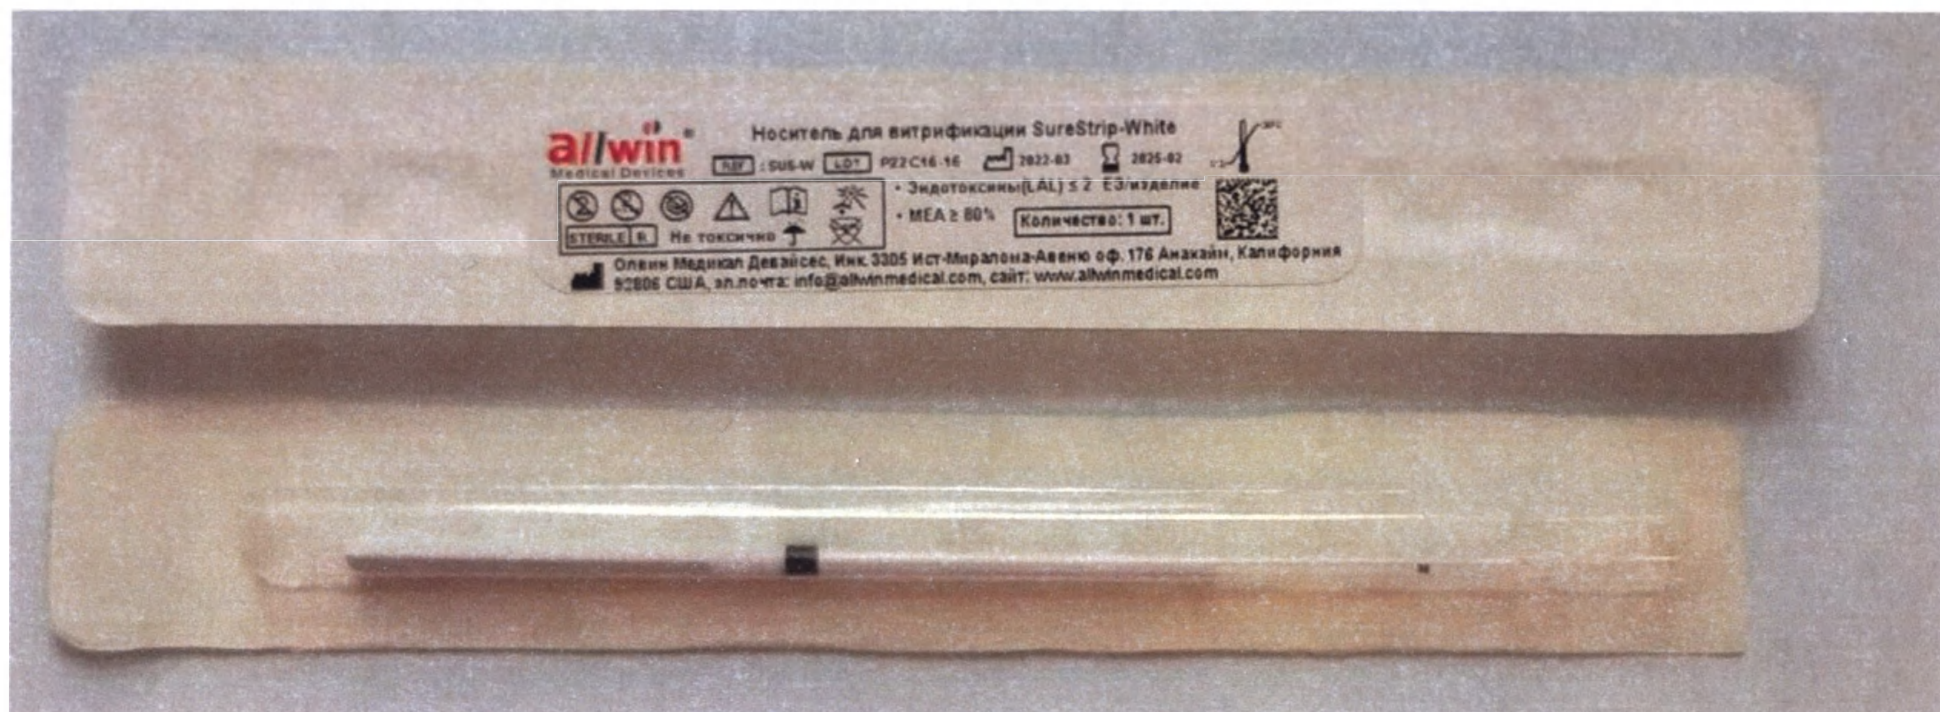

Общий вид носителя для витрификации SureStrip Weighted – Blue





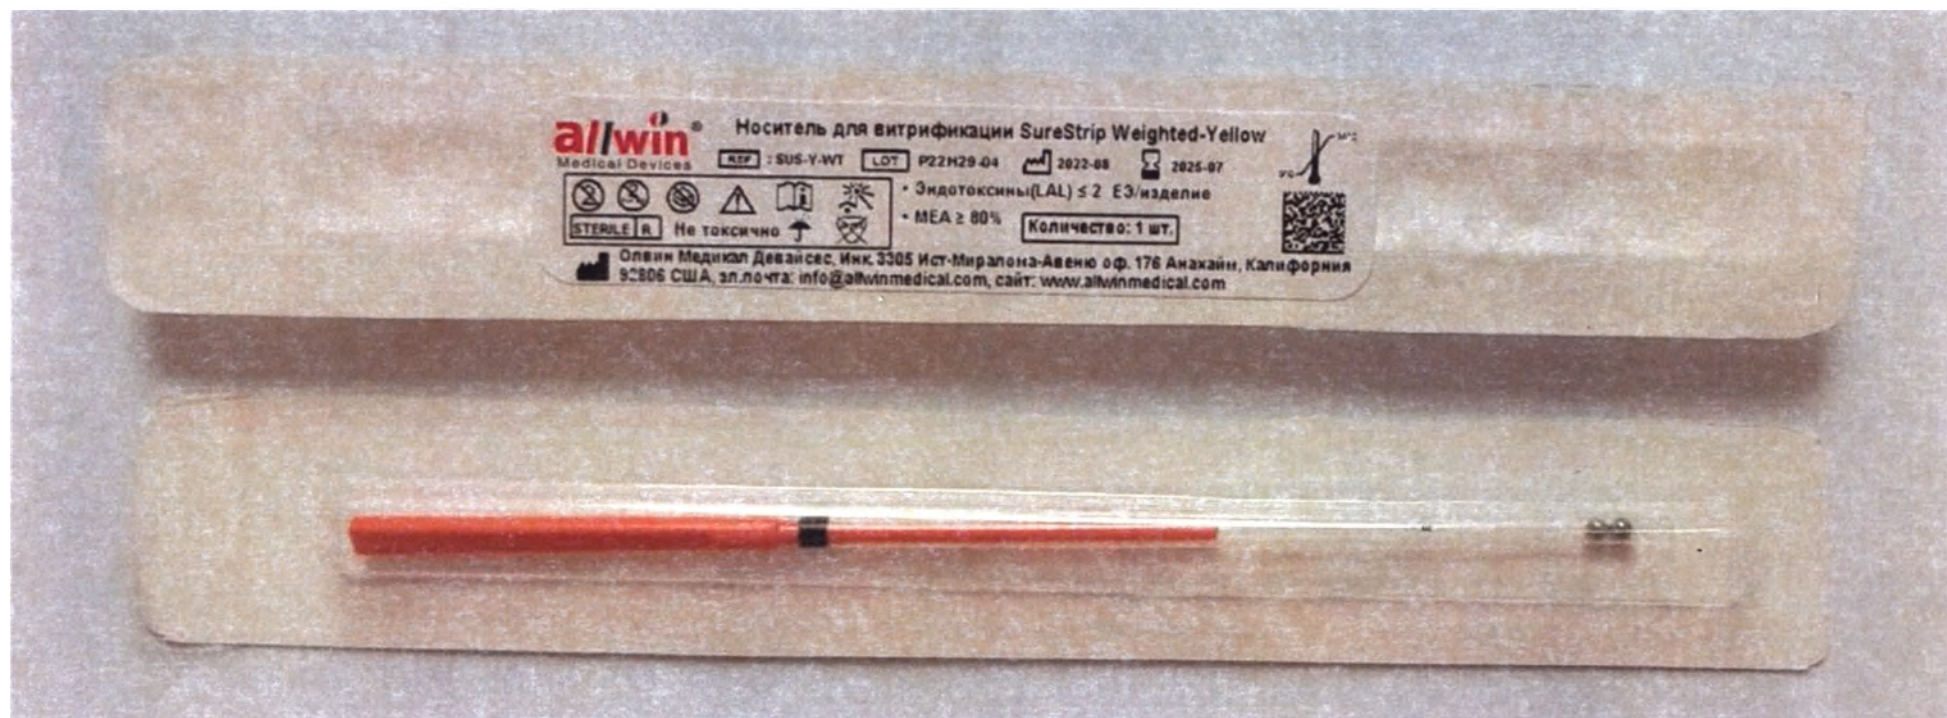


Общий вид носителя для витрификации SureStrip Weighted- Ivory




Общий вид носителя для витрификации SureStrip Weighted- White



Общий вид носителя для витрификации SureLock -Green

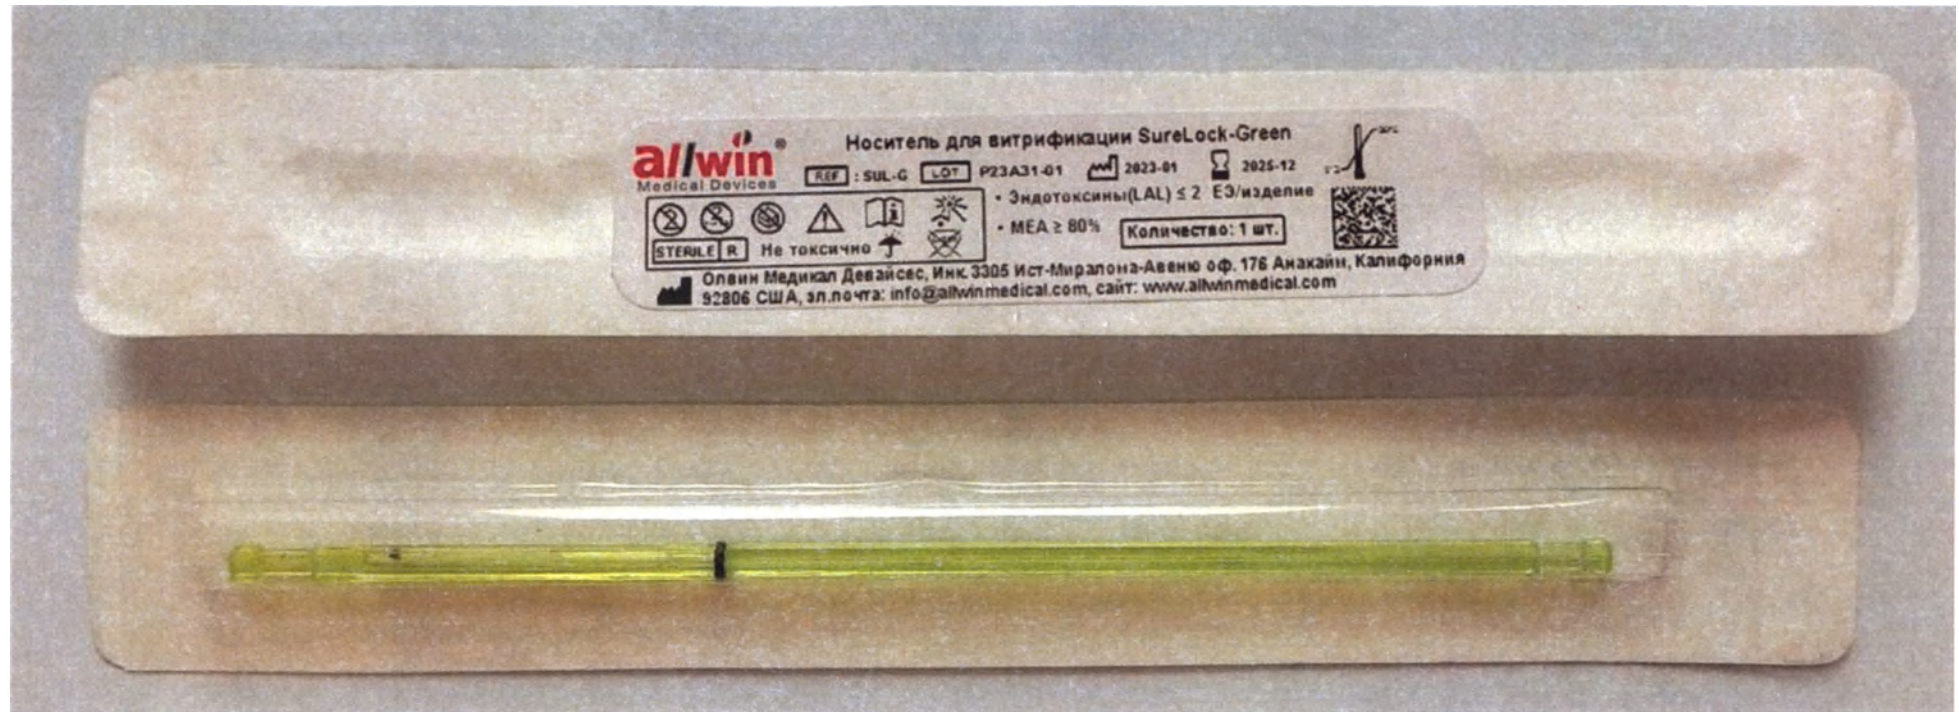


Общий вид носителя для витрификации SureLock -Blue

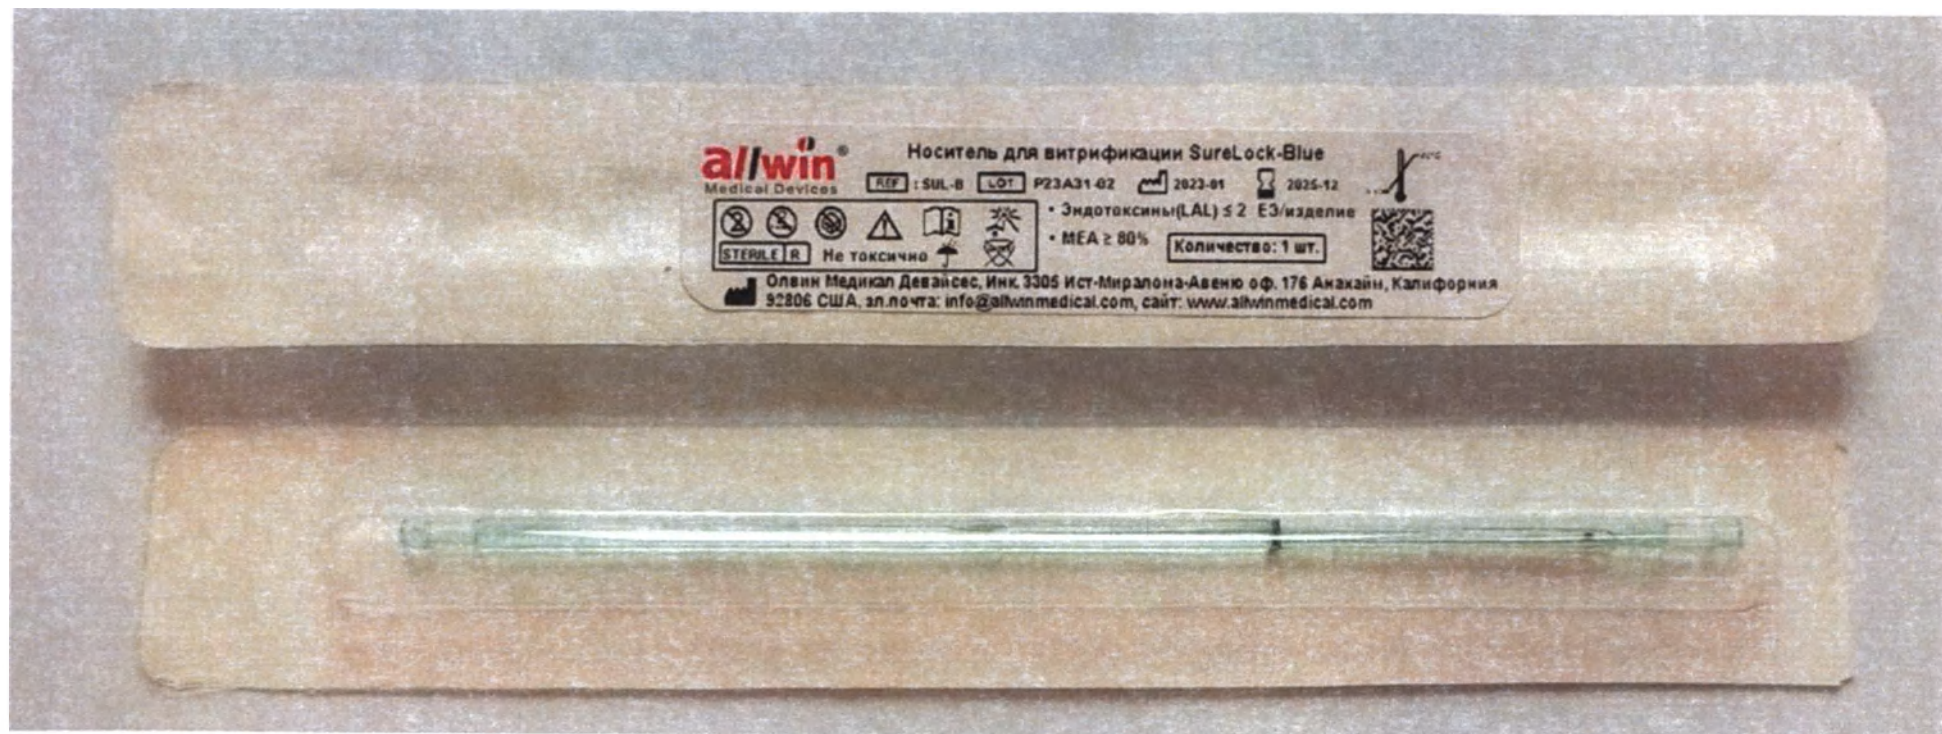


Общий вид носителя для витрификации SureLock -Yellow



Общий вид носителя для витрификации SureLock -Pink

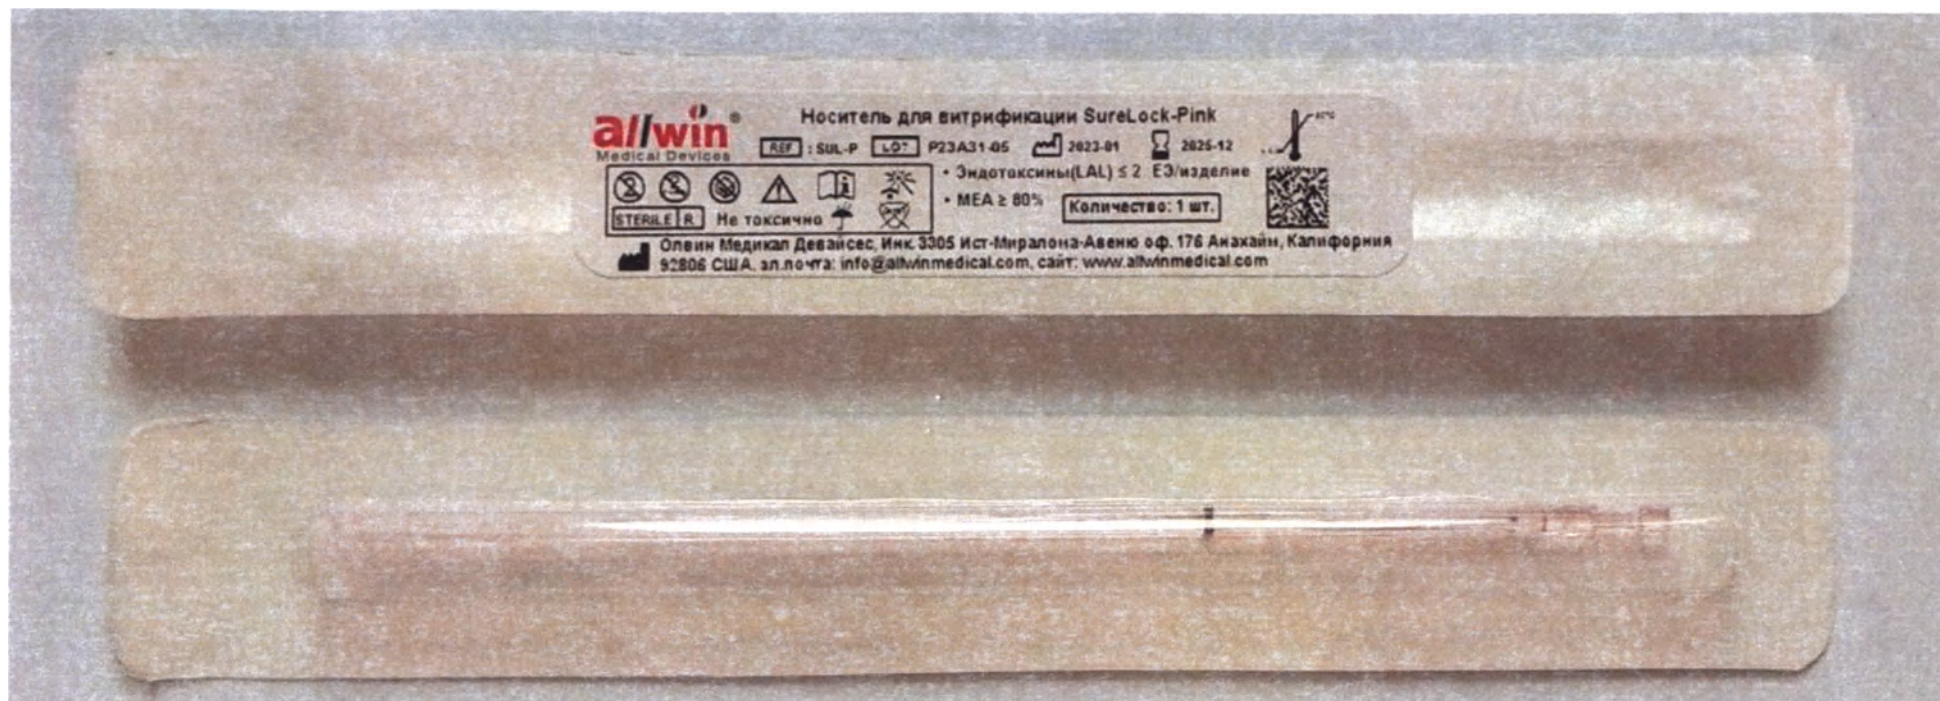

Общий вид носителя для витрификации SureLock -Violet

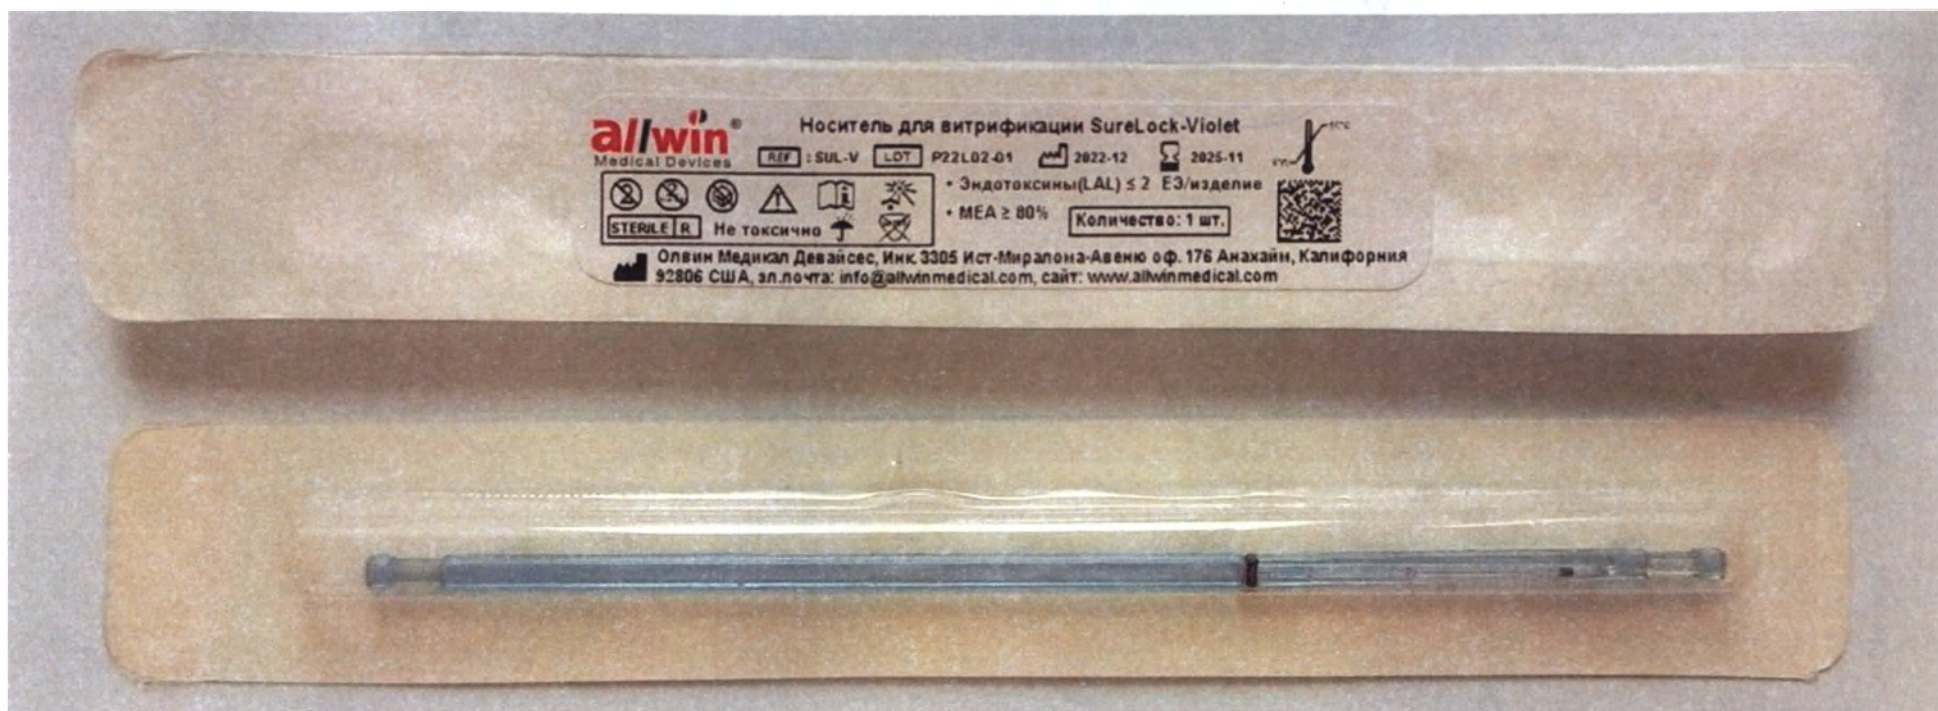

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 16 листа (-ов)

Директор

В.В.Шестопалов

